


Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения общих желчных кислот
в сыворотке или плазме крови человека энзиматическим циклическим
колориметрическим методом на биохимических анализаторах Alinity c
«Желчные кислоты общие Реагенты (Alinity c Total Bile Acids Reagent Kit)»**

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации
Желчные кислоты общие Реагенты (Alinity с Total Bile Acids Reagent Kit), Кат. № 08P5722



08P5722



Набор реагентов для количественного определения общих желчных кислот в сыворотке или плазме крови человека энзиматическим циклическим колориметрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Желчные кислоты общие Реагенты (Alinity с Total Bile Acids Reagent Kit)»

4 картриджа по 50 тестов в составе:

- Реагент 1 (Alinity с Total Bile Acids Reagent 1) – 4 x 16,1 мл;
- Реагент 2 (Alinity с Total Bile Acids Reagent 2) – 4 x 7,6 мл;

Инструкция по применению.

Производитель: «СЕНТИНЕЛЬ К. С.п.А.» (SENTINEL CH. S.p.A.), Via Robert Koch, 2, Milano (MI), 20152, Italy (Италия)

Место производства: SENTINEL CH. S.p.A., Via Robert Koch, 2, Milano (MI), 20152, Italy

Страна происхождения: Италия

РУ № ____ / ____ от ____ / ____ / Инструкция по применению на русском языке:
www.corelaboratory.abbott

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:


Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия Желчные кислоты общие Реагенты (Alinity с Total Bile Acids Reagent Kit), Кат. № 08P5722

Bile Acids

Alinity с Total Bile Acids Reagent Kit

Abbott




Bile Acids

REF 08P5722



4 x 50



R1 4 x 16.1 mL

R2 4 x 7.6 mL



www.corelaboratory.abbott/IFU



LOT

G90927R02

IVD




SENTINEL CH. S.p.A.
Via Robert Koch, 2
Milano (MI)
20152, Italy
+39 02 345 514 1

PRODUCT OF ITALY



CONTAINS: AZIDE

Макет маркировки компонентов медицинского изделия Желчные кислоты общие Реагенты (Alinity c Total Bile Acids Reagent Kit), Кат. № 08P5722

		Bile Acids	
R1 16.1 mL   CONTAINS: AZIDE	Total Bile Acids R2 7.6 mL   CONTAINS: AZIDE  Exp. LOT G71058R01 		
SENTINEL CH. SpA Via Robert Koch, 2 Milan 20152 Italy G71121R01 		IVD	

Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования
ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования

Расшифровка символов представлена в инструкции.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4

листов


Подпись



Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения общих желчных кислот в сыворотке или плазме крови человека энзиматическим циклическим колориметрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Желчные кислоты общие Реагенты (Alinity с Total Bile Acids Reagent Kit)»

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

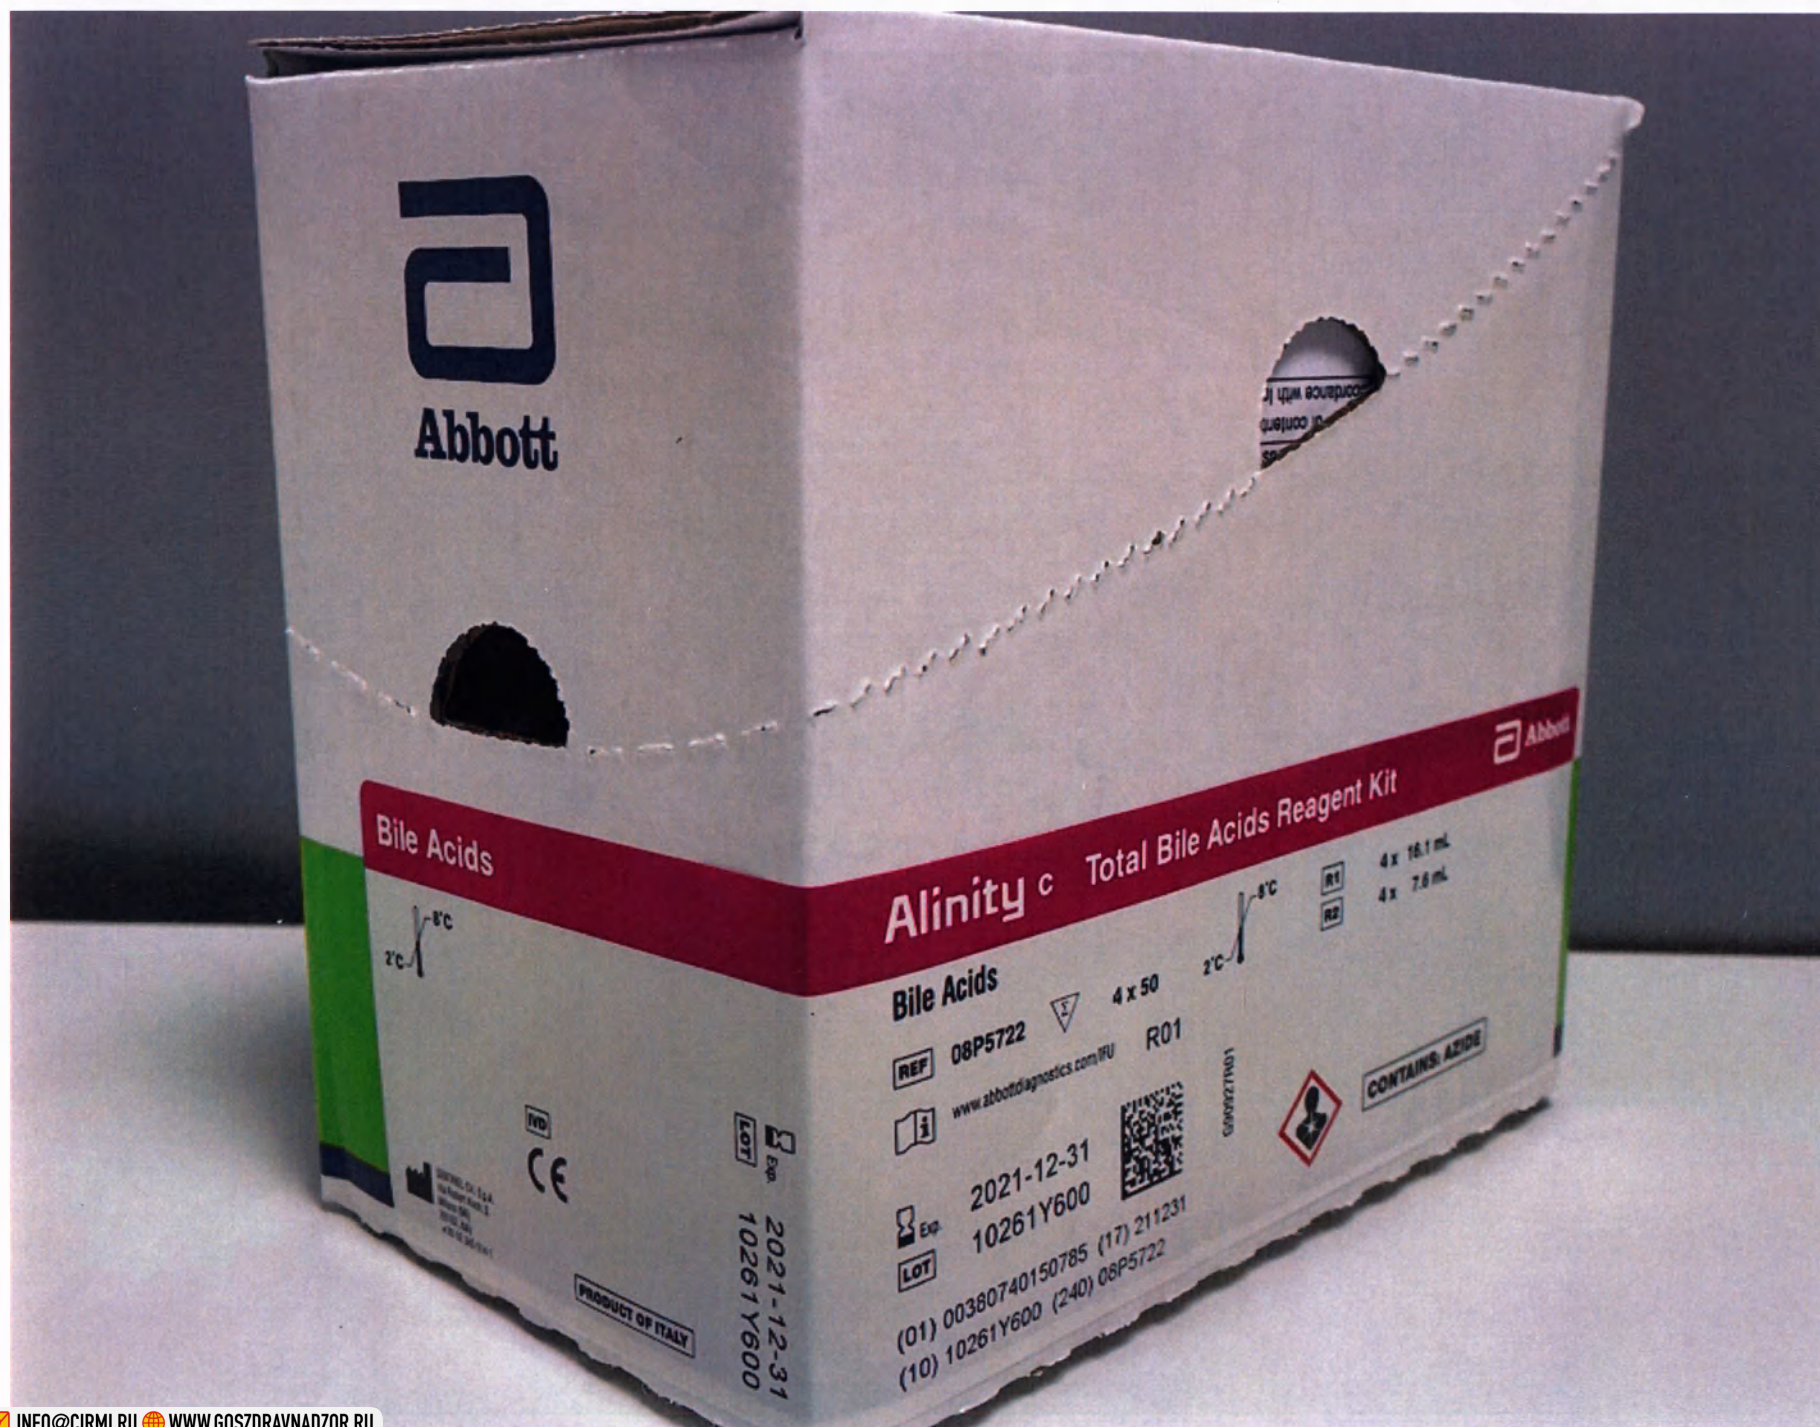





Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 листов



Подпись