


Фотографические изображения

Набор для детекции ultraView Universal DAB Detection Kit для обнаружения клеток-мишеней иммуногистохимическим методом для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark

Набор для детекции ultraView Universal DAB Detection Kit для обнаружения клеток-мишеней иммуногистохимическим методом для диагностики in vitro на иммуностейнерах автоматических серии BenchMark (общий вид)



Реагент ultraView Universal DAB Inhibitor в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт. (дозатор с реагентом)

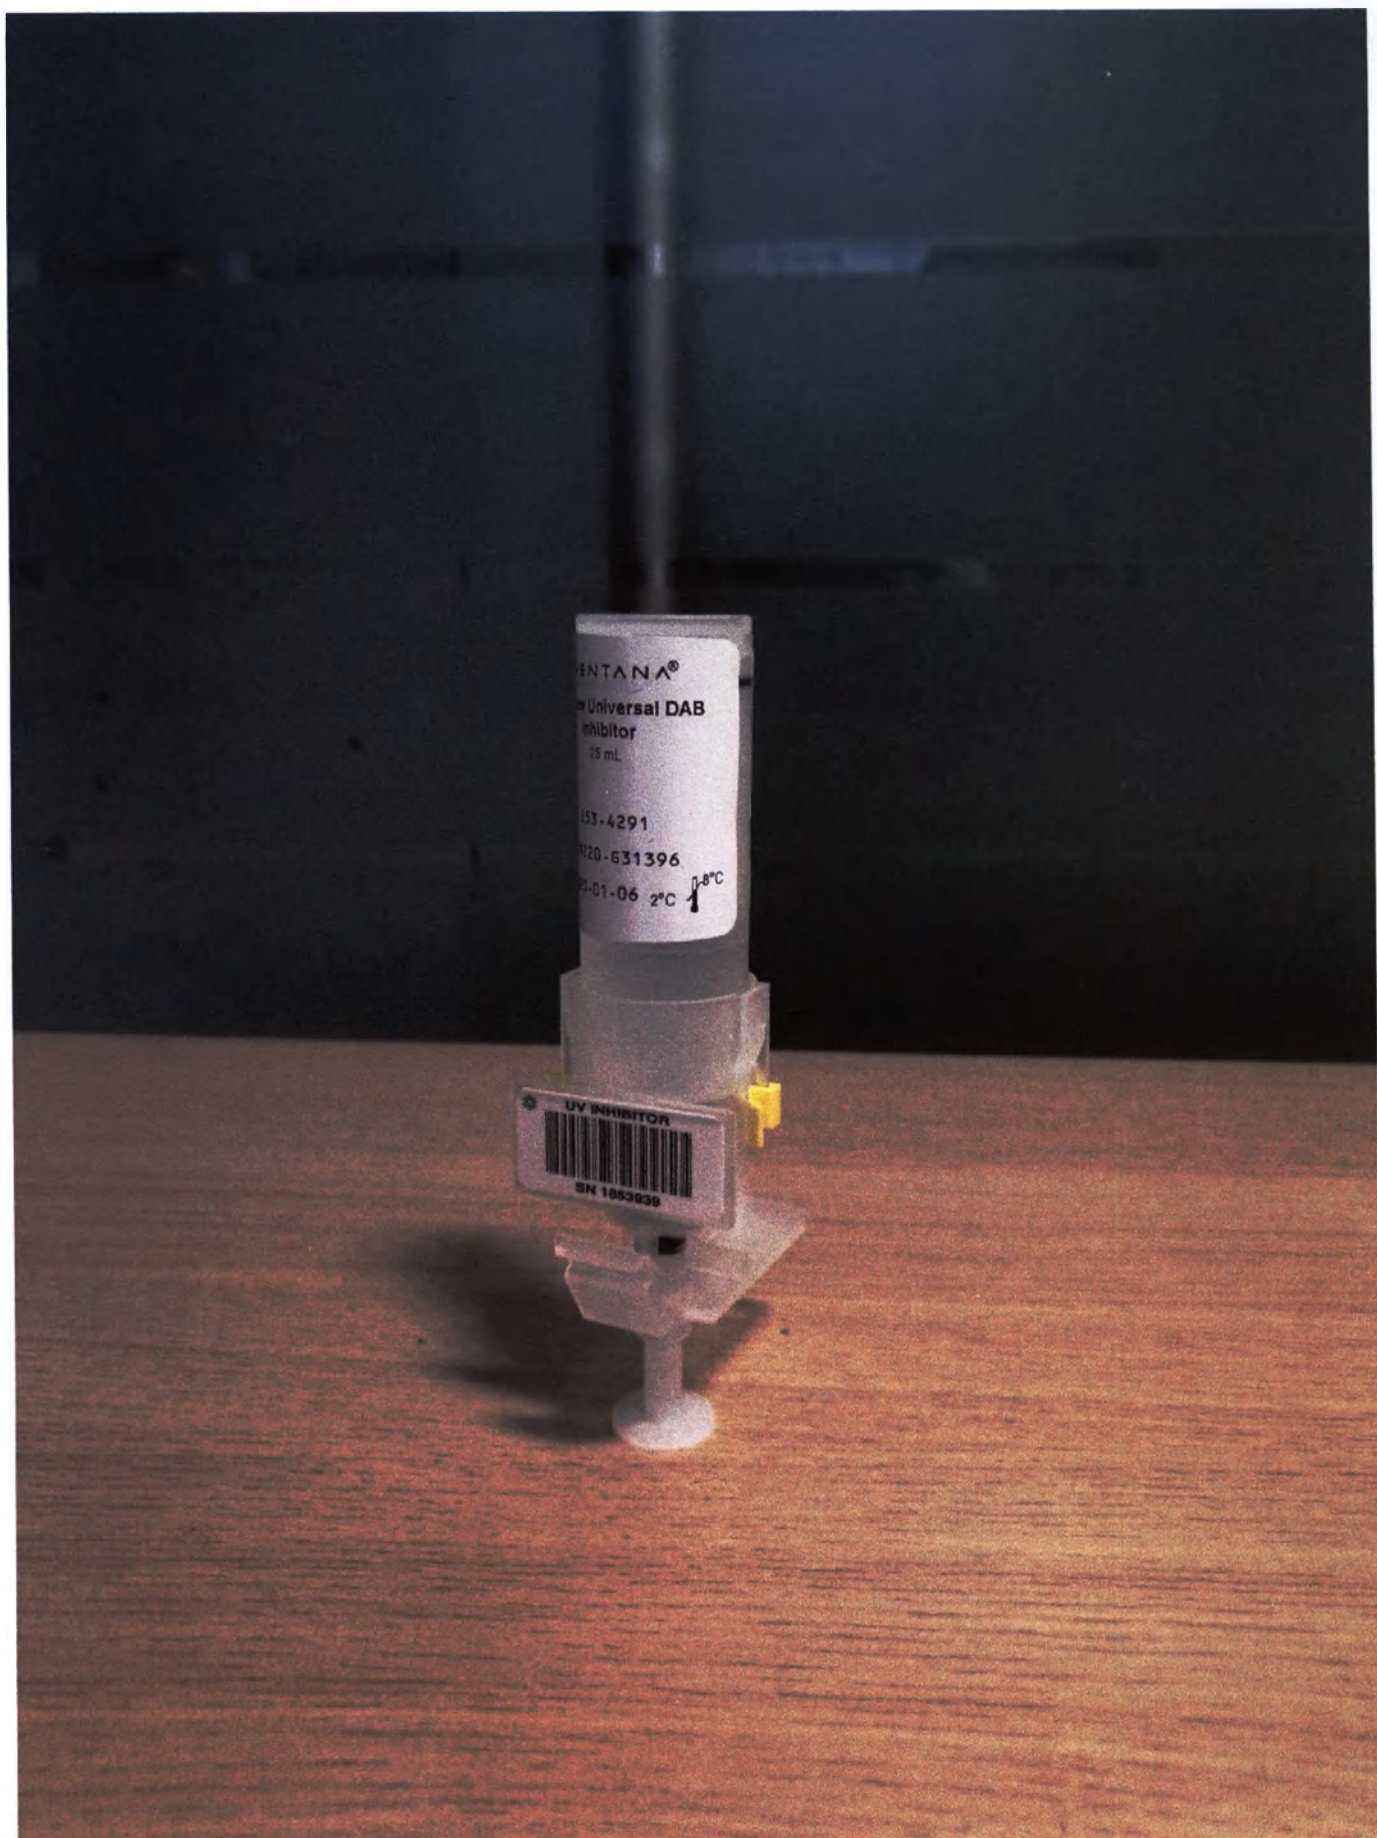


Реагент ultraView Universal DAB Inhibitor в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт. (дозатор с реагентом)



Реагент ultraView Universal DAB Inhibitor в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт. (дозатор с реагентом)




Реагент ultraView Universal HRP Multimer в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт. (дозатор с реагентом)

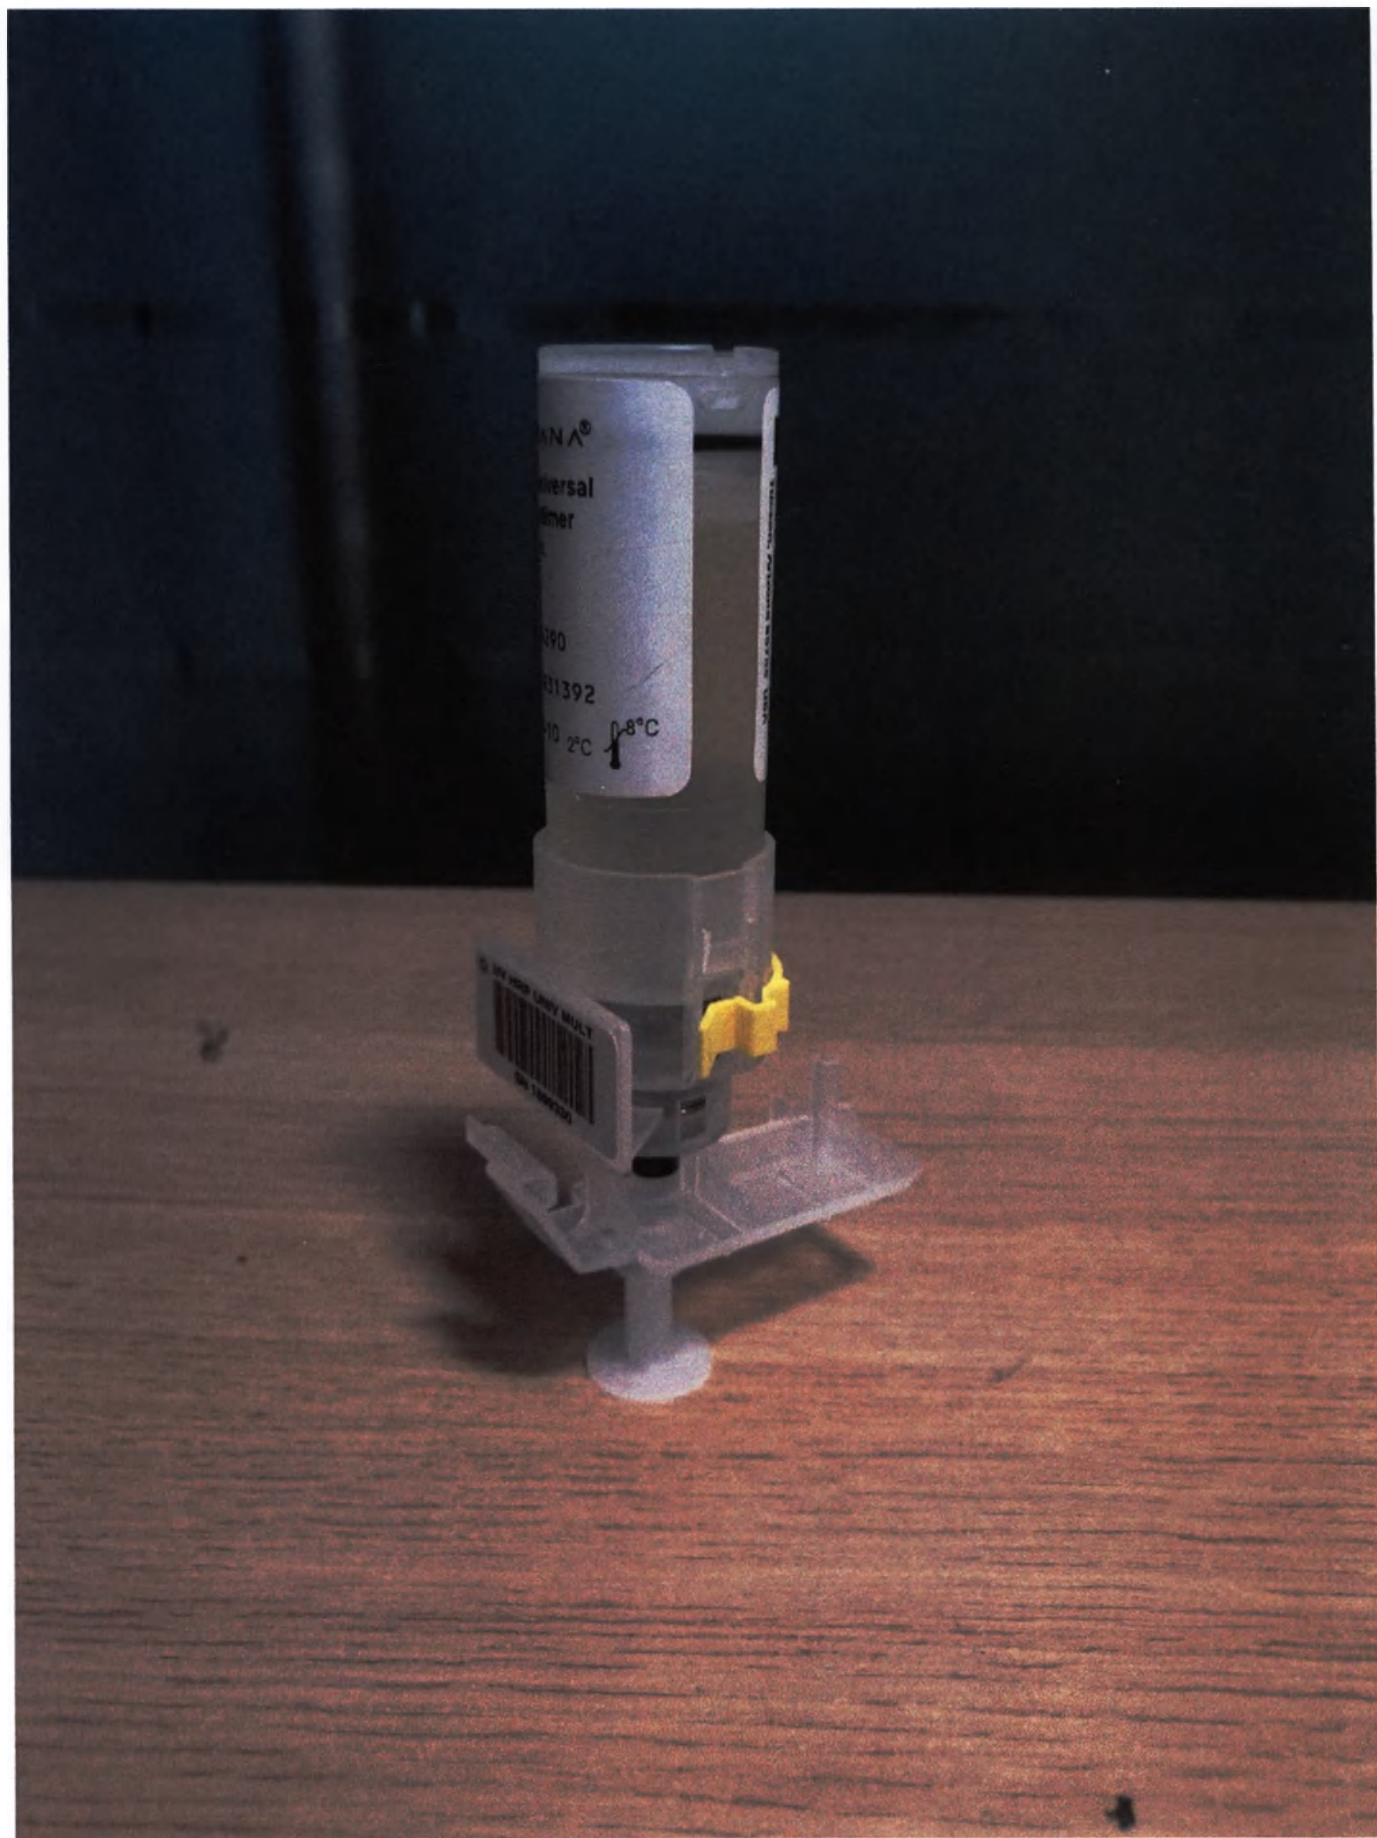


Реагент ultraView Universal HRP Multimer в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт. (дозатор с реагентом)




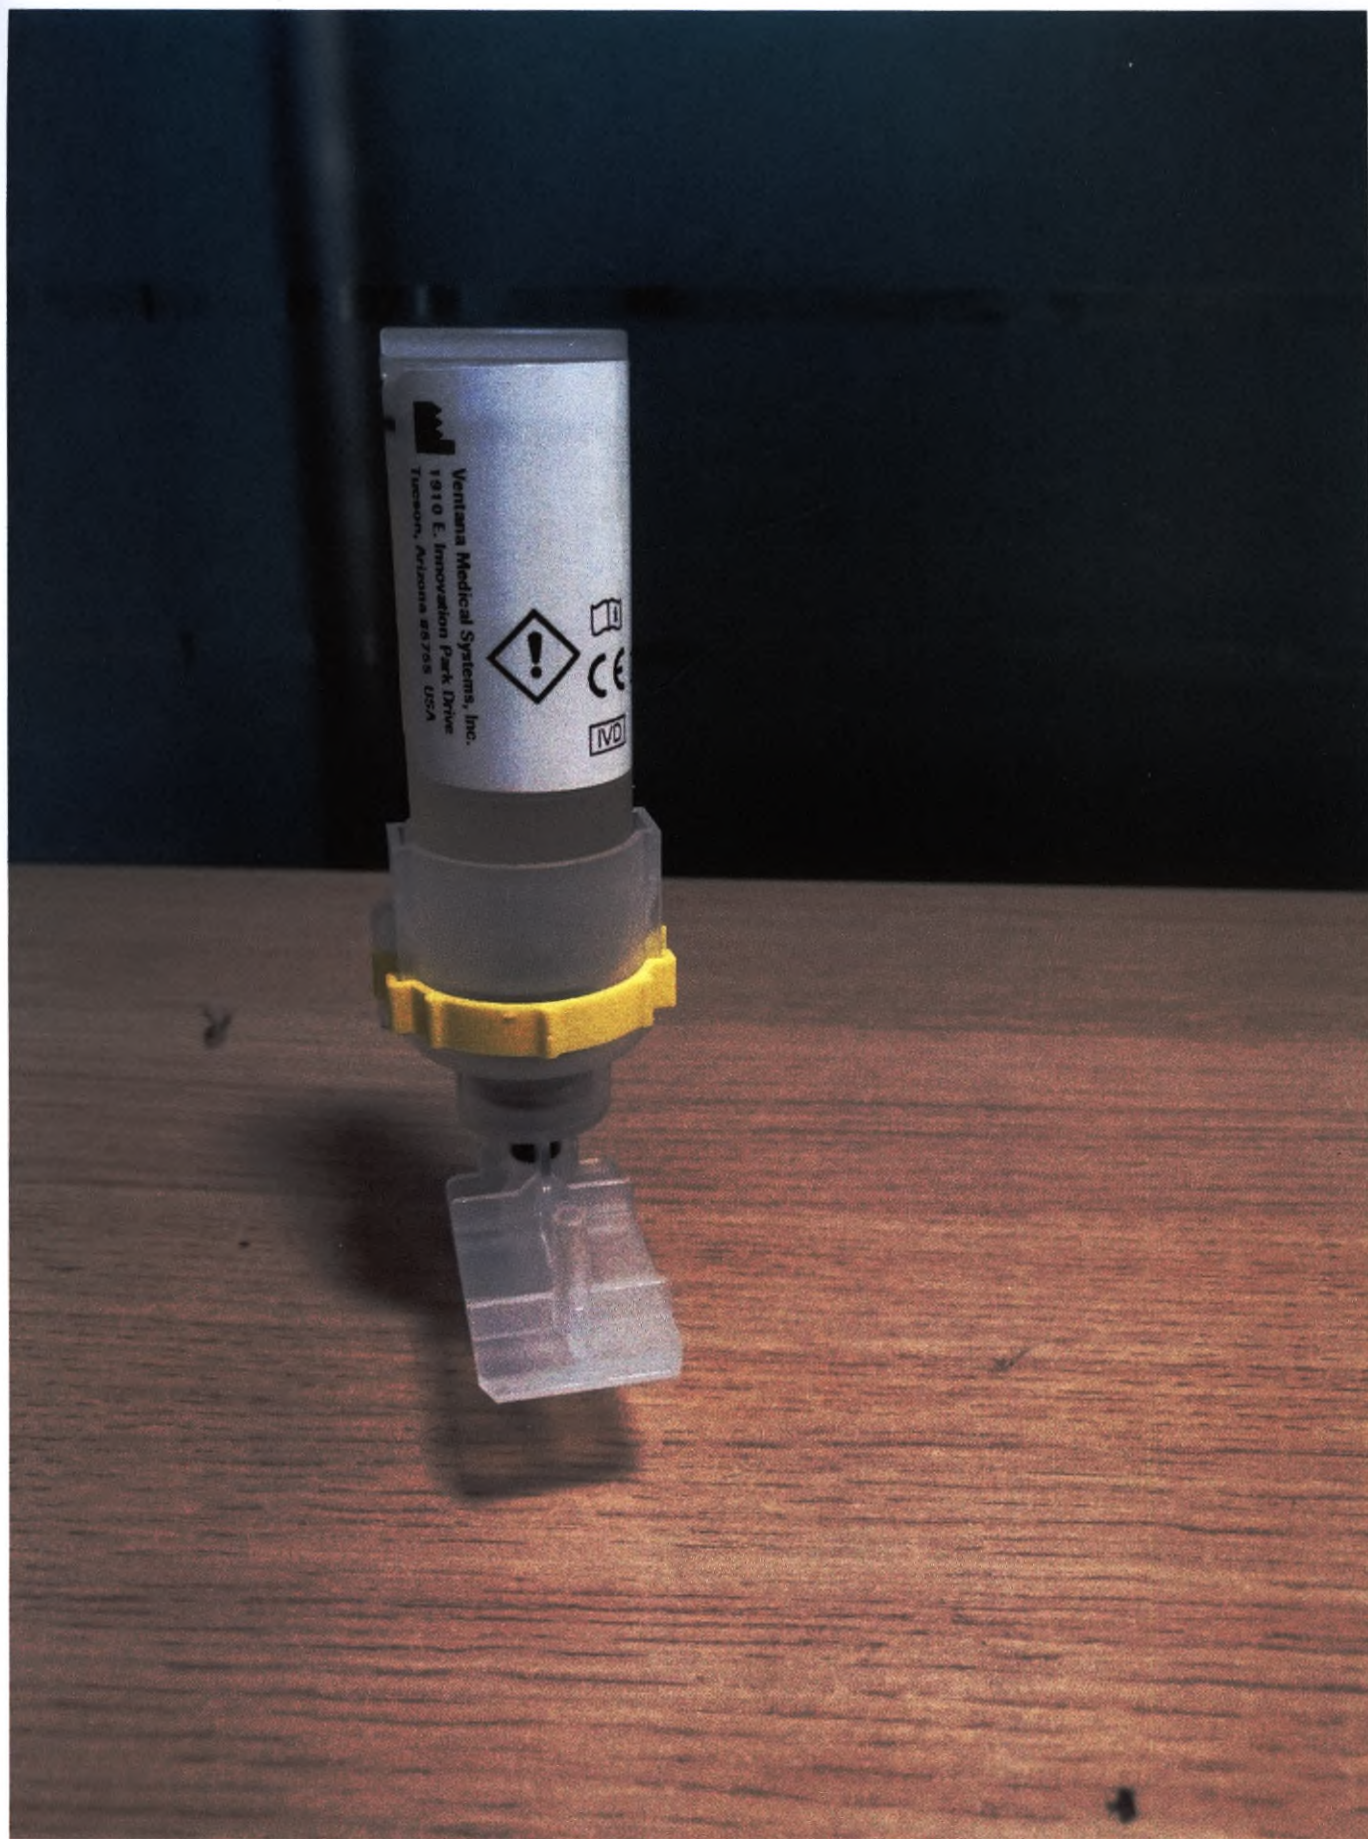

Реагент ultraView Universal DAB Chromogen в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт. (дозатор с реагентом)

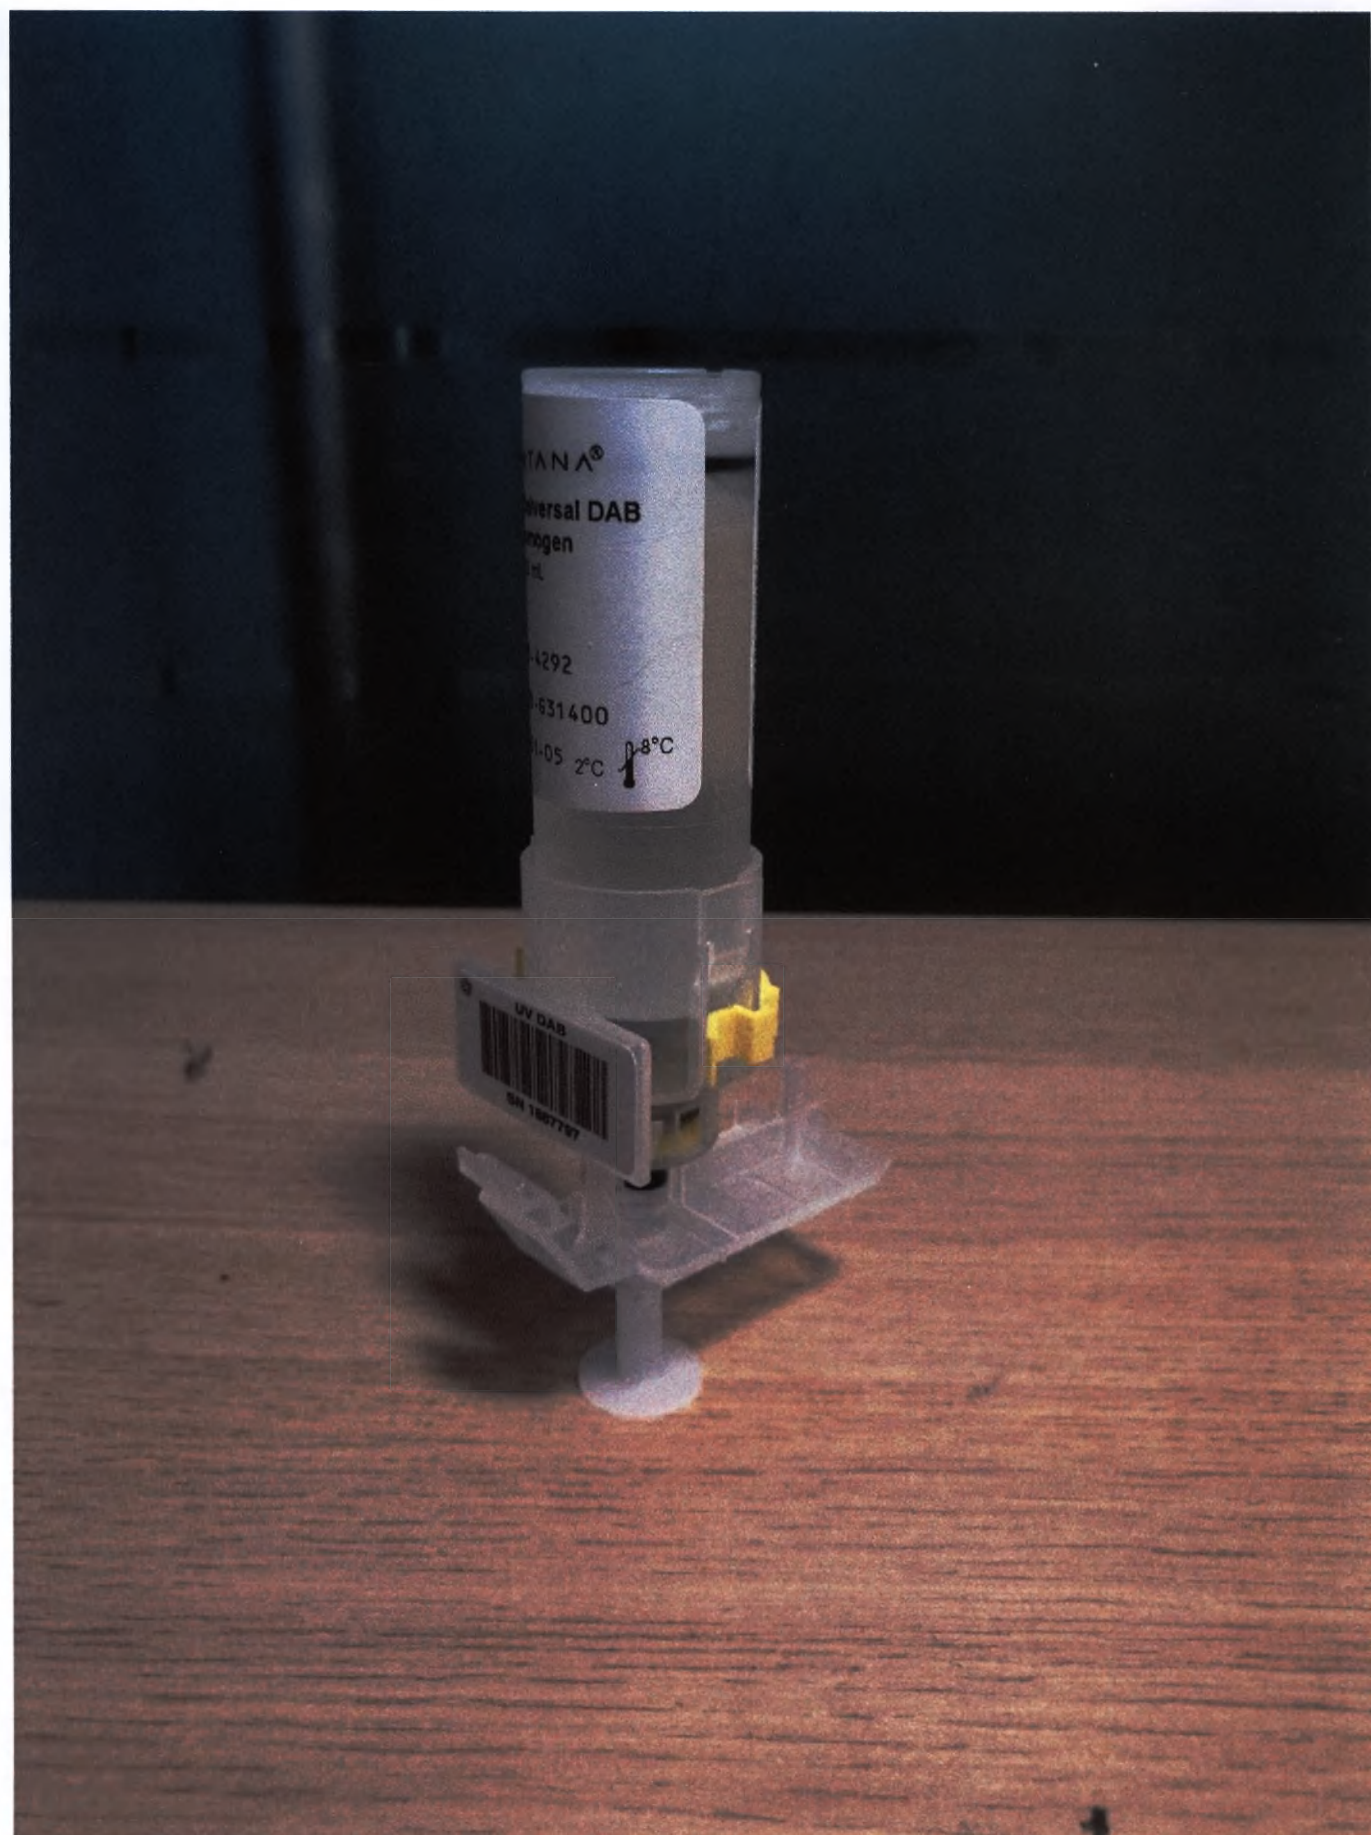


Реагент ultraView Universal DAB Chromogen в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт. (дозатор с реагентом)

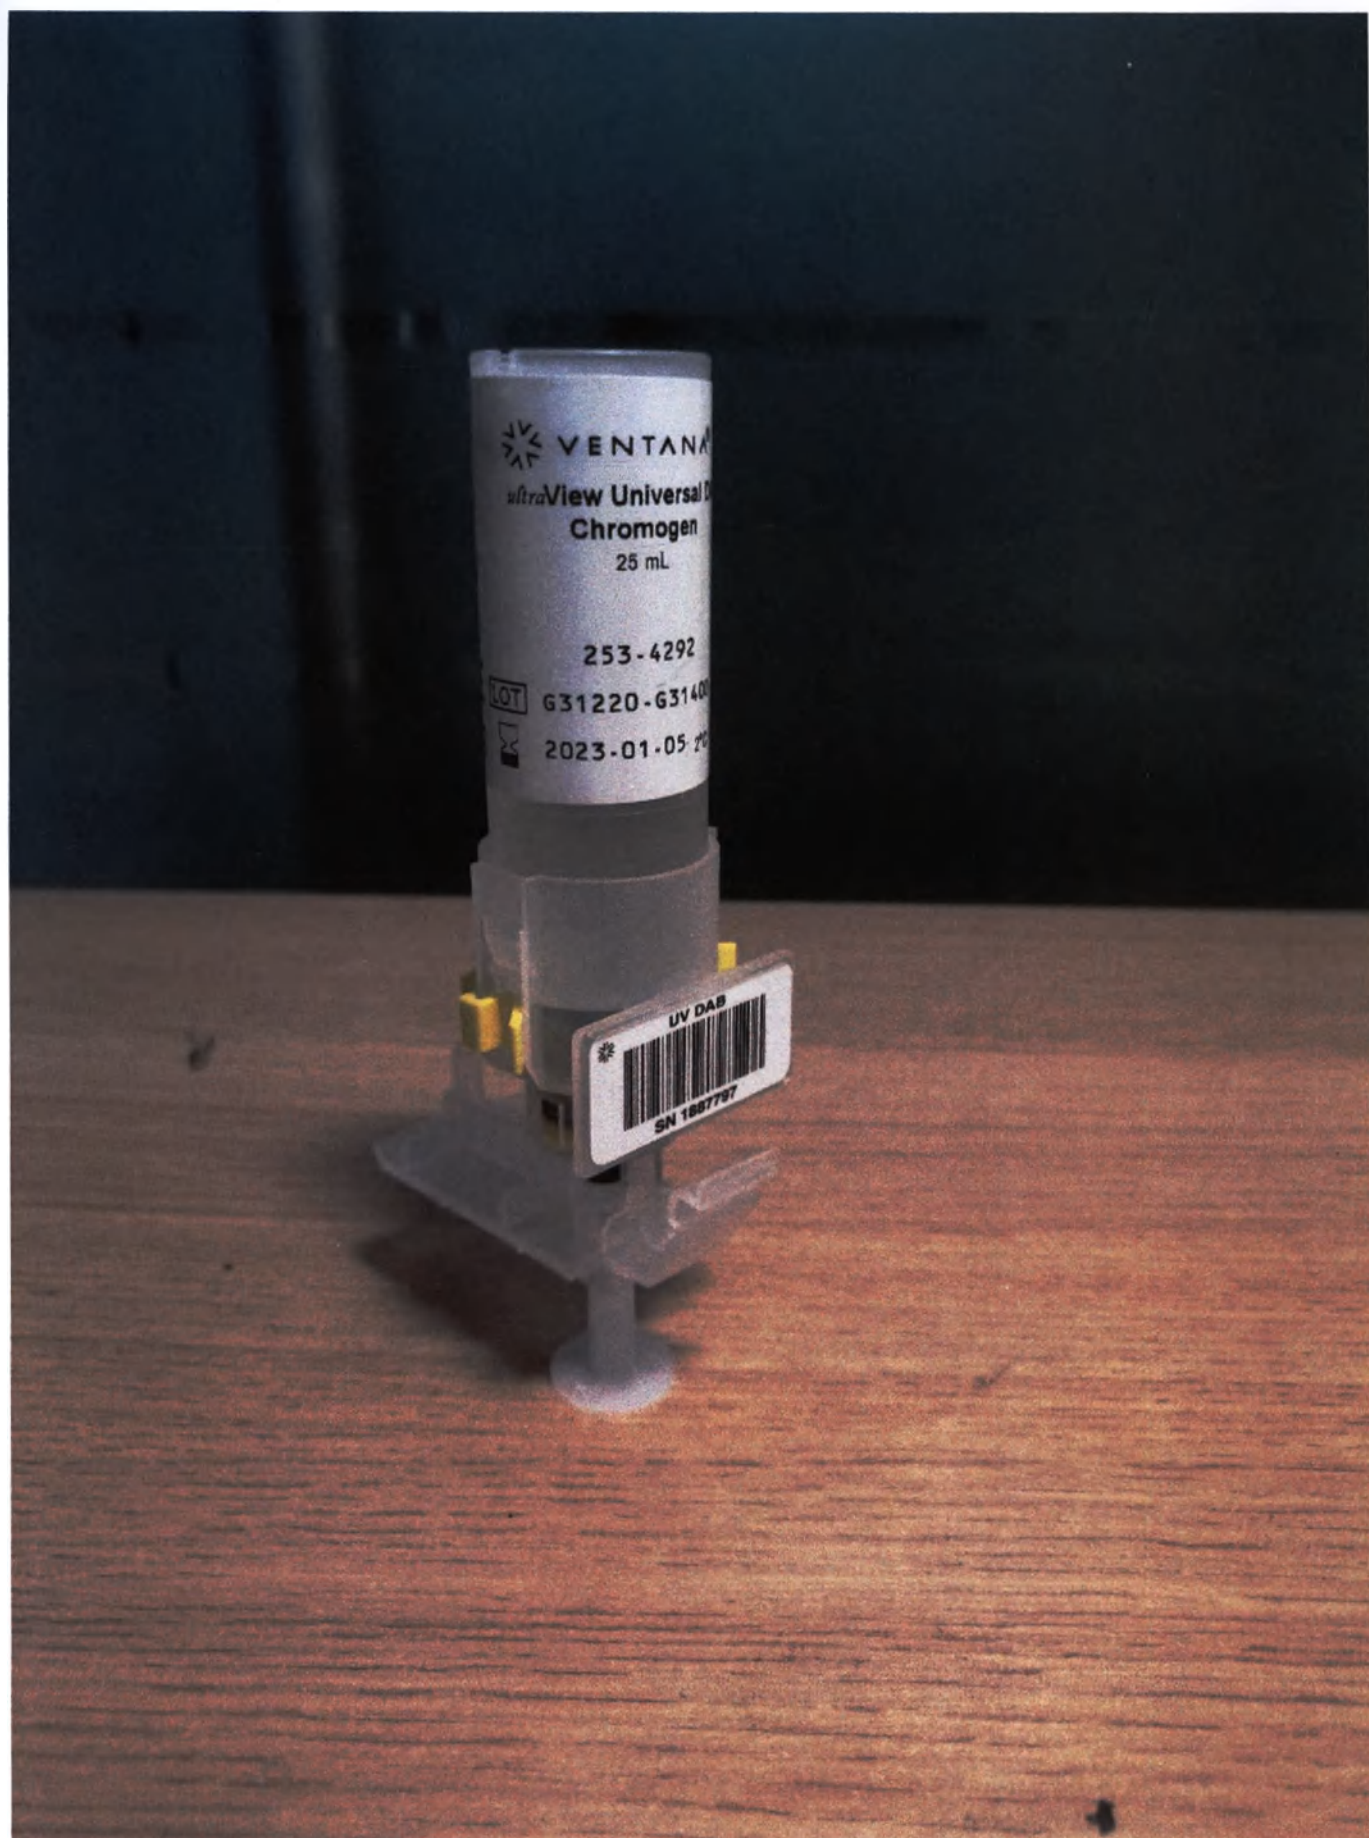

Реагент ultraView Universal DAB Chromogen в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт. (дозатор с реагентом)



Реагент ultraView Universal DAB H2O2 в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт. (дозатор с реагентом)

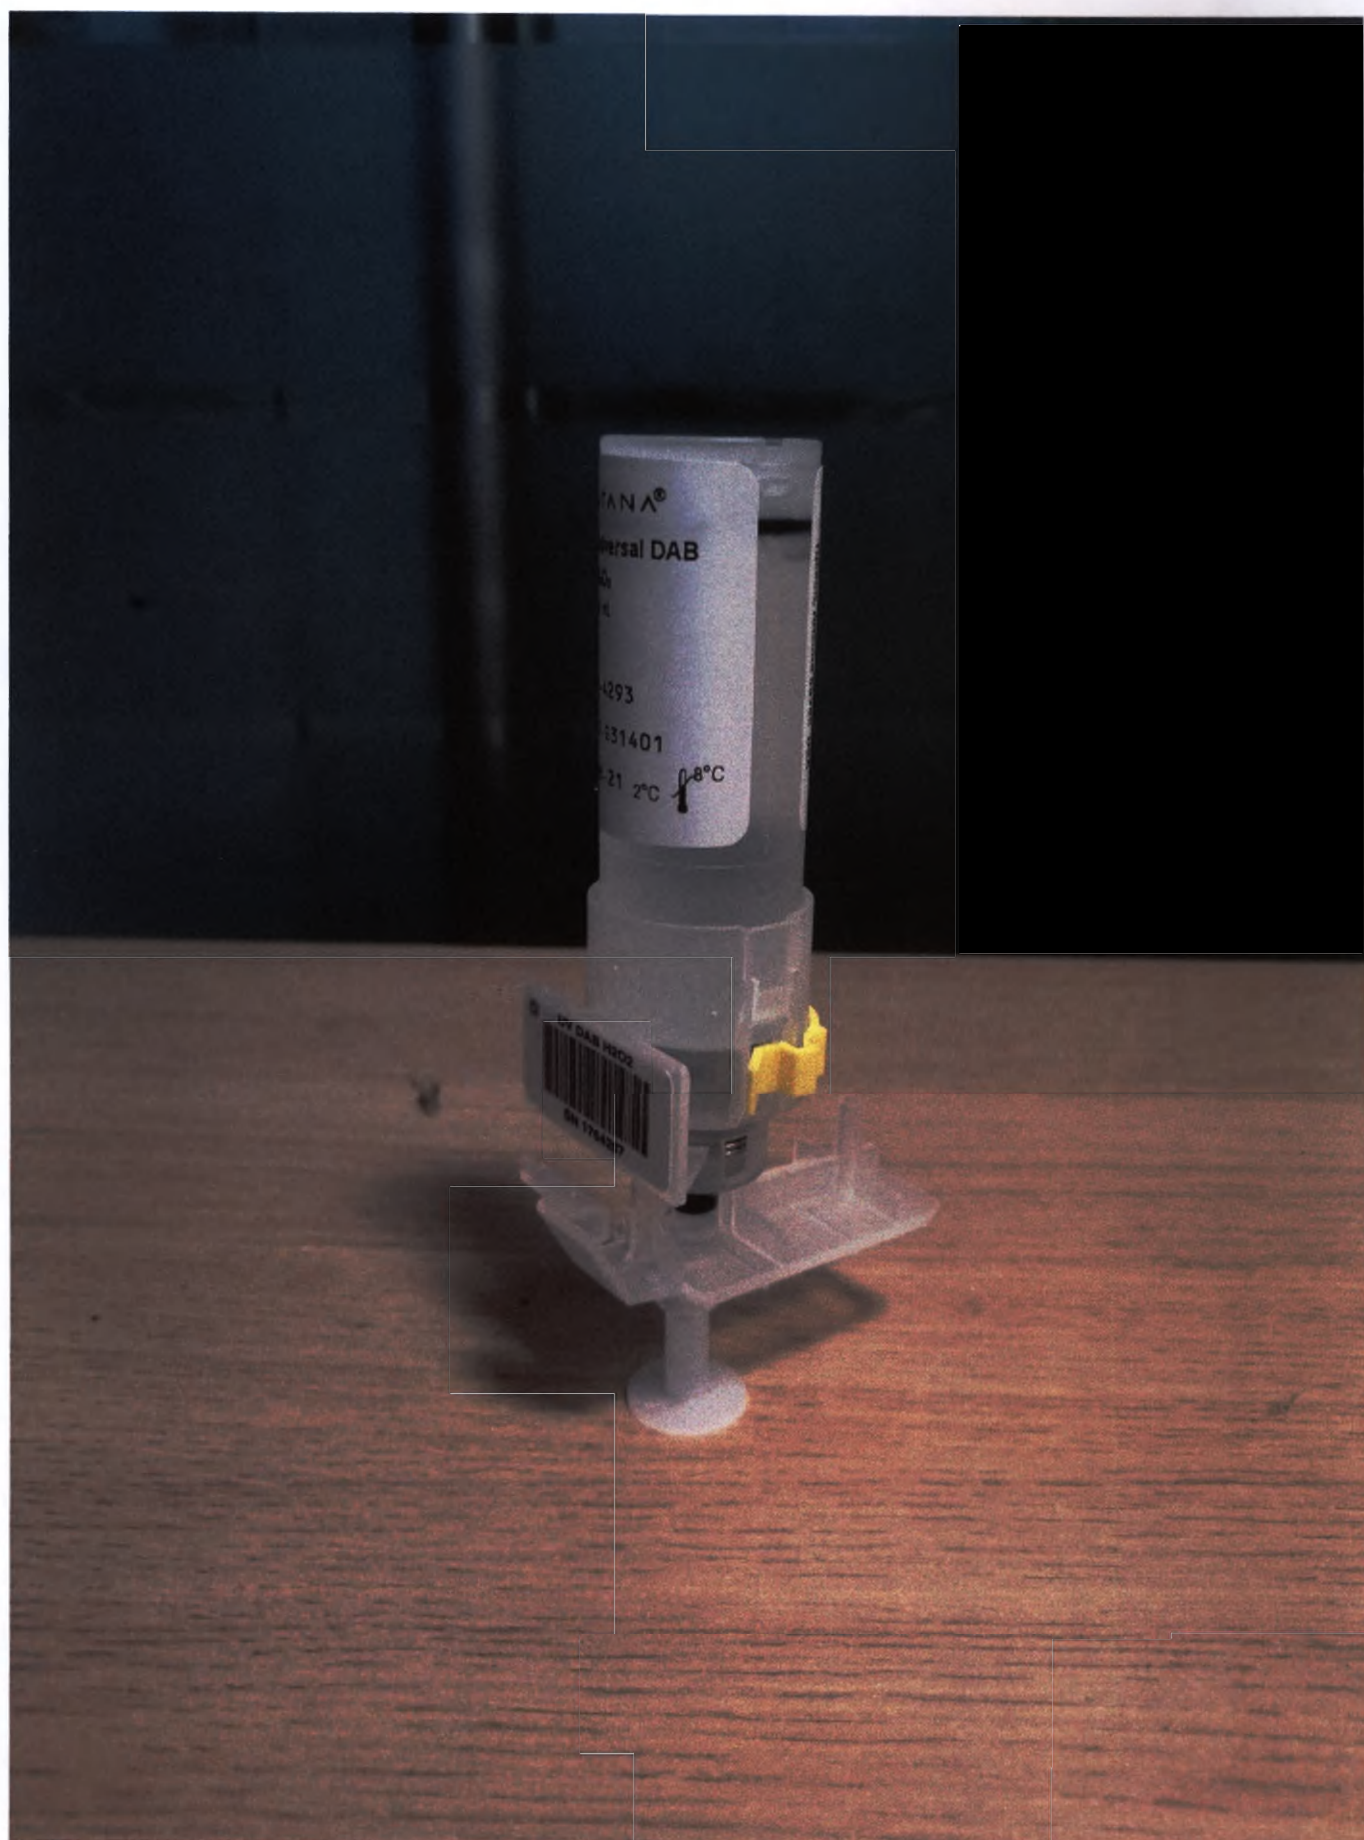

Реагент ultraView Universal DAB H₂O₂ в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт. (дозатор с реагентом)



Реагент ultraView Universal DAB H2O2 в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт. (дозатор с реагентом)



Реагент ultraView Universal DAB Copper в дозаторе, объем 25 мл. (дозатор с реагентом)



Реагент ultraView Universal DAB Copper в дозаторе, объем 25 мл. (дозатор с реагентом)



Реагент ultraView Universal DAB Copper в дозаторе, объем 25 мл. (дозатор с реагентом)



Набор для детекции ultraView Universal DAB Detection Kit для обнаружения клеток-мишеней иммуногистохимическим методом для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (маркировка)



Набор для детекции ultraView Universal DAB Detection Kit для обнаружения клеток-мишеней иммуногистохимическим методом для диагностики *in vitro* на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (маркировка)



Набор для детекции ultraView Universal DAB Detection Kit для обнаружения клеток-мишеней иммуногистохимическим методом для диагностики in vitro на иммуностейнерах автоматических серии BenchMark (маркировка)

VENTANA

VENTANA

REF 760-500

LOT 631220

GTIN 04015630972173

2021-03-01

(240) 05269806001-Roche

2023-01-05

250

2°C

CE

IVD



Rx Only 760-500 631220 1318



ultraView Universal DAB Detection Kit

- (1) 25 mL ultraView Universal DAB Inhibitor (3% H₂O₂)
- (1) 25 mL ultraView Universal HRP Multimer (<50 µg/mL)
- (1) 25 mL ultraView Universal DAB Chromogen (0.2% DAB)
- (1) 25 mL ultraView Universal DAB H₂O₂ (0.04% H₂O₂)
- (1) 25 mL ultraView Universal DAB Copper (CuSO₄ 5 g/L)

Набор для детекции ultraView Universal DAB Detection Kit для обнаружения клеток-мишеней иммуногистохимическим методом для диагностики *in vitro* на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (маркировка)



Набор для детекции ultraView Universal DAB Detection Kit для обнаружения клеток-мишеней иммуногистохимическим методом для диагностики in vitro на иммуногистостероидных автоматических серии BenchMark (маркировка)



Ventana Medical Systems, Inc.
1810 E. Innovation Park Drive
Tucson, Arizona 85755
USA
+1 520 887 2155
+1 800 227 2155 (USA)



www.ventanamed.com



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim
Germany

Made in USA



Набор для детекции ultraView Universal DAB Detection Kit для обнаружения
клеток-мишеней иммуногистохимическим методом для диагностики in vitro на
иммуногистостероидных автоматических серии BenchMark.

Содержит:

1. Реагент ultraView Universal DAB Substrate в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт.
2. Реагент ultraView Universal HRP Multimer в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт.
3. Реагент ultraView Universal DAB Chromogen в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт.
4. Реагент ultraView Universal DAB Slit в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт.
5. Реагент ultraView Universal DAB Slit в дозаторе, объем 25 мл., 1 шт.

Реактивация: см. на упаковке. Дату производства см. на упаковке.
Температура хранения см. на упаковке. Номер лота см. на упаковке.



Примечание: «Ventana Medical Systems, Inc.», 1810 East Innovation Park
Drive, Tucson, AZ 85755 USA.

Не использовать для диагностики in vitro.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Рос Диагностика Рес» (ООО
«Рос Диагностика Рес») 107031, Москва, Трубная площадь, д.7 Тел: +7 495
225-49-99, Факс: +7 495 225-43-66. E-mail: info@rosdiag.ru, sales@rosdiag.ru.

Код, номер 9524980001 (768-500)



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
22 листа (ов)

по доверенности
от 04.02.2021

(Еремеев ДВ)

