

ИНН/КПП 5029204750/502901001
р/с 40702810820100002976
в ТКБ БАНК ПАО
БИК 044525388
к/с 30101810800000000388
Юридический адрес: 141001, Московская область, г.Мытищи, ул.1-я Вокзальная, д.8
Тел/факс (495) 956-83-16; (499) 706-83-16
raymedoffice@mail.ru

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

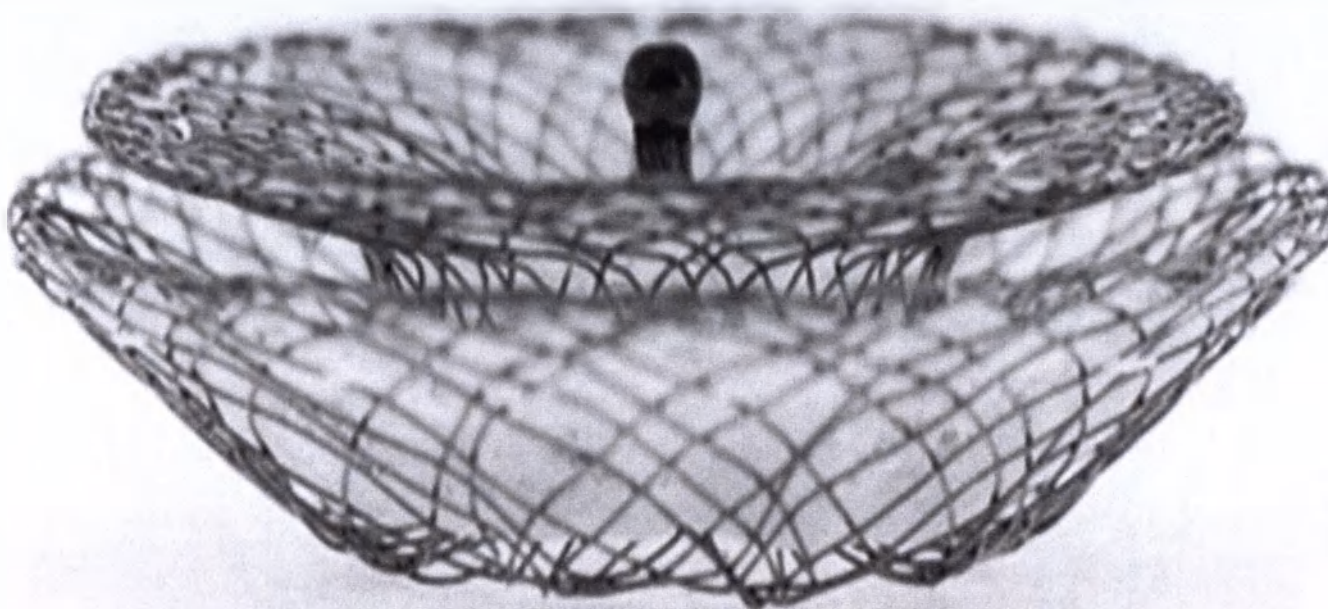


Рис.1. Окклюдер Figulla Flex II ASD (вид сбоку)

Рис.2. Окклюдер Figulla Flex II ASD (Вид со стороны проксимального диска)

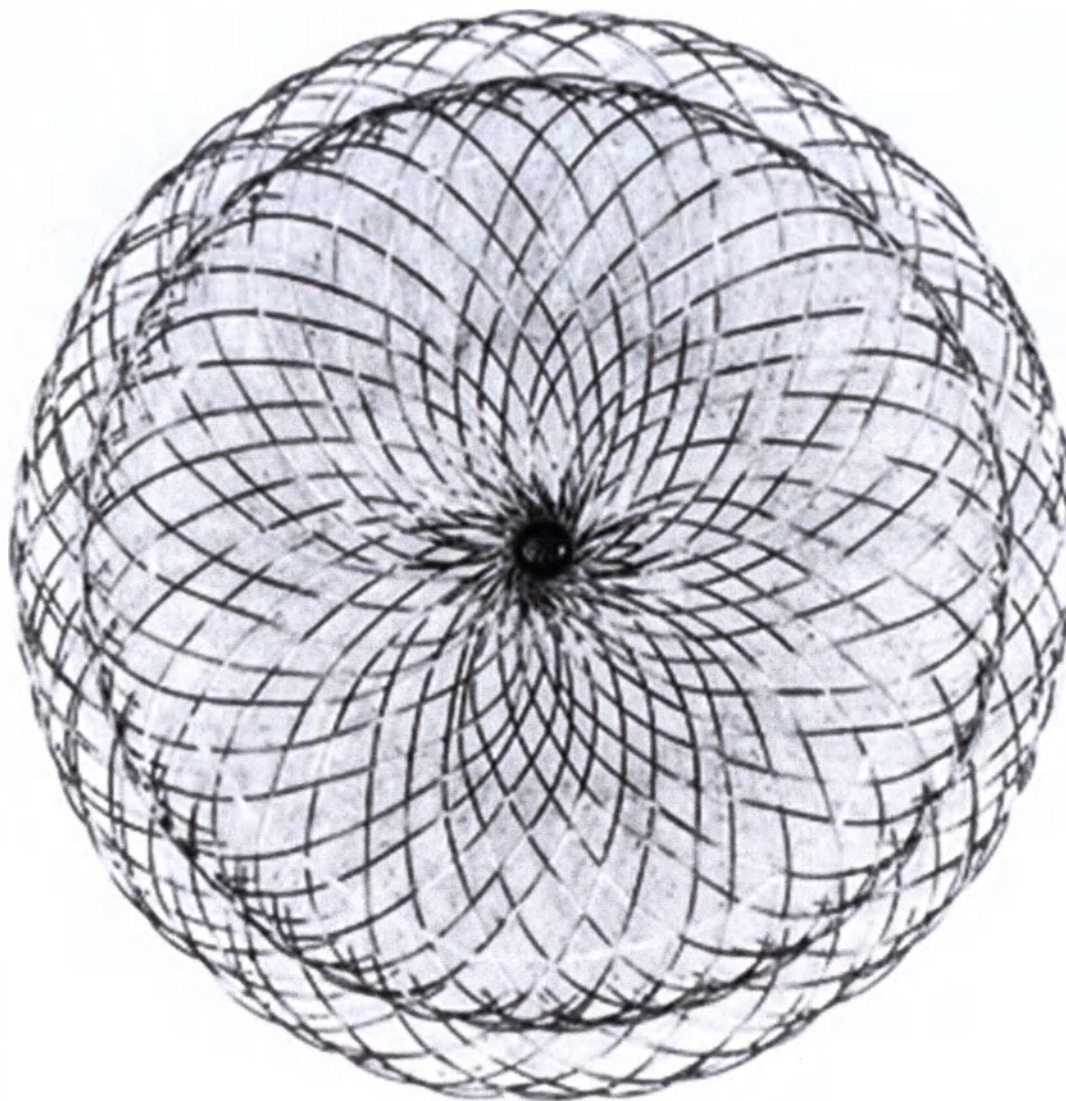


Рис.3. Оклюдер Figulla Flex II ASD (Вид со стороны
дистального диска)

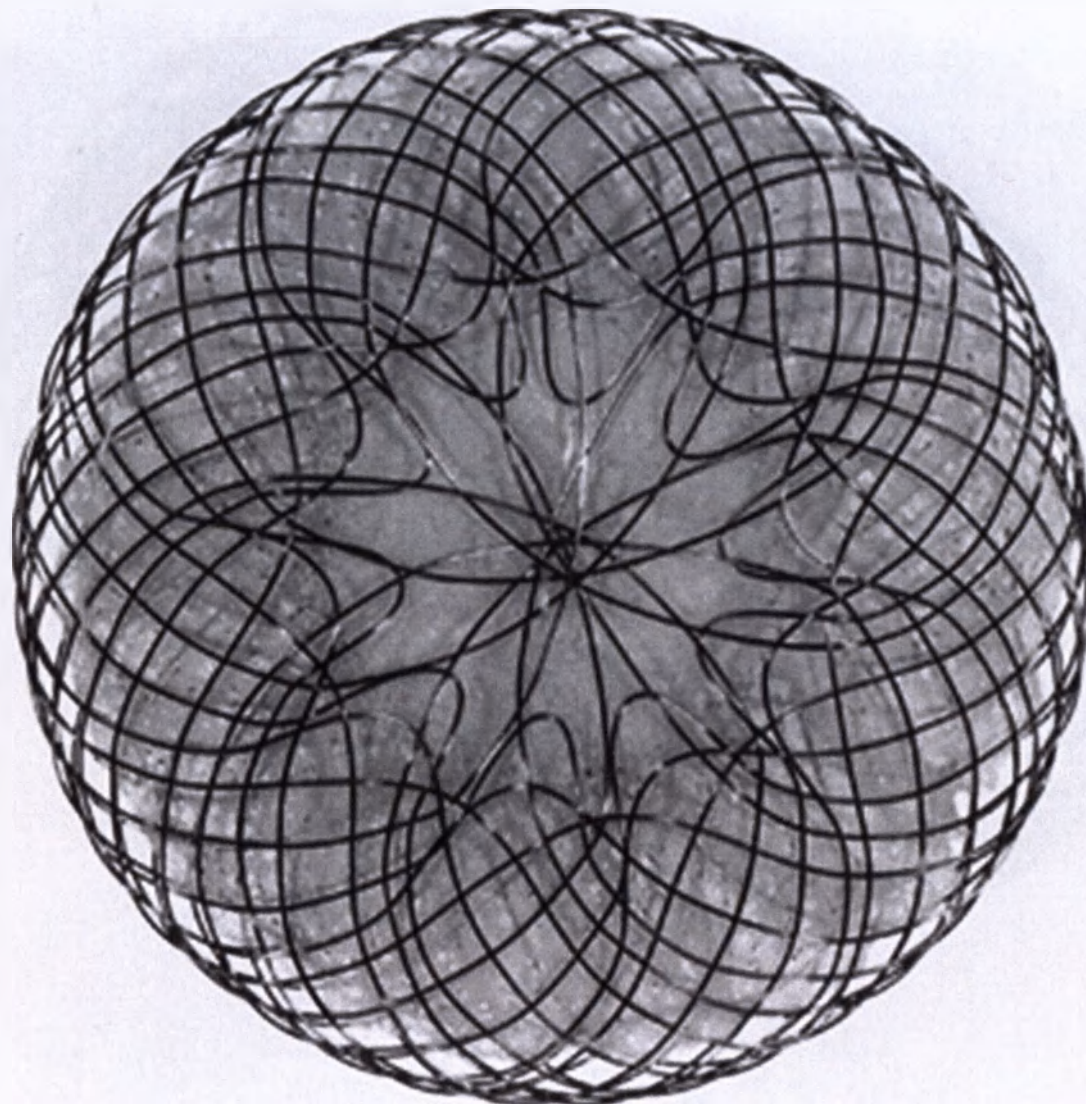


Рис.4. Оклюдер Figulla Flex II PFO S (однослойный дистальный диск)



Рис.5. Окклюдер Figulla Flex II PFO D (двухслойный дистальный диск)

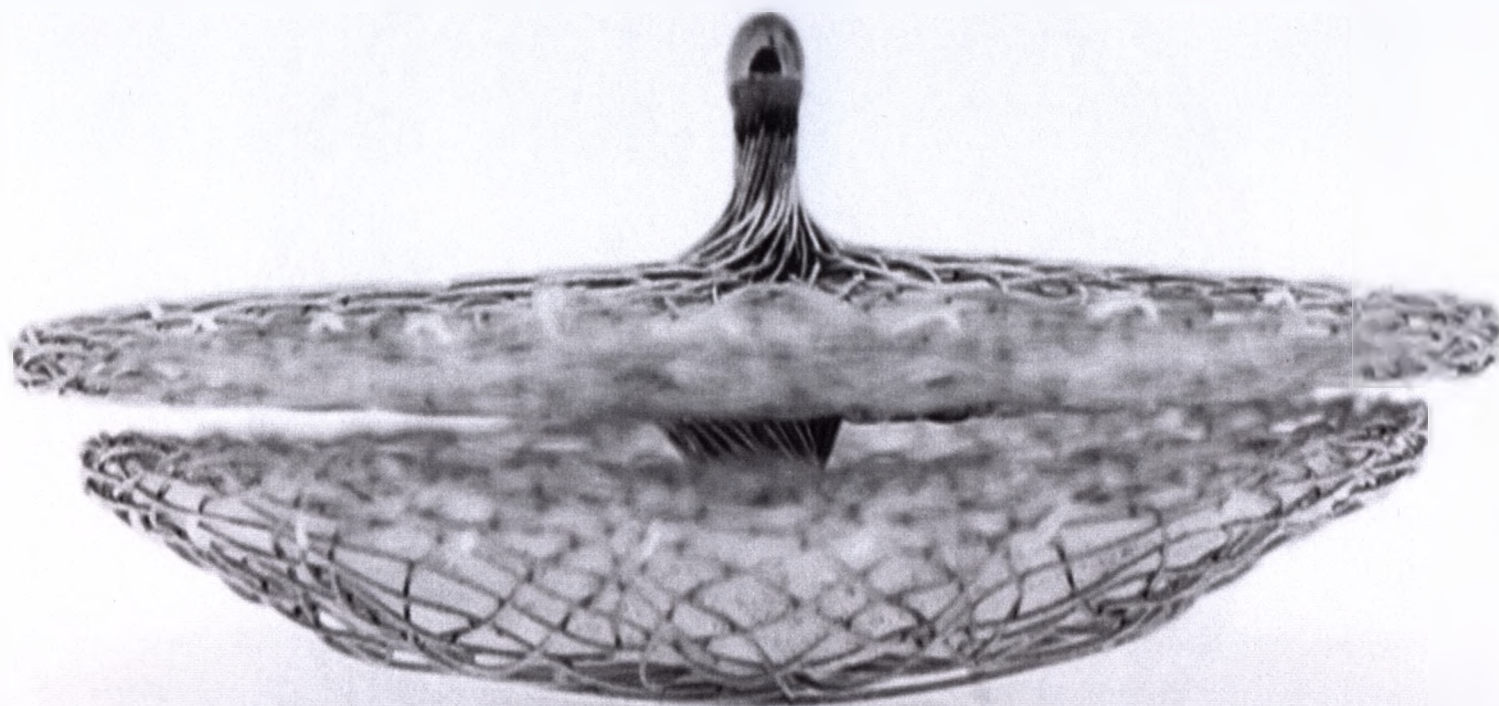


Рис.6. Окклюдер Figulla Flex II PFO D (вид со стороны
дистального диска)

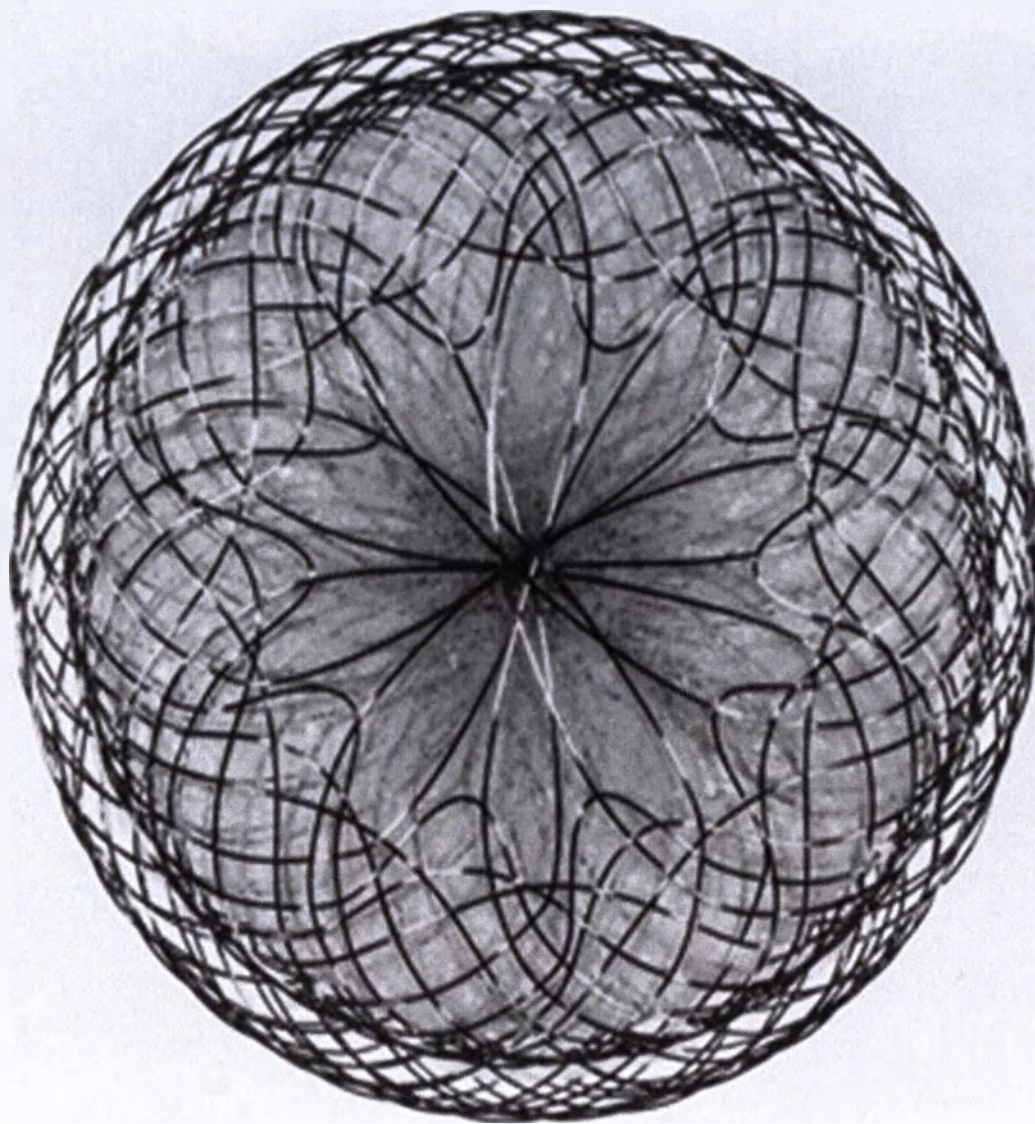
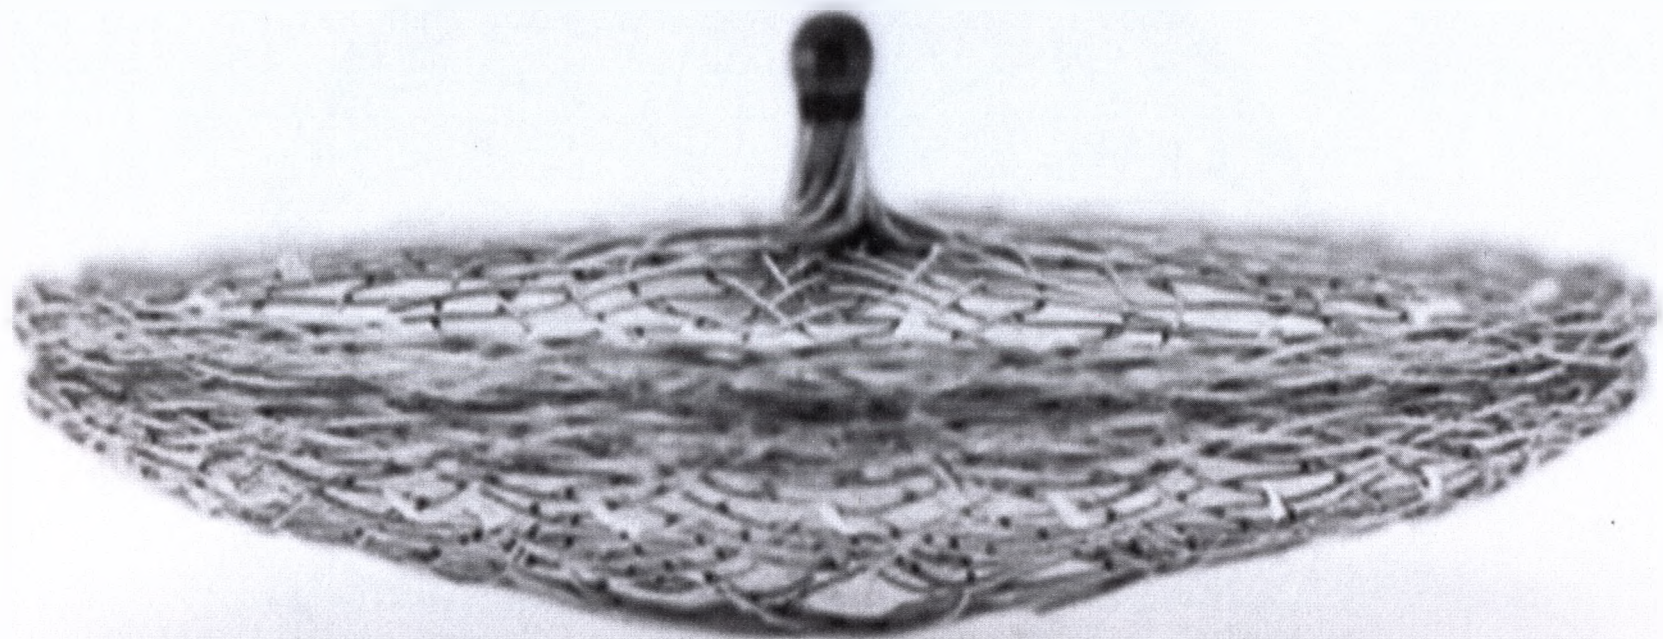
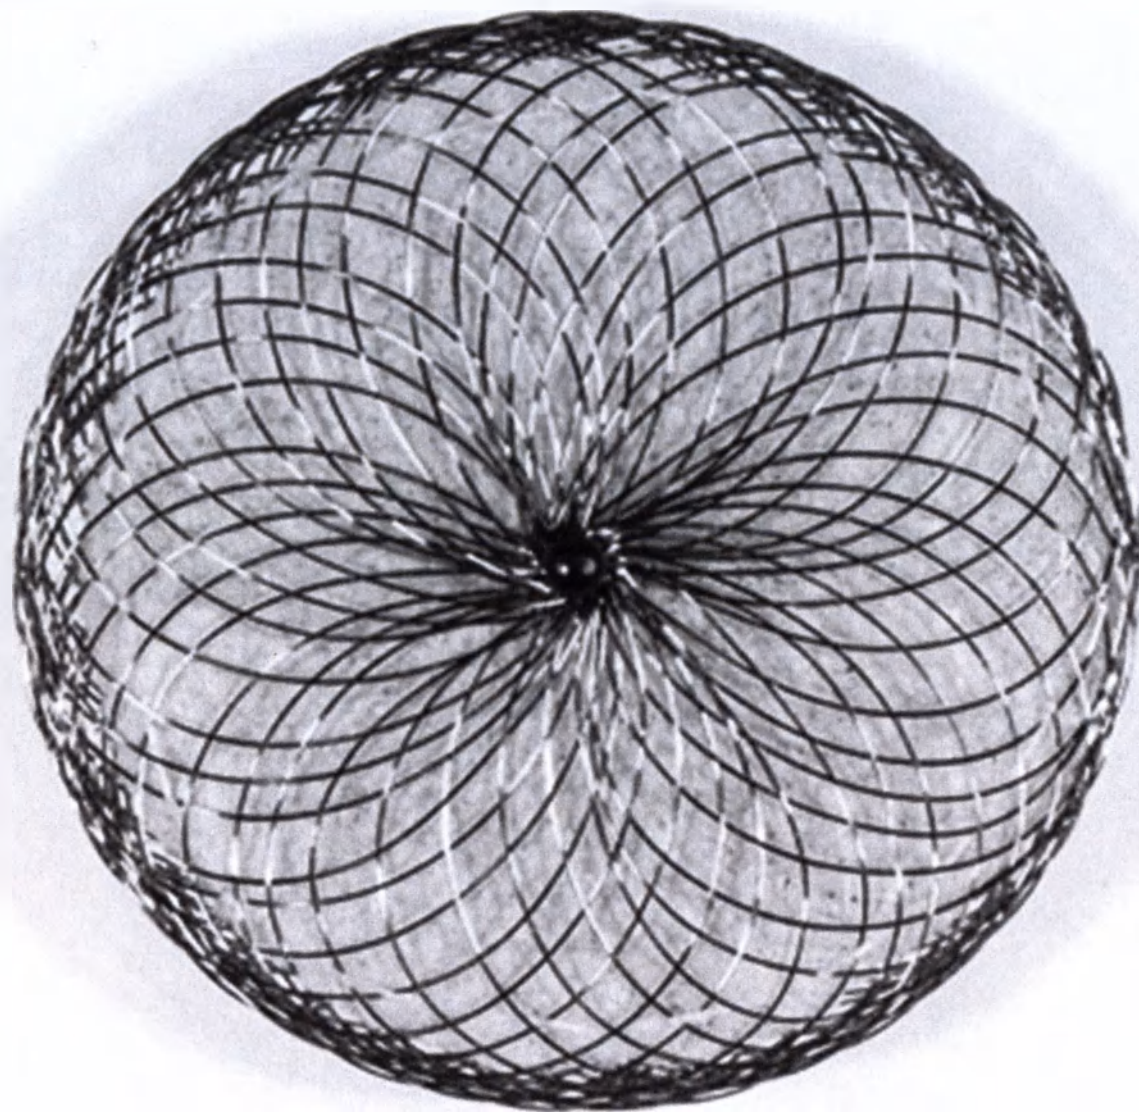


Рис.7. Окклюдер Figulla Flex II UNI (вид сбоку)





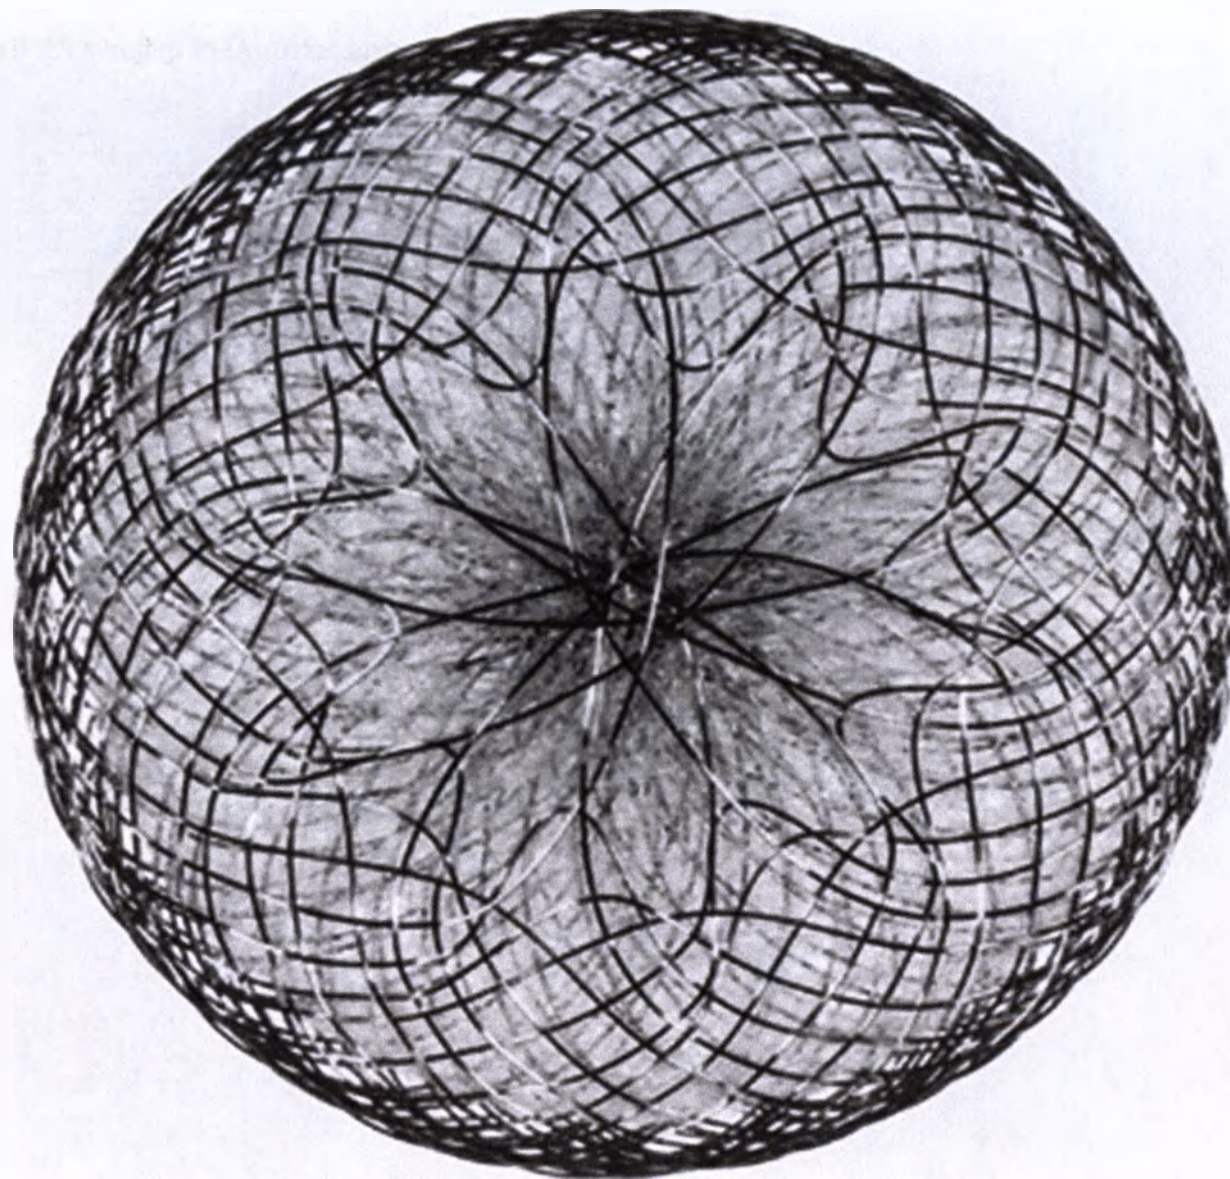


Рис.10. Оклюдер PDA (стандартный)



Рис.11. Окклюдер PDA L (с удлиненной талией)

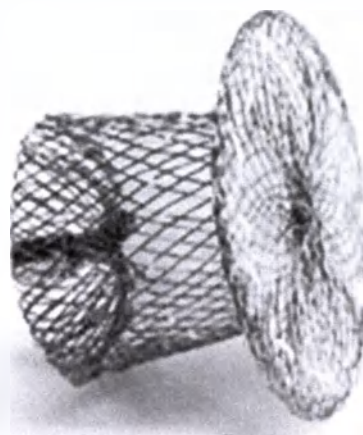




Рис.13. Окклюдер PLD RECTANGULAR_W (вид со стороны
дистального диска)

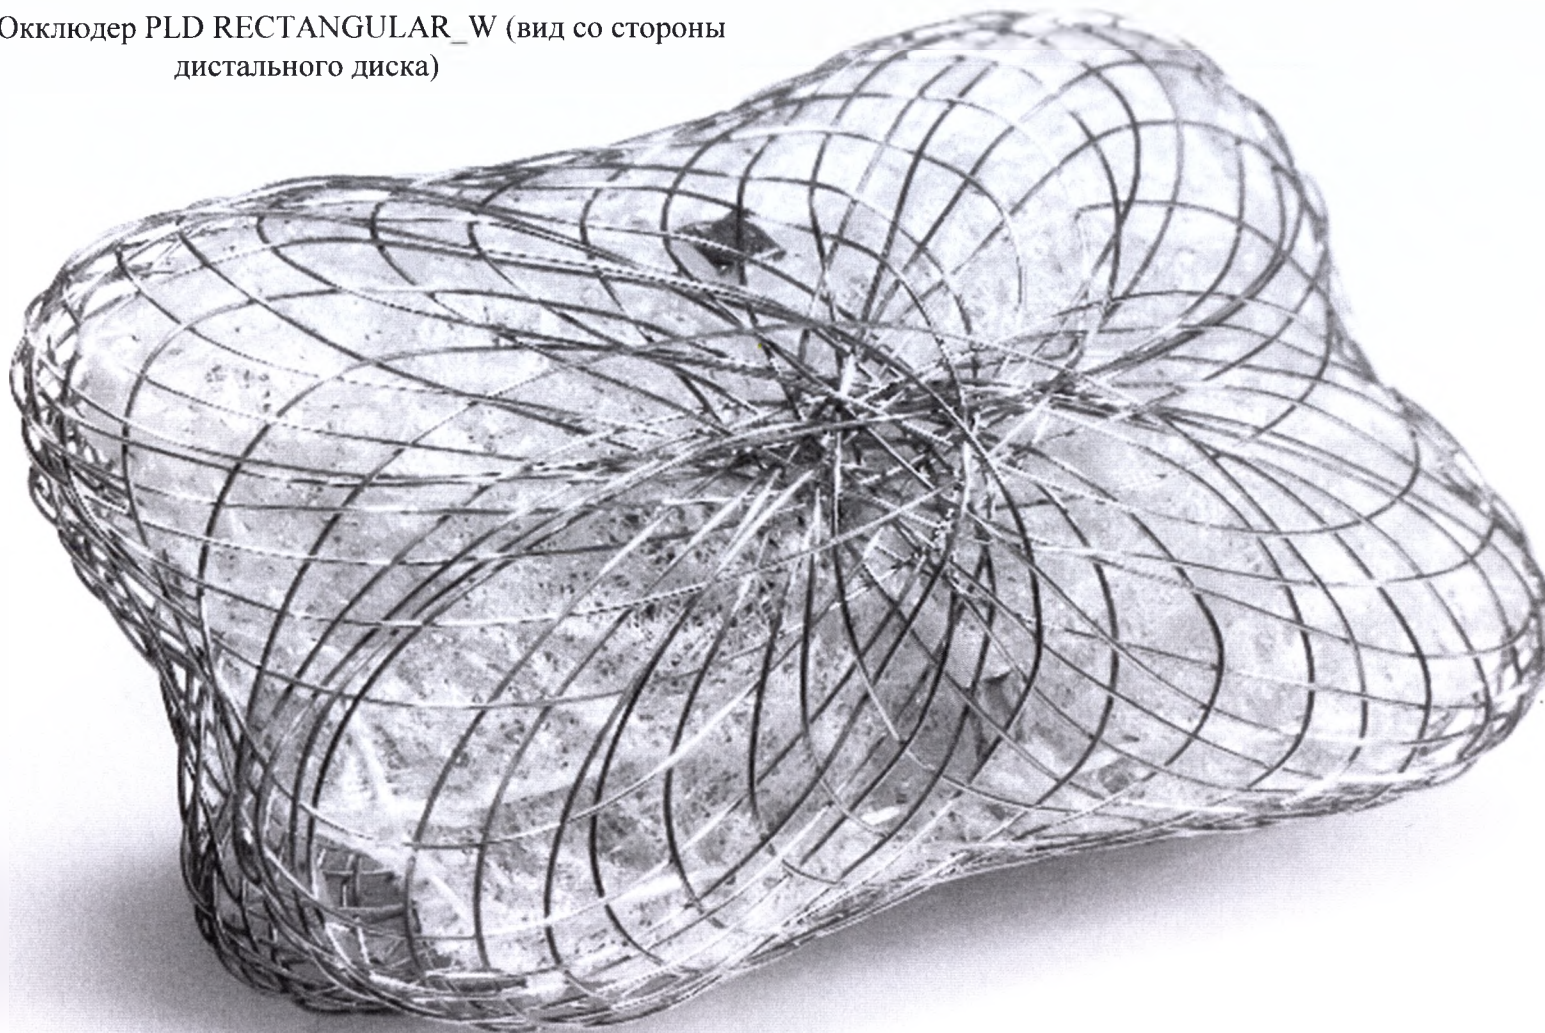


Рис.15. Окклюдер PLD Square_W (вид сбоку Толстая талия)



талия)


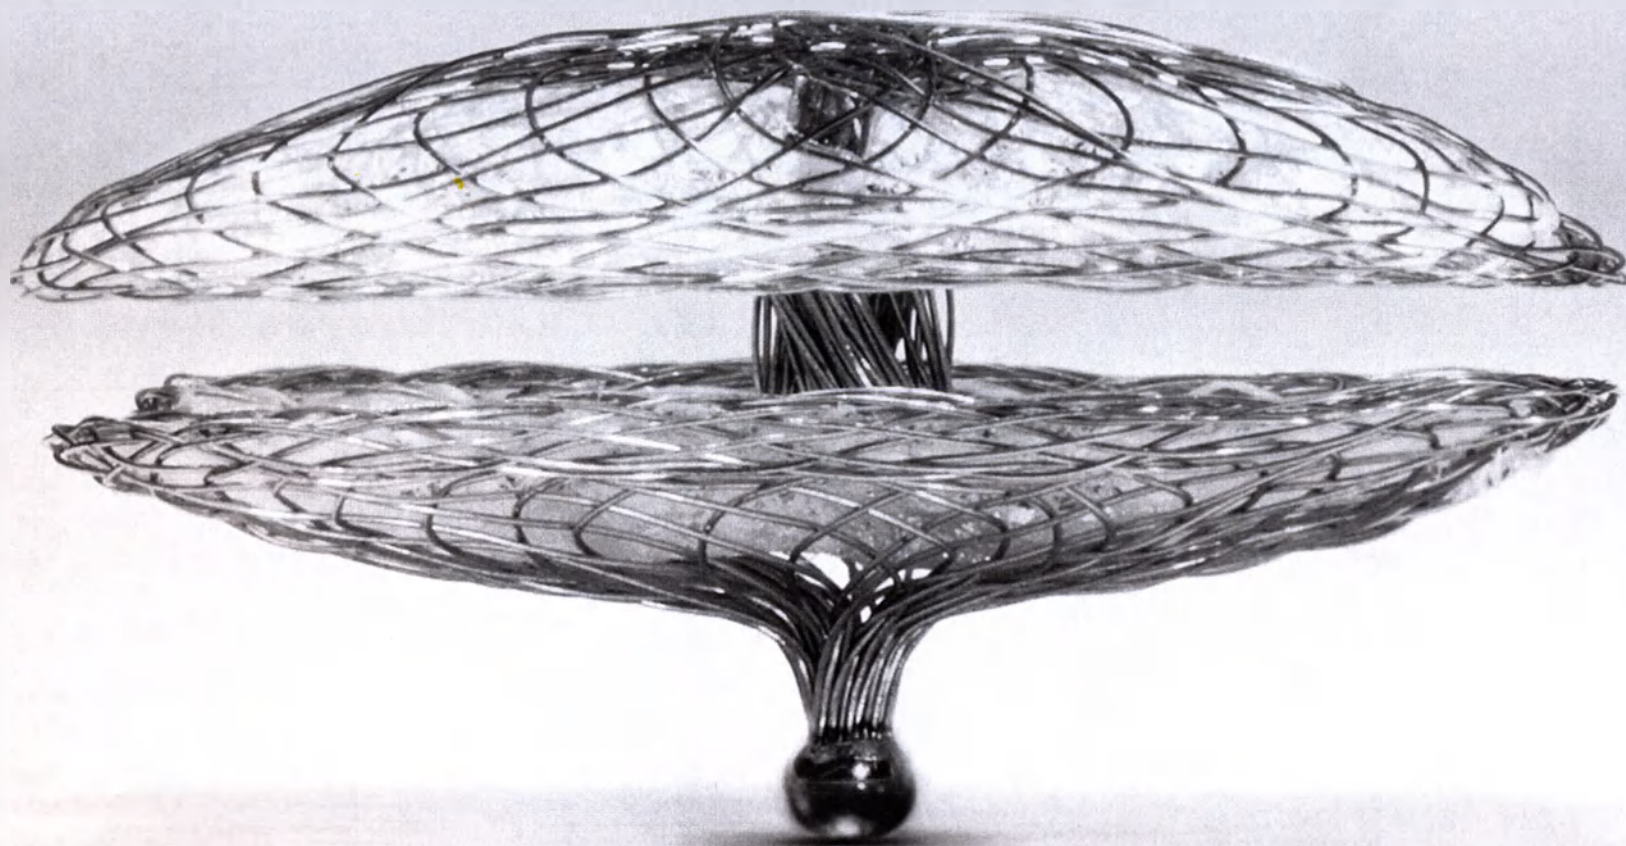


Рис.17. Толкатель Flex-Pusher II

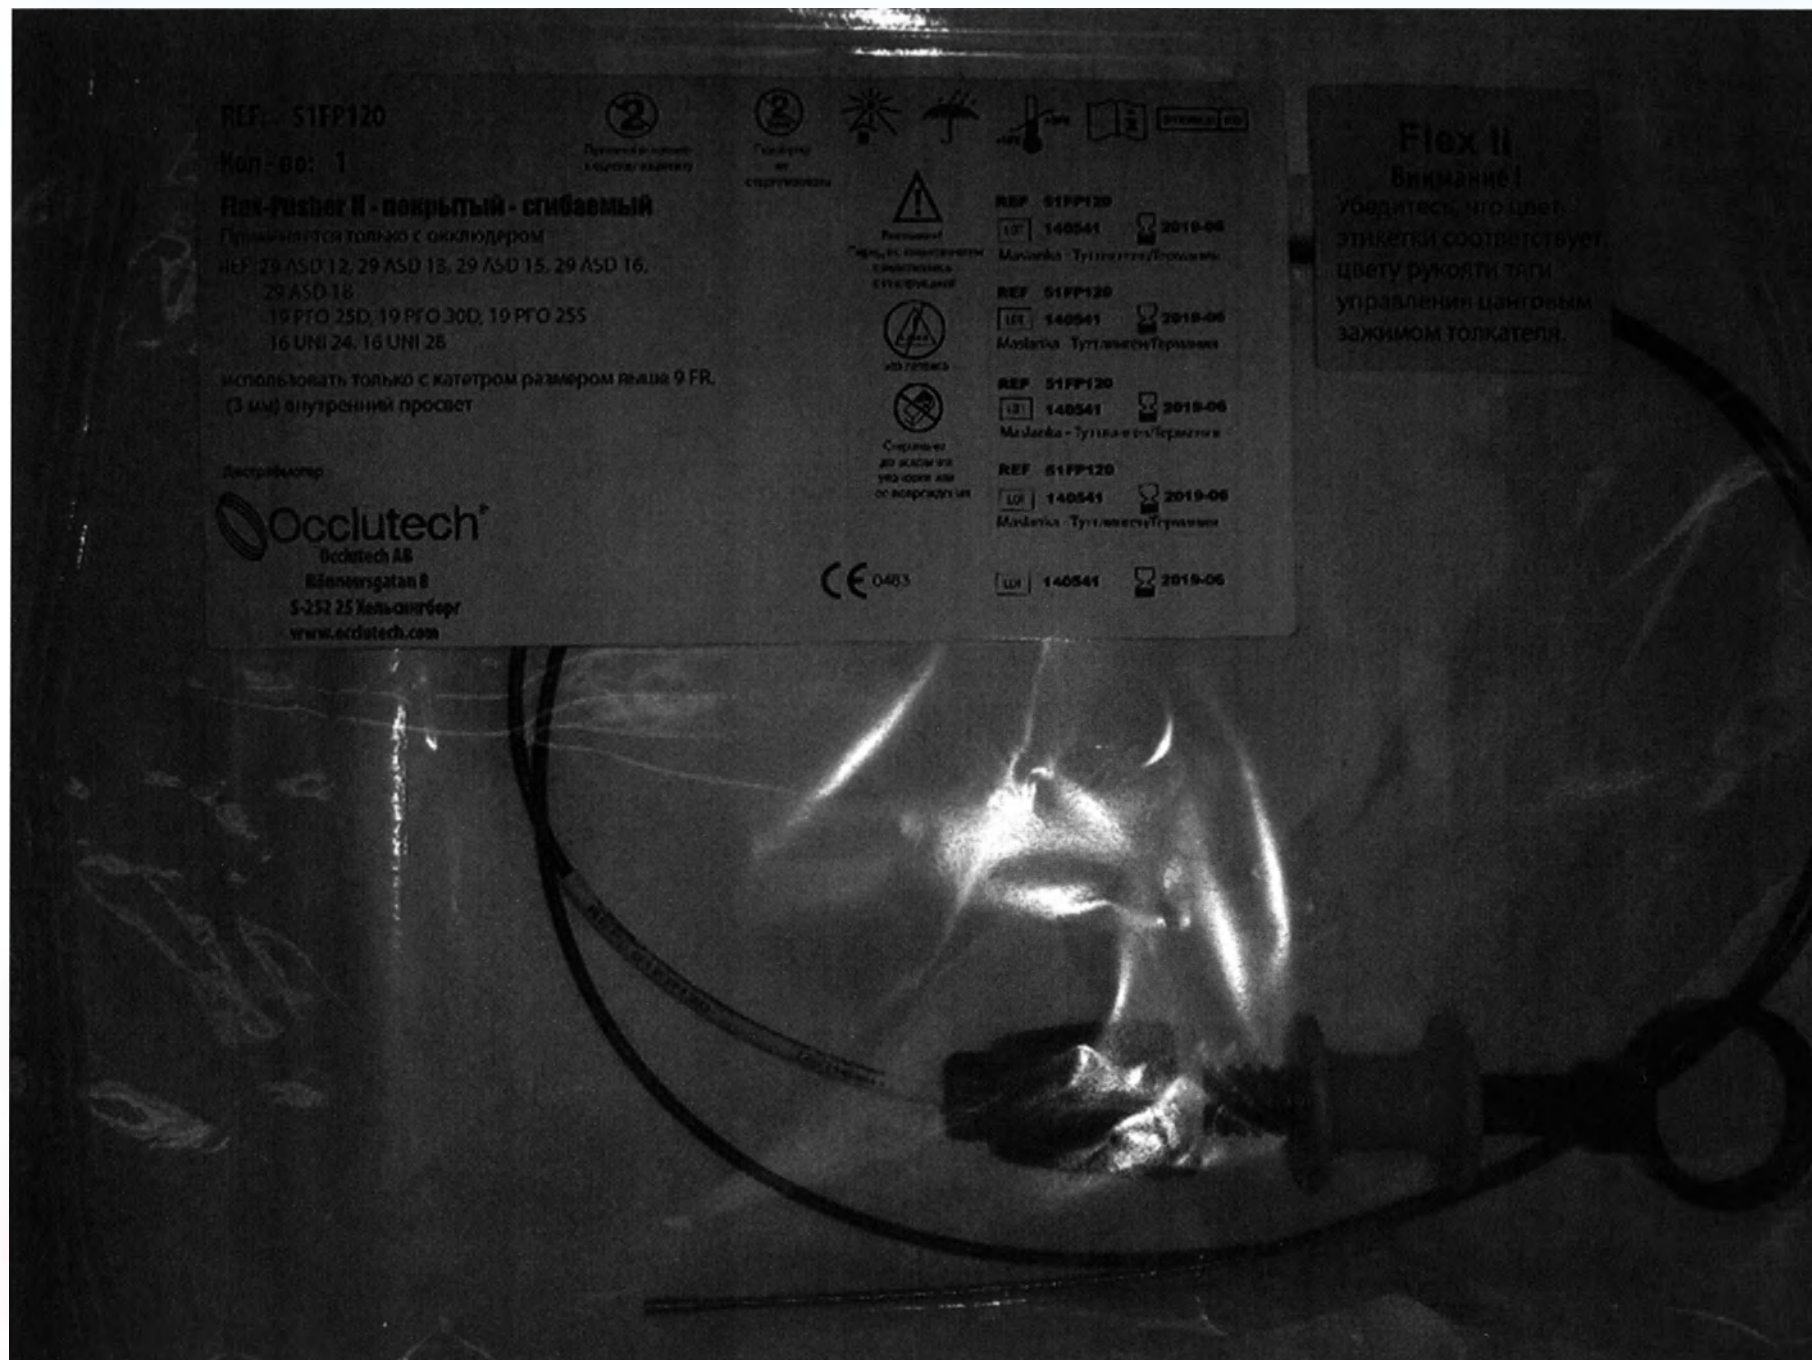

REF: 50FP100L

Кол-во: 1

Flex-Pusher I - не покрытый

применяется только с катетрами

REF: 60PLD04W, 60PLD05W, 60PLD06W, 60PLD07W

61PLD04W, 61PLD05W, 61PLD06W, 61PLD07W

62PLD03T, 62PLD05T, 62PLD07T

63PLD05T, 63PLD07T, 63PLD10T

использовать только с катетром размером выше 6 FR.
(2,71 мм внутреннем просвете)

Дистрибутор:


Occlutech[®]

Occlutech AB

Линн 6

S-232 71 Вальсгрендс

www.occlutech.com



Внимание!
Не использовать
в стерильной
среде



Не использовать



Не использовать
в стерильной
среде

REF: 50FP100L

142382

2020-02

Медиа - Тульские Термостаты

REF: 50FP100L

142382

2020-02

Медиа - Тульские Термостаты

REF: 50FP100L

142382

2020-02

Медиа - Тульские Термостаты

REF: 50FP100L

142382

2020-02

Медиа - Тульские Термостаты

CE 0683

142382

2020-02

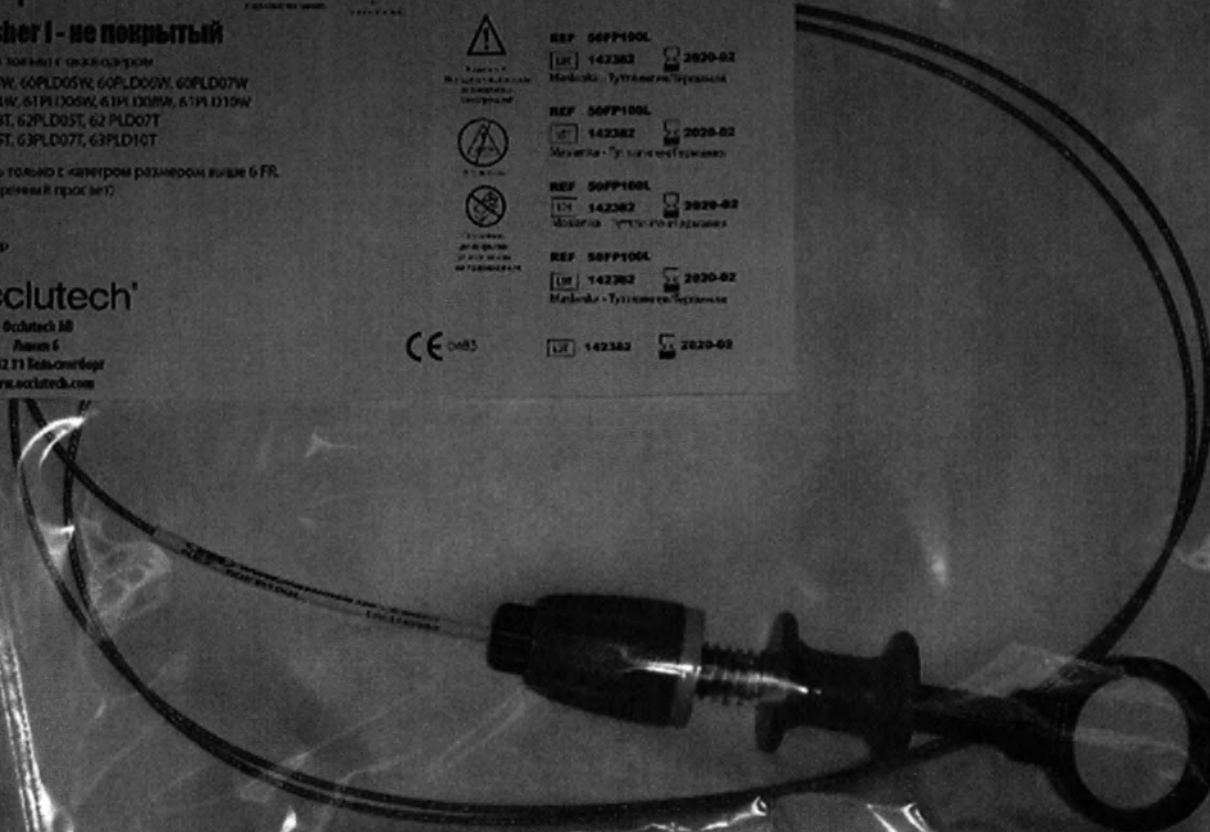


Рис.18. Толкатель Flex-Pusher I







A



B

Рис.20. Система доставки Occlutech. **A** – вид в упаковке, **B** – изображение доставочного катетера с расширителем в сборе.

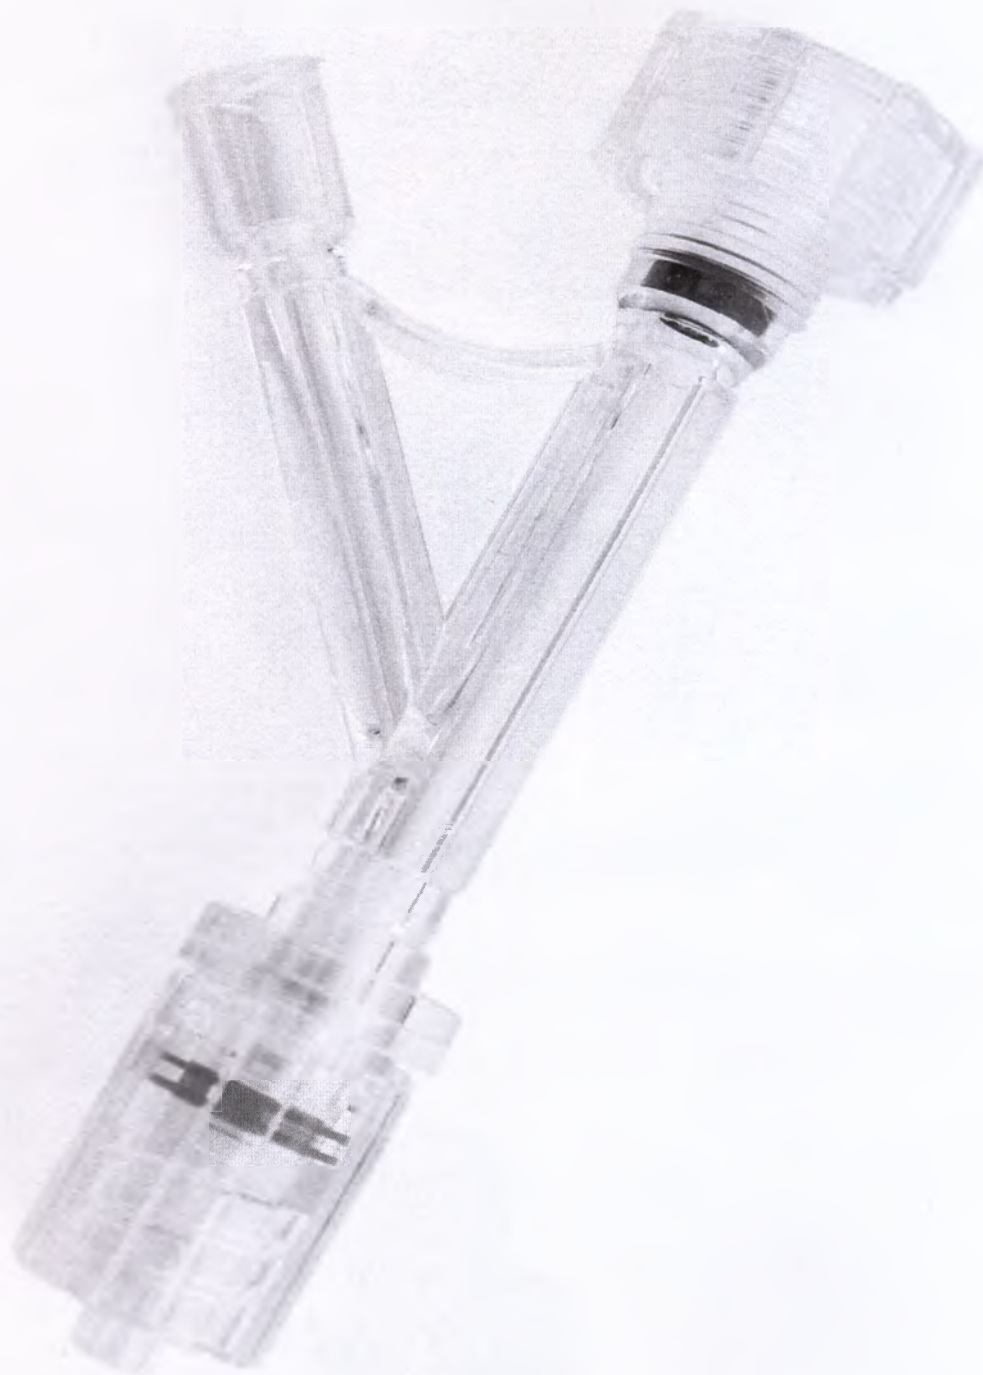

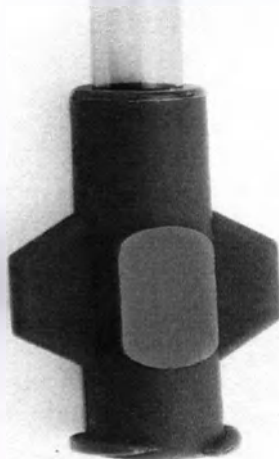

Генеральный директор
ООО «РАЙМЕД ТГ ПВТ»

*Принято
и передано
22 марта*



Кумар Р.