

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «АНАЛИТИКА»


С.А. Балабаев

20 21 г.




Фотографические изображения медицинского изделия


Набор измерительных кювет к коагулометру автоматическому HumaClot Pro
для лабораторных исследований in vitro

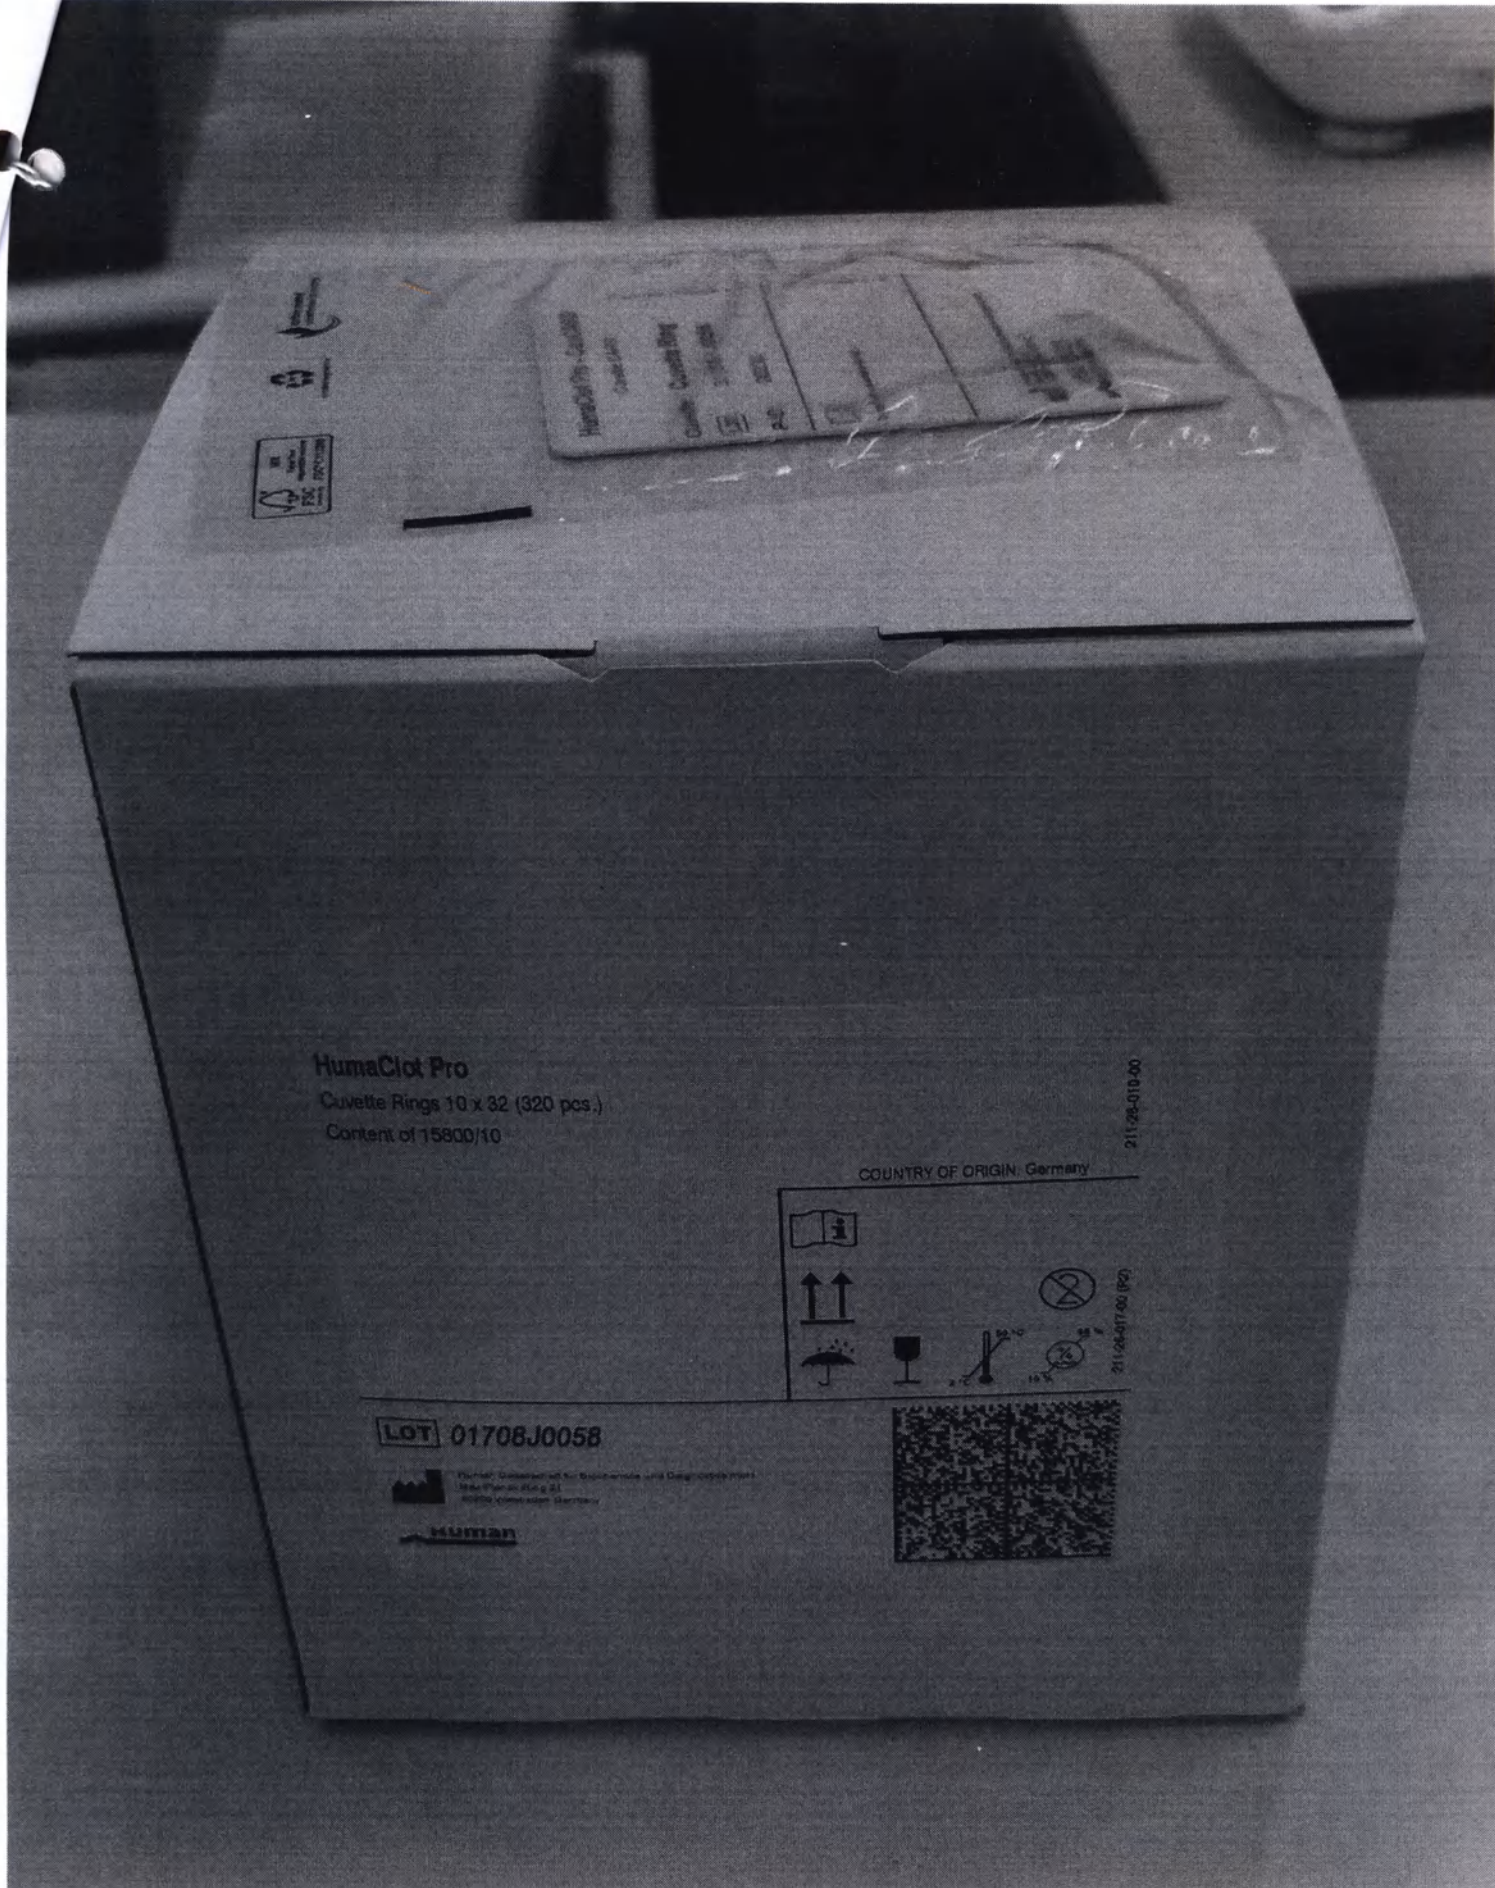

**Фотографическое изображение 1 – Первичная упаковка образца медицинского изделия
«Набор измерительных кювет к коагулометру автоматическому HumaClot Pro для
лабораторных исследований in vitro»**

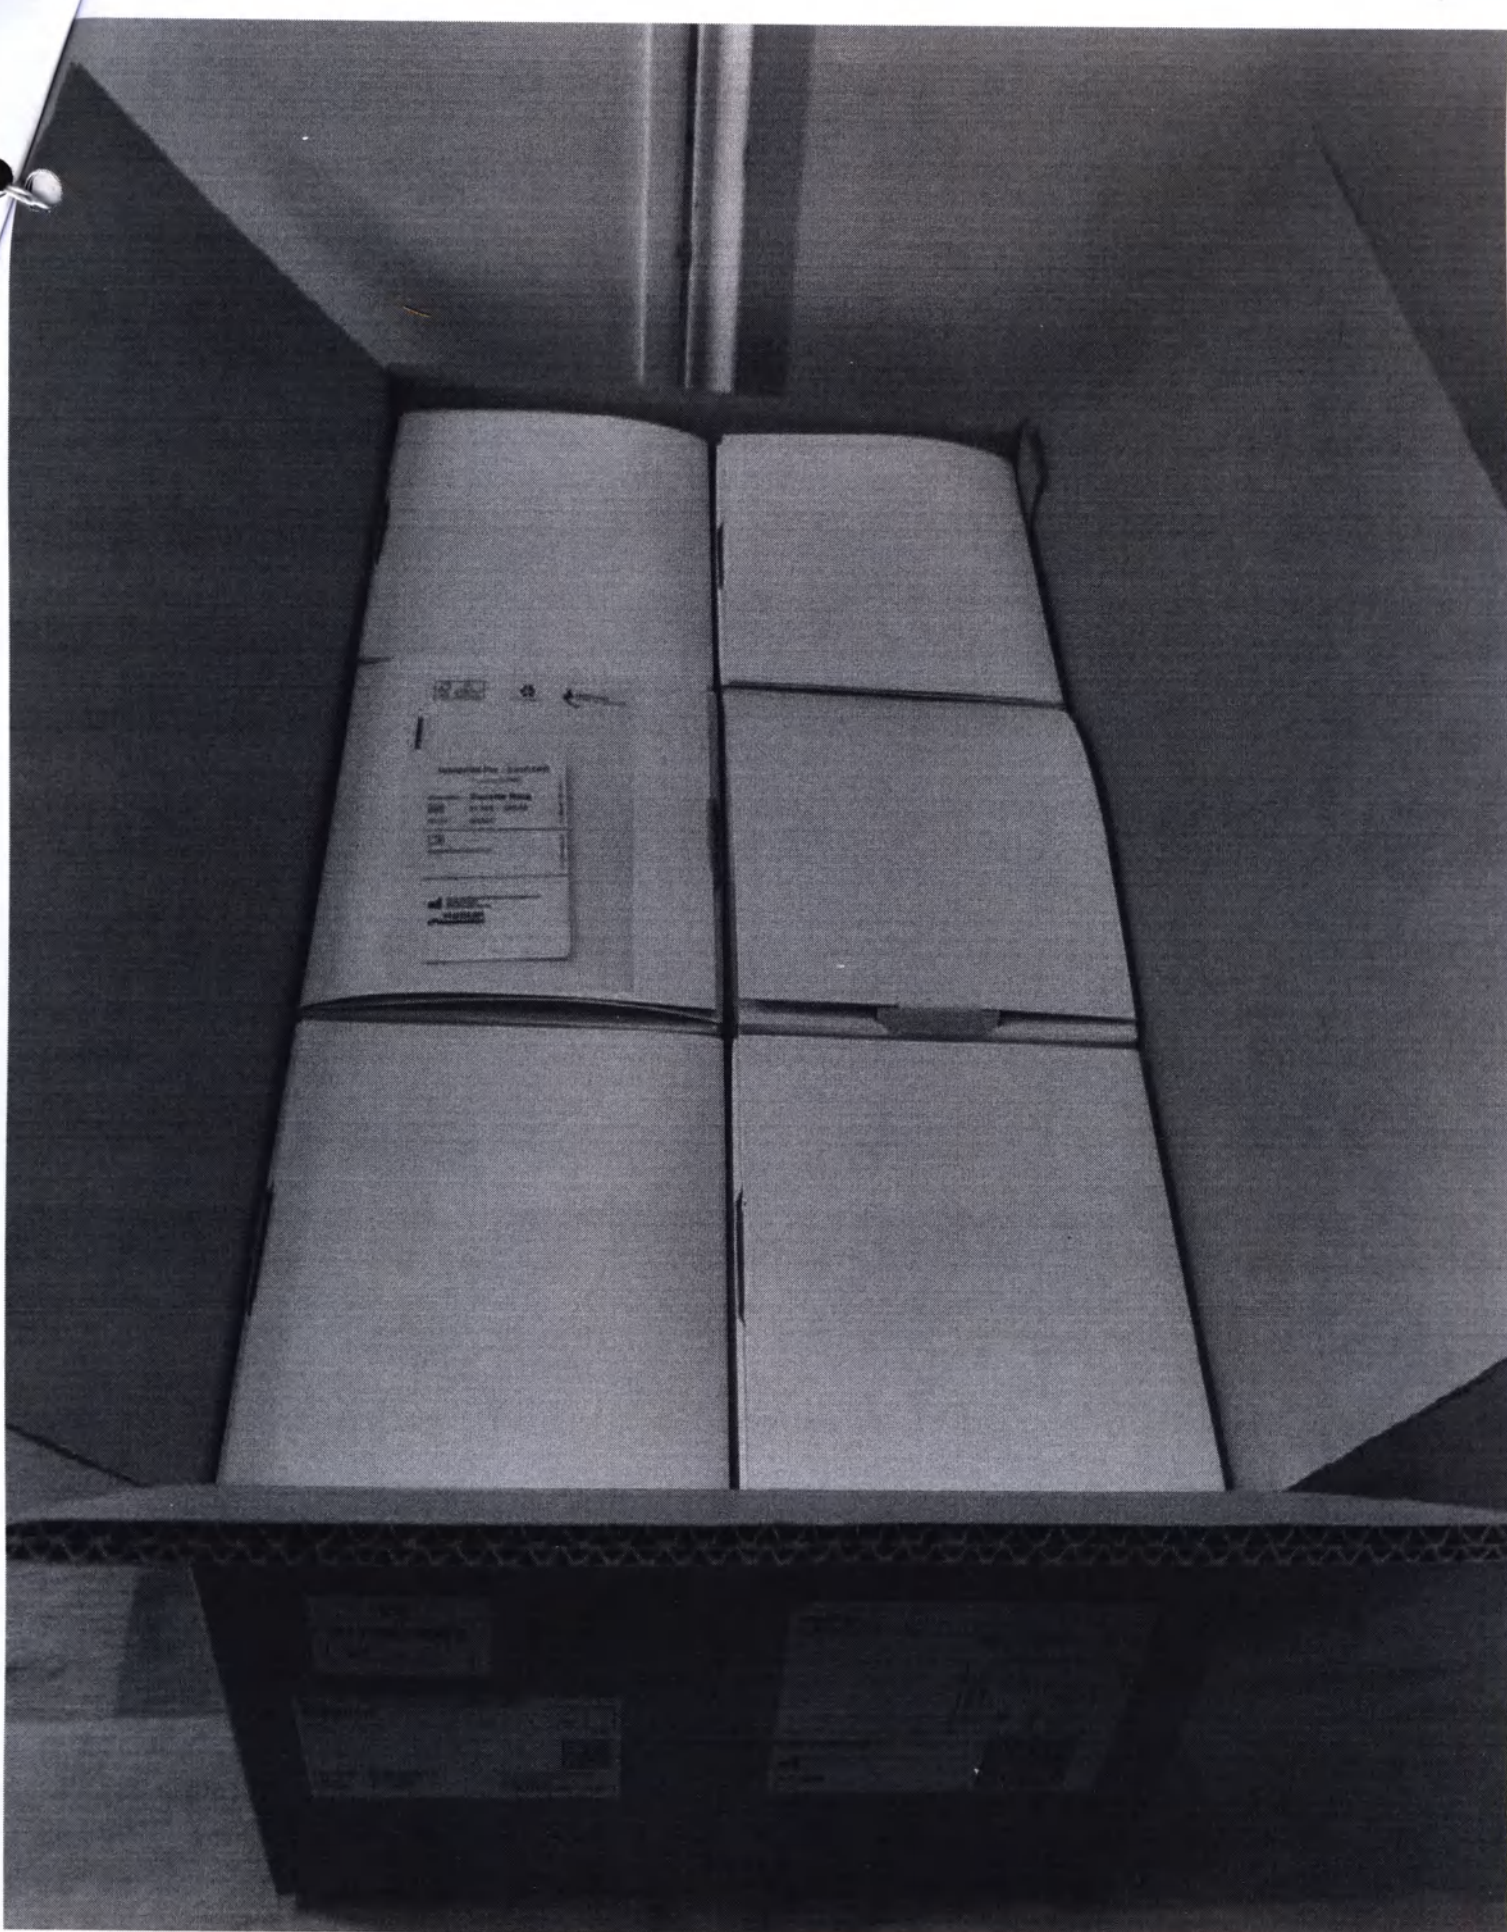

**Фотографическое изображение 2 – Потребительская (транспортная) упаковка
медицинского изделия «Набор измерительных кювет к коагулометру автоматическому
HumaClot Pro для лабораторных исследований in vitro»**

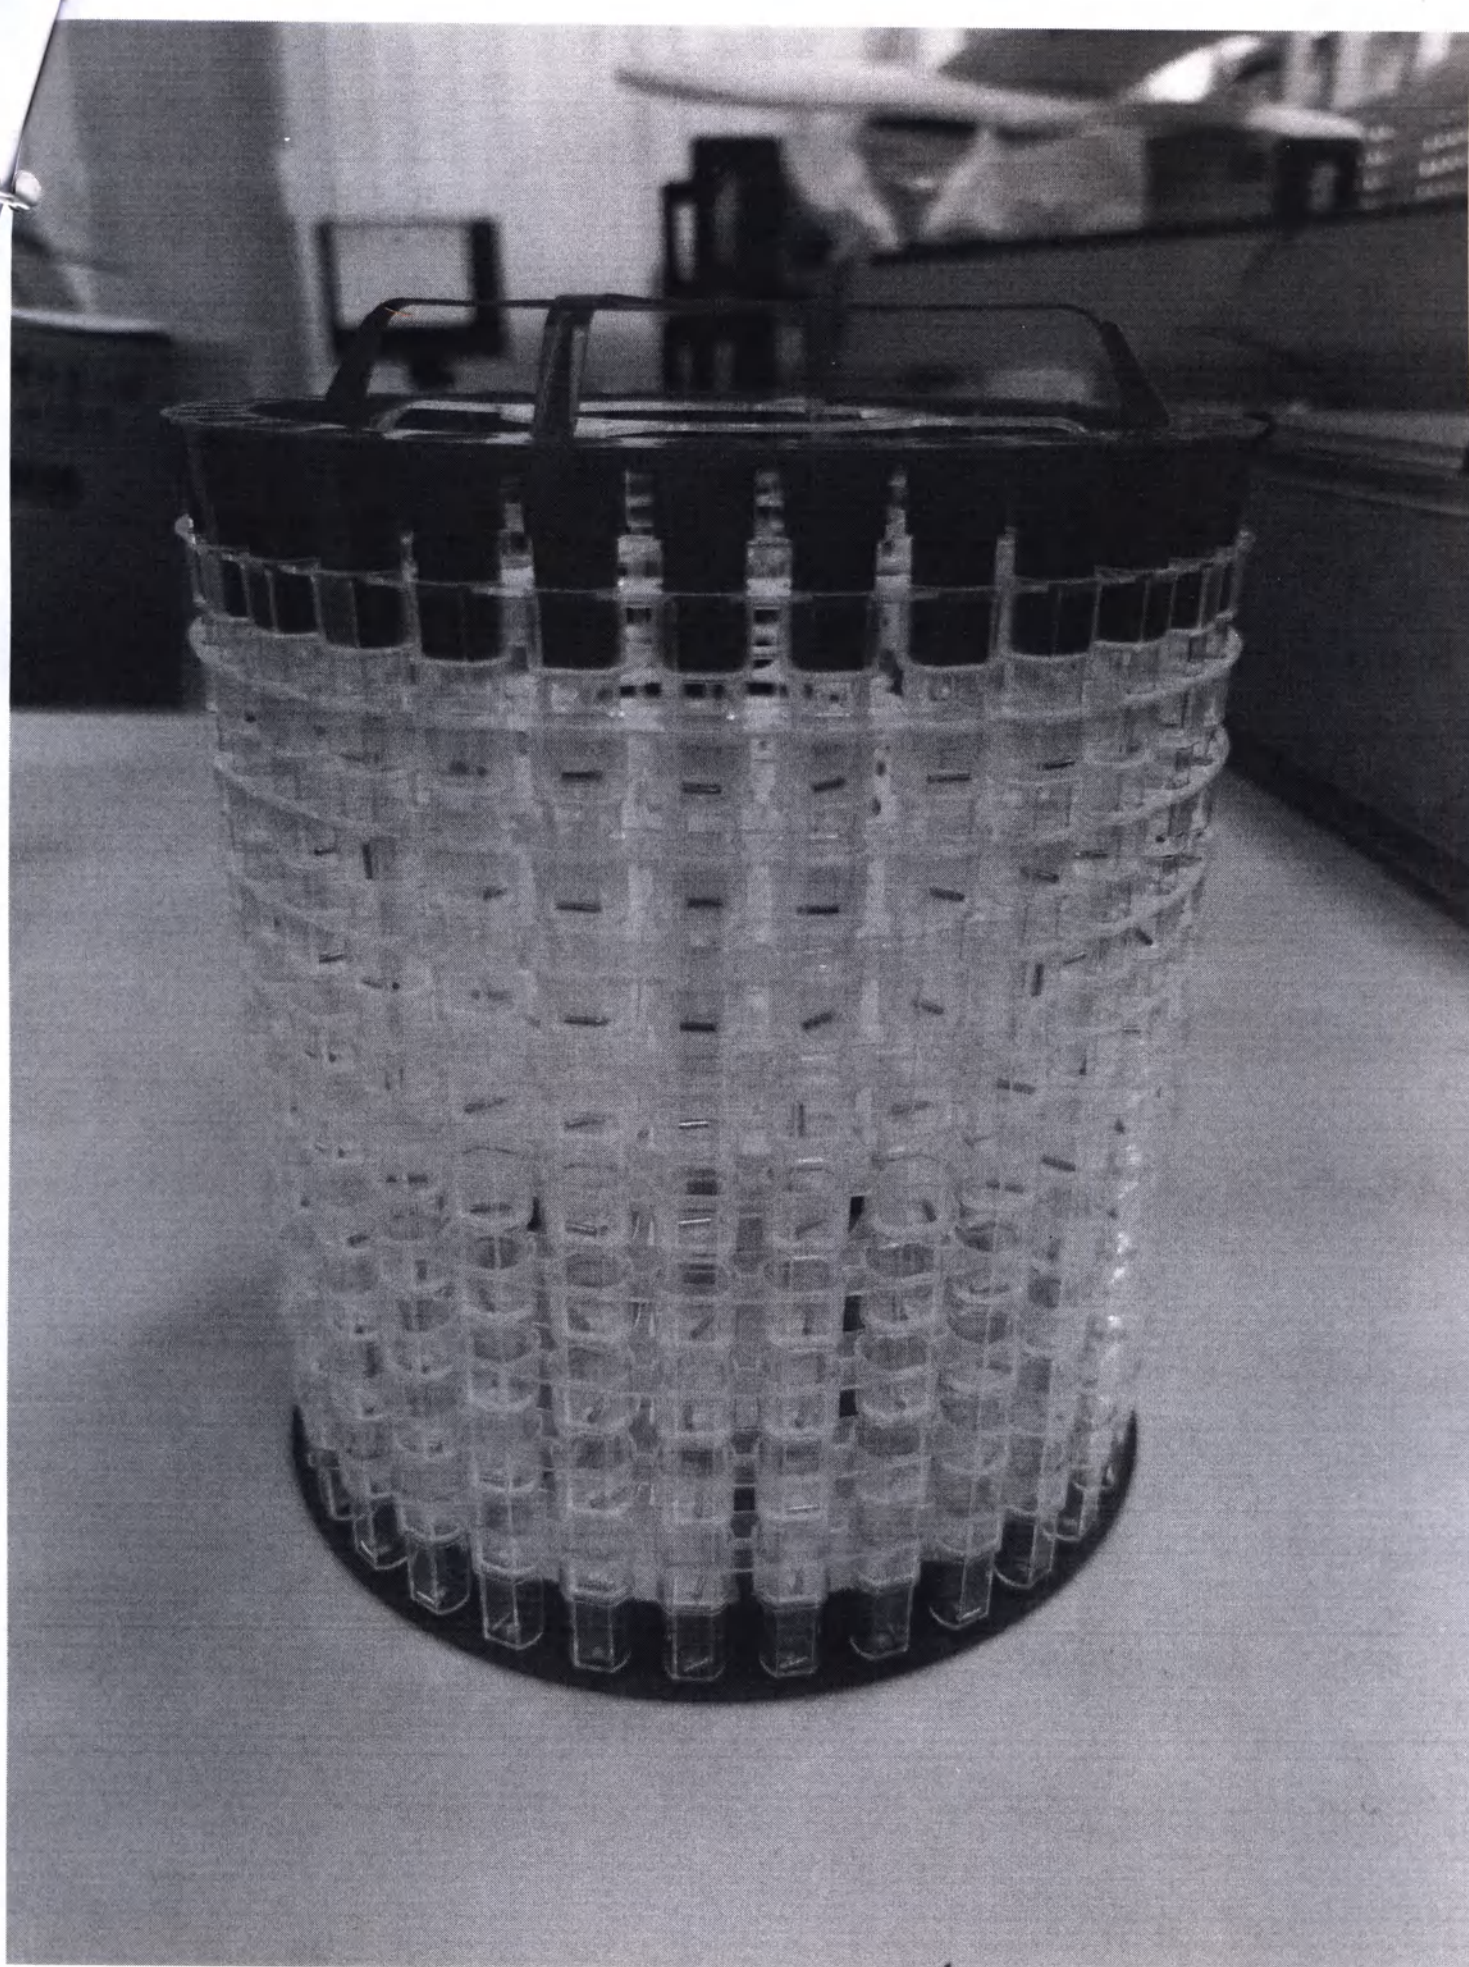

Фотографическое изображение 3 – Моноблок из 32 кювет со стержнями для перемешивания (10 шт./упак.), медицинского изделия «Набор измерительных кювет к коагулометру автоматическому HumaClot Pro для лабораторных исследований in vitro»

HumaClot Pro - CuvCARD

Cuvette CARD

Cuvette: **Cuvette Ring**

LOT

01708 - J0058

P-ID:

20230

211-89-447-00 (R1)




To install, ref to user manual prior to use.

211-89-440-00



Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21
65205 Wiesbaden Germany

human

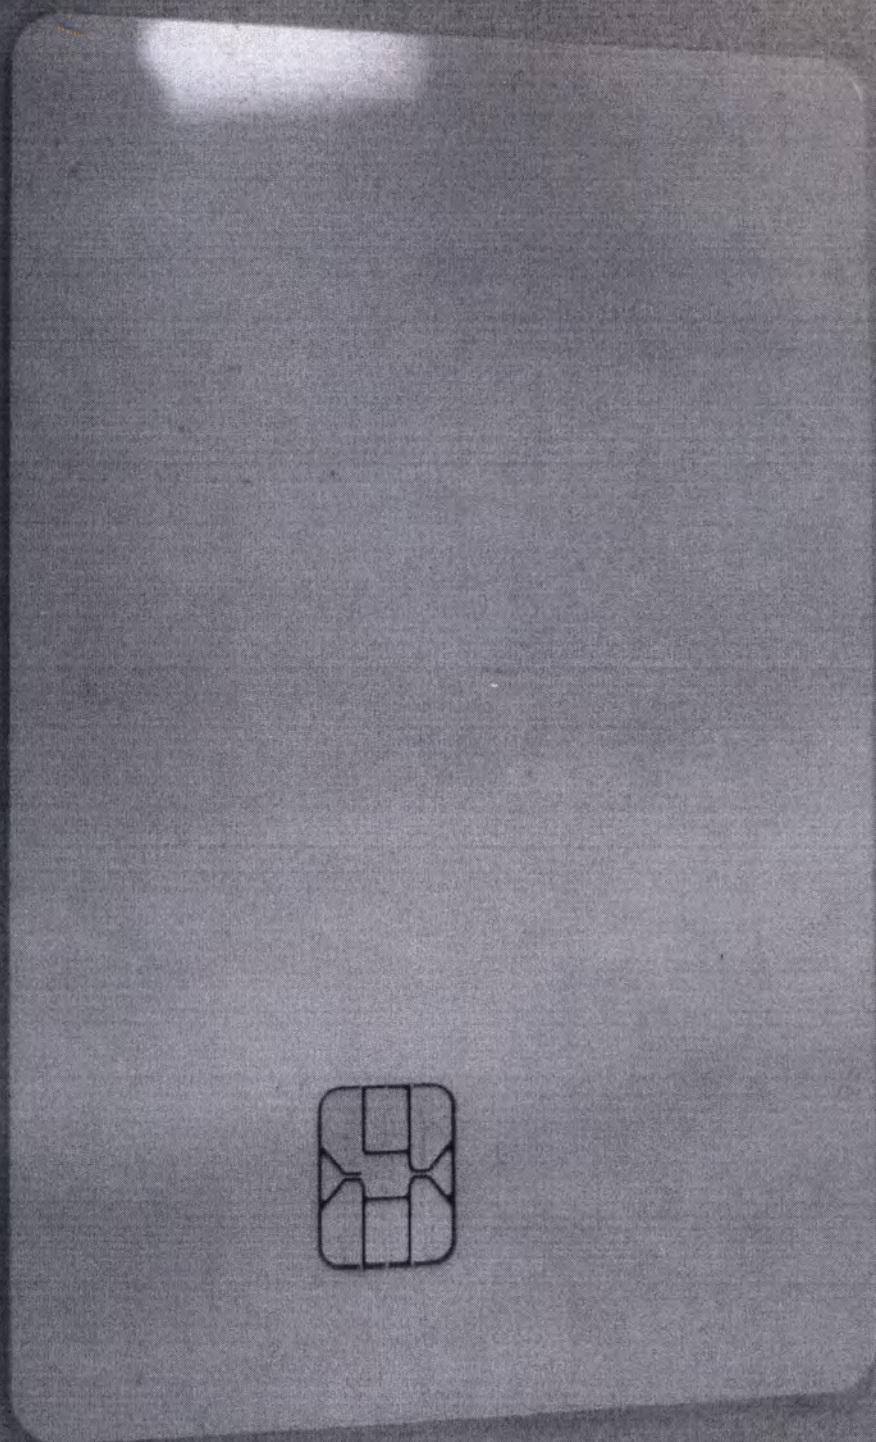

Фотографическое изображение 5 – Карточка кюветная в составе образца медицинского изделия «Набор измерительных кювет к коагулометру автоматическому HumaClot Pro для лабораторных исследований in vitro» (Вид сзади)

Инструкция по применению
Набор измерительных кювет к коагулометру автоматическому HumaClot Pro для
лабораторных исследований in vitro

Фотографическое изображение 6 – Инструкция по применению

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 7 листов.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БАЛАБЕВ С.А.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО "АНАЛИТИКА"

С.А. Балабаев

«29» ноября 2021 г

**Проект маркировки русскоязычного стикера потребительской
(транспортной) упаковки**

Набор измерительных кювет к коагулометру автоматическому HumaClot Pro
для лабораторных исследований *in vitro*

Набор измерительных кювет к коагулометру автоматическому HumaClot Pro для лабораторных исследований *in vitro*:

- Моноблок из 32 кювет со стержнями для перемешивания, 10 шт./упак., 6 упак.
- Карточка кюветная, 1 шт.
- Инструкция по применению, 1 шт.

Производитель:

HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH

(Хуман Гезельшафт фюр Биохемика унд Diagnostika мбХ)

Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия

Температура хранения от +2 °C до +50 °C

Регистрационное Удостоверение №: РЗН ____ от ____ г.

Медицинское изделие для диагностики *in vitro*

Основные свойства и характеристики, состав, правила и условия
использования: см. вложенную инструкцию на русском языке

Уполномоченный представитель в РФ: ЗАО "АНАЛИТИКА",

129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1

Кат. №: 15800/10

