

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ЛабПэк»

А.А. Козаренко

«15» октября 2021 г.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия для диагностики ин витро

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2

методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин»

серия 7, серия 8, серия 9



1. Набор реагентов «SARS-CoV-2-скрин», форма комплектации 1, серия 7 (общий вид)







1.1.1. Магнетизированный сорбент

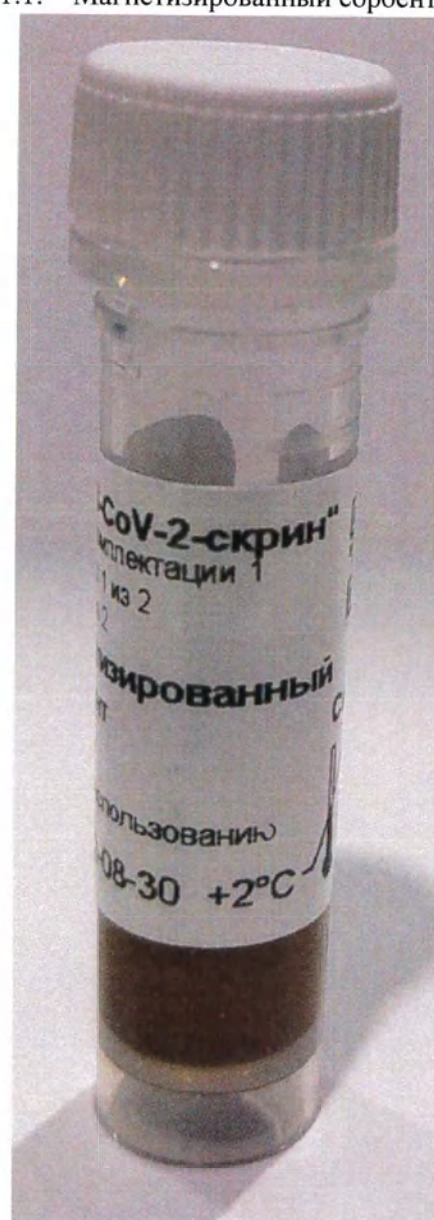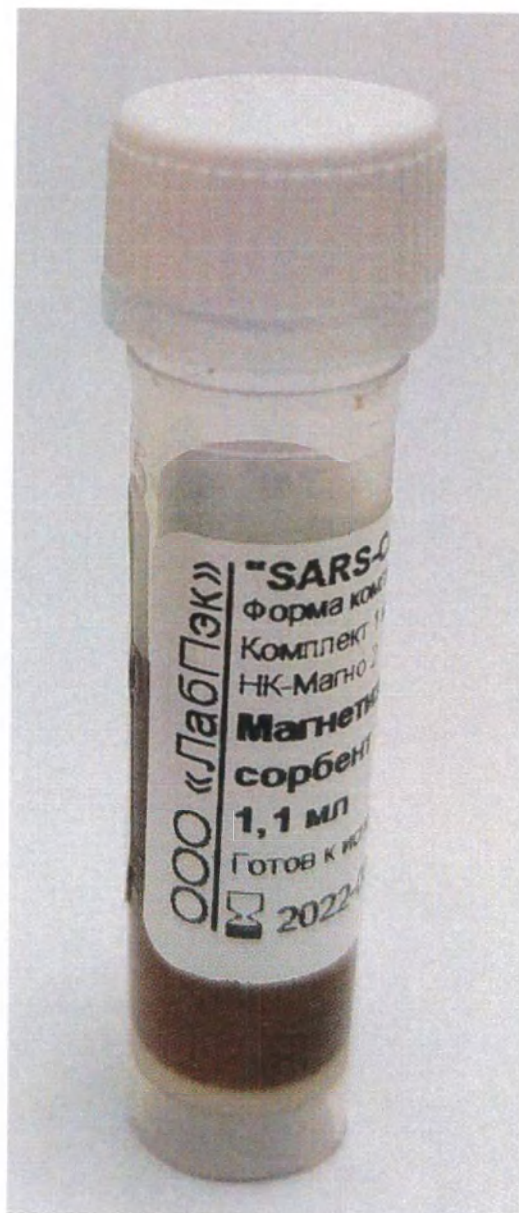

1.1.2. Лизирующий буфер




1.1.3. Промывочный буфер 1



1.1.4. Промывочный буфер 2



1.1.5. Элюирующий буфер

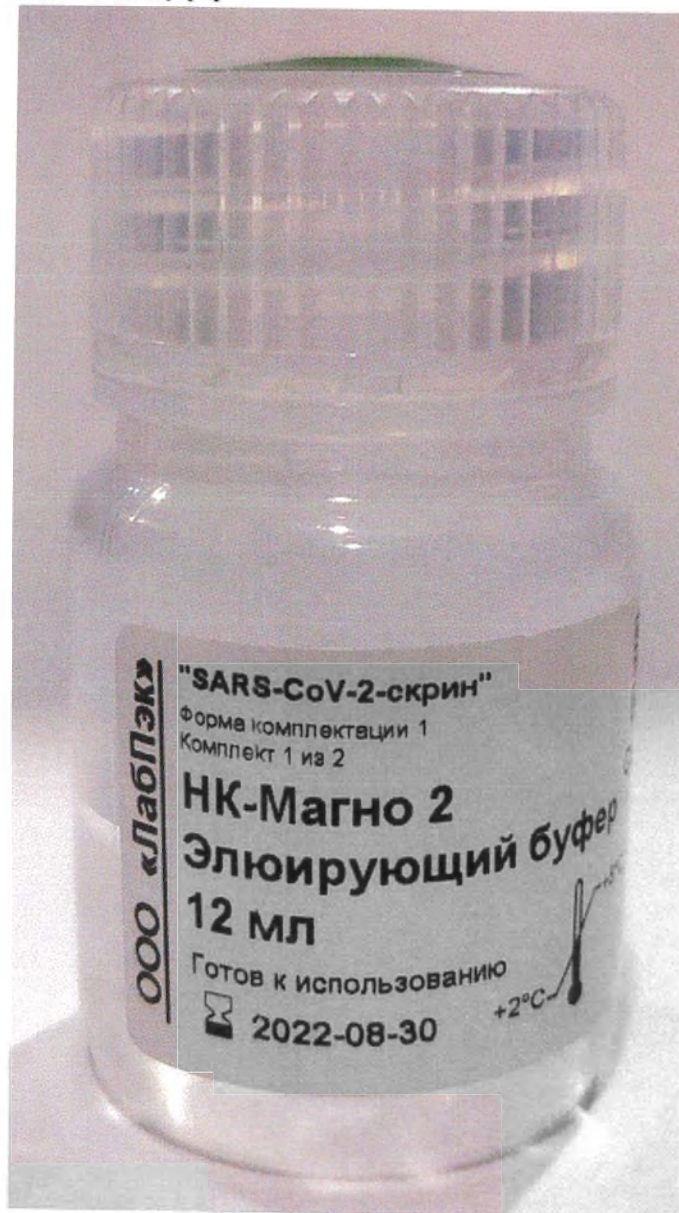

Набор реагентов для качественного выявления
РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР
в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин»
серия 7, серия 8, серия 9

Комплект реагентов для ОТ-ПЦР-РВ «SARS-CoV-2-скрин» (SARS-CoV-2).

Форма комплектации 1. Комплект 2 из 2.

Состав комплекта:

- Буфер SARS-CoV-2	1,5 мл	1 пробирка
- ОТ-полимераза	0,1 мл	1 пробирка
- ПКО SARS-CoV-2	1,0 мл	1 пробирка
- ОКО	1,0 мл	1 пробирка

Серия 7



2021-08-30



2022-08-30

Условия хранения:



-25°C



-16°C





96




ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург,
наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н,
тел. +7(812)490-75-93 info@labpack.ru

Только для профессионального применения


1.2.1. Буфер SARS-CoV-2

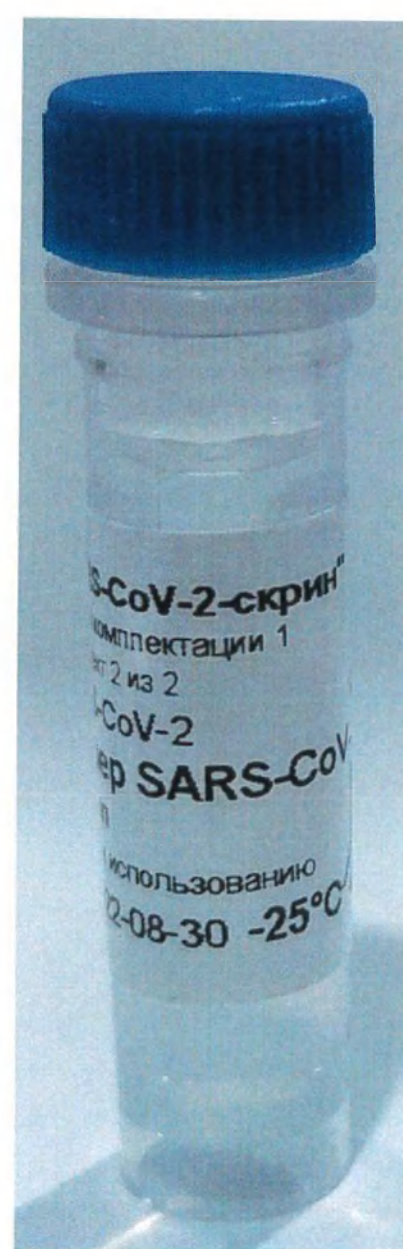
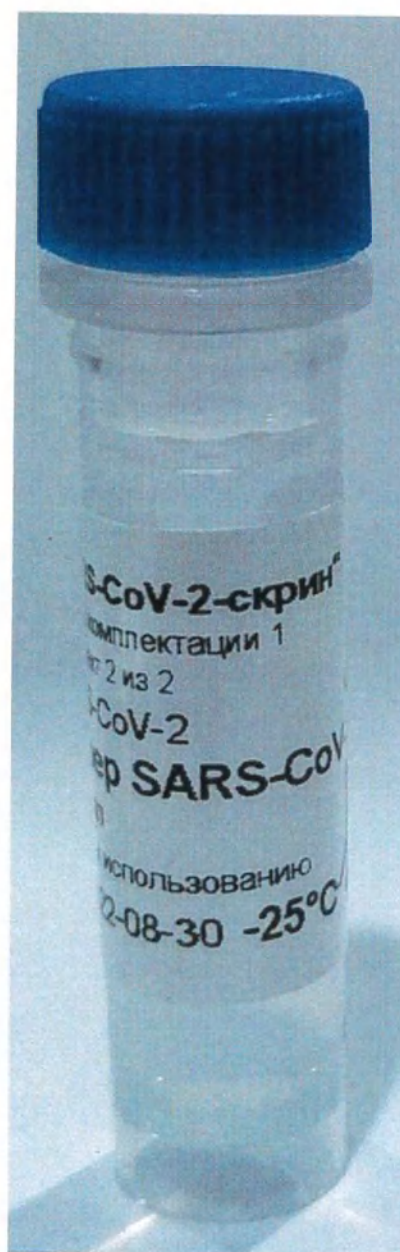


1.2.2. ОТ-полимераза

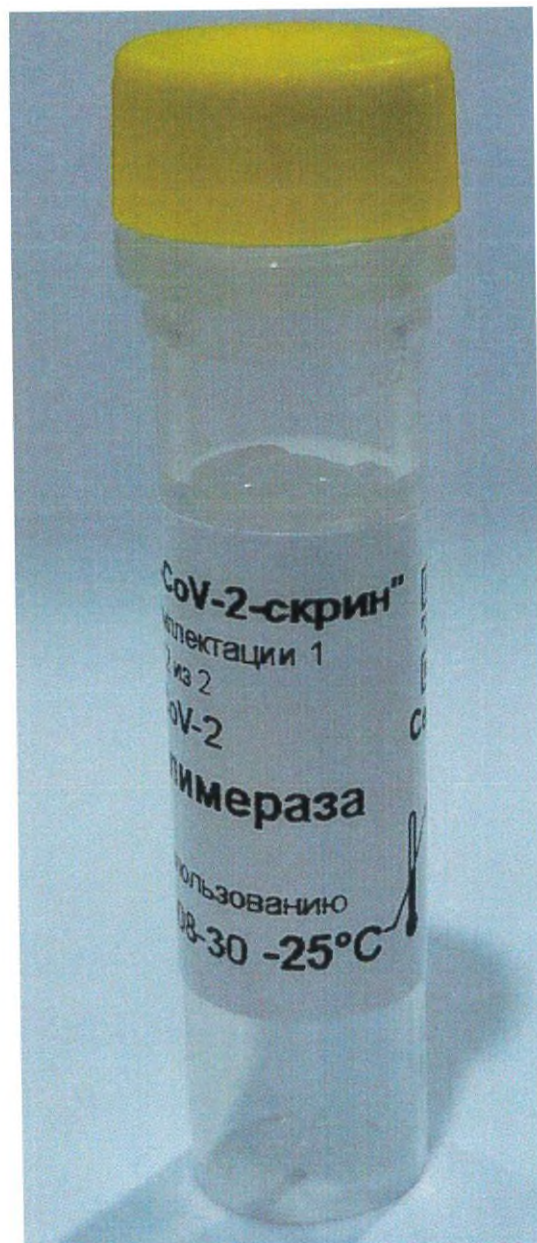

1.2.3. ПКО SARS-CoV-2

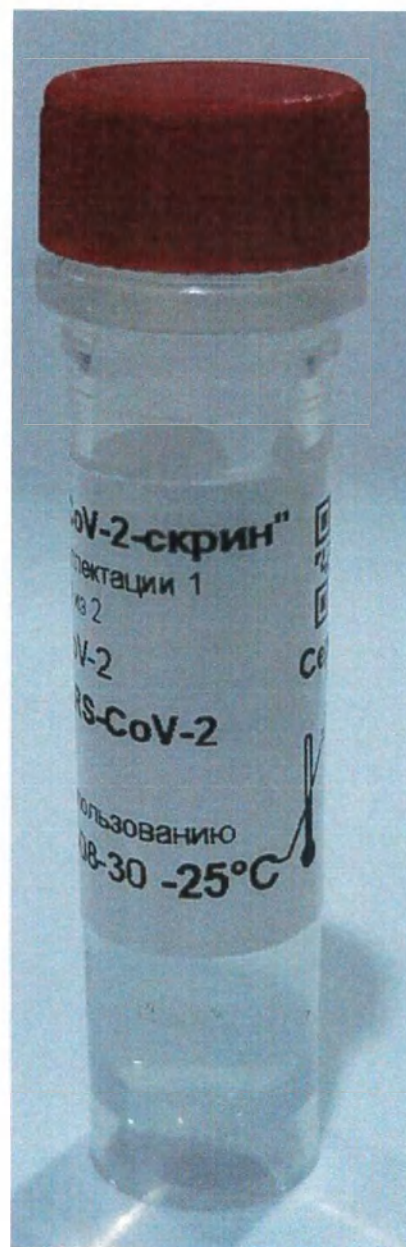

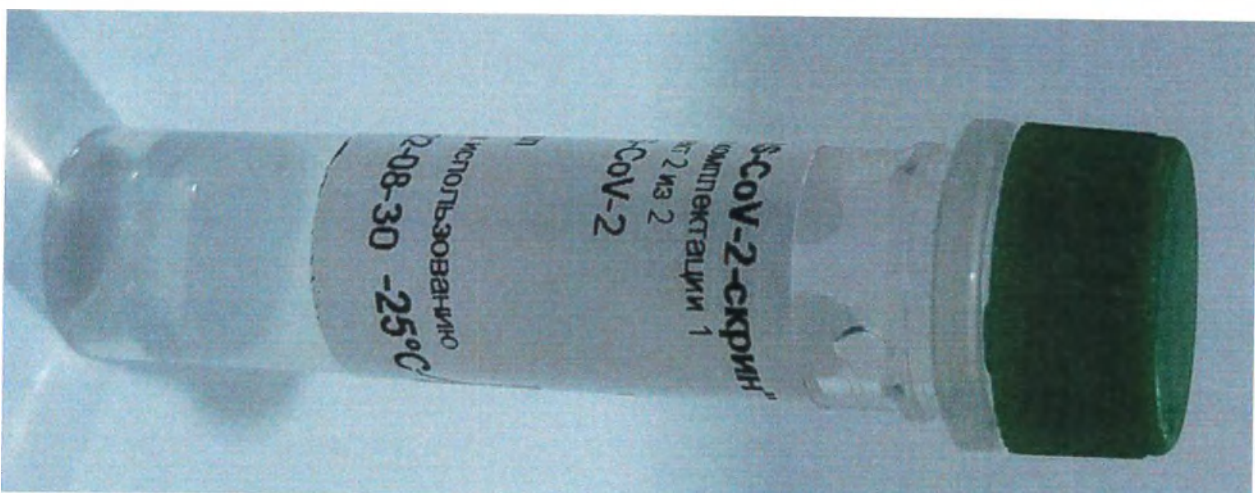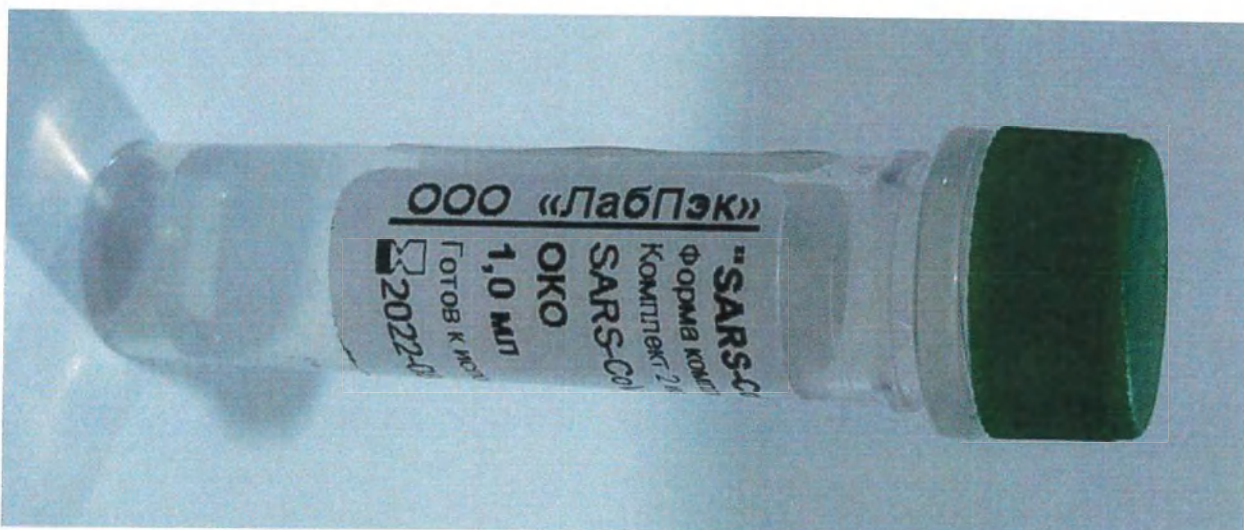

2. Набор реагентов «SARS-CoV-2-скрин», форма комплектации 2, серия 7 (общий вид)



Набор реагентов для количественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени
«SARS-CoV-2-скрин» серия 7, серия А, серия В

"SARS-CoV-2-скрин"
Форма комплектации 2. Состав набора:

1. Буфер 1 из 2
2. ОТ-полимераза для амплификации субстрата РНК и ДНК из биологических материалов «OT-Master 2» 200 мкл
3. ПКО SARS-CoV-2
4. ПКО SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2)
5. ПКО SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2)
6. ПКО SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2)

Условия хранения:  +2°C - +8°C  -16°C - -25°C

Серия 7  2021-09-01
  2022-09-01
  IVD  96 

ООО «ЛабПак» 197376, г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н, тел. +7(812)490-75-93, info@labpack.ru

**ОТ-ПЦР-ПВ «SARS-CoV-2-скрин»
(SARS-CoV-2).**

Форма комплектации 2. Комплект 2 из 2.

Состав комплекта:

Буфер SARS-CoV-2	1,6 мл	1 пробирка
ОТ-полимераза	0,1 мл	1 пробирка
ПКО SARS-CoV-2	1,0 мл	1 пробирка
ОКО	1,0 мл	1 пробирка

Серия 7  2021-09-01
  IVD  2022-09-01

Условия хранения:  +2°C - +8°C  -16°C - -25°C  96 

ООО «ЛабПак» 197376 г. Санкт-Петербург,
наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н,
тел. +7(812)490-75-93 info@labpack.ru

Только для профессионального применения

2.1. Комплект реагентов для автоматического выделения РНК и ДНК из биологического материала «НК-Магно 2» (НК-Магно 2)
(Комплект 1 из 2)





2.1.1. Планшет с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом



2.1.2. Планшет с промывочным буфером



2.1.3. Планшет с элюирующим буфером



2.1.4. Гребенка



Набор реагентов для качественного выявления
РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР
в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин»
серия 7, серия 8, серия 9

"SARS-CoV-2-скрин"

Комплект реагентов для
ОТ-ПЦР-РВ «SARS-CoV-2-скрин»
(SARS-CoV-2).

Форма комплектации 2. Комплект 2 из 2.

Состав комплекта:

- Буфер SARS-CoV-2	1,5 мл	1 пробирка
- ОТ-полимераза	0,1 мл	1 пробирка
- ПКО SARS-CoV-2	1,0 мл	1 пробирка
- ОКО	1,0 мл	1 пробирка

Серия 7



2021-09-01



2022-09-01

Условия хранения:



-25°C



-16°C




96






ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург,
наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н,
тел. +7(812)490-75-93 info@labpack.ru

Только для профессионального применения


2.2.1. Буфер SARS-CoV-2

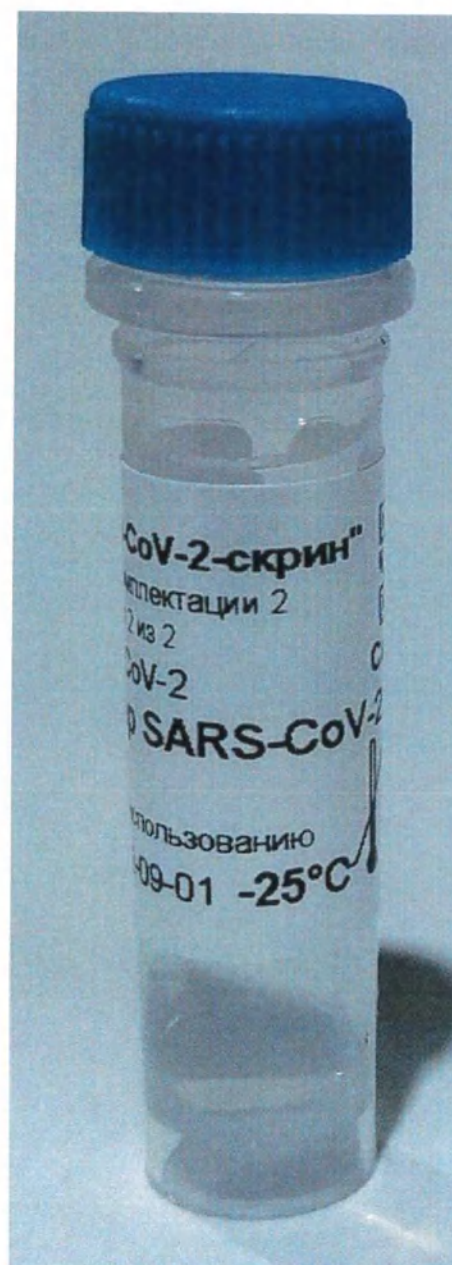

2.2.2. ОТ-полимераза

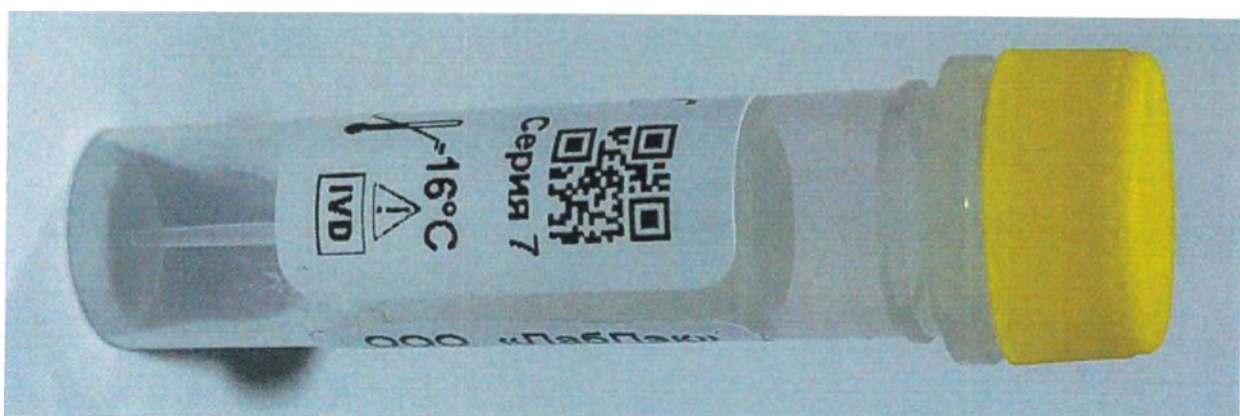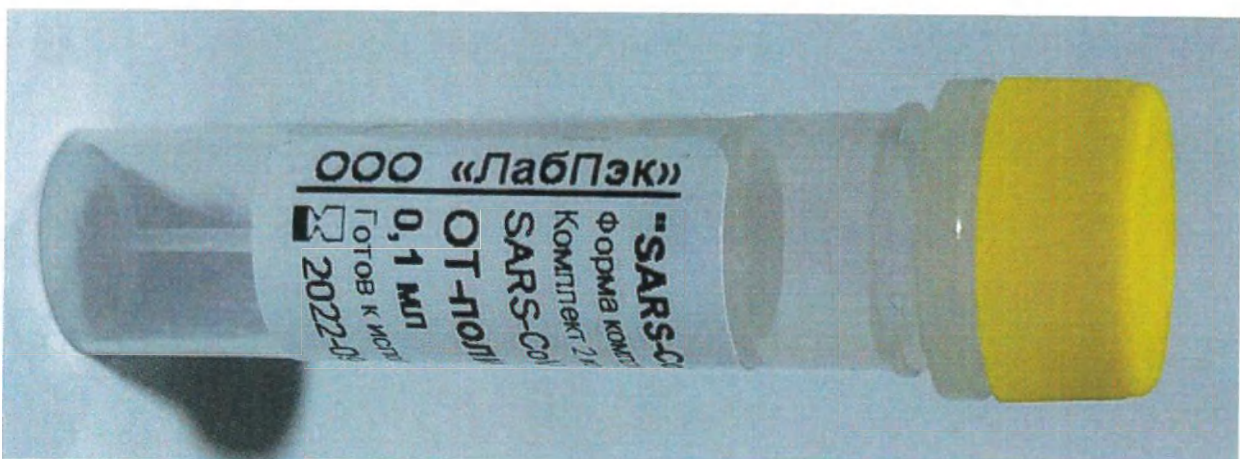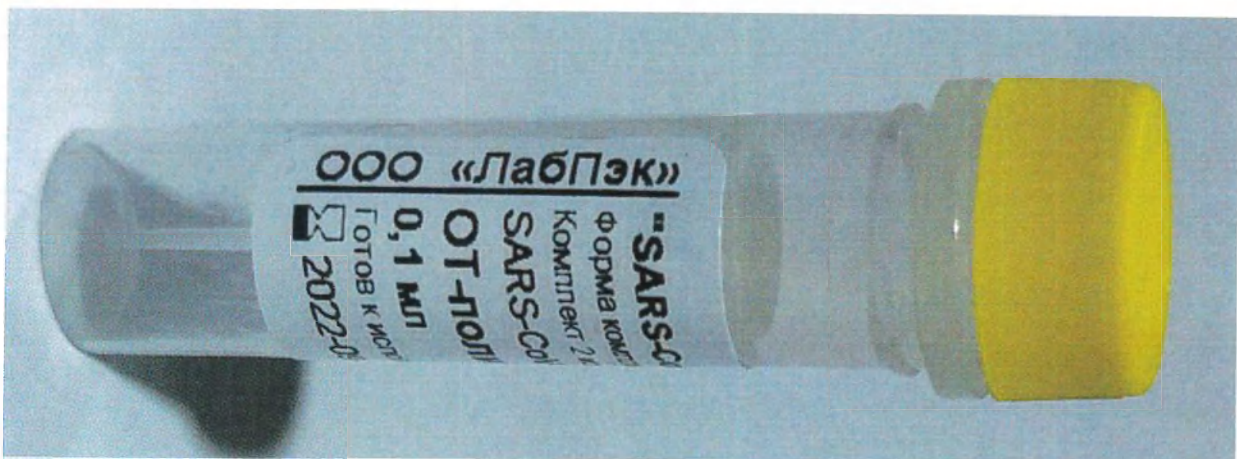

2.2.3. ПКО SARS-CoV-2

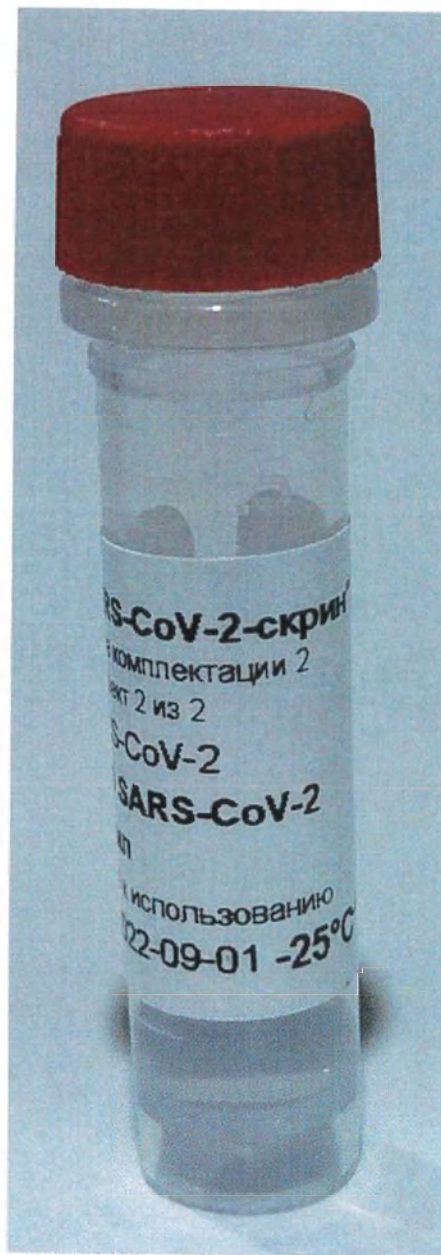

2.2.4. ОКО



3. Набор реагентов «SARS-CoV-2-скрин», форма комплектации 1, серия 8 (общий вид)





Набор реагентов «SARS-CoV-2-скрин», форма комплектации 1, серия 8:



3.1. Комплект реагентов для ручного выделения РНК и ДНК из биологического материала «НК-Магно 2» (НК-Магно 2) (Комплект 1 из 2)



3.1.1. Магнетизированный сорбент

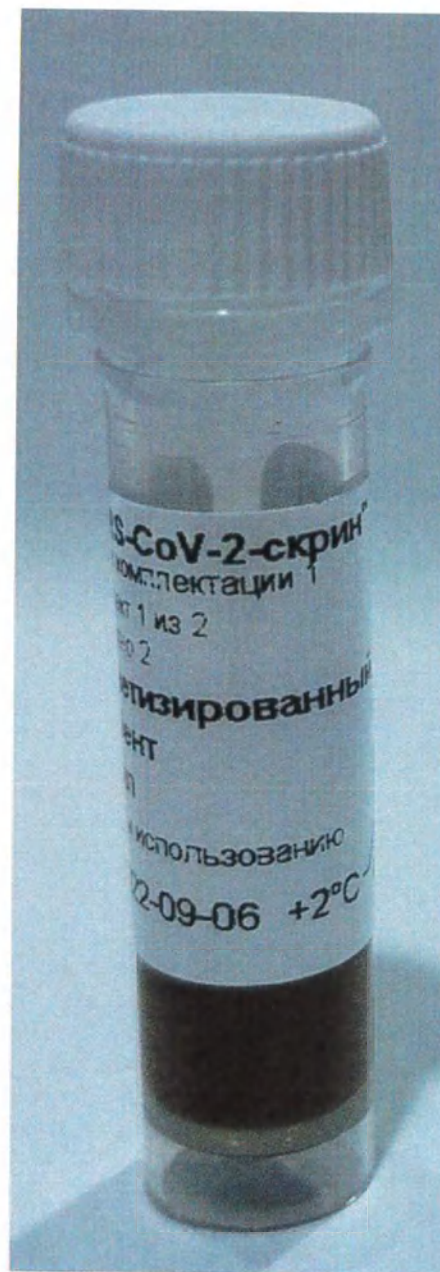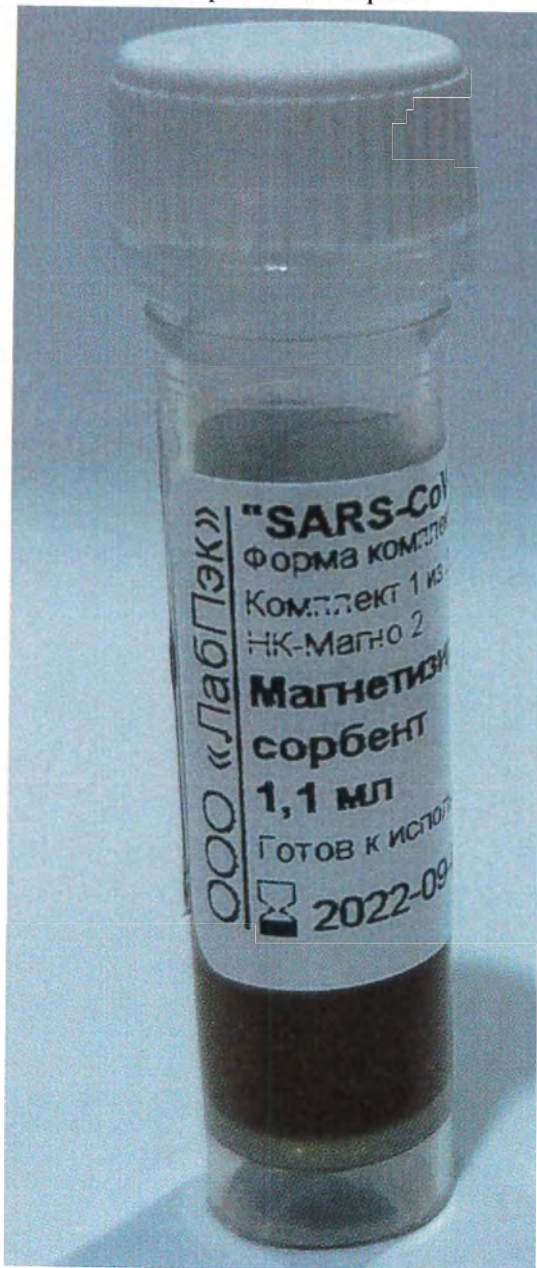



3.1.2. Лизирующий буфер



3.1.3. Промывочный буфер 1



3.1.4. Промывочный буфер 2

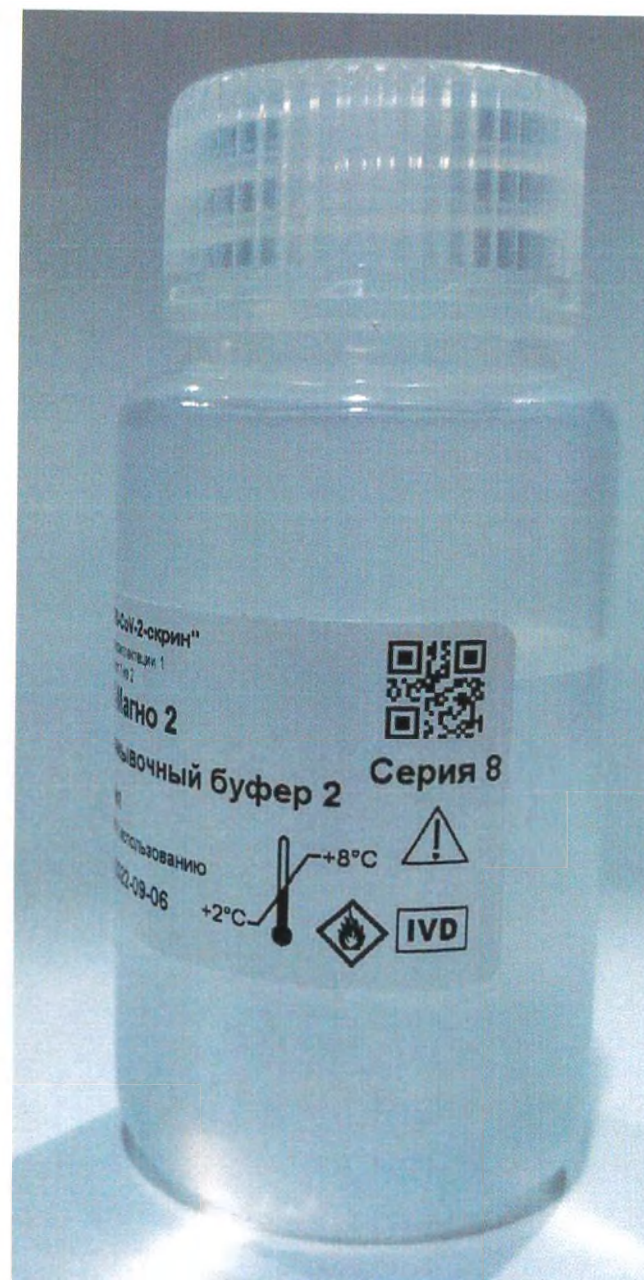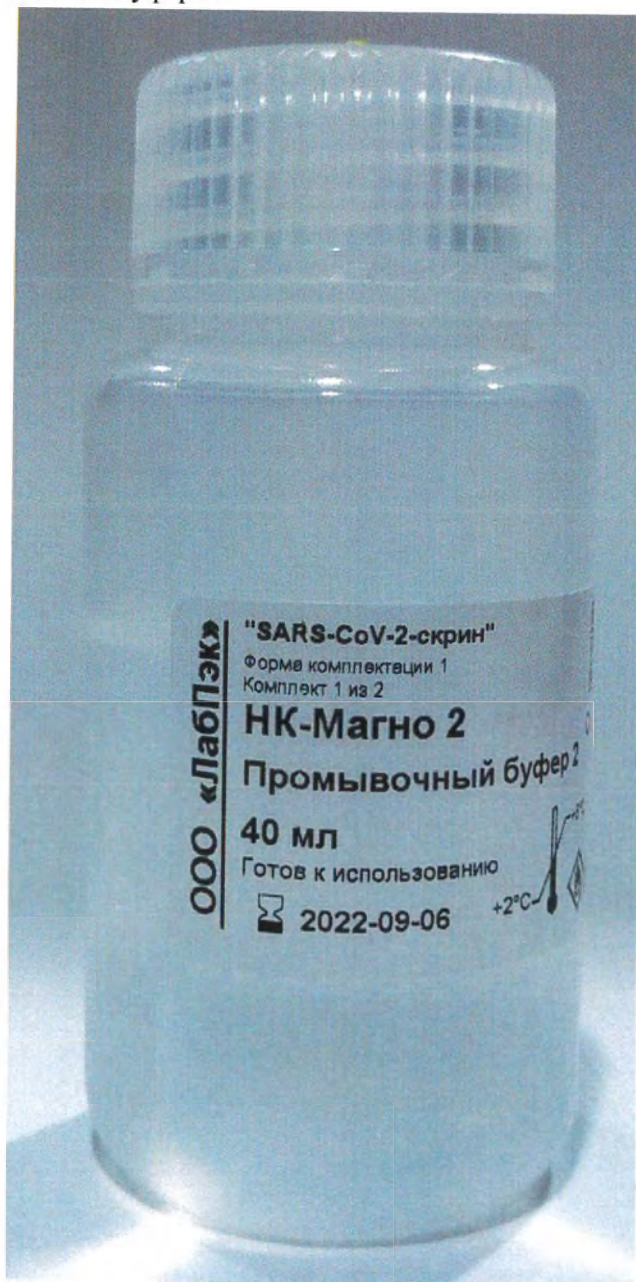

3.1.5. Элюирующий буфер



Набор реагентов для качественного выявления
РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР
в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин»
серия 7, серия 8, серия 9

Комплект реагентов для ОТ-ПЦР-РВ «SARS-CoV-2-скрин» (SARS-CoV-2).

Форма комплектации 1. Комплект 2 из 2.

Состав комплекта:

- Буфер SARS-CoV-2	1,5 мл	1 пробирка
- ОТ-полимераза	0,1 мл	1 пробирка
- ПКО SARS-CoV-2	1,0 мл	1 пробирка
- ОКО	1,0 мл	1 пробирка

Серия 8



2021-09-06



2022-09-06

Условия хранения:



-25°C -16°C






96




ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург,
наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н,
тел. +7(812)490-75-93 info@labpack.ru

Только для профессионального применения


3.2.1. Буфер SARS-CoV-2

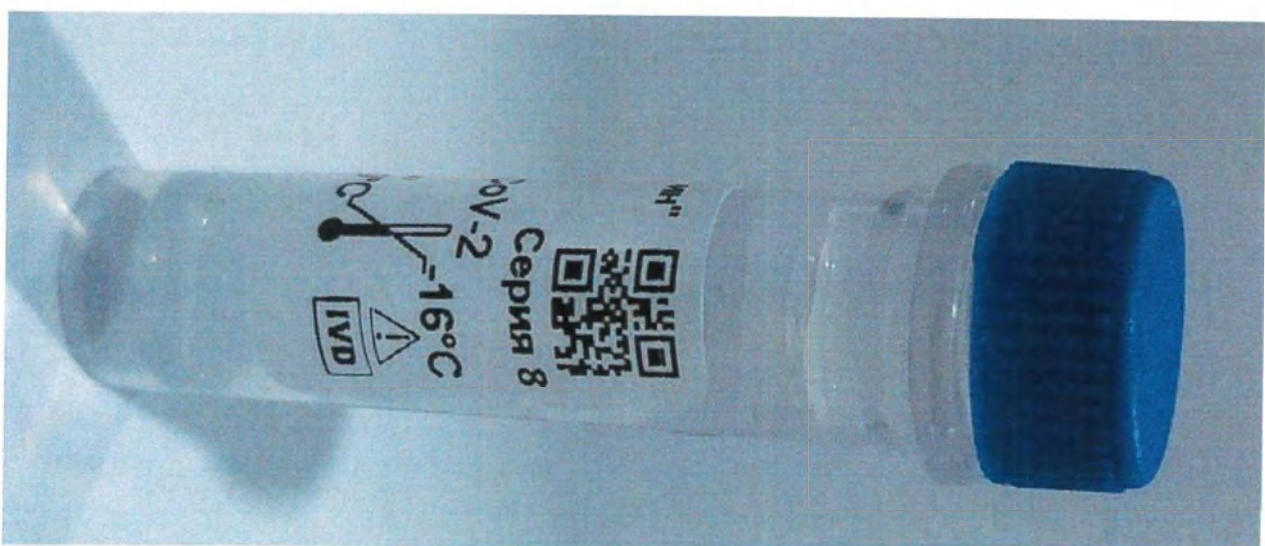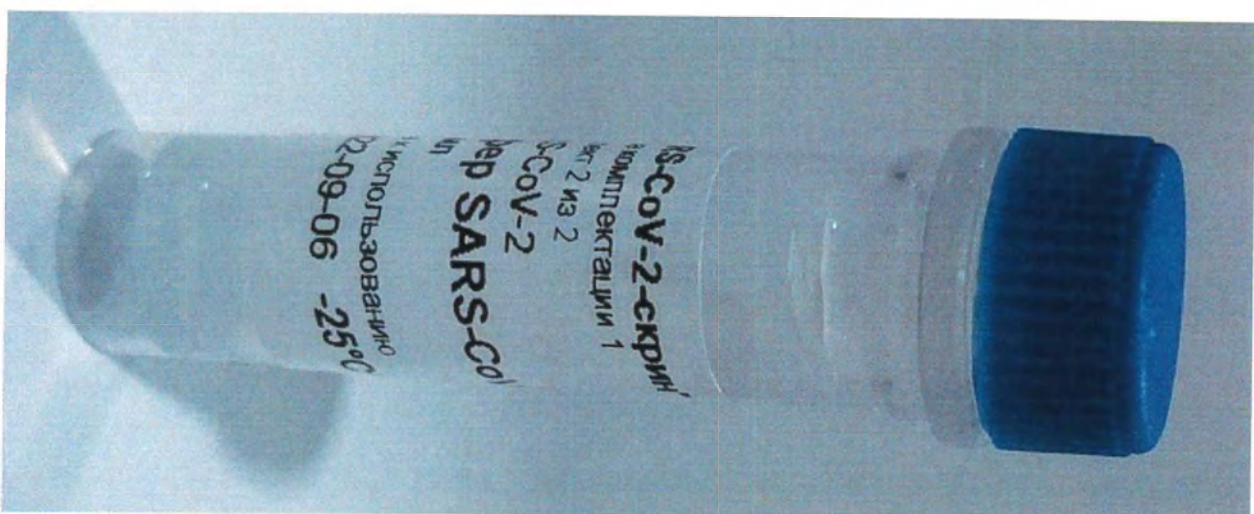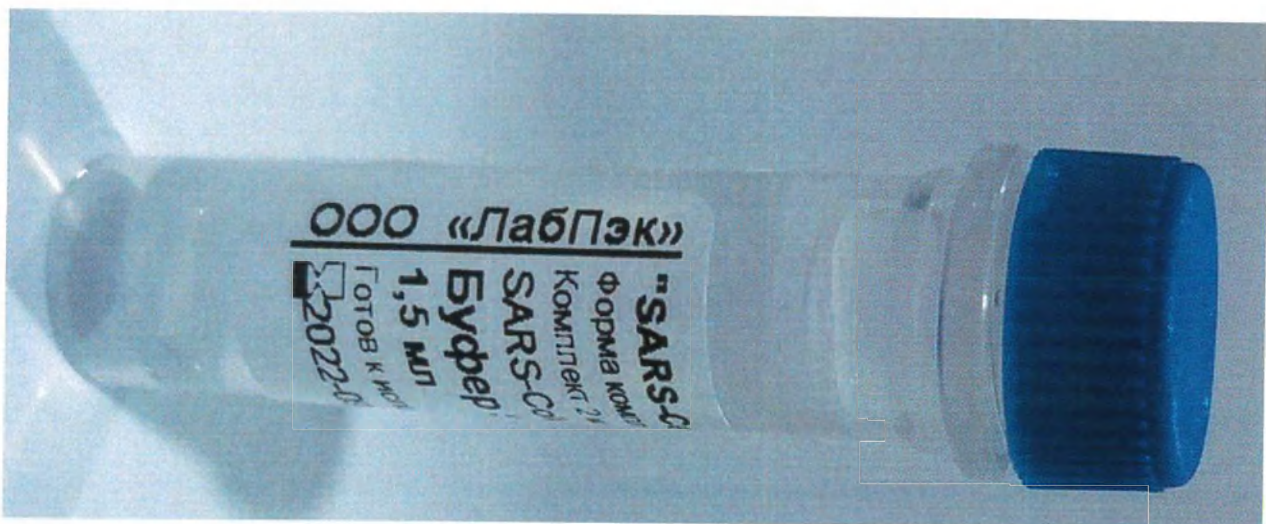


3.2.2. ОТ-полимераза

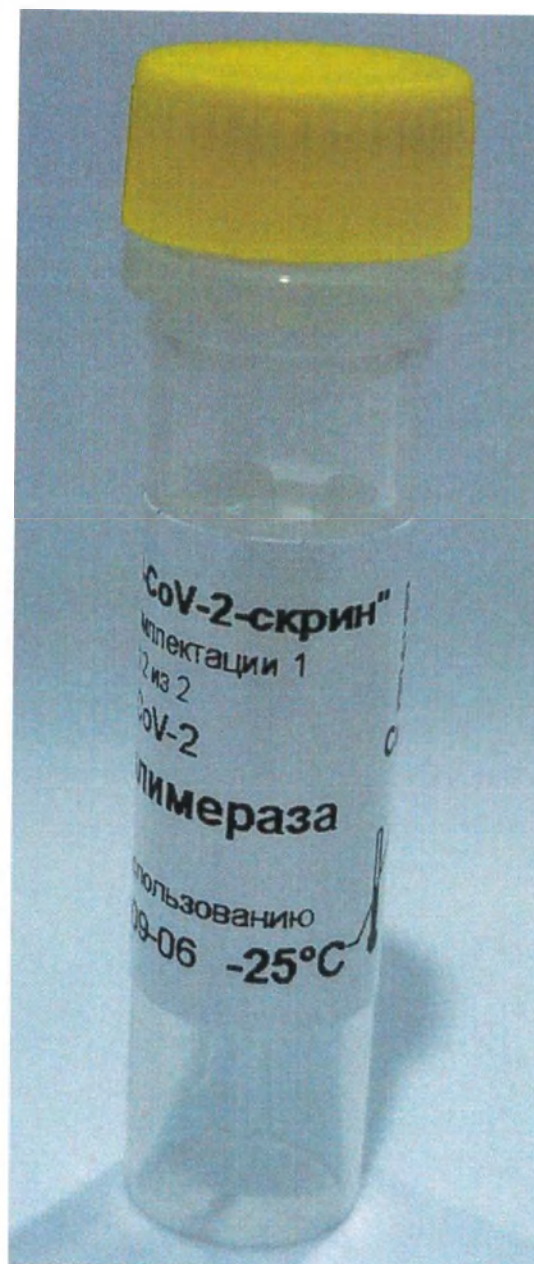


3.2.3. ПКО SARS-CoV-2

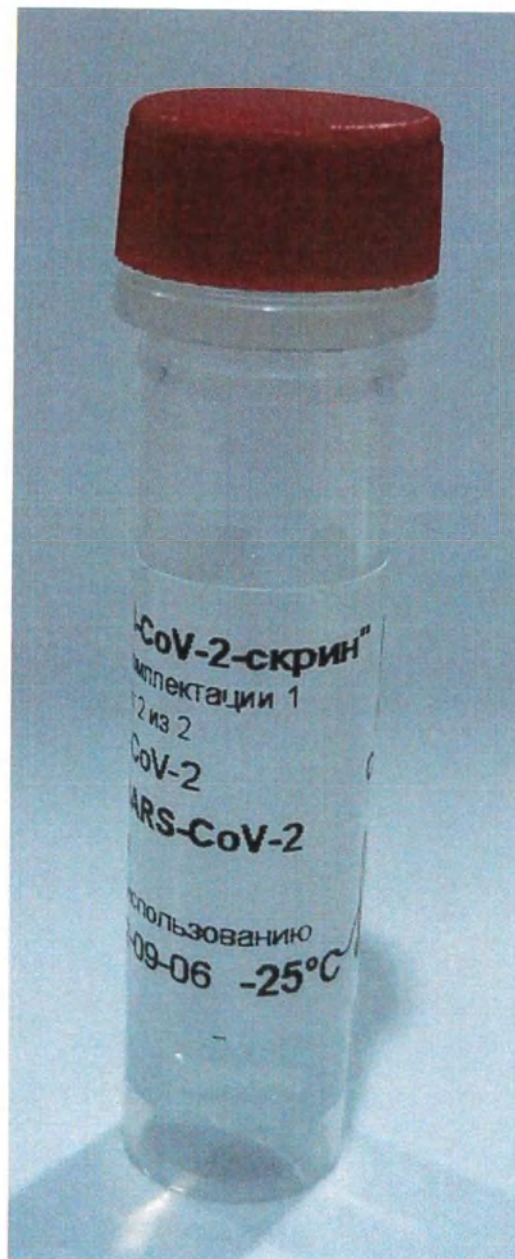

3.2.4. ОКО

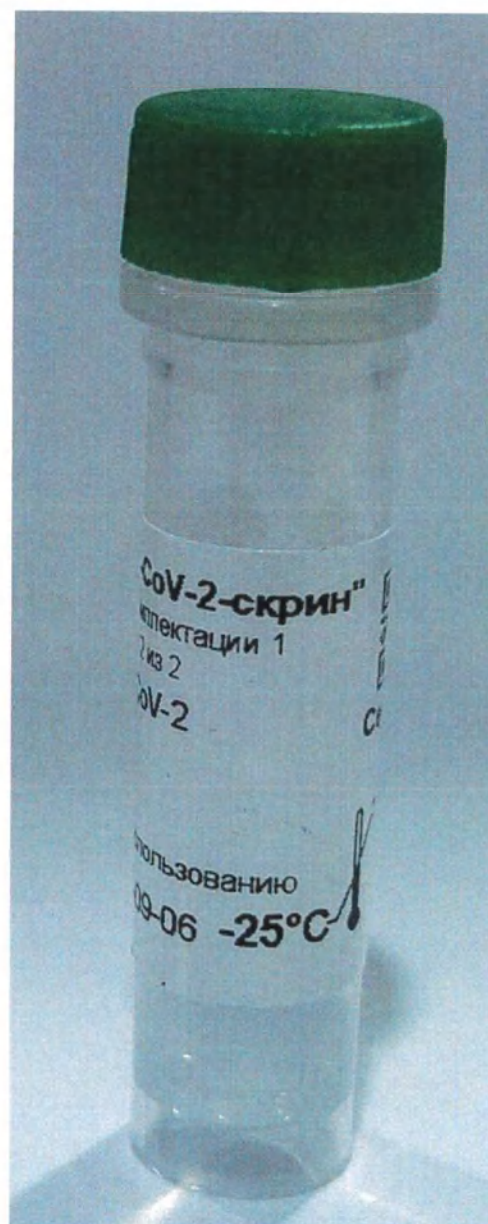

4. Набор реагентов «SARS-CoV-2-скрин», форма комплектации 2, серия 8 (общий вид)

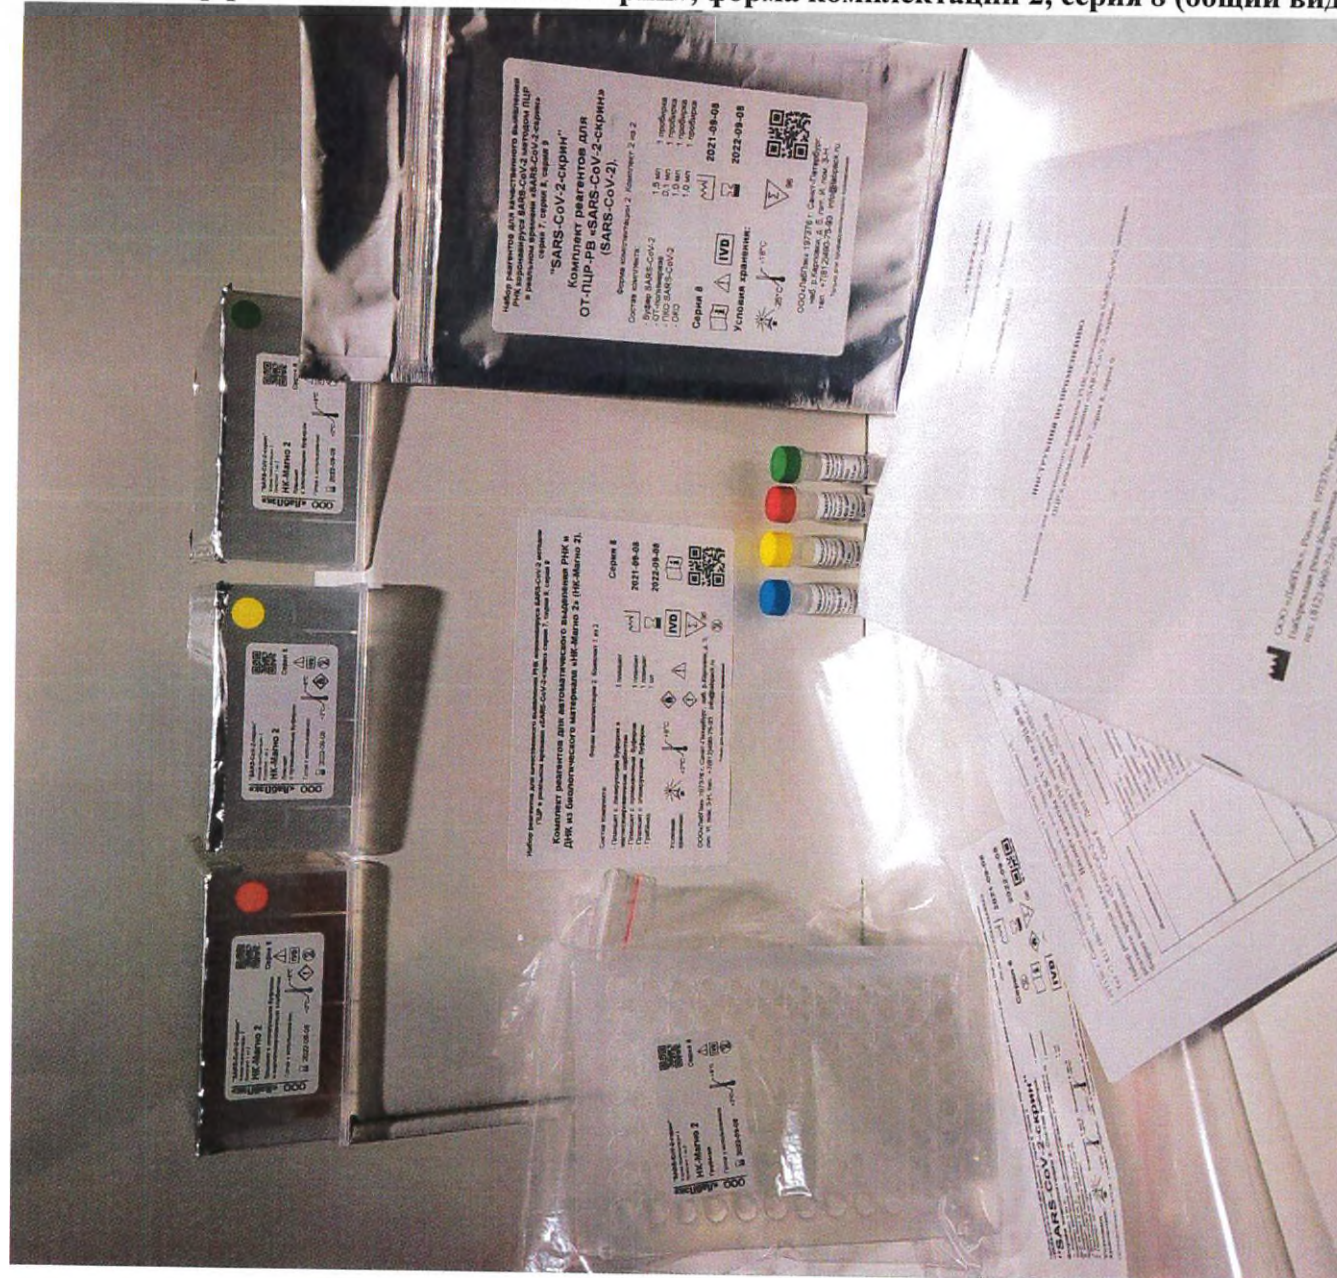

Набор реагентов «SARS-CoV-2-скрин», форма комплектации 2, серия 8



4.1. Комплект реагентов для автоматического выделения РНК и ДНК из биологического материала «НК-Магно 2» (НК-Магно 2) (Комплект 1 из 2)

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин» серия 7, серия 8, серия 9

Комплект реагентов для автоматического выделения РНК и ДНК из биологического материала «НК-Магно 2» (НК-Магно 2).

Форма комплектации 2. Комплект 1 из 2.

Состав комплекта:

- Планшет с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом
- Планшет с промывочным буфером
- Планшет с элюирующим буфером
- Гребёнка

1 планшет

1 планшет

1 планшет


1 шт

Серия 8

2021-09-08

2022-09-08

Условия хранения:



ООО «ЛабПак» 197376 г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н, тел. +7(812)490-75-93, info@labpack.ru

Только для профессионального применения





4.1.1. Планшет с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом



4.1.2. Планшет с промывочным буфером



4.1.3. Планшет с элюирующим буфером



4.1.4. Гребенка



Набор реагентов для качественного выявления
РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР
в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин»
серия 7, серия 8, серия 9

"SARS-CoV-2-скрин"

Комплект реагентов для
ОТ-ПЦР-РВ «SARS-CoV-2-скрин»
(SARS-CoV-2).

Форма комплектации 2. Комплект 2 из 2.

Состав комплекта:

- Буфер SARS-CoV-2	1,5 мл	1 пробирка
- ОТ-полимераза	0,1 мл	1 пробирка
- ПКО SARS-CoV-2	1,0 мл	1 пробирка
- ОКО	1,0 мл	1 пробирка

Серия 8



2021-09-08



2022-09-08

Условия хранения:




-16°C




ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург,
наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н,
тел. +7(812)490-75-93 info@labpack.ru

Только для профессионального применения


4.2.1. Буфер SARS-CoV-2

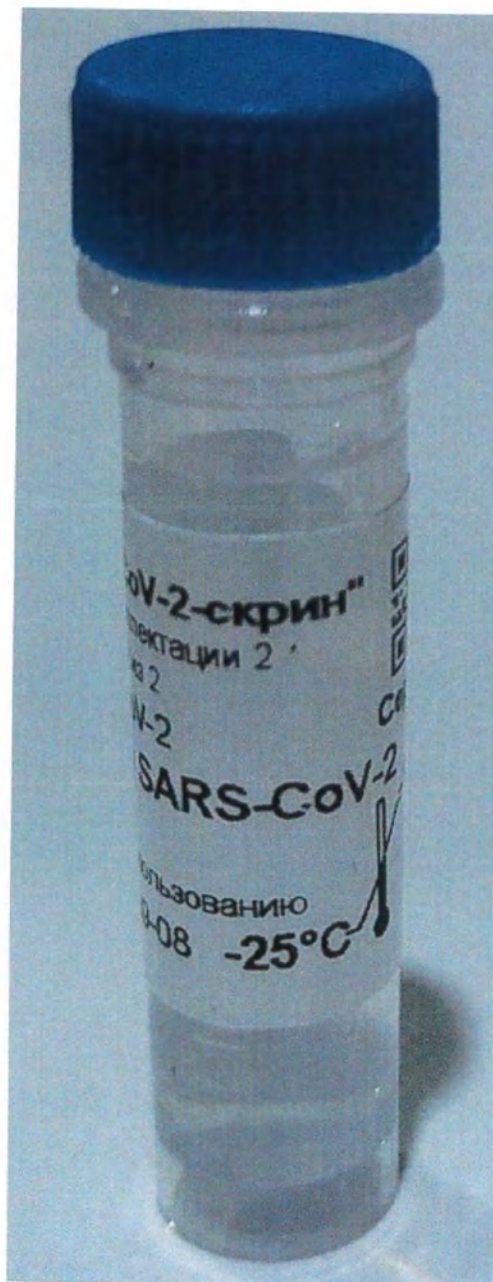


4.2.2. ОТ-полимераза

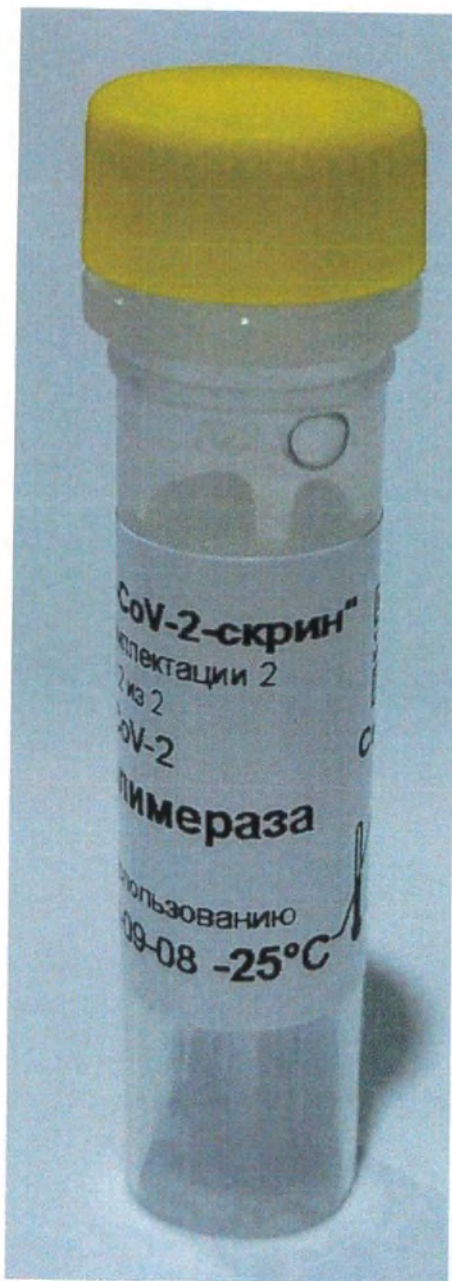

4.2.3. ПКО SARS-CoV-2

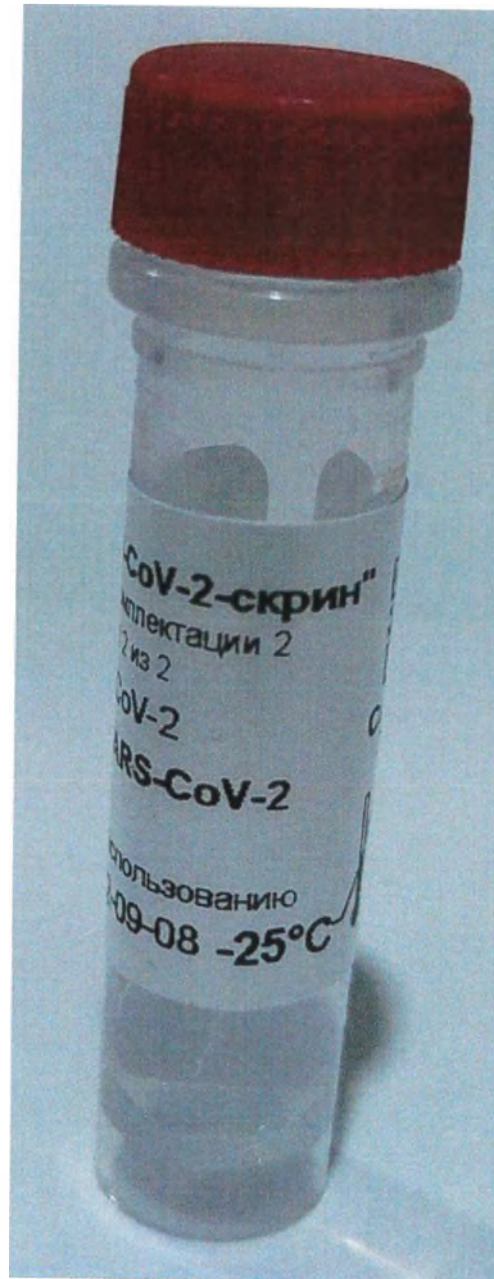

4.2.4. ОКО

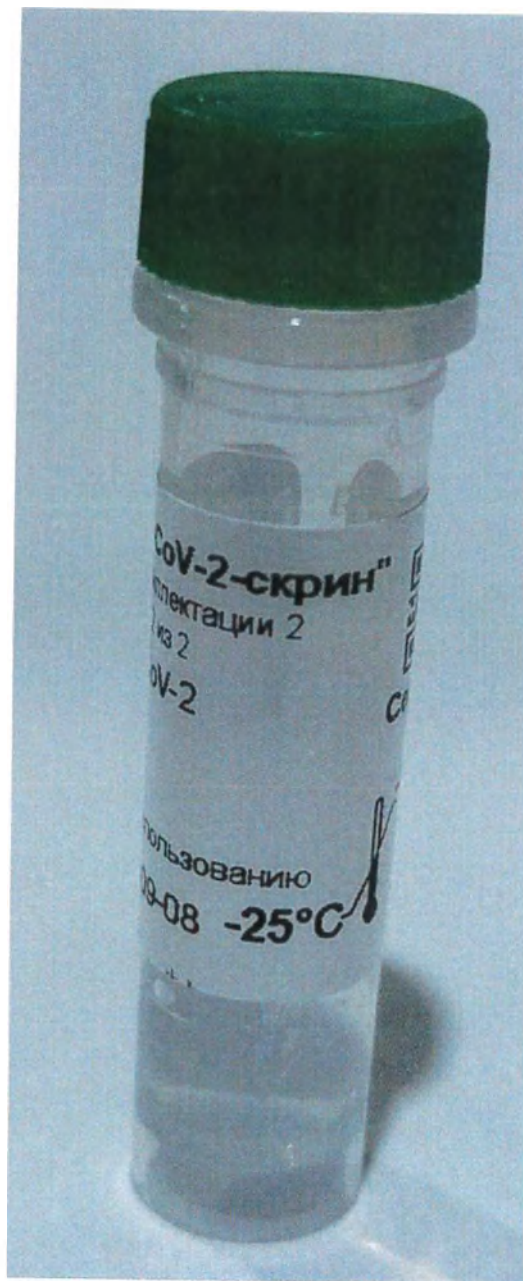

5. Набор реагентов «SARS-CoV-2-скрин», форма комплектации 1, серия 9 (общий вид)



Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин» серия 7, серия 8, серия 9

Комплект реагентов для ручного выделения РНК и ДНК из биологического материала «НК-Магно 2» (НК-Магно 2).

Форма комплектации 1. Комплект 1 из 2.

Состав комплекта:

- Магнетизированный сорбент	1,1 мл	1 пробирка
- Лизирующий буфер	44 мл	1 флакон
- Промывочный буфер 1	40 мл	2 флакона
- Промывочный буфер 2	40 мл	2 флакона
- Элюирующий буфер	12 мл	1 флакон

Серия 9



2021-09-13



96




2022-09-13

Условия хранения:




+2°C +8°C



ООО «ЛабПак» 197376 г. Санкт-Петербург,
наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н,
тел. +7(812)490-75-93 info@labpack.ru

Только для профессионального применения


5.1.1. Магнетизированный сорбент

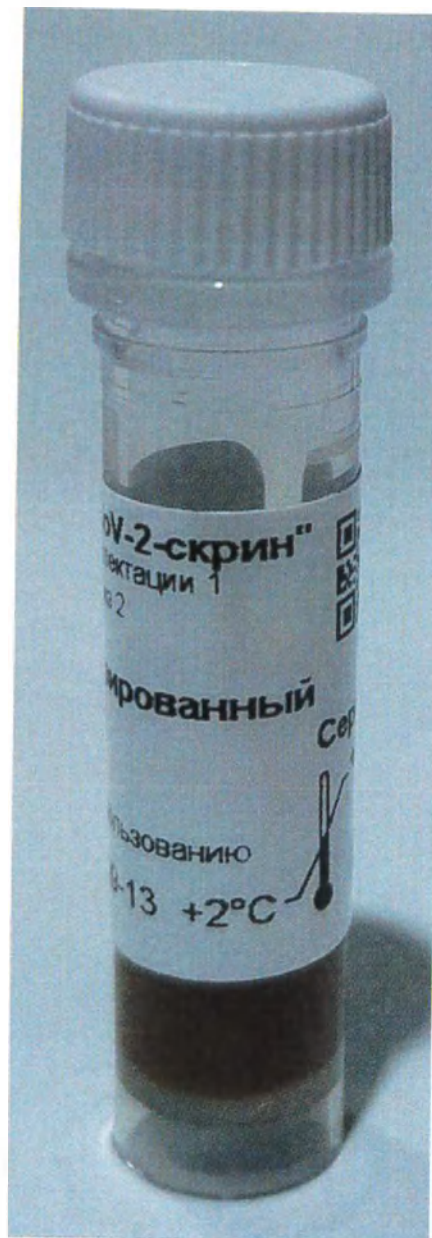


5.1.2. Лизирующий буфер



5.1.3. Промывочный буфер 1

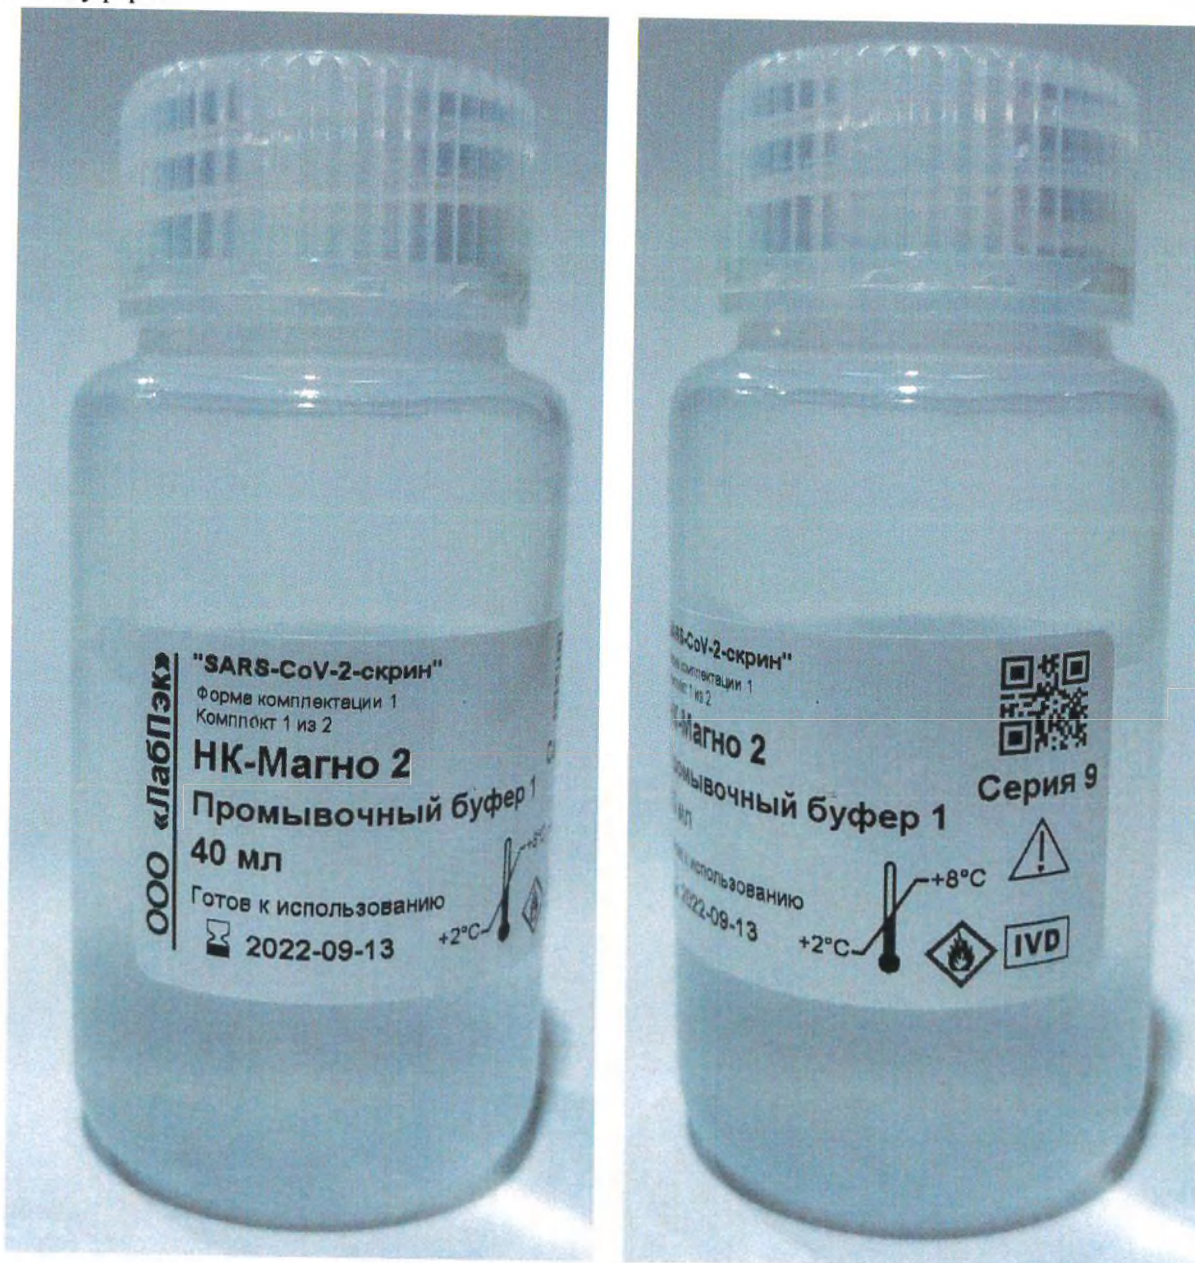

5.1.4. Промывочный буфер 2

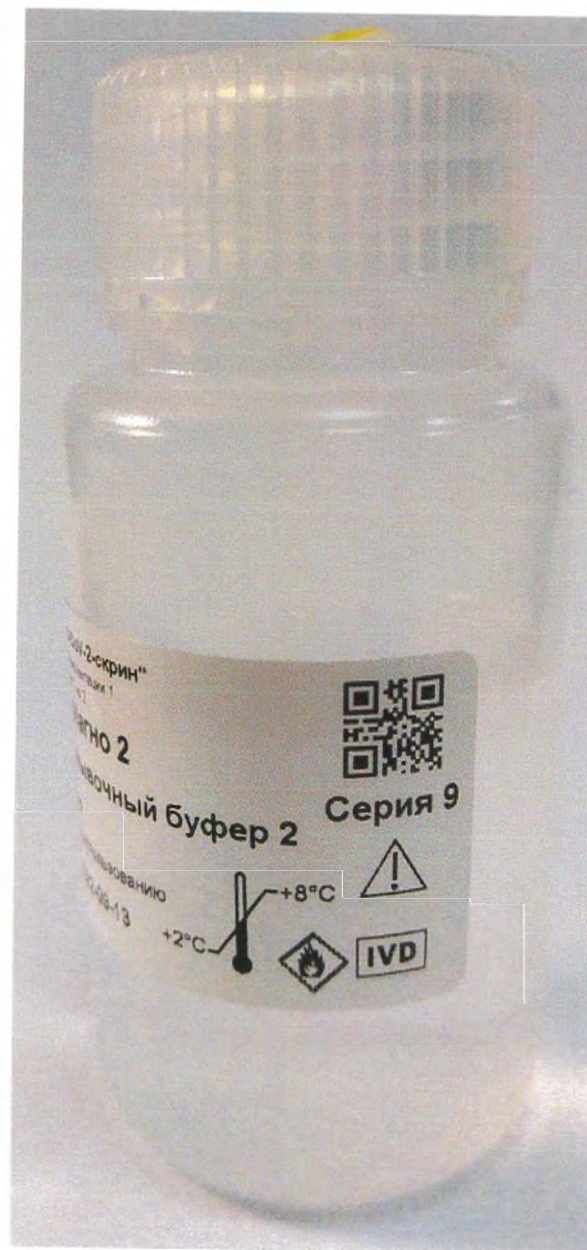

5.1.5. Элюирующий буфер





Набор реагентов для качественного выявления
РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР
в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин»
серия 7, серия 8, серия 9

Комплект реагентов для ОТ-ПЦР-РВ «SARS-CoV-2-скрин» (SARS-CoV-2).

Форма комплектации 1. Комплект 2 из 2.

Состав комплекта:

- Буфер SARS-CoV-2	1,5 мл	1 пробирка
- ОТ-полимераза	0,1 мл	1 пробирка
- ПКО SARS-CoV-2	1,0 мл	1 пробирка
- ОКО	1,0 мл	1 пробирка

Серия 9



2021-09-13



2022-09-13

Условия хранения:






-25°C -16°C




ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург,
наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н,
тел. +7(812)490-75-93 info@labpack.ru
Только для профессионального применения


5.2.1. Буфер SARS-CoV-2

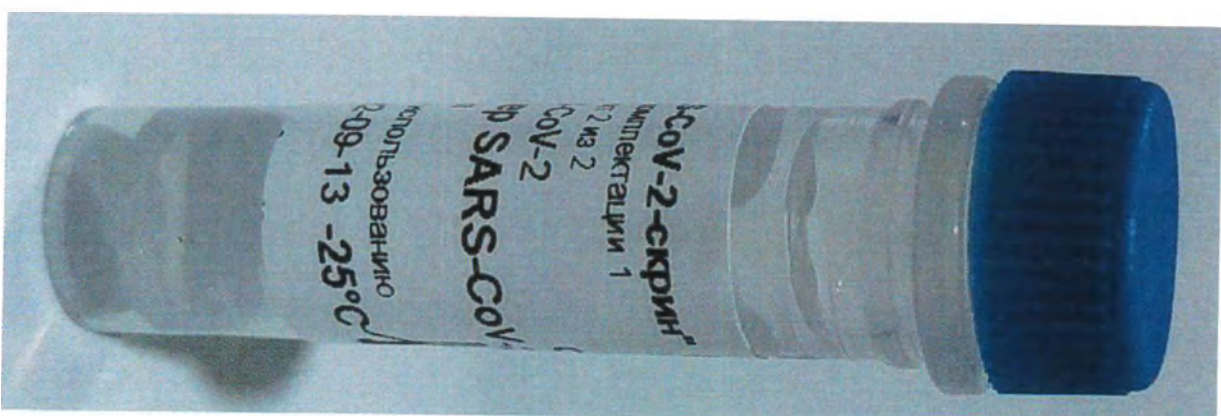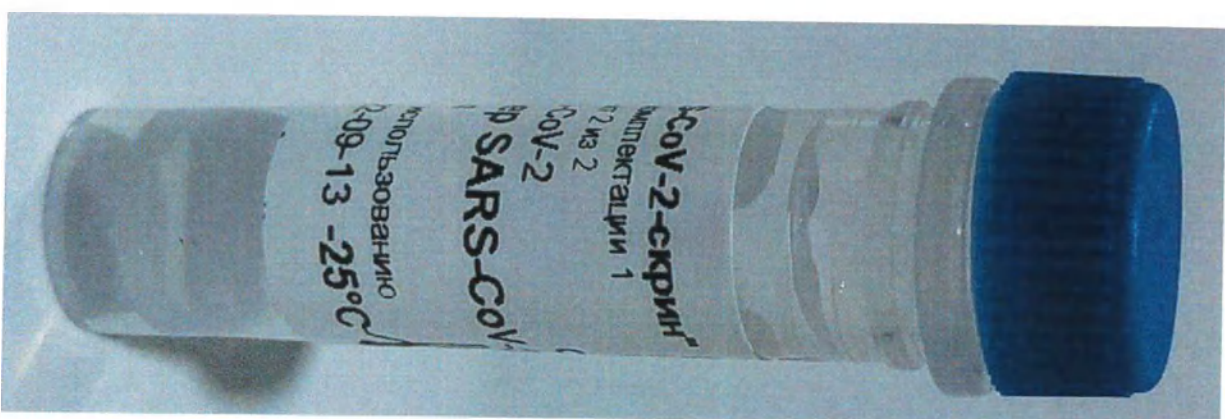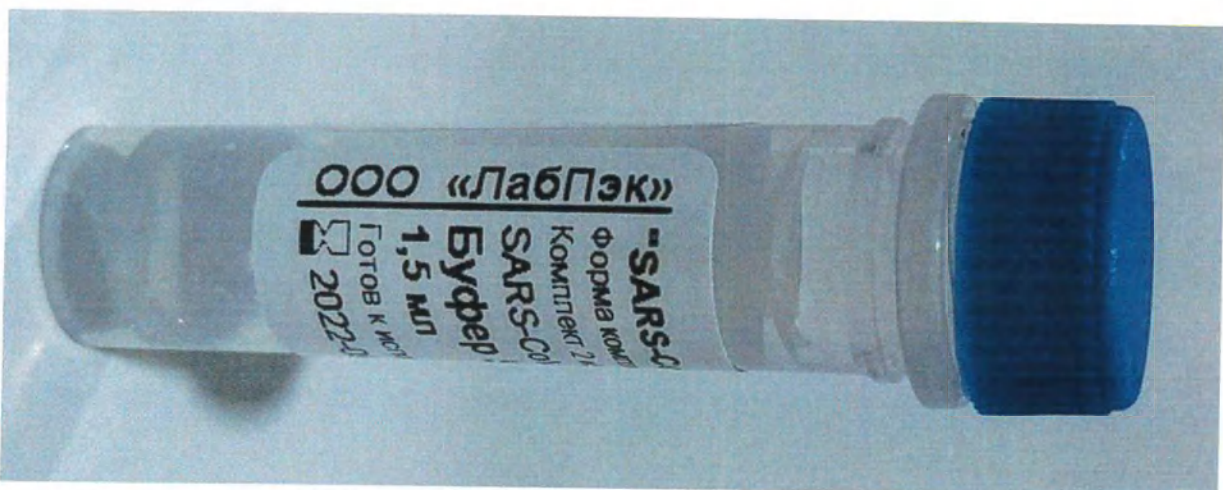


5.2.2. ОТ-полимераза

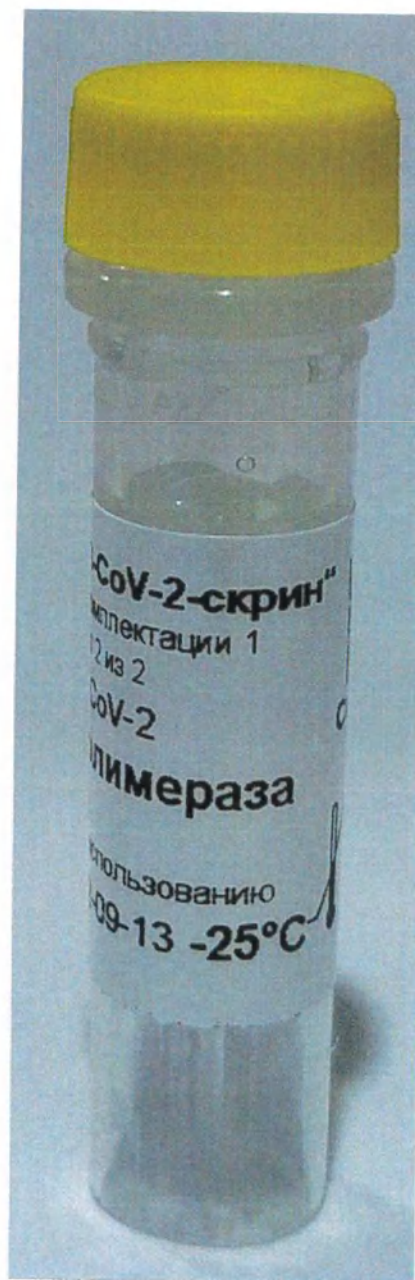

5.2.3. ПКО SARS-CoV-2

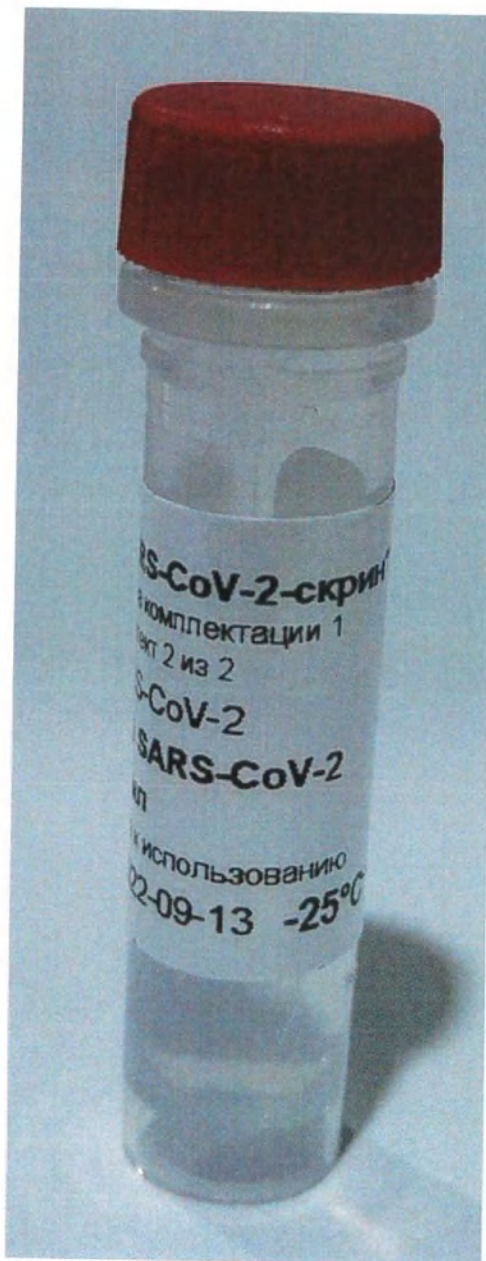


5.2.4. ОКО

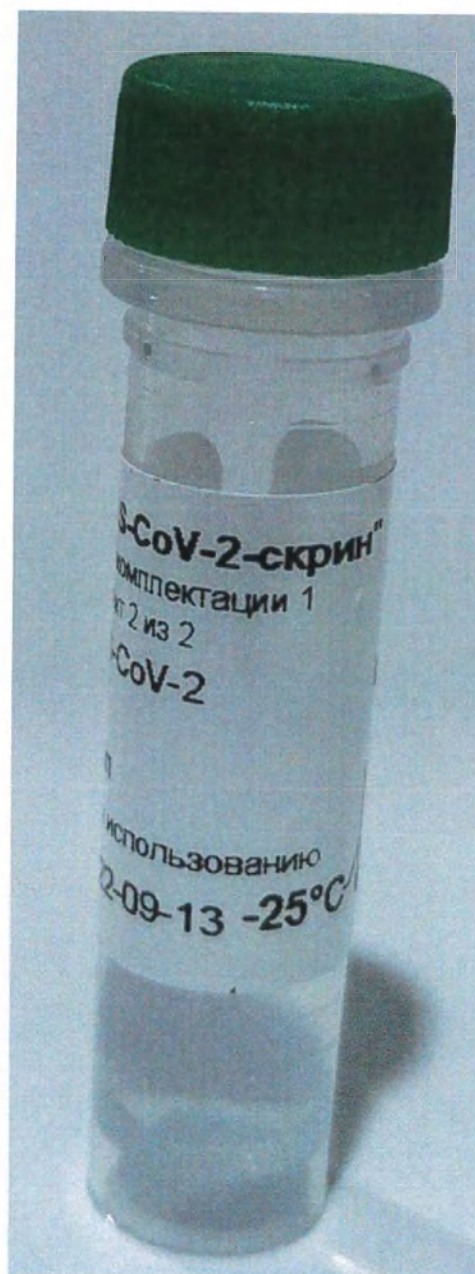

6. Набор реагентов «SARS-CoV-2-скрин», форма комплектации 2, серия 9 (общий вид)



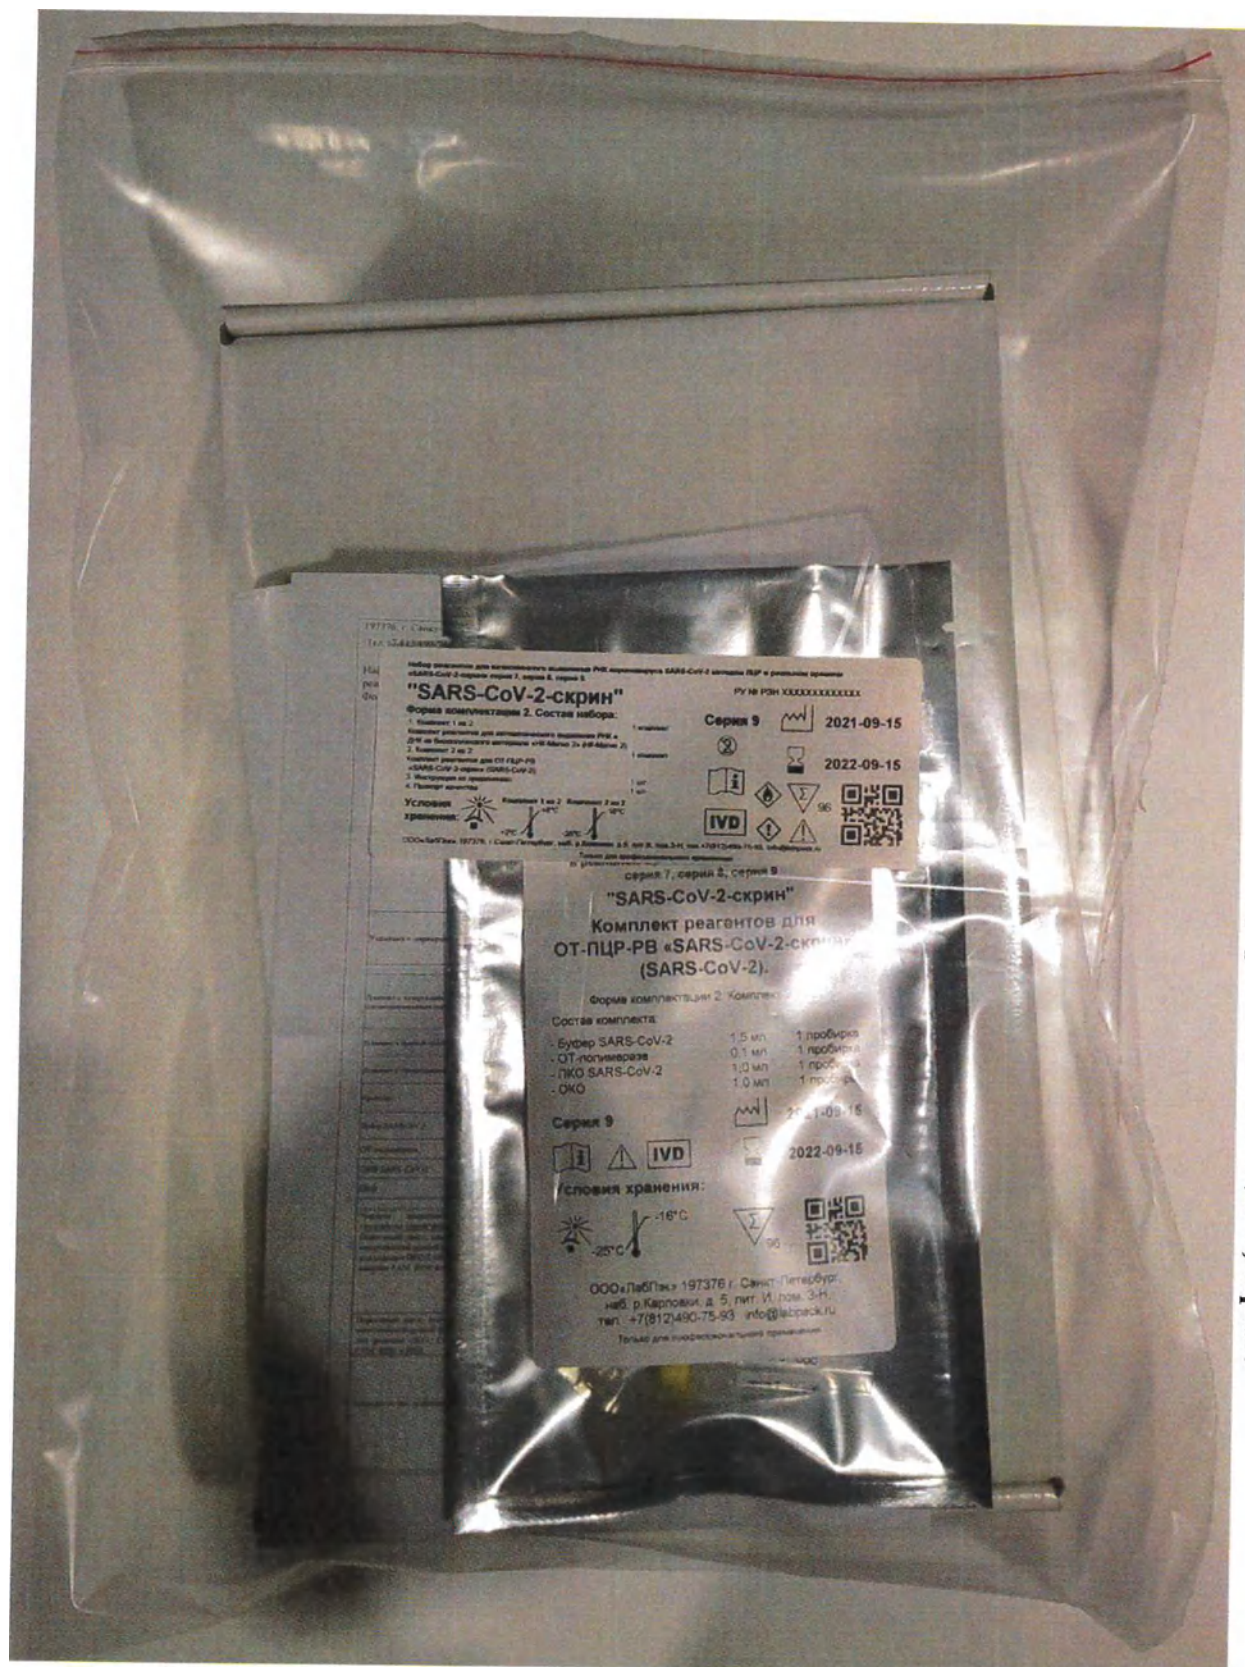

6.1. Комплект реагентов для автоматического выделения РНК и ДНК из биологического материала «НК-Магно 2» (НК-Магно 2)
(Комплект 1 из 2)

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин» серия 7, серия 8, серия 9

Комплект реагентов для автоматического выделения РНК и ДНК из биологического материала «НК-Магно 2» (НК-Магно 2).

Форма комплектации 2. Комплект 1 из 2.

Состав комплекта:



- | | |
|--|-----------|
| - Планшет с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом | 1 планшет |
| - Планшет с промывочным буфером | 1 планшет |
| - Планшет с элюирующим буфером | 1 планшет |
| - Гребёнка | 1 шт |

Серия 9

2021-09-15

2022-09-15

Условия хранения:



ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н, тел. +7(812)490-75-93, info@labpack.ru

Только для профессионального применения




6.1.1. Планшет с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом



6.1.2. Планшет с промывочным буфером



6.1.3. Планшет с элюирующим буфером

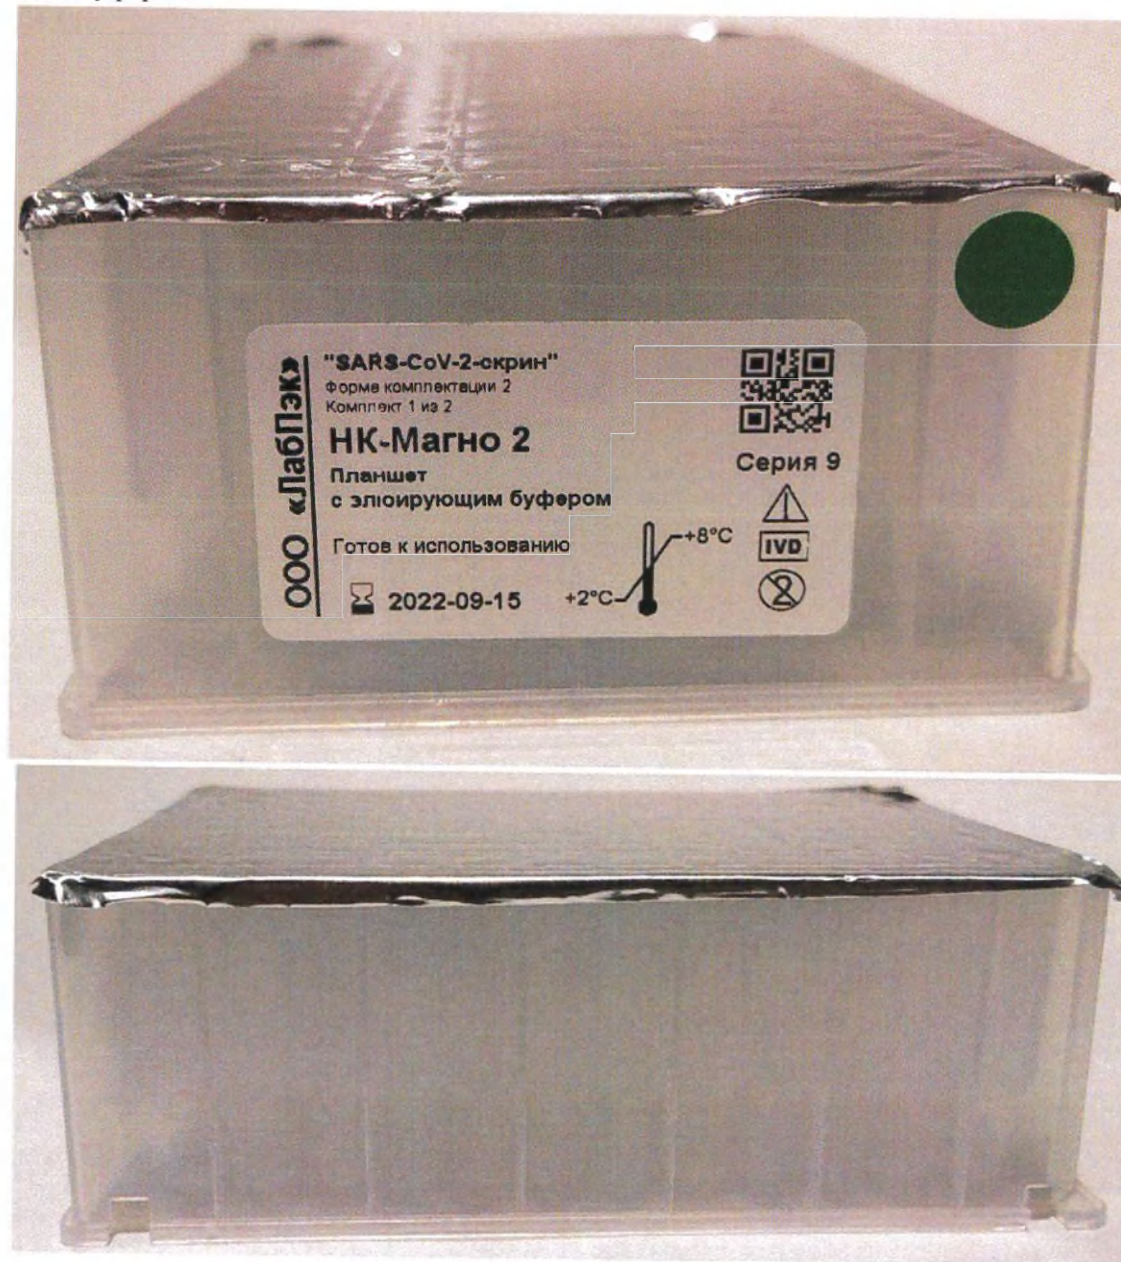

Набор реагентов для качественного выявления
РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР
в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин»
серия 7, серия 8, серия 9

"SARS-CoV-2-скрин"
Комплект реагентов для
ОТ-ПЦР-РВ «SARS-CoV-2-скрин»
(SARS-CoV-2).

Форма комплектации 2. Комплект 2 из 2.

Состав комплекта:

- Буфер SARS-CoV-2	1,5 мл	1 пробирка
- ОТ-полимераза	0,1 мл	1 пробирка
- ПКО SARS-CoV-2	1,0 мл	1 пробирка
- ОКО	1,0 мл	1 пробирка

Серия 9



2021-09-15



2022-09-15

Условия хранения:



-25°C -16°C





96





ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург,
наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н,
тел. +7(812)490-75-93 info@labpack.ru

Только для профессионального применения


6.2.1. Буфер SARS-CoV-2

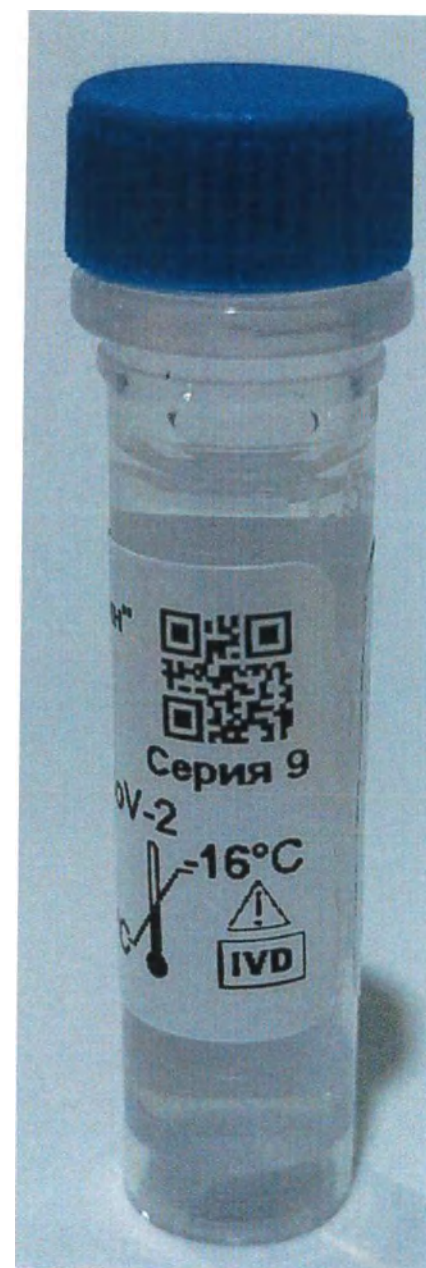
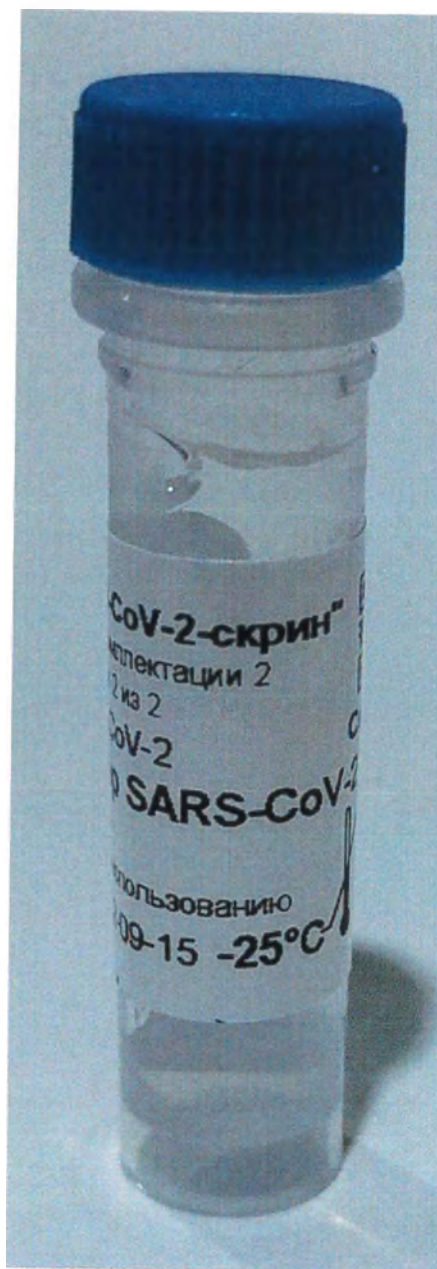


6.2.2. ОТ-полимераза

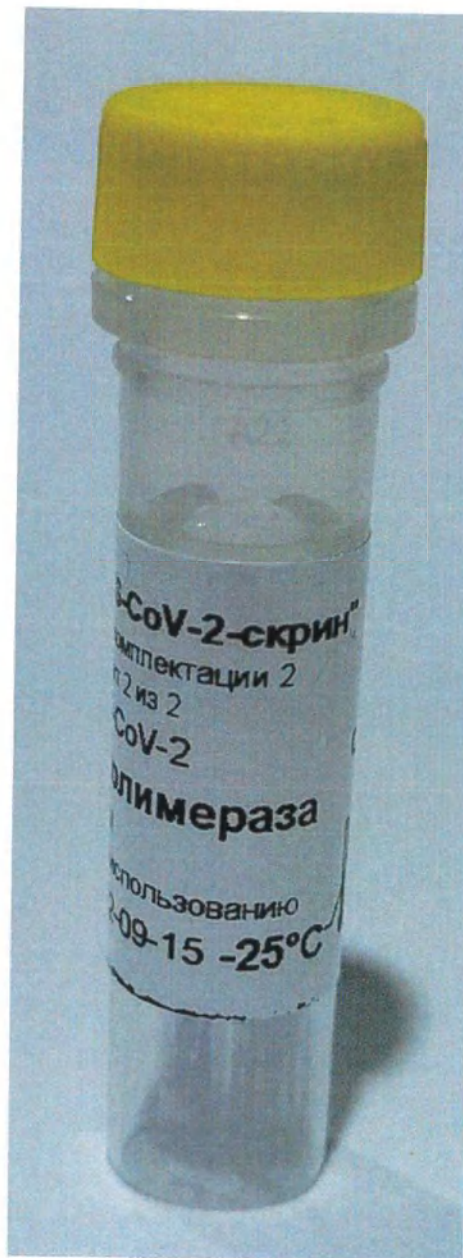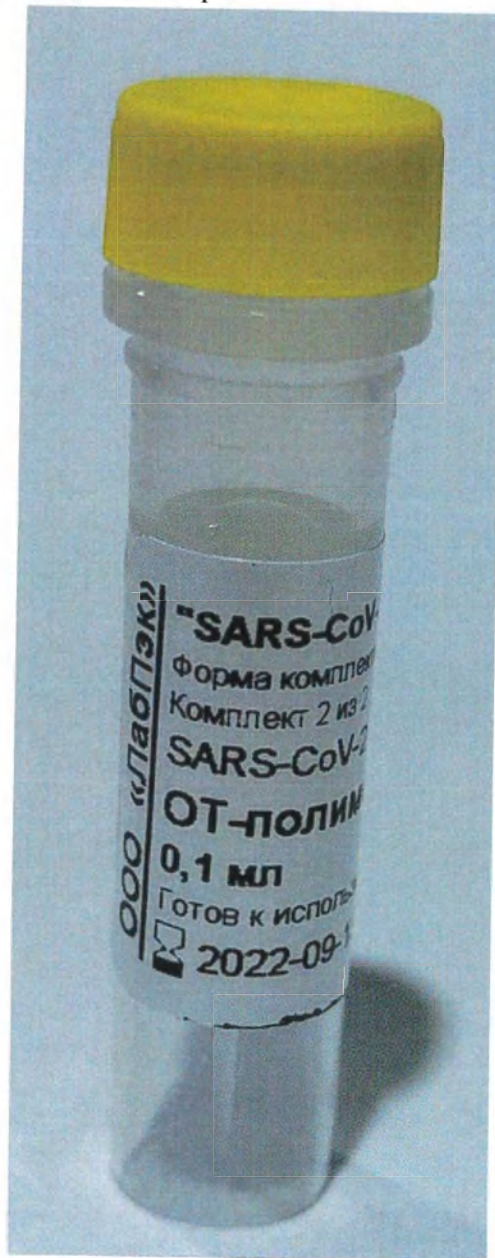

6.2.3. ПКО SARS-CoV-2

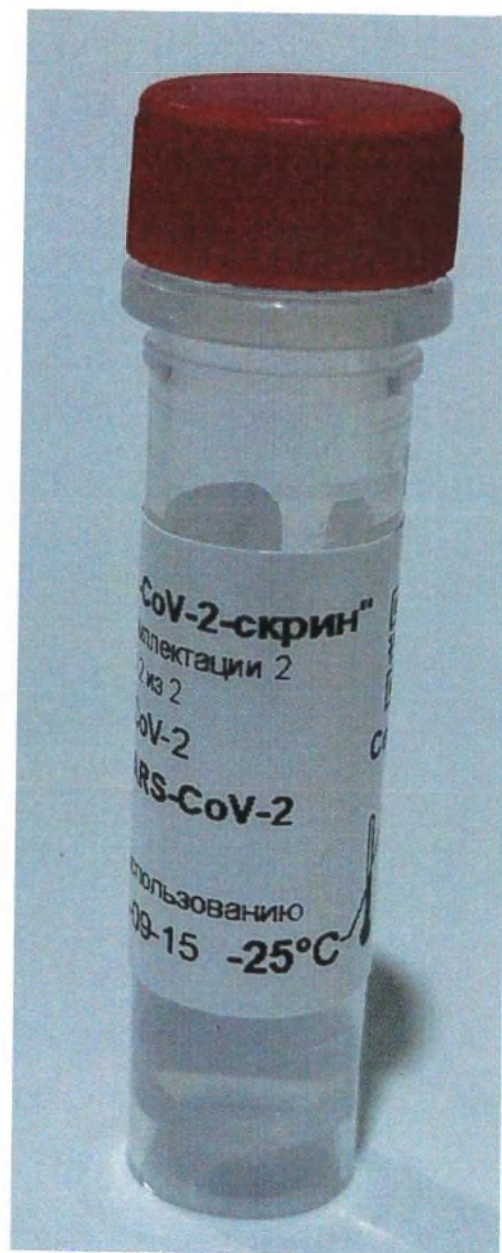

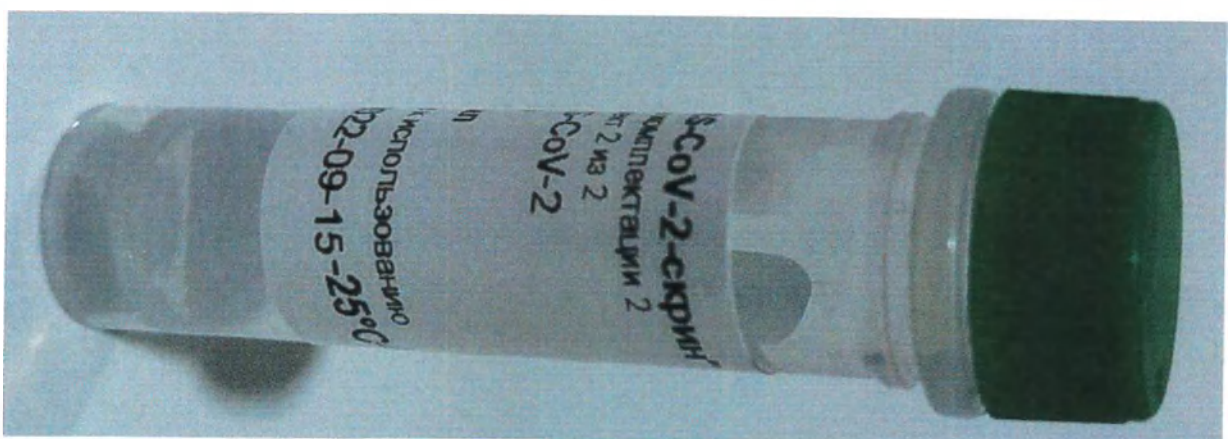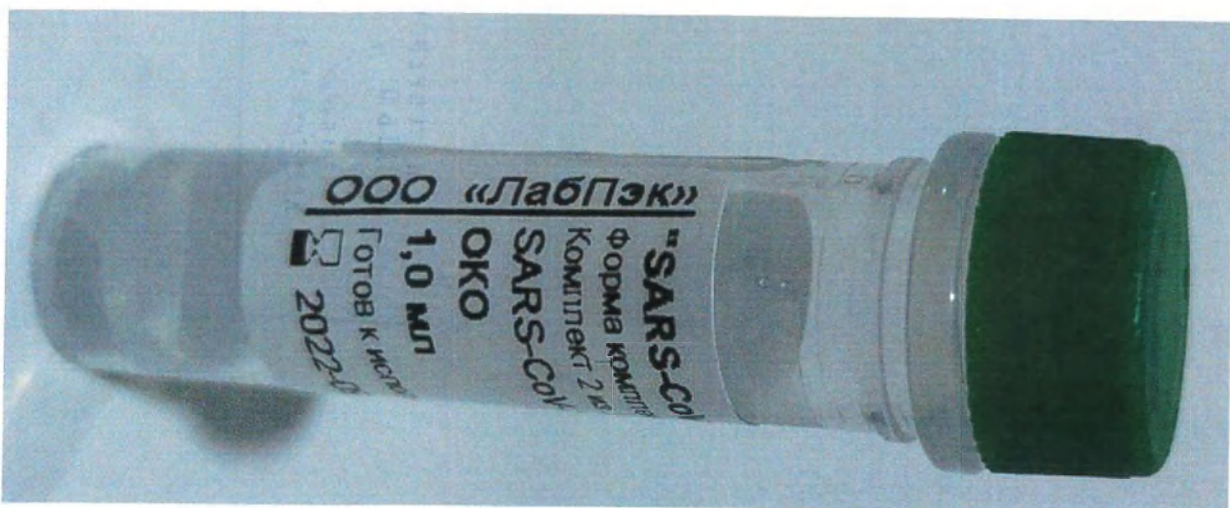



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ЛабПэк»

А.А. Козаренко/

«05» октября 2021 г.




Маркировка первичной, потребительской и групповой (транспортной) упаковки.


Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин» серия 7, серия 8, серия 9

I. Набор «SARS-CoV-2-скрин». Форма комплектации 1, серия 7 Форма комплектации 1. Комплект 1 из 2. Серия 7. Образцы маркировки первичной упаковки:


Магнетизированный сорбент

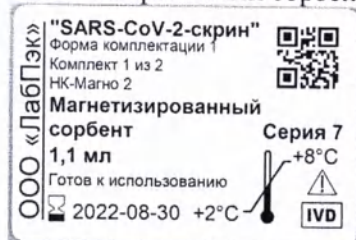


Лизирующий буфер

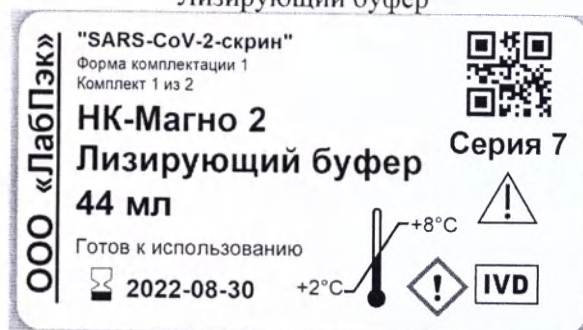


Промывочный буфер 1

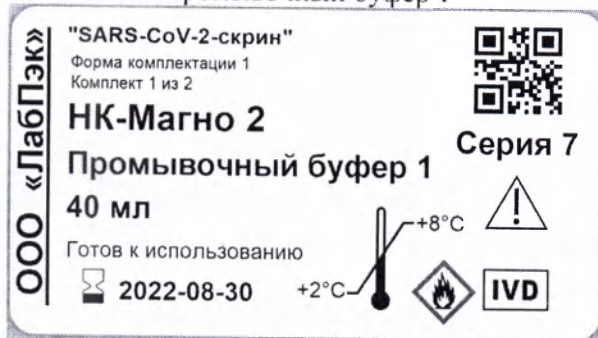

Промывочный буфер 2

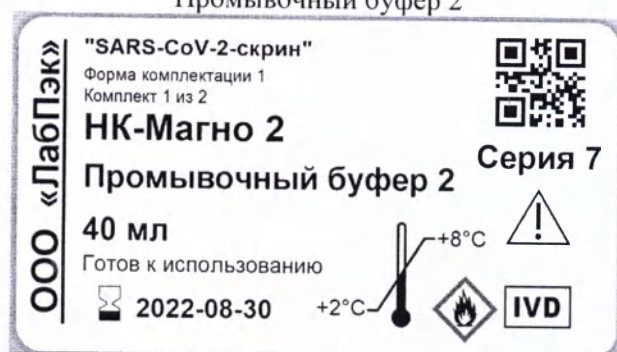

Элюирующий буфер

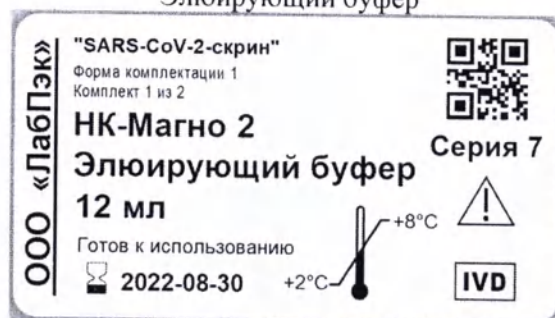

Форма комплектации 1. Комплект 1 из 2. Серия 7. Образец маркировки вторичной упаковки:

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин» серия 7, серия 8, серия 9

Комплект реагентов для ручного выделения РНК и ДНК из биологического материала «НК-Магно 2» (НК-Магно 2).

Форма комплектации 1. Комплект 1 из 2.

Состав комплекта:

- Магнетизированный сорбент	1,1 мл	1 пробирка
- Лизирующий буфер	44 мл	1 флакон
- Промывочный буфер 1	40 мл	2 флакона
- Промывочный буфер 2	40 мл	2 флакона
- Элюирующий буфер	12 мл	1 флакон

Серия 7  2021-08-30

  96  2022-08-30

Условия хранения:     

 +2°C  +8°C

ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург,
наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н,
тел. +7(812)490-75-93 info@labpack.ru

Только для профессионального применения

Форма комплектации 1. Комплект 2 из 2. Серия 7. Образцы маркировки первичной упаковки:

Буфер SARS-CoV-2

"SARS-CoV-2-скрин" 

Форма комплектации 1
Комплект 2 из 2
SARS-CoV-2
Серия 7

Буфер SARS-CoV-2
1,5 мл

Готов к использованию

 2022-08-30  -16°C  IVD

ОТ-полимераза

"SARS-CoV-2-скрин" 

Форма комплектации 1
Комплект 2 из 2
SARS-CoV-2
Серия 7

ОТ-полимераза
0,1 мл

Готов к использованию

 2022-08-30  -16°C  IVD

ПКО SARS-CoV-2

"SARS-CoV-2-скрин" 

Форма комплектации 1
Комплект 2 из 2
SARS-CoV-2
Серия 7

ПКО SARS-CoV-2
1,0 мл

Готов к использованию

 2022-08-30  -16°C  IVD

ОКО

"SARS-CoV-2-скрин" 

Форма комплектации 1
Комплект 2 из 2
SARS-CoV-2
Серия 7

ОКО
1,0 мл

Готов к использованию

 2022-08-30  -16°C  IVD

Форма комплектации 1. Комплект 2 из 2. Серия 7. Образец маркировки вторичной упаковки:

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин» серия 7, серия 8, серия 9

Комплект реагентов для ОТ-ПЦР-PB «SARS-CoV-2-скрин» (SARS-CoV-2).

Форма комплектации 1. Комплект 2 из 2.

Состав комплекта:

- Буфер SARS-CoV-2	1,5 мл	1 пробирка
- ОТ-полимераза	0,1 мл	1 пробирка
- ПКО SARS-CoV-2	1,0 мл	1 пробирка
- ОКО	1,0 мл	1 пробирка

Серия 7  **2021-08-30**

    **2022-08-30**

Условия хранения:

 -25°C  -16°C  96 

ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н, тел. +7(812)490-75-93 info@labpack.ru
Только для профессионального применения

Набор «SARS-CoV-2-скрин». Форма комплектации 1. Серия 7. Образец маркировки групповой потребительской упаковки

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин» серия 7, серия 8, серия 9

"SARS-CoV-2-скрин" РУ № РЗН XXXXXXXXXX

Форма комплектации 1. Состав набора:

1. Комплект 1 из 2:	1 комплект
Комплект реагентов для ручного выделения РНК и ДНК из биологического материала «НК-Магнэ 2» (НК-Магнэ 2);	
2. Комплект 2 из 2:	1 комплект
Комплект реагентов для ОТ-ПЦР-PB «SARS-CoV-2-скрин» (SARS-CoV-2);	
3. Инструкция по применению;	1 шт
4. Паспорт качества	1 шт

Условия хранения:   +2°C  +8°C  -16°C  -25°C

ООО «ЛабПэк», 197376, г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н, тел. +7(812)490-75-93, info@labpack.ru
Только для профессионального применения

Серия 7  **2021-08-30**

   96 

Набор «SARS-CoV-2-скрин». Форма комплектации 1. Серия 7. Образец маркировки групповой (транспортной) упаковки

ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н,
тел. (812) 490-75-93, E-mail: info@labpack.ru, https://www.labpack.ru

**Набор реагентов для качественного выявления
РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР
в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин»
серия 7, серия 8, серия 9**



Серия 7

Форма комплектации 1.

Число единиц потребительской упаковки
изделий..... шт

Масса нетто групповой упаковки кг

Масса брутто групповой упаковки..... кг

Масса нетто потребительской упаковки кг

Дата изготовления: **2021-08**

Срок годности: **2022-08**



Условия транспортирования:



Условия хранения:

Комплект 1 из 2

Комплект 2 из 2



При получении разукomплектовать.


Хранить в соответствии с условиями, указанными на
компонентах набора.




II. Набор «SARS-CoV-2-скрин». Форма комплектации 2. Серия 7

Форма комплектации 2. Комплект 1 из 2. Серия 7. Образцы маркировки первичной упаковки:


Планшет с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом

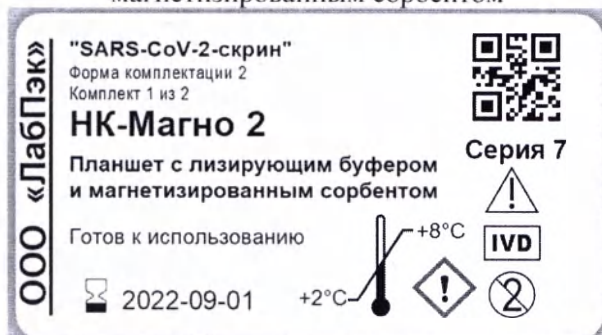


Планшет с промывочным буфером

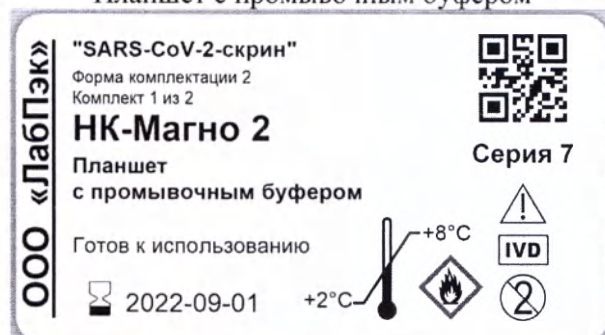

Планшет с элюирующим буфером

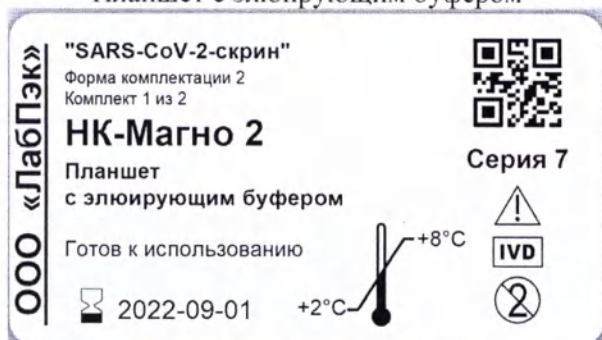

Гребенка

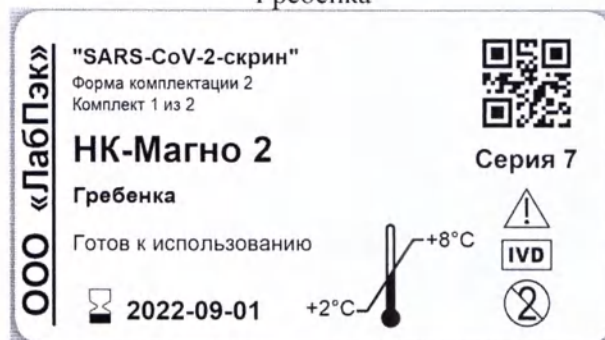

Форма комплектации 2. Комплект 1 из 2. Серия 7. Образец маркировки вторичной упаковки:



Форма комплектации 2. Комплект 2 из 2. Серия 7. Образцы маркировки первичной упаковки:



Форма комплектации 2. Комплект 2 из 2. Серия 7. Образец маркировки вторичной упаковки:



Набор «SARS-CoV-2-скрин». Форма комплектации 2. Серия 7. Образец маркировки групповой потребительской упаковки

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени
«SARS-CoV-2-скрин» серия 7, серия 8, серия 9

"SARS-CoV-2-скрин"

Форма комплектации 2. Состав набора:

1. Комплект 1 из 2: Комплект реагентов для автоматического выделения РНК и ДНК из биологического материала «НК-Магно 2» (НК-Магно 2);	1 комплект
2. Комплект 2 из 2: Комплект реагентов для ОТ-ПЦР-РВ «SARS-CoV-2-скрин» (SARS-CoV-2);	1 комплект
3. Инструкция по применению;	1 шт
4. Паспорт качества	1 шт

Условия хранения:

Комплект 1 из 2: +2°C — +8°C
Комплект 2 из 2: -25°C — -16°C

ООО «ЛабПэк», 197376, г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н, тел. +7(812)490-75-93, info@labpack.ru
Только для профессионального применения

ПУ № РЗН XXXXXXXXXXXX

Серия 7

2021-09-01

2022-09-01

96

IVD

QR code

Набор «SARS-CoV-2-скрин». Форма комплектации 2. Серия 7. Образец маркировки групповой (транспортной) упаковки

ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н, тел. (812) 490-75-93, E-mail: info@labpack.ru, https://www.labpack.ru

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин»
серия 7, серия 8, серия 9

Форма комплектации 2.

Число единиц потребительской упаковки изделий..... шт

Масса нетто групповой упаковки кг

Масса брутто групповой упаковки..... кг

Масса нетто потребительской упаковки кг

Условия транспортирования:

+2°C — +8°C

-25°C — -16°C

При получении разуккомплектовать.
Хранить в соответствии с условиями, указанными на компонентах набора.

Серия 7

Дата изготовления: 2021-09
Срок годности: 2022-09

Условия хранения:

Комплект 1 из 2: +2°C — +8°C
Комплект 2 из 2: -25°C — -16°C

QR code


III. Набор «SARS-CoV-2-скрин». Форма комплектации 1, серия 5

Форма комплектации 1. Комплект 1 из 2. Серия 8. Образцы маркировки первичной упаковки:


Магнетизированный сорбент




Лизирующий буфер

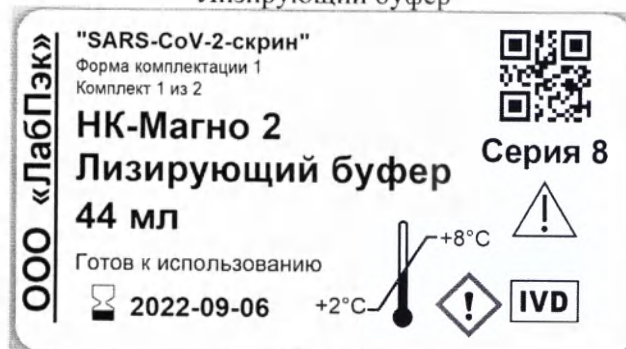


Промывочный буфер 1

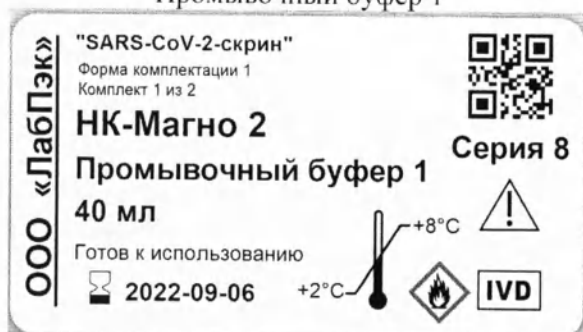

Промывочный буфер 2

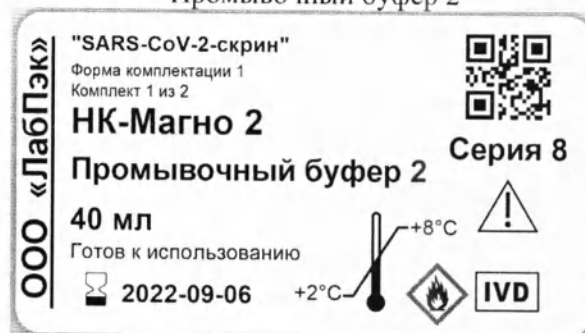

Элюирующий буфер

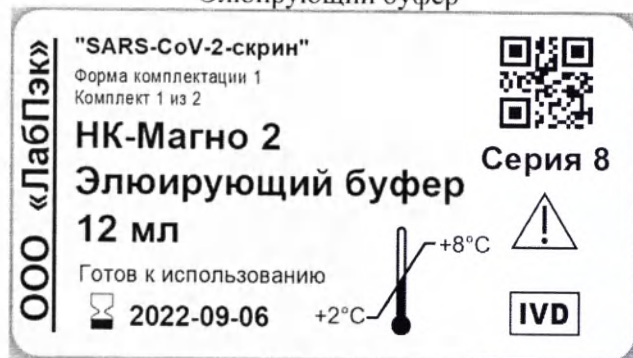

Форма комплектации 1. Комплект 1 из 2. Серия 8. образцы маркировки вторичной упаковки:

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин» серия 7, серия 8, серия 9

Комплект реагентов для ручного выделения РНК и ДНК из биологического материала «НК-Магно 2» (НК-Магно 2).

Форма комплектации 1. Комплект 1 из 2.

Состав комплекта:

- Магнетизированный сорбент	1,1 мл	1 пробирка
- Лизирующий буфер	44 мл	1 флакон
- Промывочный буфер 1	40 мл	2 флакона
- Промывочный буфер 2	40 мл	2 флакона
- Элюирующий буфер	12 мл	1 флакон

Серия 8  2021-09-06

  96  2022-09-06

Условия хранения:  +2°C  +8°C    

ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург, наб. р.Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н, тел. +7(812)490-75-93 info@labpack.ru

Только для профессионального применения

Форма комплектации 1. Комплект 2 из 2. Серия 8. Образцы маркировки первичной упаковки:

Буфер SARS-CoV-2

ООО «ЛабПэк» "SARS-CoV-2-скрин" 

Форма комплектации 1
Комплект 2 из 2
SARS-CoV-2
Серия 8

Буфер SARS-CoV-2
1,5 мл
Готов к использованию

 -16°C  -25°C  2022-09-06

ОТ-полимераза

ООО «ЛабПэк» "SARS-CoV-2-скрин" 

Форма комплектации 1
Комплект 2 из 2
SARS-CoV-2
Серия 8

ОТ-полимераза
0,1 мл
Готов к использованию

 -16°C  -25°C  2022-09-06

ПКО SARS-CoV-2

ООО «ЛабПэк» "SARS-CoV-2-скрин" 

Форма комплектации 1
Комплект 2 из 2
SARS-CoV-2
Серия 8

ПКО SARS-CoV-2
1,0 мл
Готов к использованию

 -16°C  -25°C  2022-09-06

ОКО

ООО «ЛабПэк» "SARS-CoV-2-скрин" 

Форма комплектации 1
Комплект 2 из 2
SARS-CoV-2
Серия 8

ОКО
1,0 мл
Готов к использованию

 -16°C  -25°C  2022-09-06

Форма комплектации 1. Комплект 2 из 2. Серия 8. Образец маркировки вторичной упаковки:

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин»
серия 7, серия 8, серия 9

Комплект реагентов для ОТ-ПЦР-РВ «SARS-CoV-2-скрин» (SARS-CoV-2).

Форма комплектации 1. Комплект 2 из 2.

Состав комплекта:

- Буфер SARS-CoV-2	1,5 мл	1 пробирка
- ОТ-полимераза	0,1 мл	1 пробирка
- ПКО SARS-CoV-2	1,0 мл	1 пробирка
- ОКО	1,0 мл	1 пробирка

Серия 8  **2021-09-06**

    **2022-09-06**

Условия хранения:

 -25°C  -16°C

 96 

ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург,
наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н,
тел. +7(812)490-75-93 info@labpack.ru
Только для профессионального применения

Набор «SARS-CoV-2-скрин». Форма комплектации 1. Серия 8. Образец маркировки групповой потребительской упаковки

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени
«SARS-CoV-2-скрин» серия 7, серия 8, серия 9

"SARS-CoV-2-скрин"

РУ № РЗН XXXXXXXXXX

Форма комплектации 1. Состав набора:

1. Комплект 1 из 2: Комплект реагентов для ручного выделения РНК и ДНК из биологического материала «НК-Магнэ 2» (НК-Магнэ 2);	1 комплект
2. Комплект 2 из 2: Комплект реагентов для ОТ-ПЦР-РВ «SARS-CoV-2-скрин» (SARS-CoV-2);	1 комплект
3. Инструкция по применению;	1 шт
4. Паспорт качества	1 шт

Условия хранения:   +2°C  +8°C  -25°C  -16°C

Серия 8  **2021-09-06**

   96  **2022-09-06**

ООО «ЛабПэк», 197376, г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н, тел. +7(812)490-75-93, info@labpack.ru
Только для профессионального применения

Набор «SARS-CoV-2-скрин». Форма комплектации 1. Серия 8. Образец маркировки групповой (транспортной) упаковки

ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н,
тел. (812) 490-75-93, E-mail: info@labpack.ru, https://www.labpack.ru

**Набор реагентов для качественного выявления
РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР
в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин»
серия 7, серия 8, серия 9**



Серия 8

Форма комплектации 1.
Число единиц потребительской упаковки
изделий..... шт

Дата изготовления: **2021-09**

Срок годности: **2022-09**

Масса нетто групповой упаковки кг

Масса брутто групповой упаковки..... кг

Масса нетто потребительской упаковки кг



Условия транспортирования:



Условия хранения:

Комплект 1 из 2

Комплект 2 из 2



При получении разукomплектовать.

Хранить в соответствии с условиями, указанными на
компонентах набора.



IV. Набор «SARS-CoV-2-скрин». Форма комплектации 2. Серия 8

Форма комплектации 2. Комплект 1 из 2. Серия 8. Образцы маркировки первичной упаковки:

Планшет с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом

ООО «ЛабПэк»

"SARS-CoV-2-скрин"
Форма комплектации 2
Комплект 1 из 2

НК-Магно 2

Планшет с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом

Серия 8

Готов к использованию

2022-09-08

+2°C

+8°C

IVD

!

2

Планшет с промывочным буфером

ООО «ЛабПэк»

"SARS-CoV-2-скрин"
Форма комплектации 2
Комплект 1 из 2

НК-Магно 2

Планшет с промывочным буфером

Серия 8

Готов к использованию

2022-09-08

+2°C

+8°C

IVD

!

2

Планшет с элюирующим буфером

ООО «ЛабПэк»

"SARS-CoV-2-скрин"
Форма комплектации 2
Комплект 1 из 2

НК-Магно 2

Планшет с элюирующим буфером

Серия 8

Готов к использованию

2022-09-08

+2°C

+8°C

IVD

!

2

Гребенка

ООО «ЛабПэк»

"SARS-CoV-2-скрин"
Форма комплектации 2
Комплект 1 из 2

НК-Магно 2

Гребенка

Серия 8

Готов к использованию

2022-09-08

+2°C

+8°C

IVD

!

2

Форма комплектации 2. Комплект 1 из 2. Серия 8. Образец маркировки вторичной упаковки:

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин» серия 7, серия 8, серия 9

Комплект реагентов для автоматического выделения РНК и ДНК из биологического материала «НК-Магно 2» (НК-Магно 2).

Форма комплектации 2. Комплект 1 из 2.

Состав комплекта:

- Планшет с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом
- Планшет с промывочным буфером
- Планшет с элюирующим буфером
- Гребёнка

1 планшет

1 планшет

1 планшет

1 шт

Серия 8

2021-09-08

2022-09-08

Условия хранения:



+2°C

+8°C




ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5,
лит. И, пом. 3-Н, тел. +7(812)490-75-93, info@labpack.ru

Только для профессионального применения

Форма комплектации 2. Комплект 2 из 2. Серия 8. Образцы маркировки первичной упаковки:



Форма комплектации 2. Комплект 2 из 2. Серия 8. Образец маркировки вторичной упаковки:

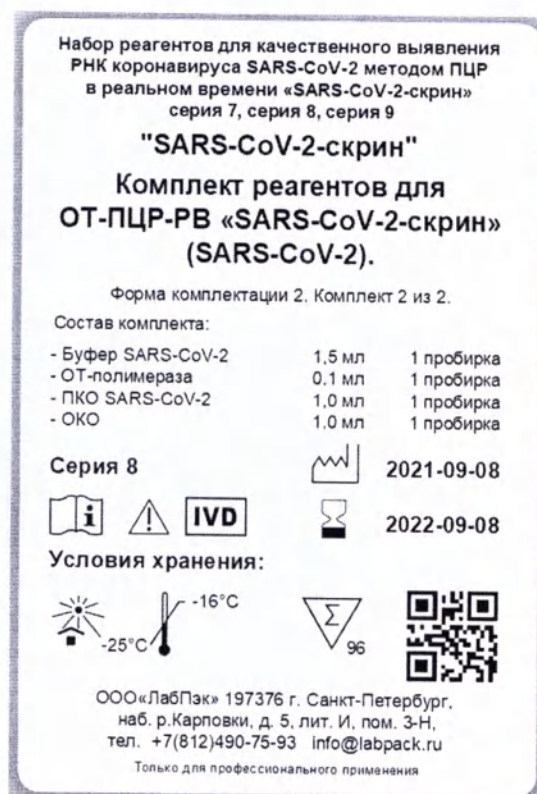

Набор «SARS-CoV-2-скрин». Форма комплектации 2. Серия 8. Образец маркировки групповой потребительской упаковки

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени
«SARS-CoV-2-скрин» серия 7, серия 8, серия 9

"SARS-CoV-2-скрин"

ПУ № РЗН XXXXXXXXXXXXX

Серия 8  **2021-09-08**

Серия 8  **2022-09-08**

Форма комплектации 2. Состав набора:

1. Комплект 1 из 2: Комплект реагентов для автоматического выделения РНК и ДНК из биологического материала «НК-Магно 2» (НК-Магно 2);	1 комплект
2. Комплект 2 из 2: Комплект реагентов для ОТ-ПЦР-РВ «SARS-CoV-2-скрин» (SARS-CoV-2);	1 комплект
3. Инструкция по применению;	1 шт
4. Паспорт качества	1 шт

Условия хранения:  **Комплект 1 из 2**  **+8°C** **Комплект 2 из 2**  **-16°C**
 **+2°C**  **-25°C**

ООО «ЛабПэк», 197376, г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н, тел. +7(812)490-75-93, info@labpack.ru

Только для профессионального применения

   96 

Набор «SARS-CoV-2-скрин». Форма комплектации 2. Серия 8. Образец маркировки групповой (транспортной) упаковки

ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н, тел. (812) 490-75-93, E-mail: info@labpack.ru, https://www.labpack.ru

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин» серия 7, серия 8, серия 9

Серия 8

Форма комплектации 2.

Число единиц потребительской упаковки изделий..... шт

Дата изготовления: **2021-09**

Срок годности: **2022-09**

Масса нетто групповой упаковки кг

Масса брутто групповой упаковки..... кг

Масса нетто потребительской упаковки кг

Условия транспортирования:

 **+8°C**   **+2°C**    

Условия хранения:

Комплект 1 из 2  **+8°C** **Комплект 2 из 2**  **-16°C**
 **+2°C**  **-25°C**


При получении разукрупнять.
Хранить в соответствии с условиями, указанными на компонентах набора.




V. Набор «SARS-CoV-2-скрин». Форма комплектации 1, серия 9

Форма комплектации 1. Комплект 1 из 2 Серия 9. Образцы маркировки первичной упаковки:


Магнетизированный сорбент

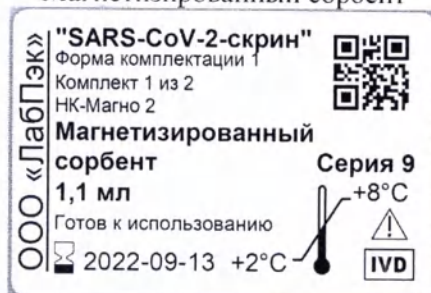


Лизирующий буфер

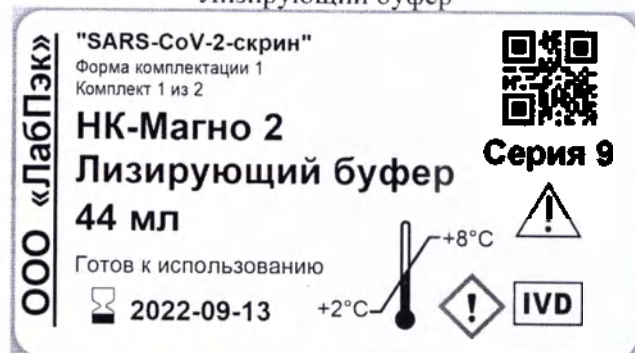


Промывочный буфер 1

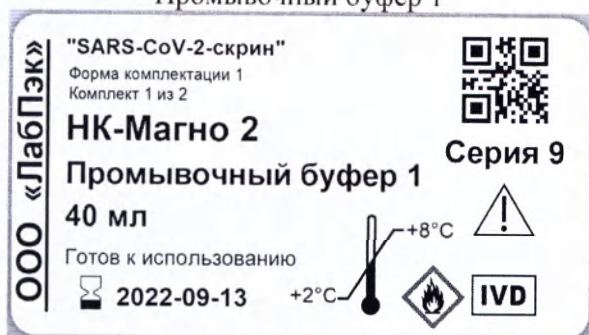

Промывочный буфер 2

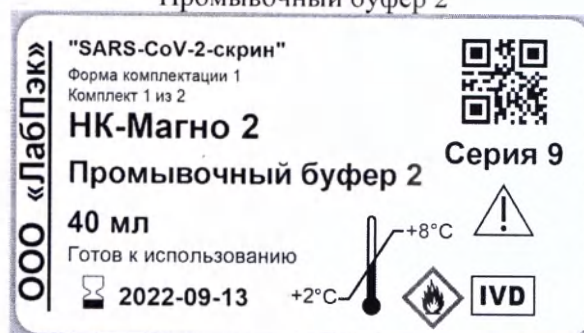

Элюирующий буфер

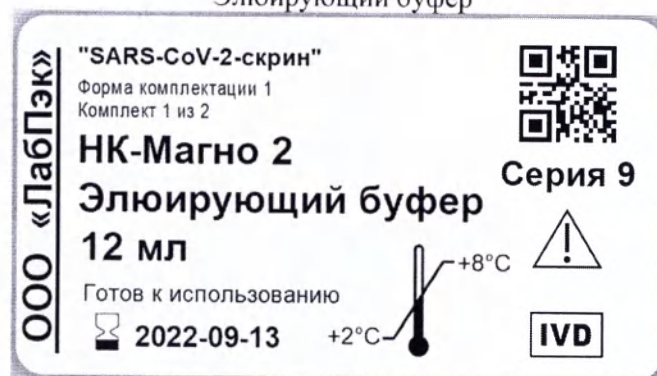

Форма комплектации 1. Комплект 1 из 2. Серия 9. Образцы маркировки вторичной упаковки:

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин» серия 7, серия 8, серия 9

Комплект реагентов для ручного выделения РНК и ДНК из биологического материала «НК-Магно 2» (НК-Магно 2).

Форма комплектации 1. Комплект 1 из 2.

Состав комплекта:

- Магнетизированный сорбент	1,1 мл	1 пробирка
- Лизирующий буфер	44 мл	1 флакон
- Промывочный буфер 1	40 мл	2 флакона
- Промывочный буфер 2	40 мл	2 флакона
- Элюирующий буфер	12 мл	1 флакон

Серия 9  2021-09-13

  96  2022-09-13

Условия хранения:   

 +2°C  +8°C 

ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н, тел. +7(812)490-75-93 info@labpack.ru

Только для профессионального применения

Форма комплектации 1. Комплект 2 из 2. Серия 9. Образцы маркировки первичной упаковки:

Буфер SARS-CoV-2

ООО «ЛабПэк» "SARS-CoV-2-скрин" 

Форма комплектации 1
Комплект 2 из 2
SARS-CoV-2 **Серия 9**

Буфер SARS-CoV-2
1,5 мл

Готов к использованию  -16°C 

 2022-09-13 -25°C 

ОТ-полимераза

ООО «ЛабПэк» "SARS-CoV-2-скрин" 

Форма комплектации 1
Комплект 2 из 2
SARS-CoV-2 **Серия 9**

ОТ-полимераза
0,1 мл

Готов к использованию  -16°C 

 2022-09-13 -25°C 

ПКО SARS-CoV-2

ООО «ЛабПэк» "SARS-CoV-2-скрин" 

Форма комплектации 1
Комплект 2 из 2
SARS-CoV-2 **Серия 9**

ПКО SARS-CoV-2
1,0 мл

Готов к использованию  -16°C 

 2022-09-13 -25°C 

ОКО

ООО «ЛабПэк» "SARS-CoV-2-скрин" 

Форма комплектации 1
Комплект 2 из 2
SARS-CoV-2 **Серия 9**

ОКО
1,0 мл

Готов к использованию  -16°C 

 2022-09-13 -25°C 

Форма комплектации 1. Комплект 2 из 2. Серия 9. Образец маркировки вторичной упаковки:

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин»
серия 7, серия 8, серия 9

Комплект реагентов для ОТ-ПЦР-РВ «SARS-CoV-2-скрин» (SARS-CoV-2).

Форма комплектации 1. Комплект 2 из 2.

Состав комплекта:

- Буфер SARS-CoV-2	1,5 мл	1 пробирка
- ОТ-полимераза	0,1 мл	1 пробирка
- ПКО SARS-CoV-2	1,0 мл	1 пробирка
- ОКО	1,0 мл	1 пробирка

Серия 9  2021-09-13

    2022-09-13

Условия хранения:

 -25°C  -16°C  

ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург,
наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н,
тел. +7(812)490-75-93 info@labpack.ru
Только для профессионального применения

Набор «SARS-CoV-2-скрин». Форма комплектации 1. Серия 9. Образец маркировки групповой потребительской упаковки

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин» серия 7, серия 8, серия 9

"SARS-CoV-2-скрин" РУ № РЗН XXXXXXXXXXXX

Форма комплектации 1. Состав набора:

1. Комплект 1 из 2: Комплект реагентов для ручного выделения РНК и ДНК из биологического материала «НК-Магнэ 2» (НК-Магнэ 2);	1 комплект
2. Комплект 2 из 2: Комплект реагентов для ОТ-ПЦР-РВ «SARS-CoV-2-скрин» (SARS-CoV-2);	1 комплект
3. Инструкция по применению;	1 шт
4. Паспорт качества	1 шт

Условия хранения:   +2°C  +8°C  -16°C  -25°C

ООО «ЛабПэк», 197376, г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н, тел. +7(812)490-75-93, info@labpack.ru
Только для профессионального применения

Серия 9  2021-09-13

    2022-09-13

Набор «SARS-CoV-2-скрин». Форма комплектации 1. Серия 9. Образец маркировки групповой (транспортной) упаковки

ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н,
тел. (812) 490-75-93, E-mail: info@labpack.ru, https://www.labpack.ru

**Набор реагентов для качественного выявления
РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР
в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин»
серия 7, серия 8, серия 9**



Серия 9

Форма комплектации 1.
Число единиц потребительской упаковки
изделий..... шт

Дата изготовления: **2021-09**
Срок годности: **2022-09**

Масса нетто групповой упаковки кг
Масса брутто групповой упаковки..... кг
Масса нетто потребительской упаковки кг

Условия хранения:

Условия транспортирования:



При получении разукomплектовать.
Хранить в соответствии с условиями, указанными на
компонентах набора.



VI. Набор «SARS-CoV-2-скрин». Форма комплектации 2. Серия 9

Форма комплектации 2. Комплект 1 из 2. Серия 9. Образцы маркировки первичной упаковки:



Форма комплектации 2. Комплект 1 из 2. Серия 9. Образцы маркировки вторичной упаковки:



Форма комплектации 2. Комплект 2 из 2. Серия 9. Образцы маркировки первичной упаковки:

Буфер SARS-CoV-2

ООО «ЛабПэк» "SARS-CoV-2-скрин"
 Форма комплектации 2
 Комплект 2 из 2
 SARS-CoV-2
 Серия 9
Буфер SARS-CoV-2
 1,5 мл
 Готов к использованию
 2022-09-15 -25°C -16°C IVD

ОТ-полимераза

ООО «ЛабПэк» "SARS-CoV-2-скрин"
 Форма комплектации 2
 Комплект 2 из 2
 SARS-CoV-2
 Серия 9
ОТ-полимераза
 0,1 мл
 Готов к использованию
 2022-09-15 -25°C -16°C IVD

ПКО SARS-CoV-2

ООО «ЛабПэк» "SARS-CoV-2-скрин"
 Форма комплектации 2
 Комплект 2 из 2
 SARS-CoV-2
 Серия 9
ПКО SARS-CoV-2
 1,0 мл
 Готов к использованию
 2022-09-15 -25°C -16°C IVD

ОКО

ООО «ЛабПэк» "SARS-CoV-2-скрин"
 Форма комплектации 2
 Комплект 2 из 2
 SARS-CoV-2
 Серия 9
ОКО
 1,0 мл
 Готов к использованию
 2022-09-15 -25°C -16°C IVD

Форма комплектации 2. Комплект 2 из 2. Серия 9. Образец маркировки вторичной упаковки:

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин» серия 7, серия 8, серия 9

"SARS-CoV-2-скрин"
 Комплект реагентов для ОТ-ПЦР-ПВ «SARS-CoV-2-скрин» (SARS-CoV-2).

Форма комплектации 2. Комплект 2 из 2.

Состав комплекта:

- Буфер SARS-CoV-2	1,5 мл	1 пробирка
- ОТ-полимераза	0,1 мл	1 пробирка
- ПКО SARS-CoV-2	1,0 мл	1 пробирка
- ОКО	1,0 мл	1 пробирка

Серия 9 2021-09-15

2022-09-15

Условия хранения:

-25°C -16°C

96

ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н, тел. +7(812)490-75-93 info@labpack.ru

Только для профессионального применения

Набор «SARS-CoV-2-скрин». Форма комплектации 2. Серия 9. Образец маркировки групповой потребительской упаковки

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин» серия 7, серия 8, серия 9.

"SARS-CoV-2-скрин"

РУ № РЗН XXXXXXXXXXXXXXX

Форма комплектации 2. Состав набора:

- | | |
|--|------------|
| 1. Комплект 1 из 2:
Комплект реагентов для автоматического выделения РНК и ДНК из биологического материала «НК-Магно 2» (НК-Магно 2); | 1 комплект |
| 2. Комплект 2 из 2:
Комплект реагентов для ОТ-ПЦР-РВ «SARS-CoV-2-скрин» (SARS-CoV-2); | 1 комплект |
| 3. Инструкция по применению; | 1 шт |
| 4. Паспорт качества | 1 шт |

Условия хранения:



ООО «ЛабПэк», 197376, г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н, тел. +7(812)490-75-93, info@labpack.ru

Только для профессионального применения

Серия 9



2021-09-15



2022-09-15



96



Набор «SARS-CoV-2-скрин». Форма комплектации 2. Серия 9. Образец маркировки групповой (транспортной) упаковки

ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н, тел. (812) 490-75-93, E-mail: info@labpack.ru, https://www.labpack.ru

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин» серия 7, серия 8, серия 9



Серия 9

Форма комплектации 2.

Число единиц потребительской упаковки изделий..... шт

Масса нетто групповой упаковки кг


Масса брутто групповой упаковки..... кг

Масса нетто потребительской упаковки кг

Дата изготовления: 2021-09

Срок годности: 2022-09


Условия транспортирования:

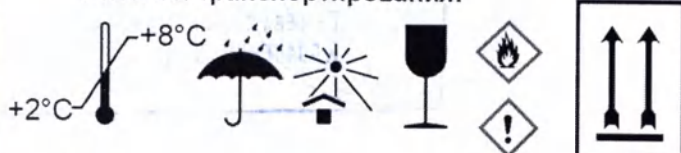

Условия хранения:

Комплект 1 из 2

Комплект 2 из 2

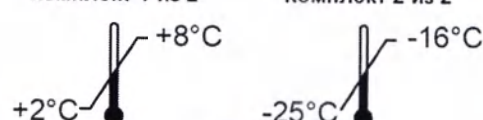

При получении разукрупнять.

Хранить в соответствии с условиями, указанными на компонентах набора.



