

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО "АНАЛИТИКА"


С.А. Балабаев

29 ноября 2021 г.




**Фотографические изображения медицинского изделия**

Коагулометр автоматический HumaClot Pro для лабораторных исследований  
in vitro

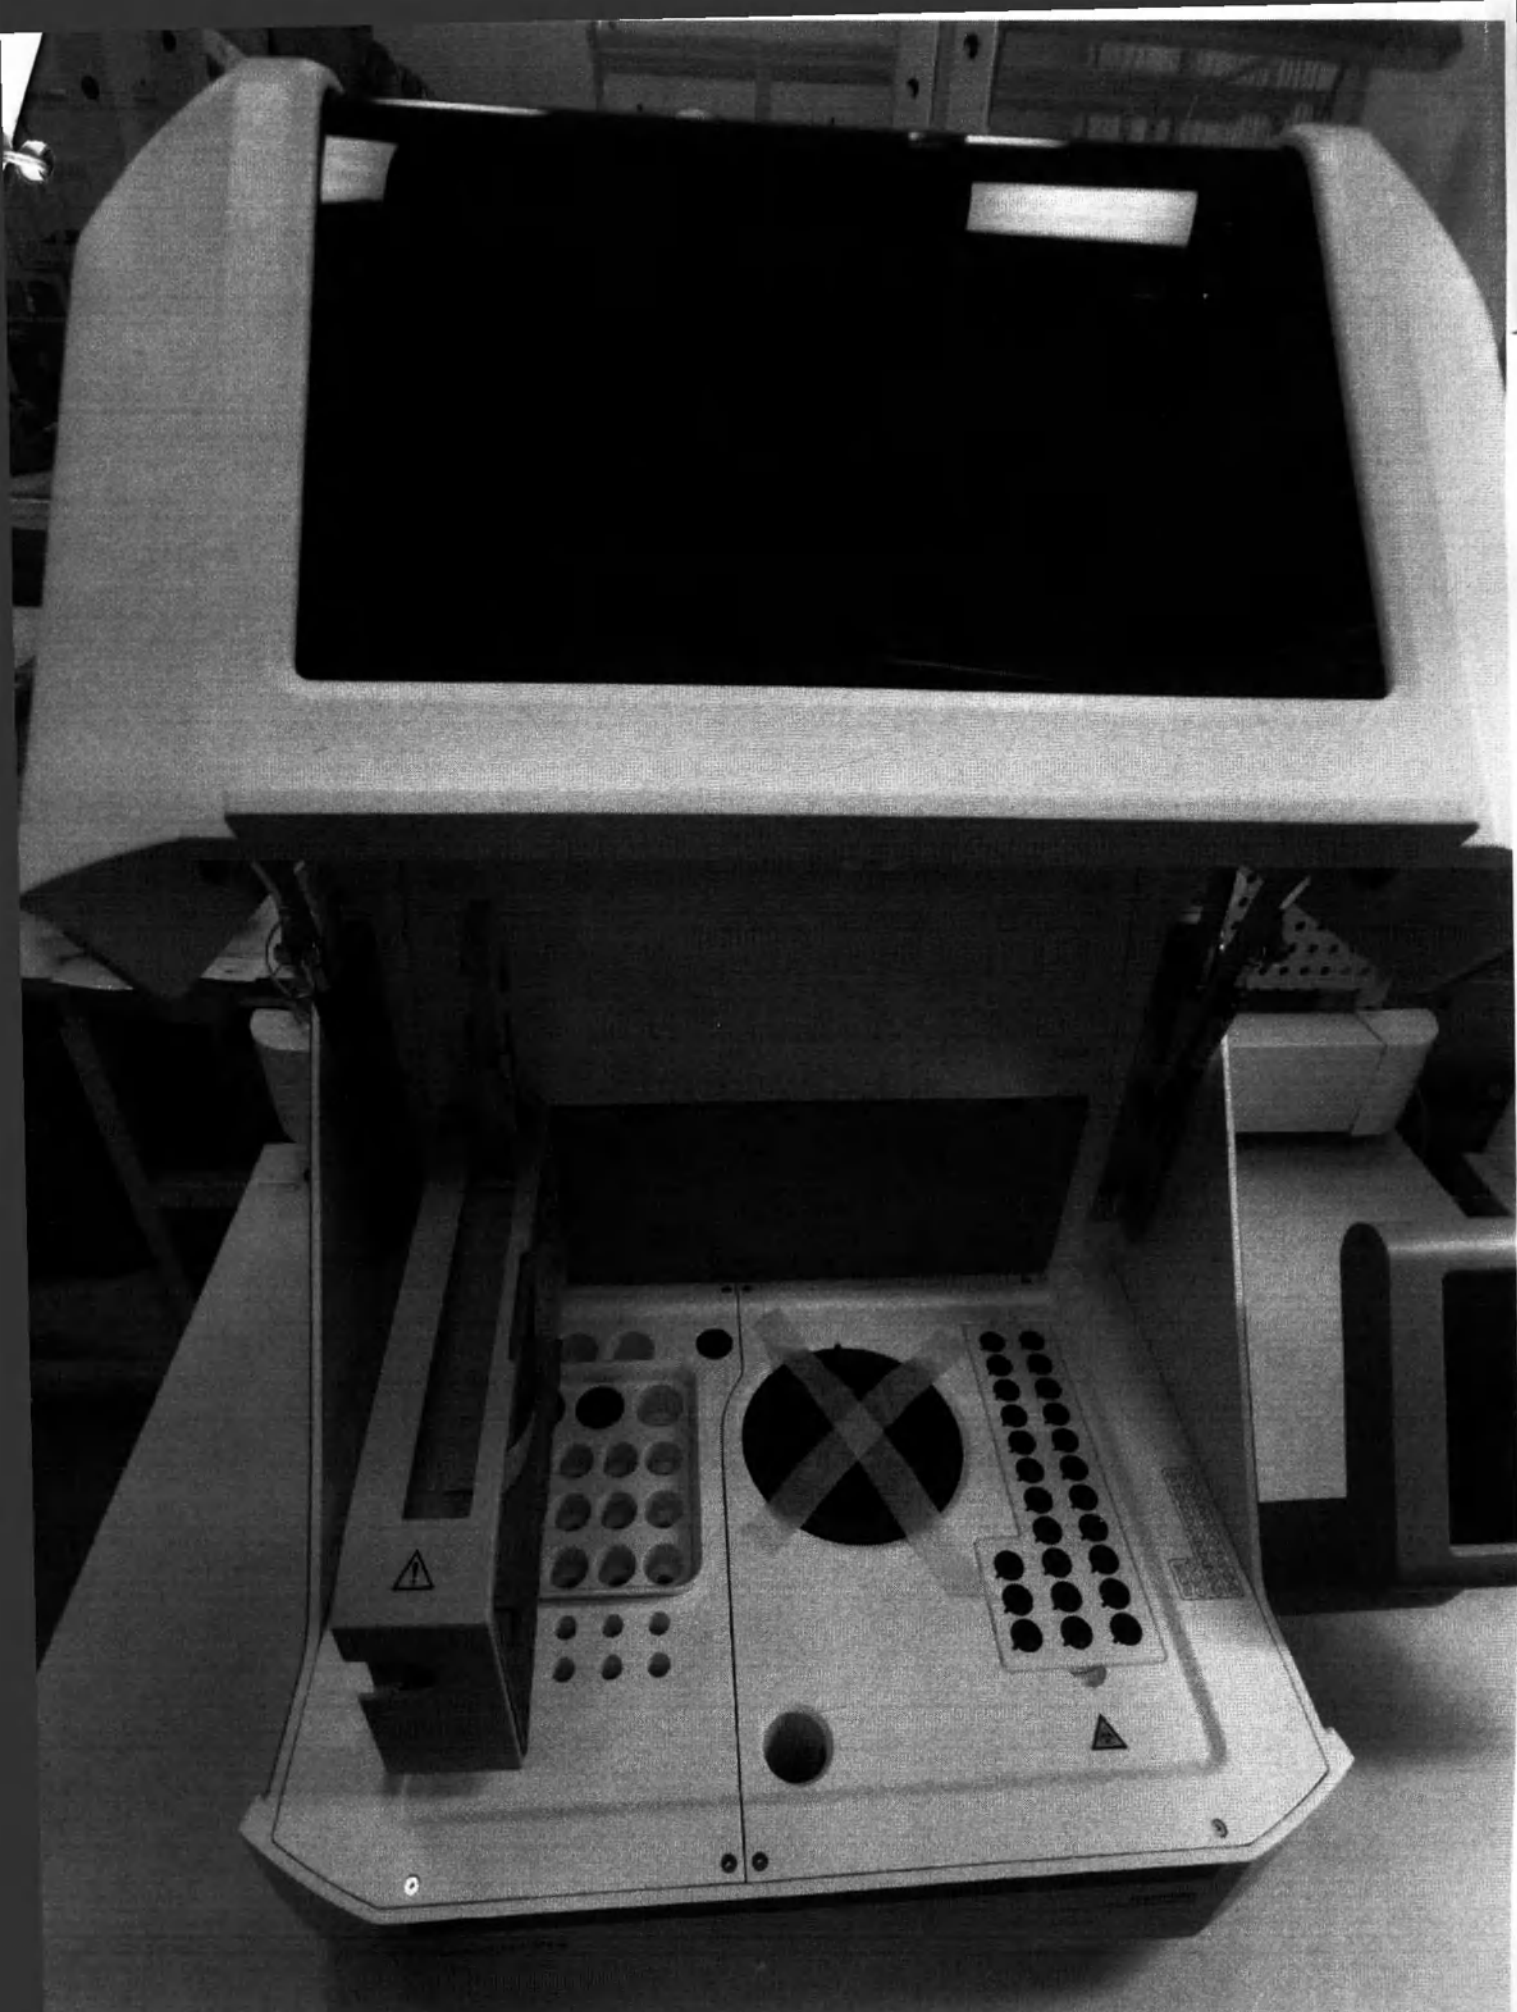


**Фотографическое изображение 1 – Блок коагулометра HumaClot Pro**



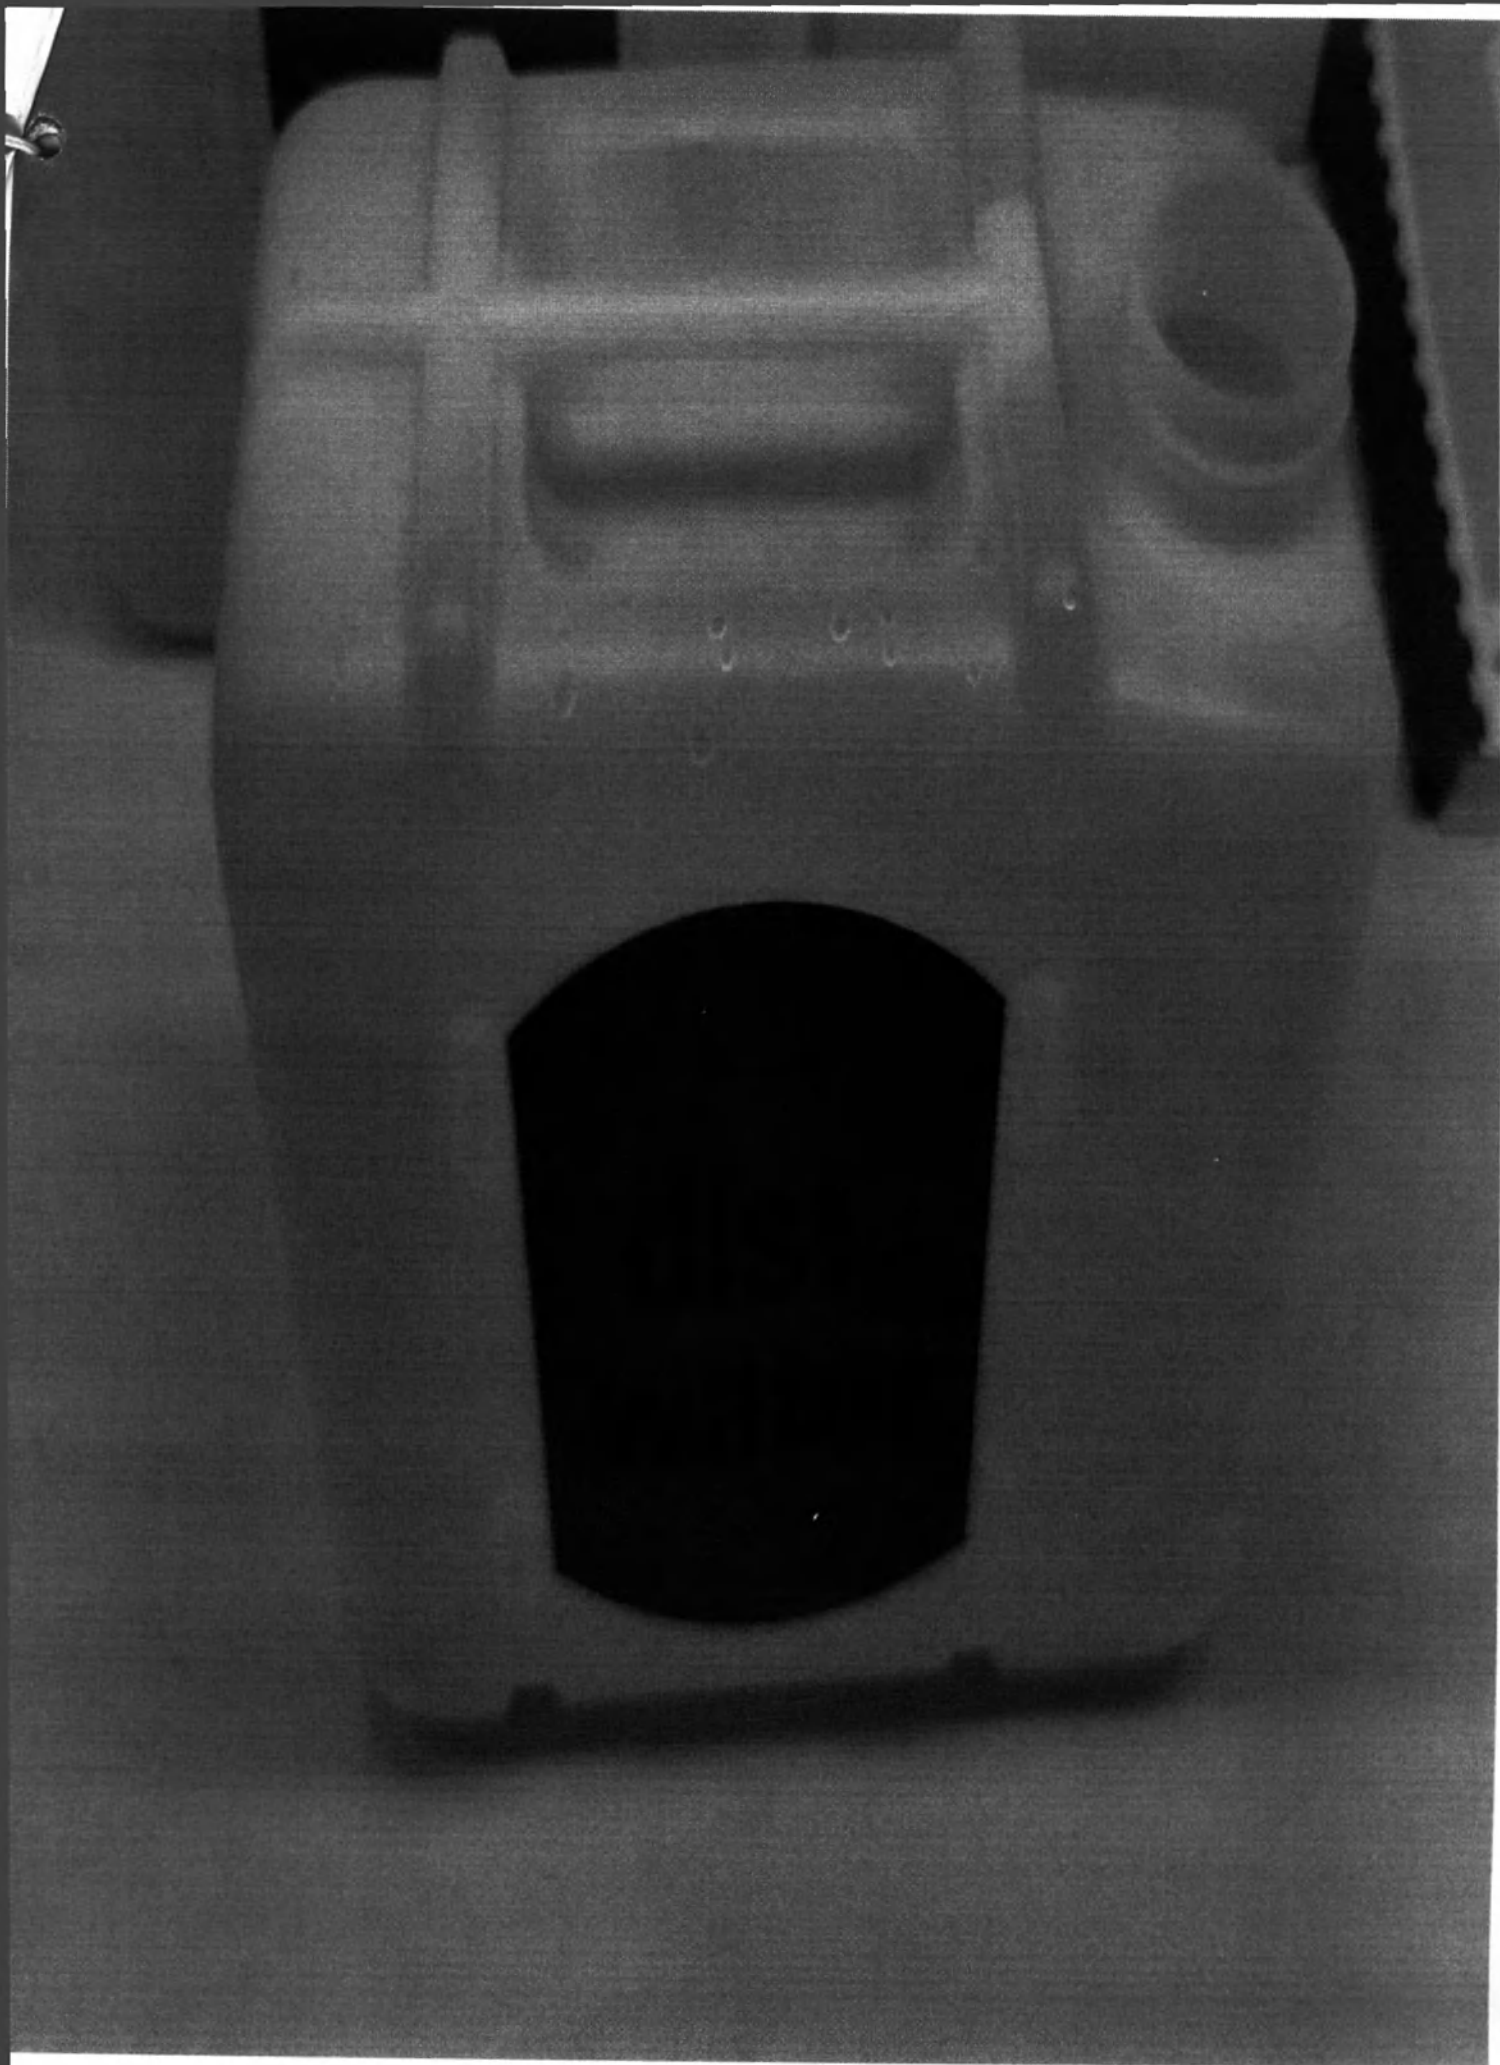

Фотографическое изображение 3 – Контейнер для промывающей жидкости с крышкой, объёмом 2,5 л

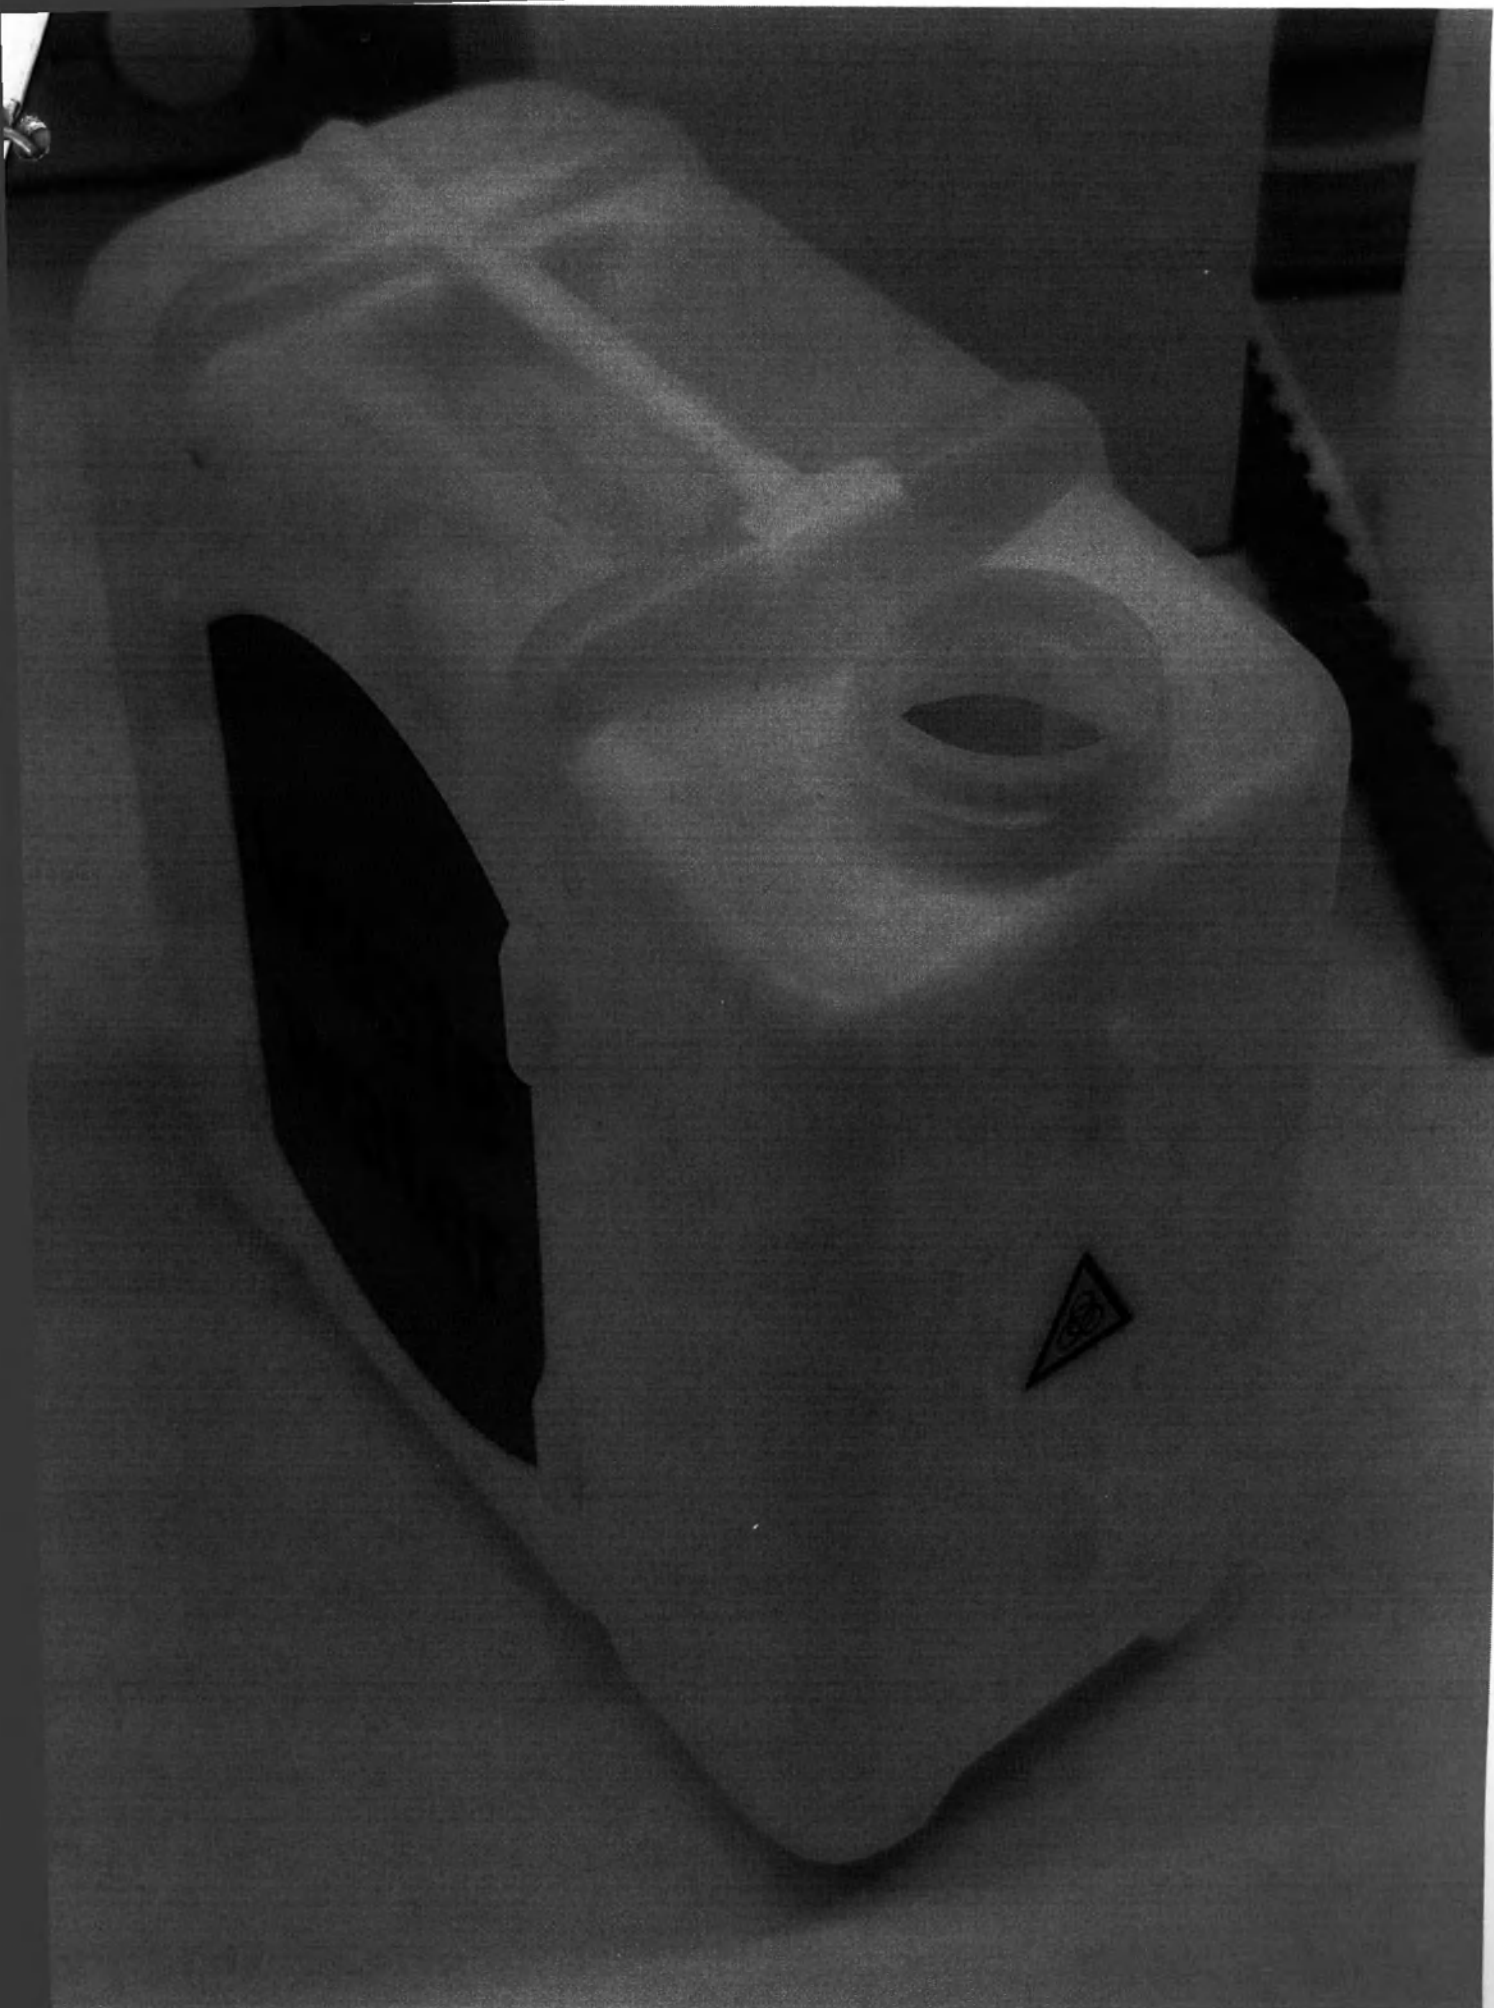

Фотографическое изображение 4 – Контейнер для слива с крышкой, объёмом 2,5 л




Фотографическое изображение 5 – Датчик контейнера для промывающей жидкости




**Фотографическое изображение 6 – Датчик контейнера для слива**




Фотографическое изображение 7 – Фильтр датчика контейнера для промывающей  
жидкости

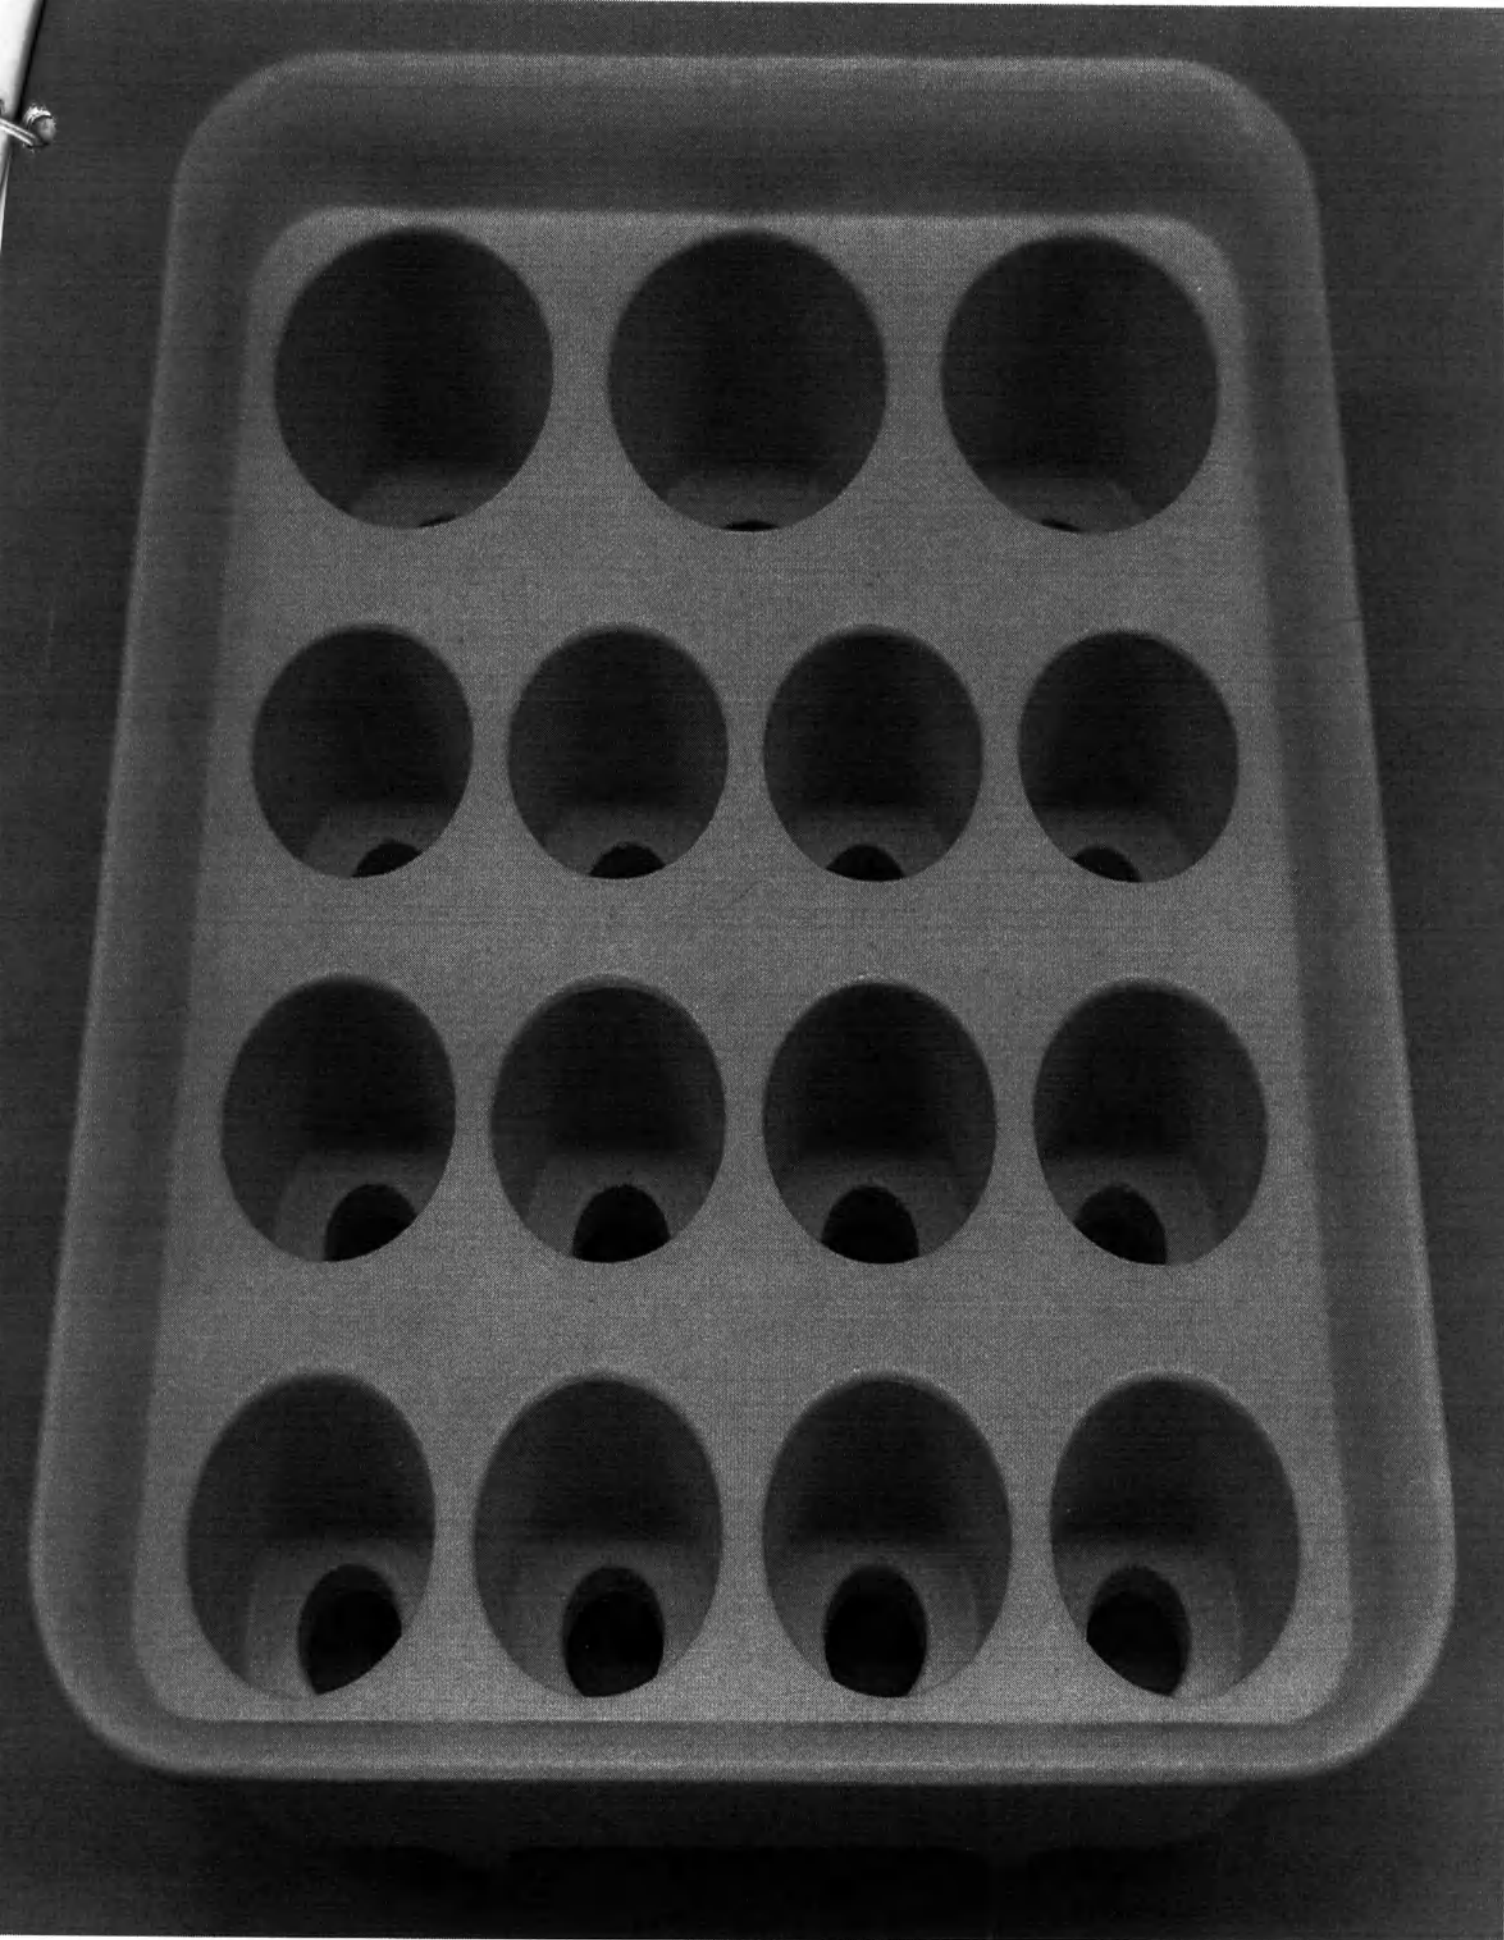

**Фотографическое изображение 8 – Штатив для реагентов**

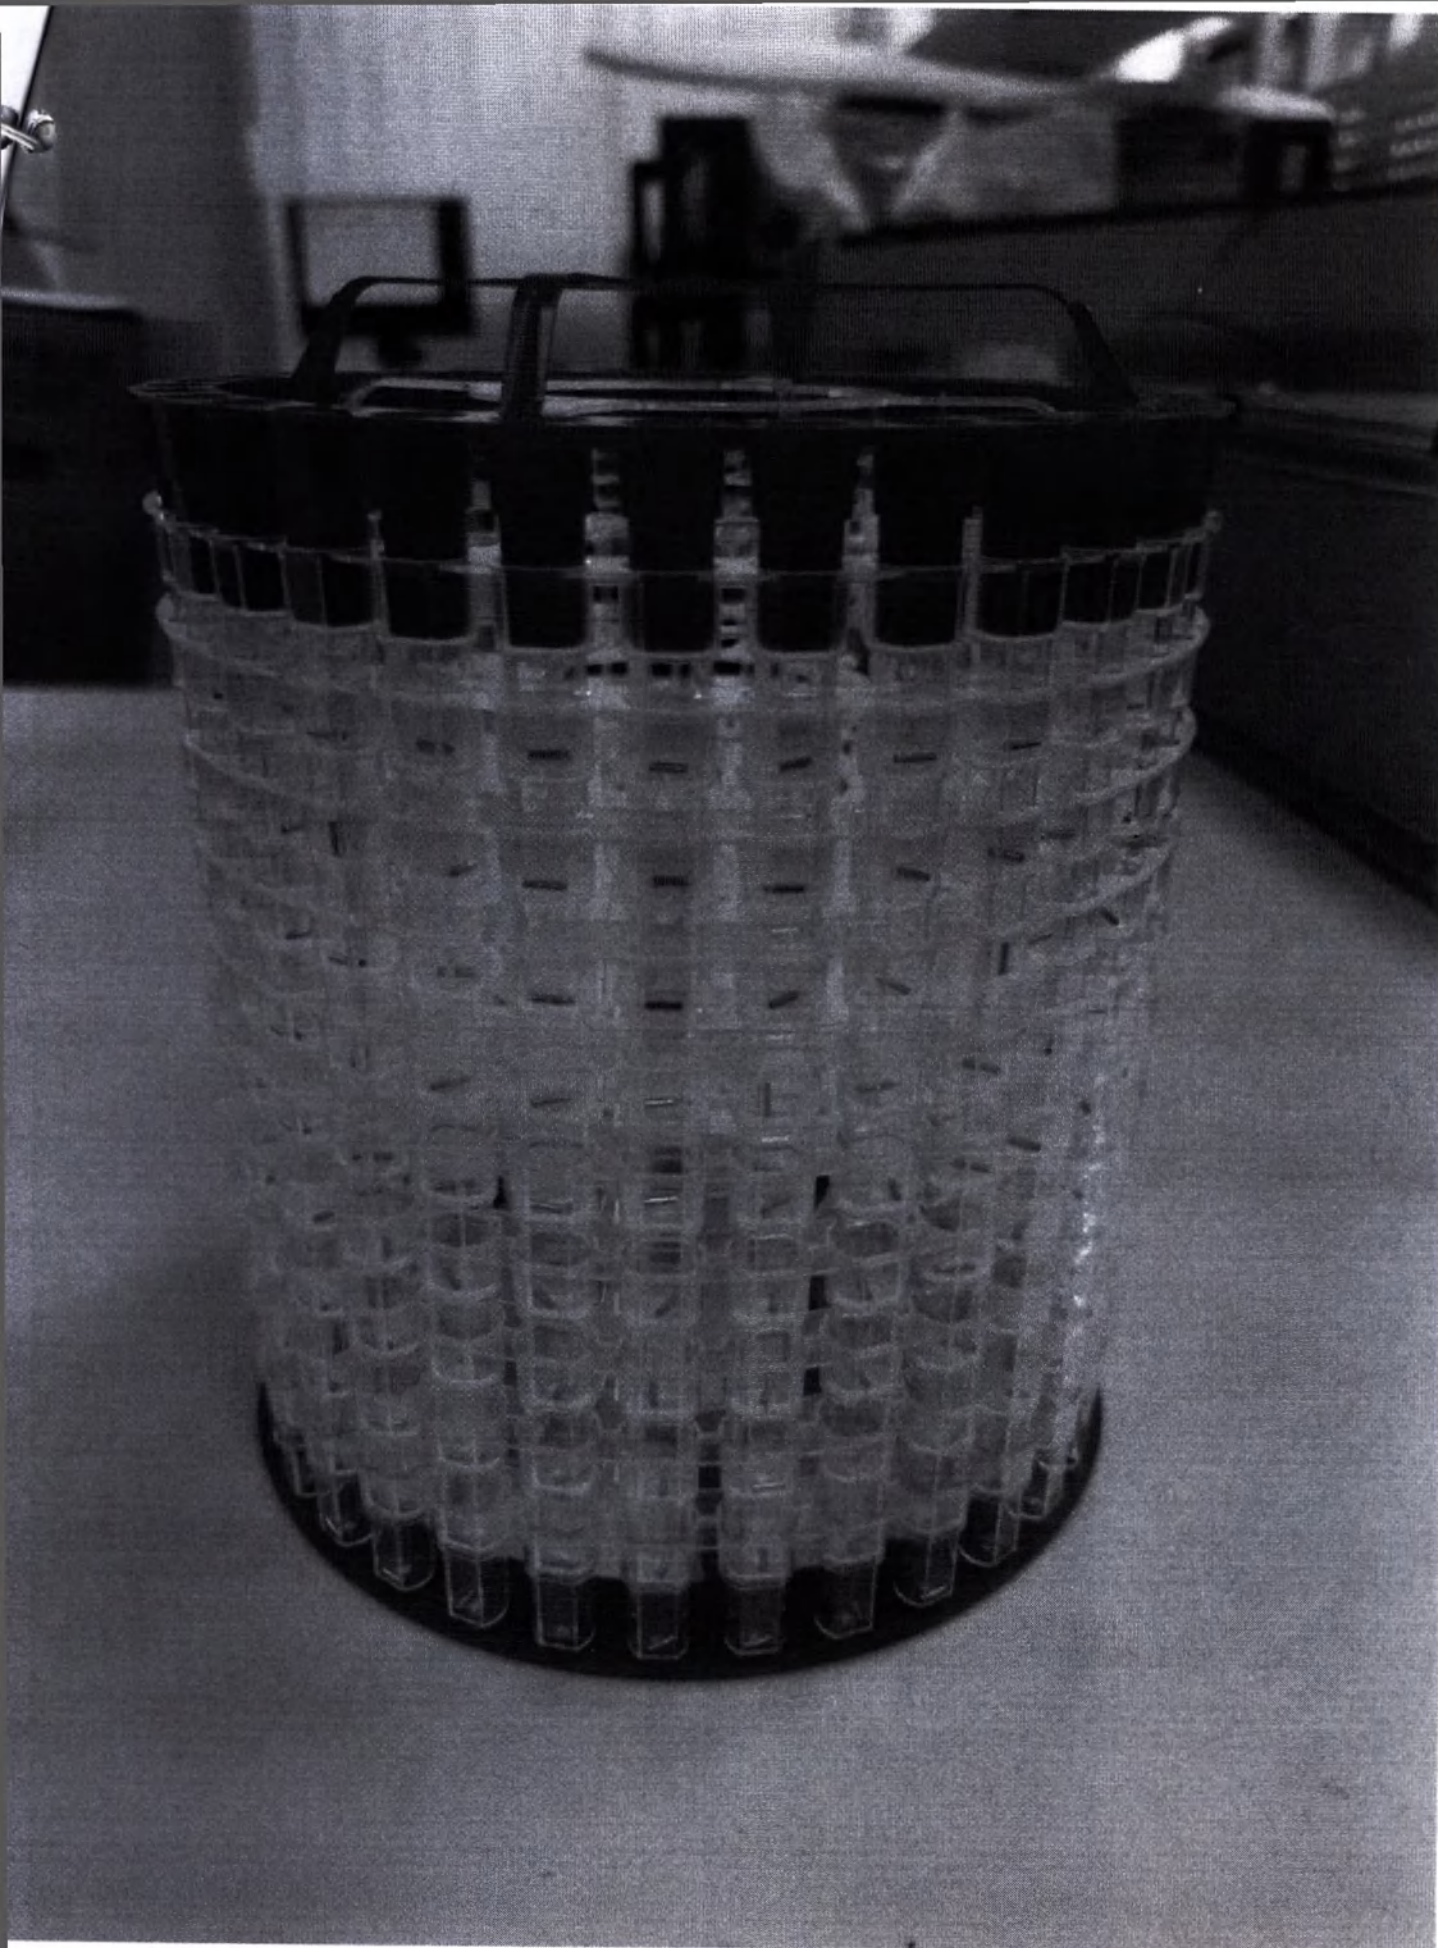


Фотографическое изображение 9 – Набор измерительных кювет: моноблок из 32 кювет со стержнями для перемешивания

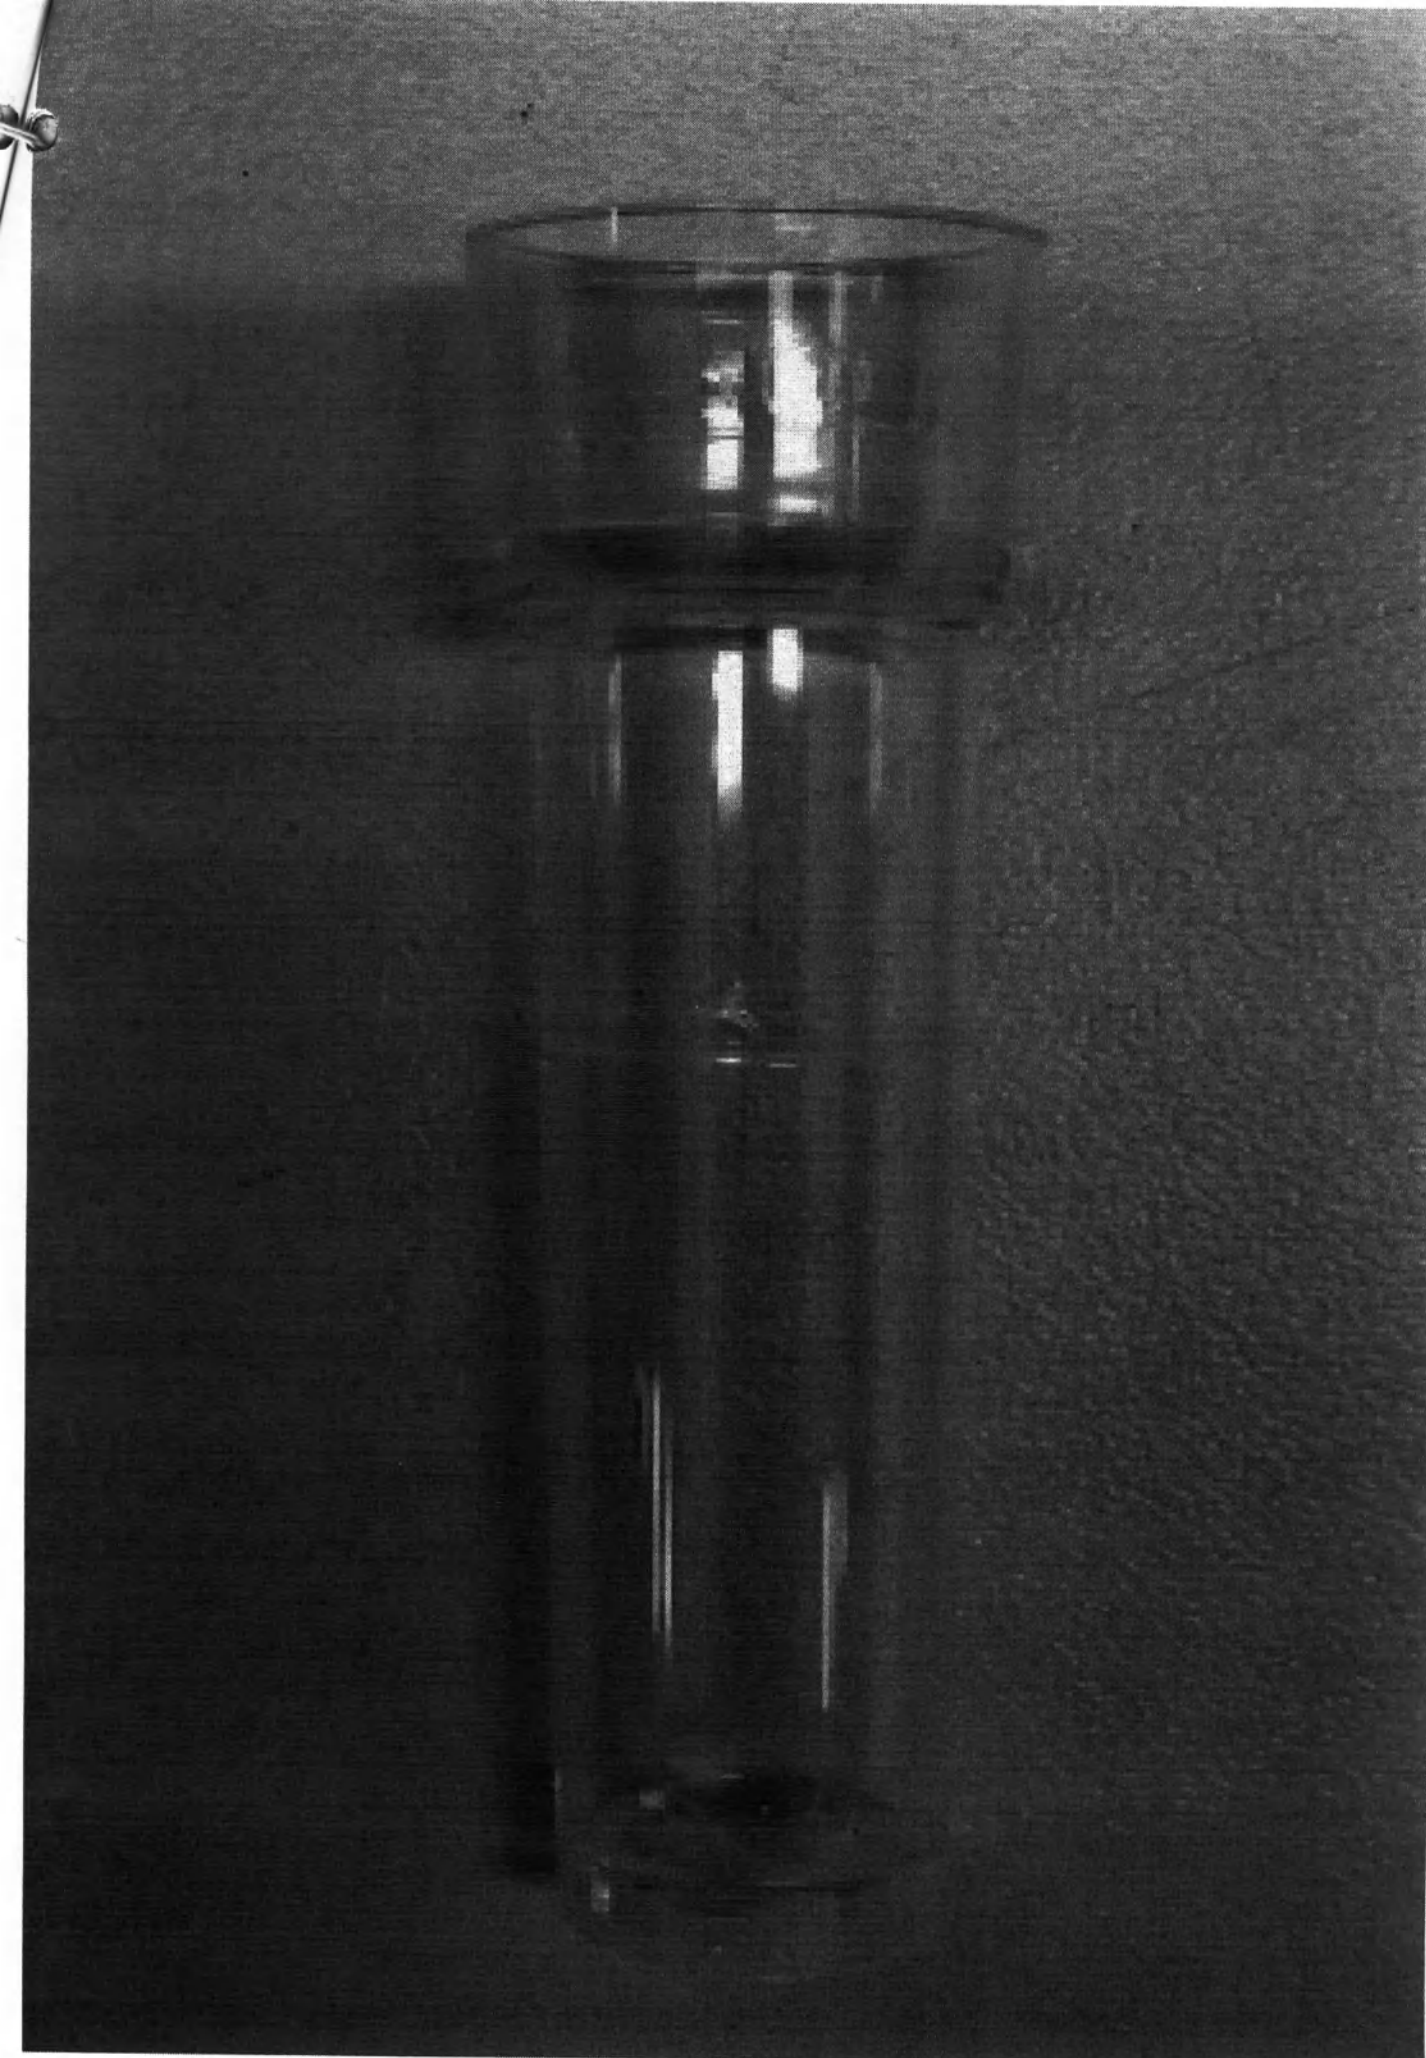






Фотографическое изображение 12 – Жидкость для очистки, 15 мл, 5 фл. /упак

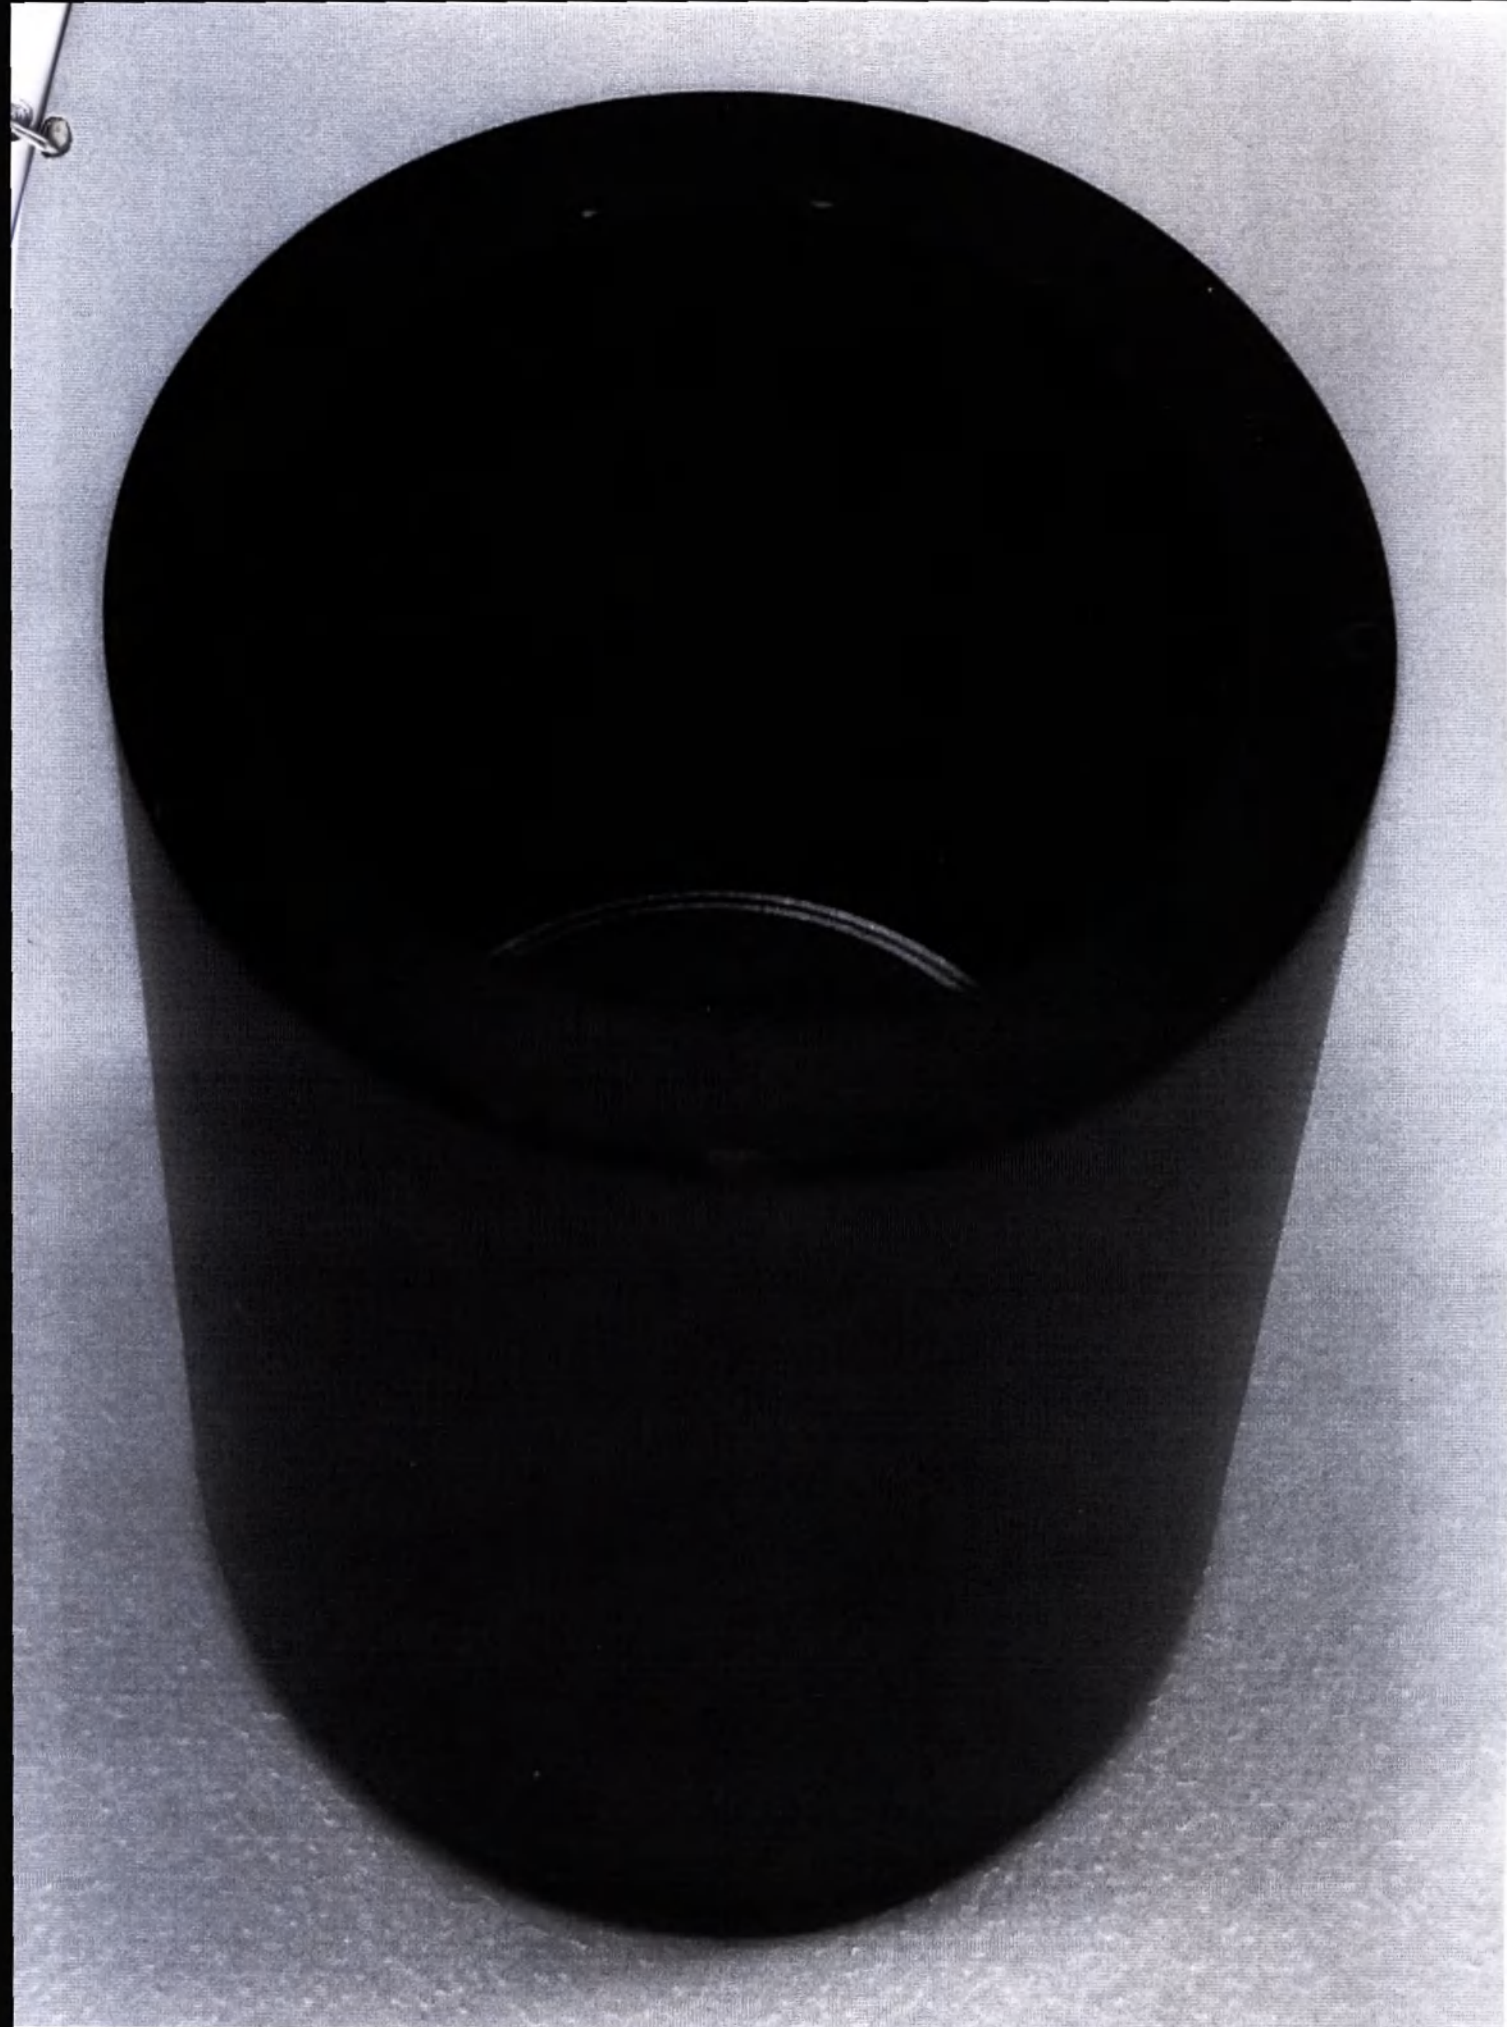

Фотографическое изображение 13 – Адаптер кольцевой для реагентов

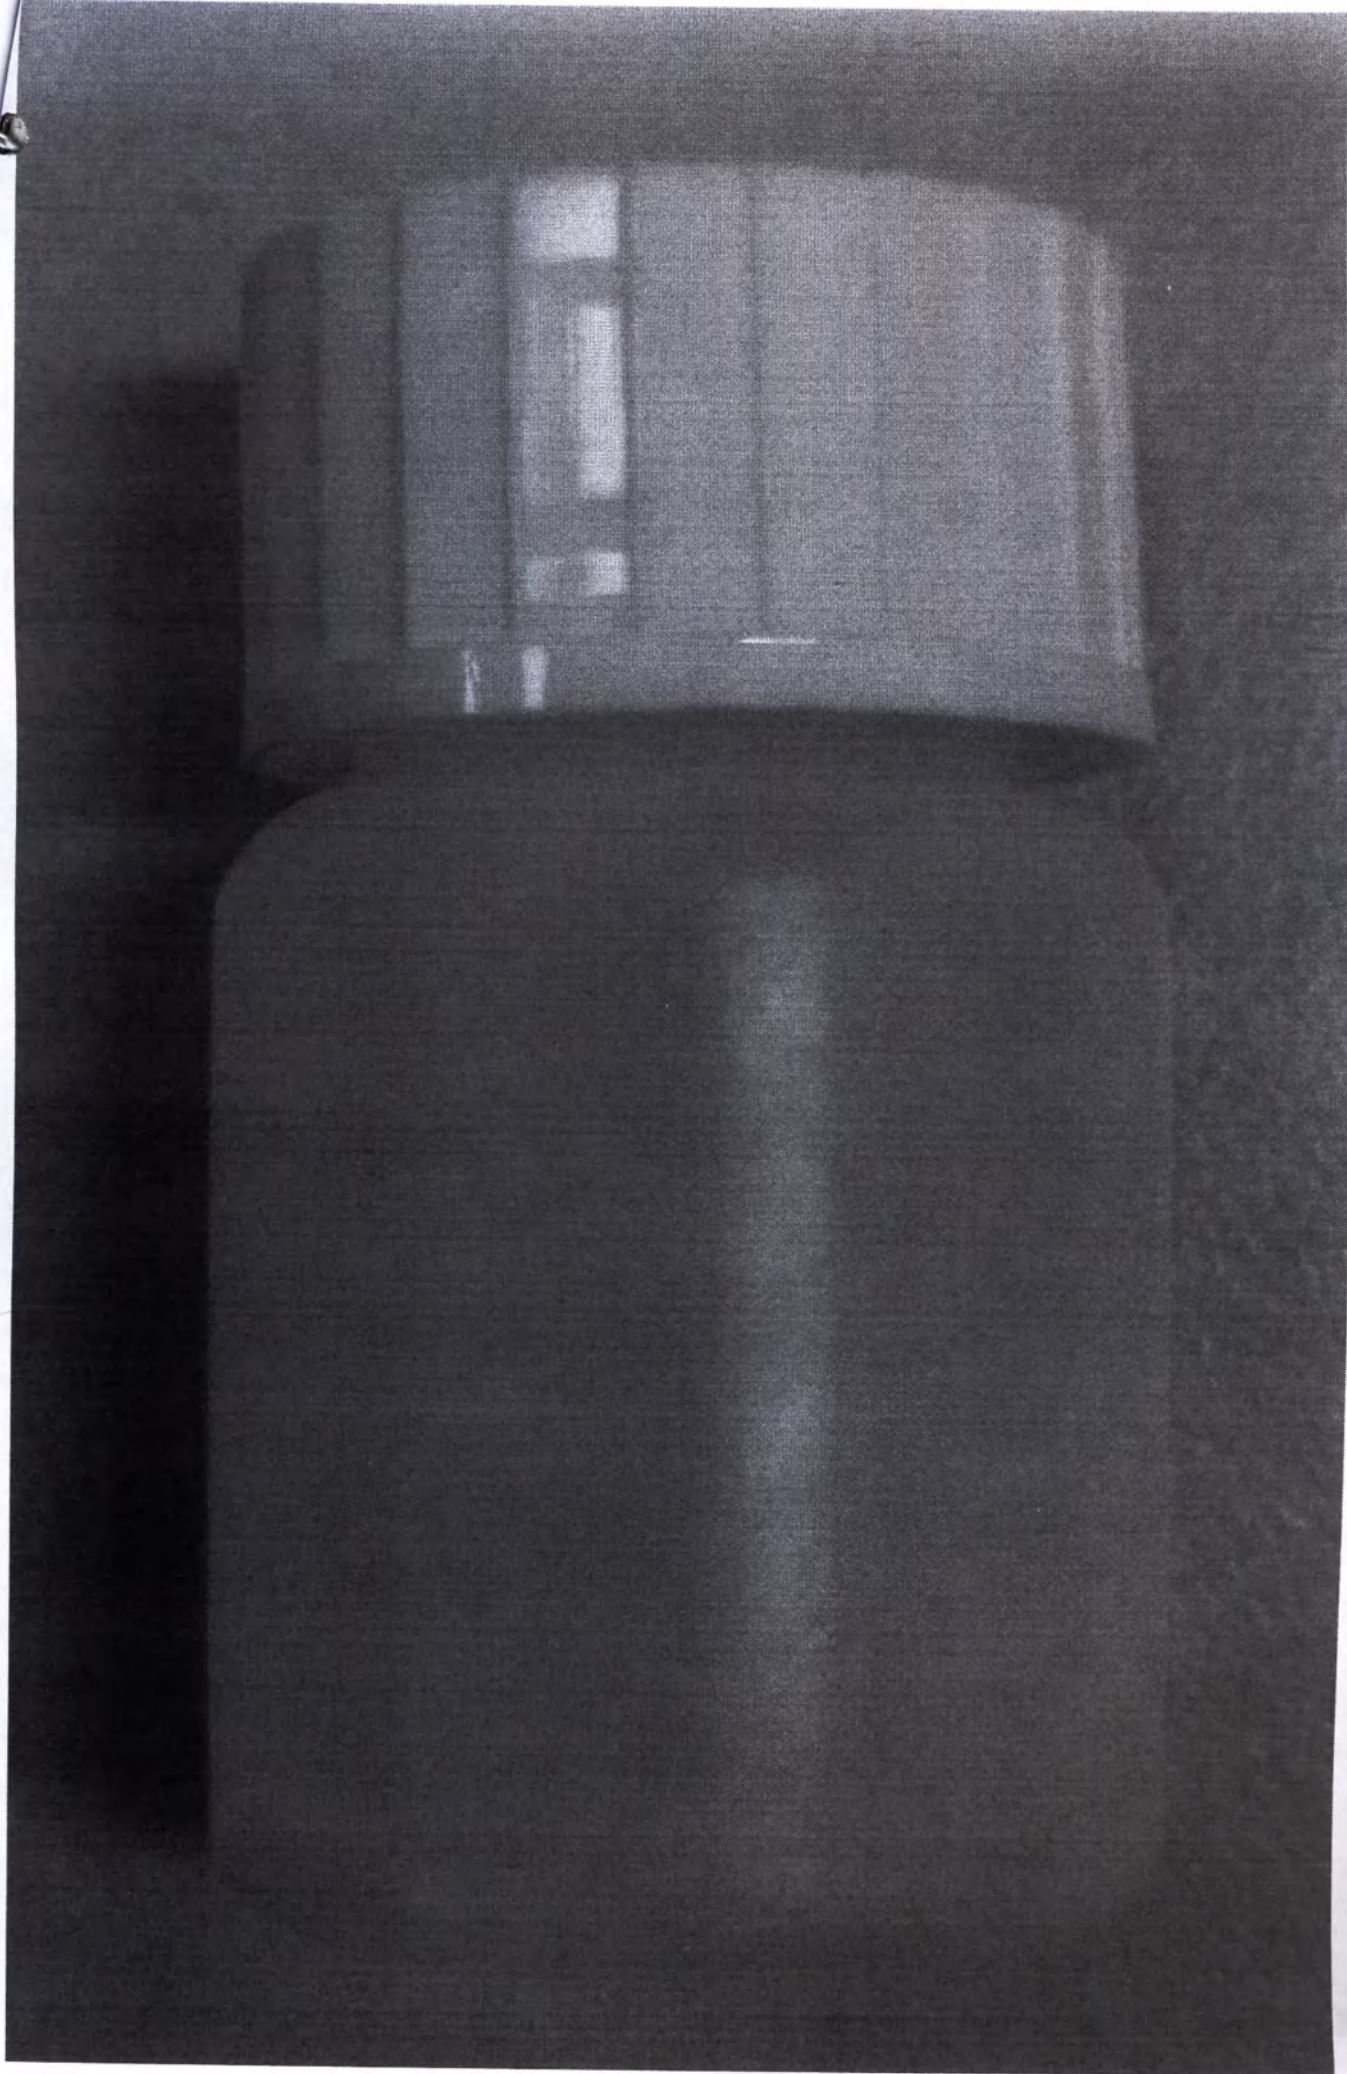





**Фотографическое изображение 15 – Предохранитель (250В/5А)**



Фотографическое изображение 16 – USB-накопитель объемом 8 GB

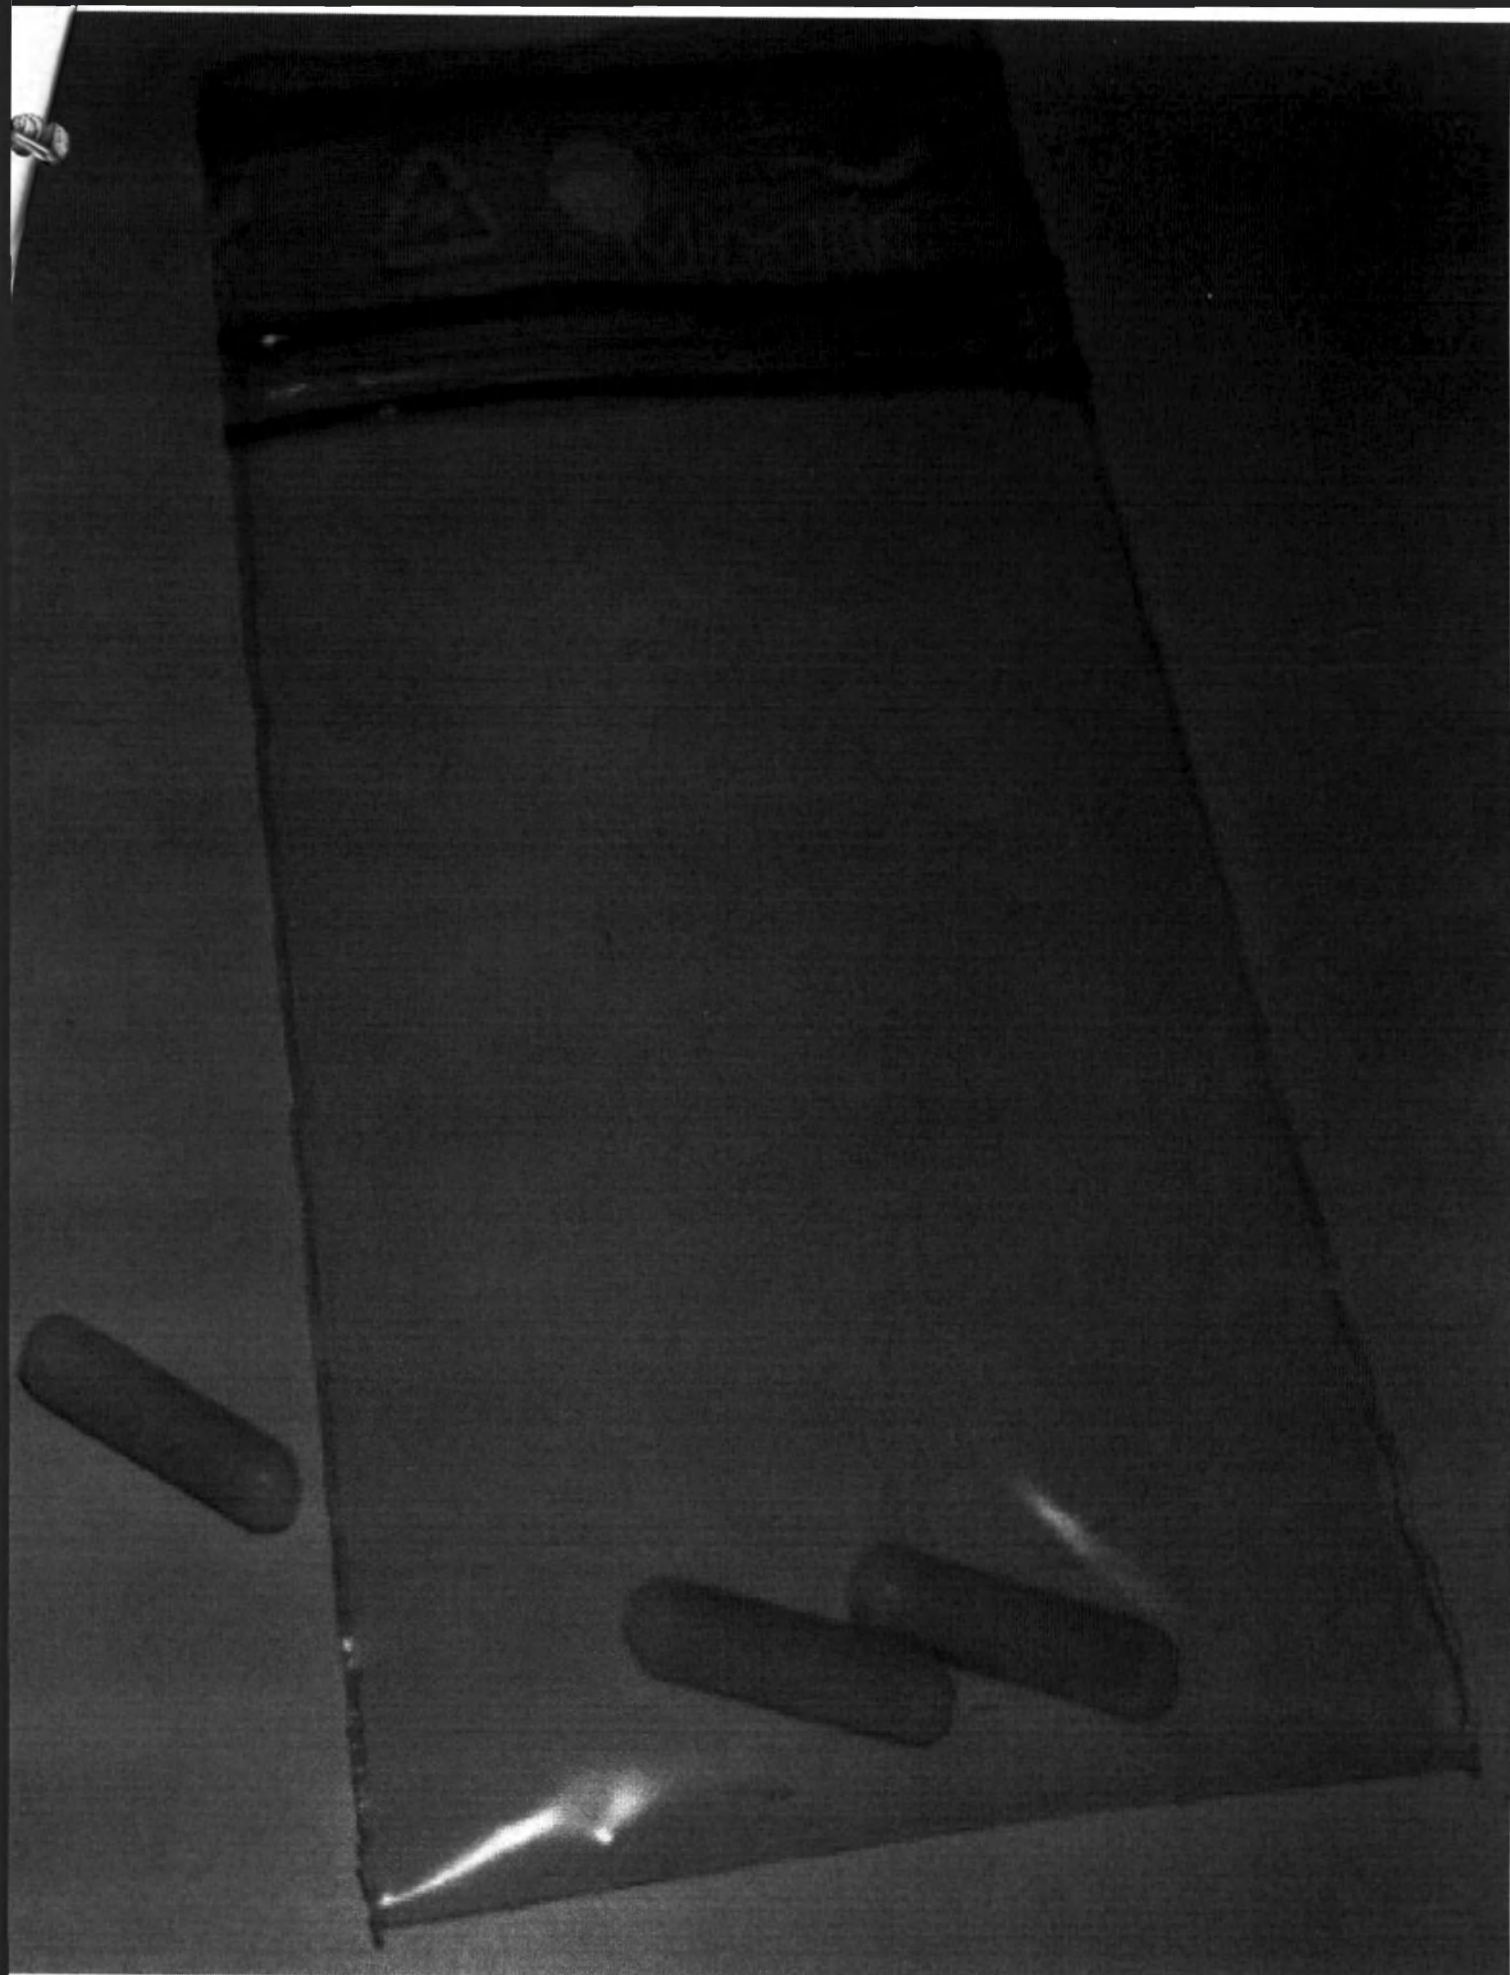

Фотографическое изображение 17 – Стержень для магнитной мешалки

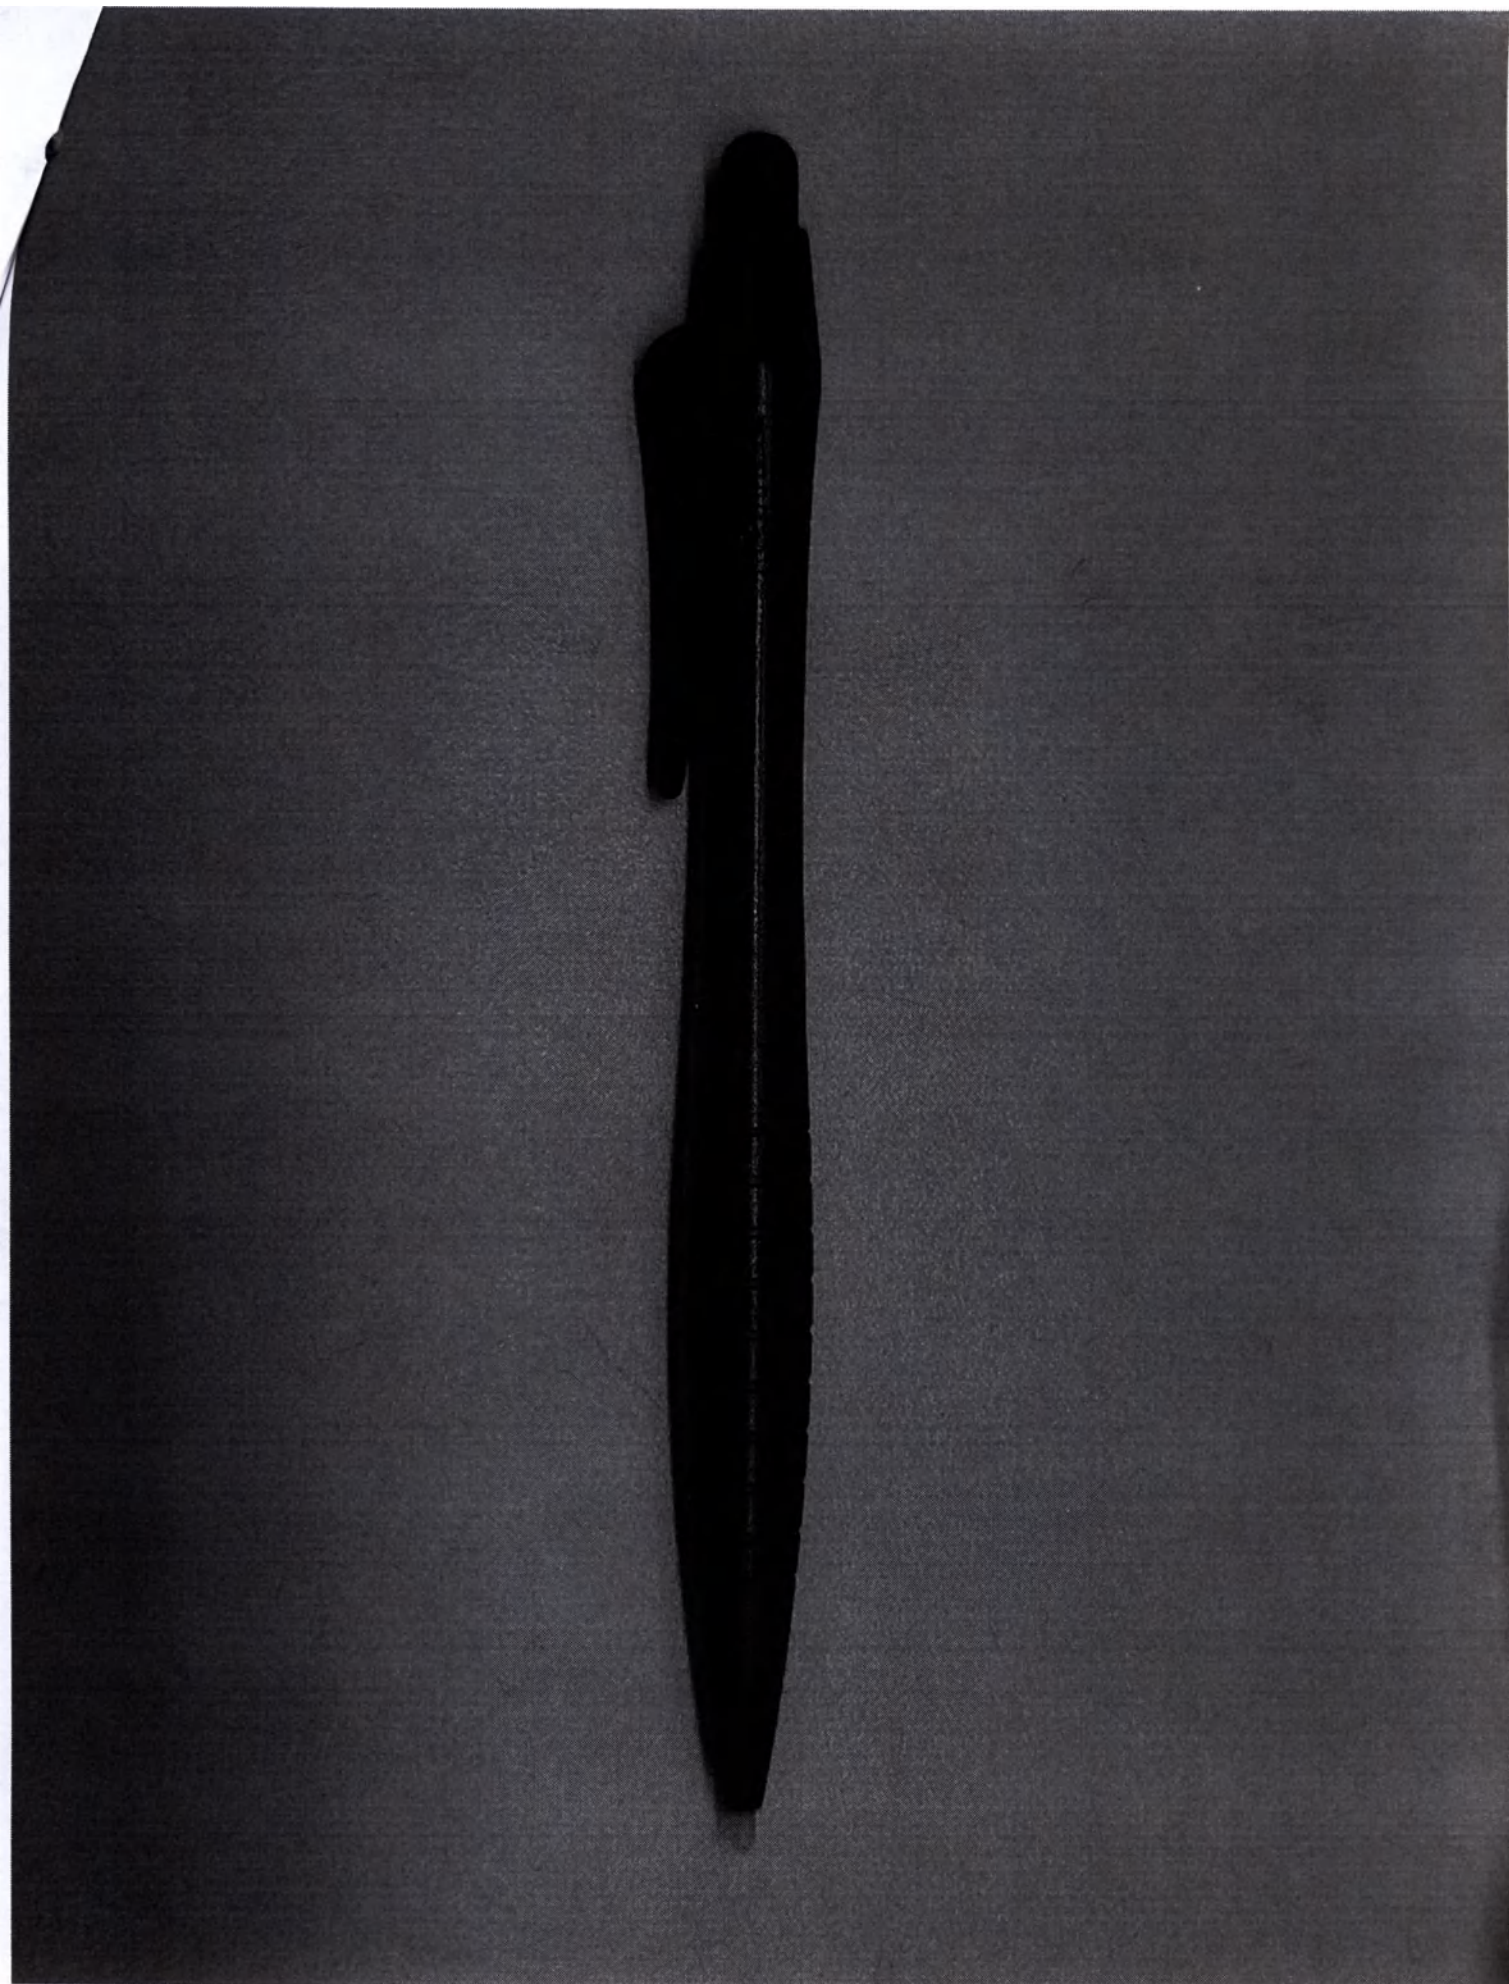

**Фотографическое изображение 18 – Стилус для ввода данных**

Руководство пользователя  
Коагулометр автоматический HumaClot Pro для лабораторных исследований *in vitro*

Фотографическое изображение 19 – Руководство пользователя

Всего пронумеровано,  
прошнуровано и скреплено  
печатью 20 листов.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БАЛАБАЕВ С.А.