

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Монитор медицинского назначения модель SC-MED в
составе, в вариантах исполнения по ТУ 26.60.12-001-
37059287-2021***

УТВЕРЖДАЮ


Директор

ООО «МедИнКом»


М.Ю. Жаворонков

« 16 » декабря 2021 г.



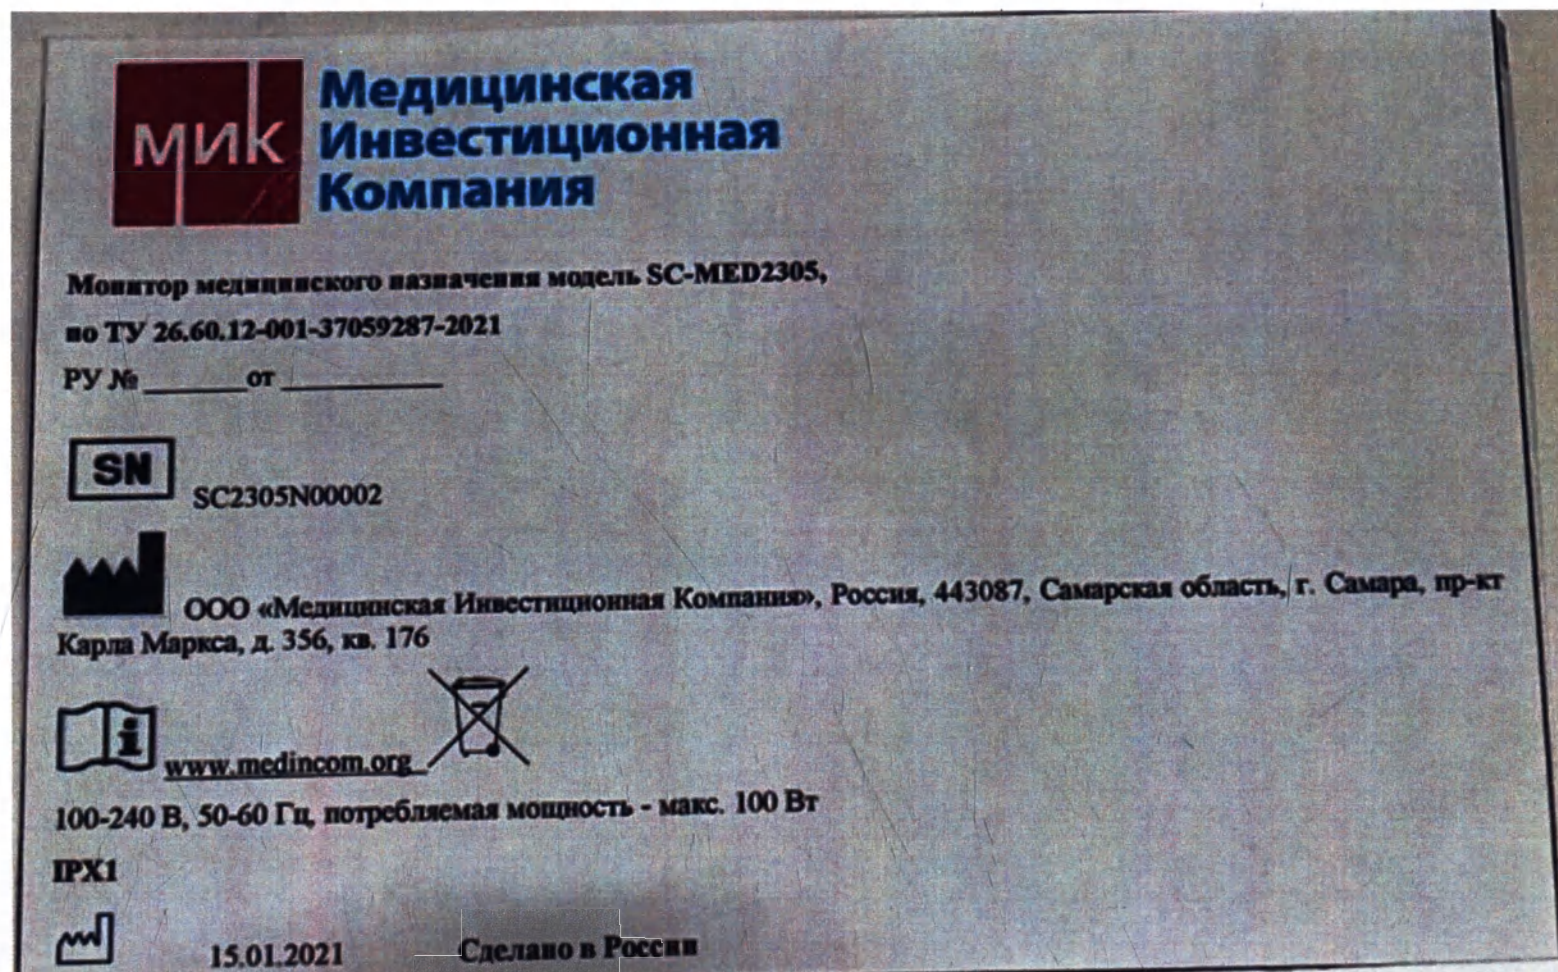


I. Монитор медицинского назначения модель SC-MED2305 (Вид спереди)

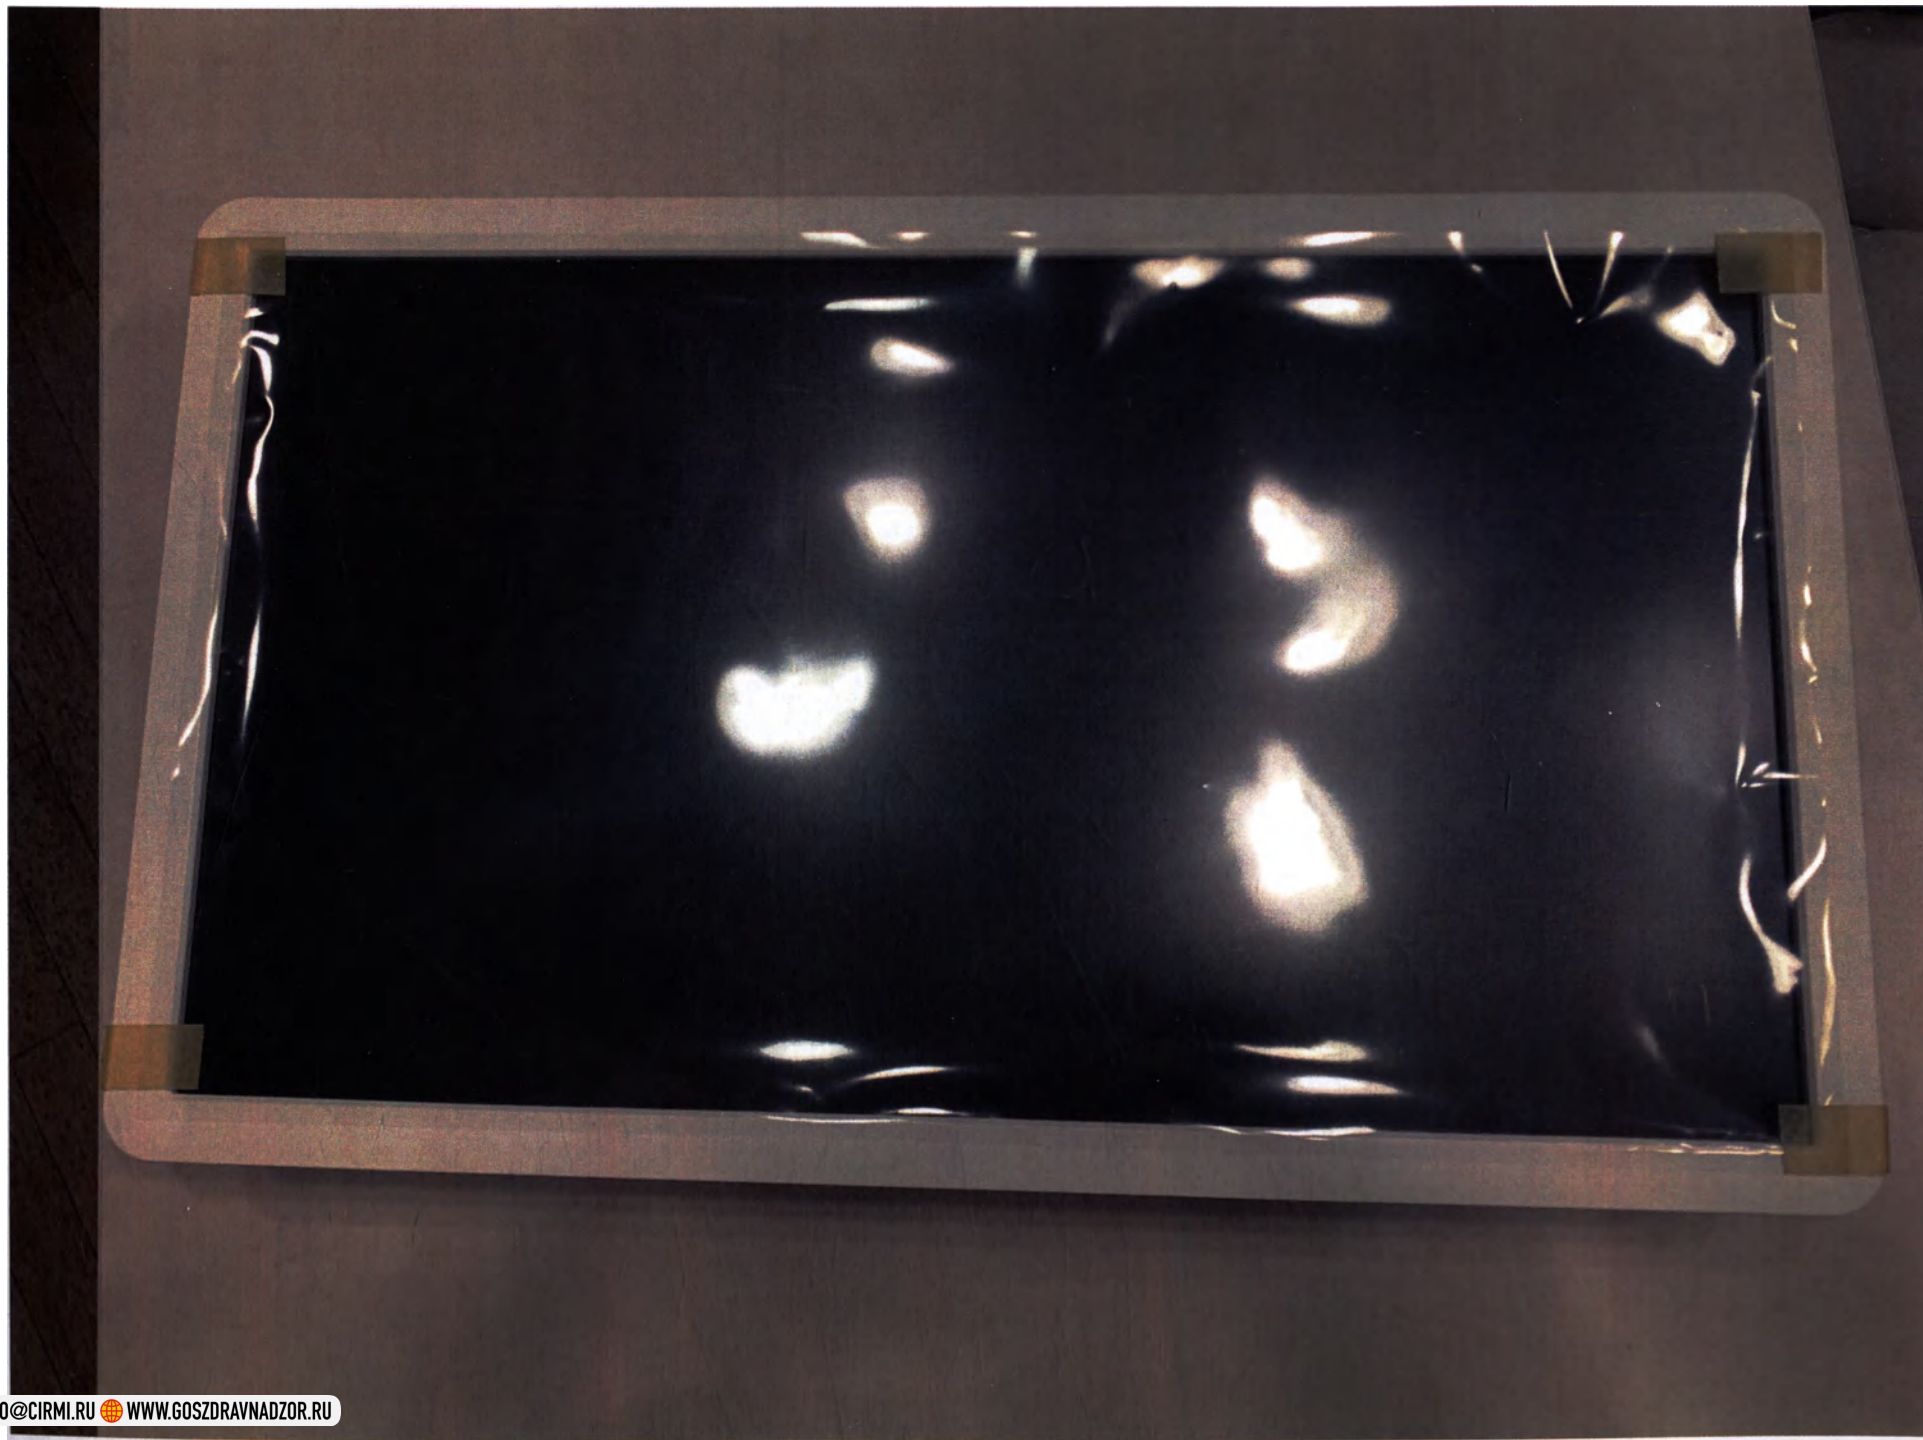


Монитор медицинского назначения модель SC-MED2305 (Вид сбоку)





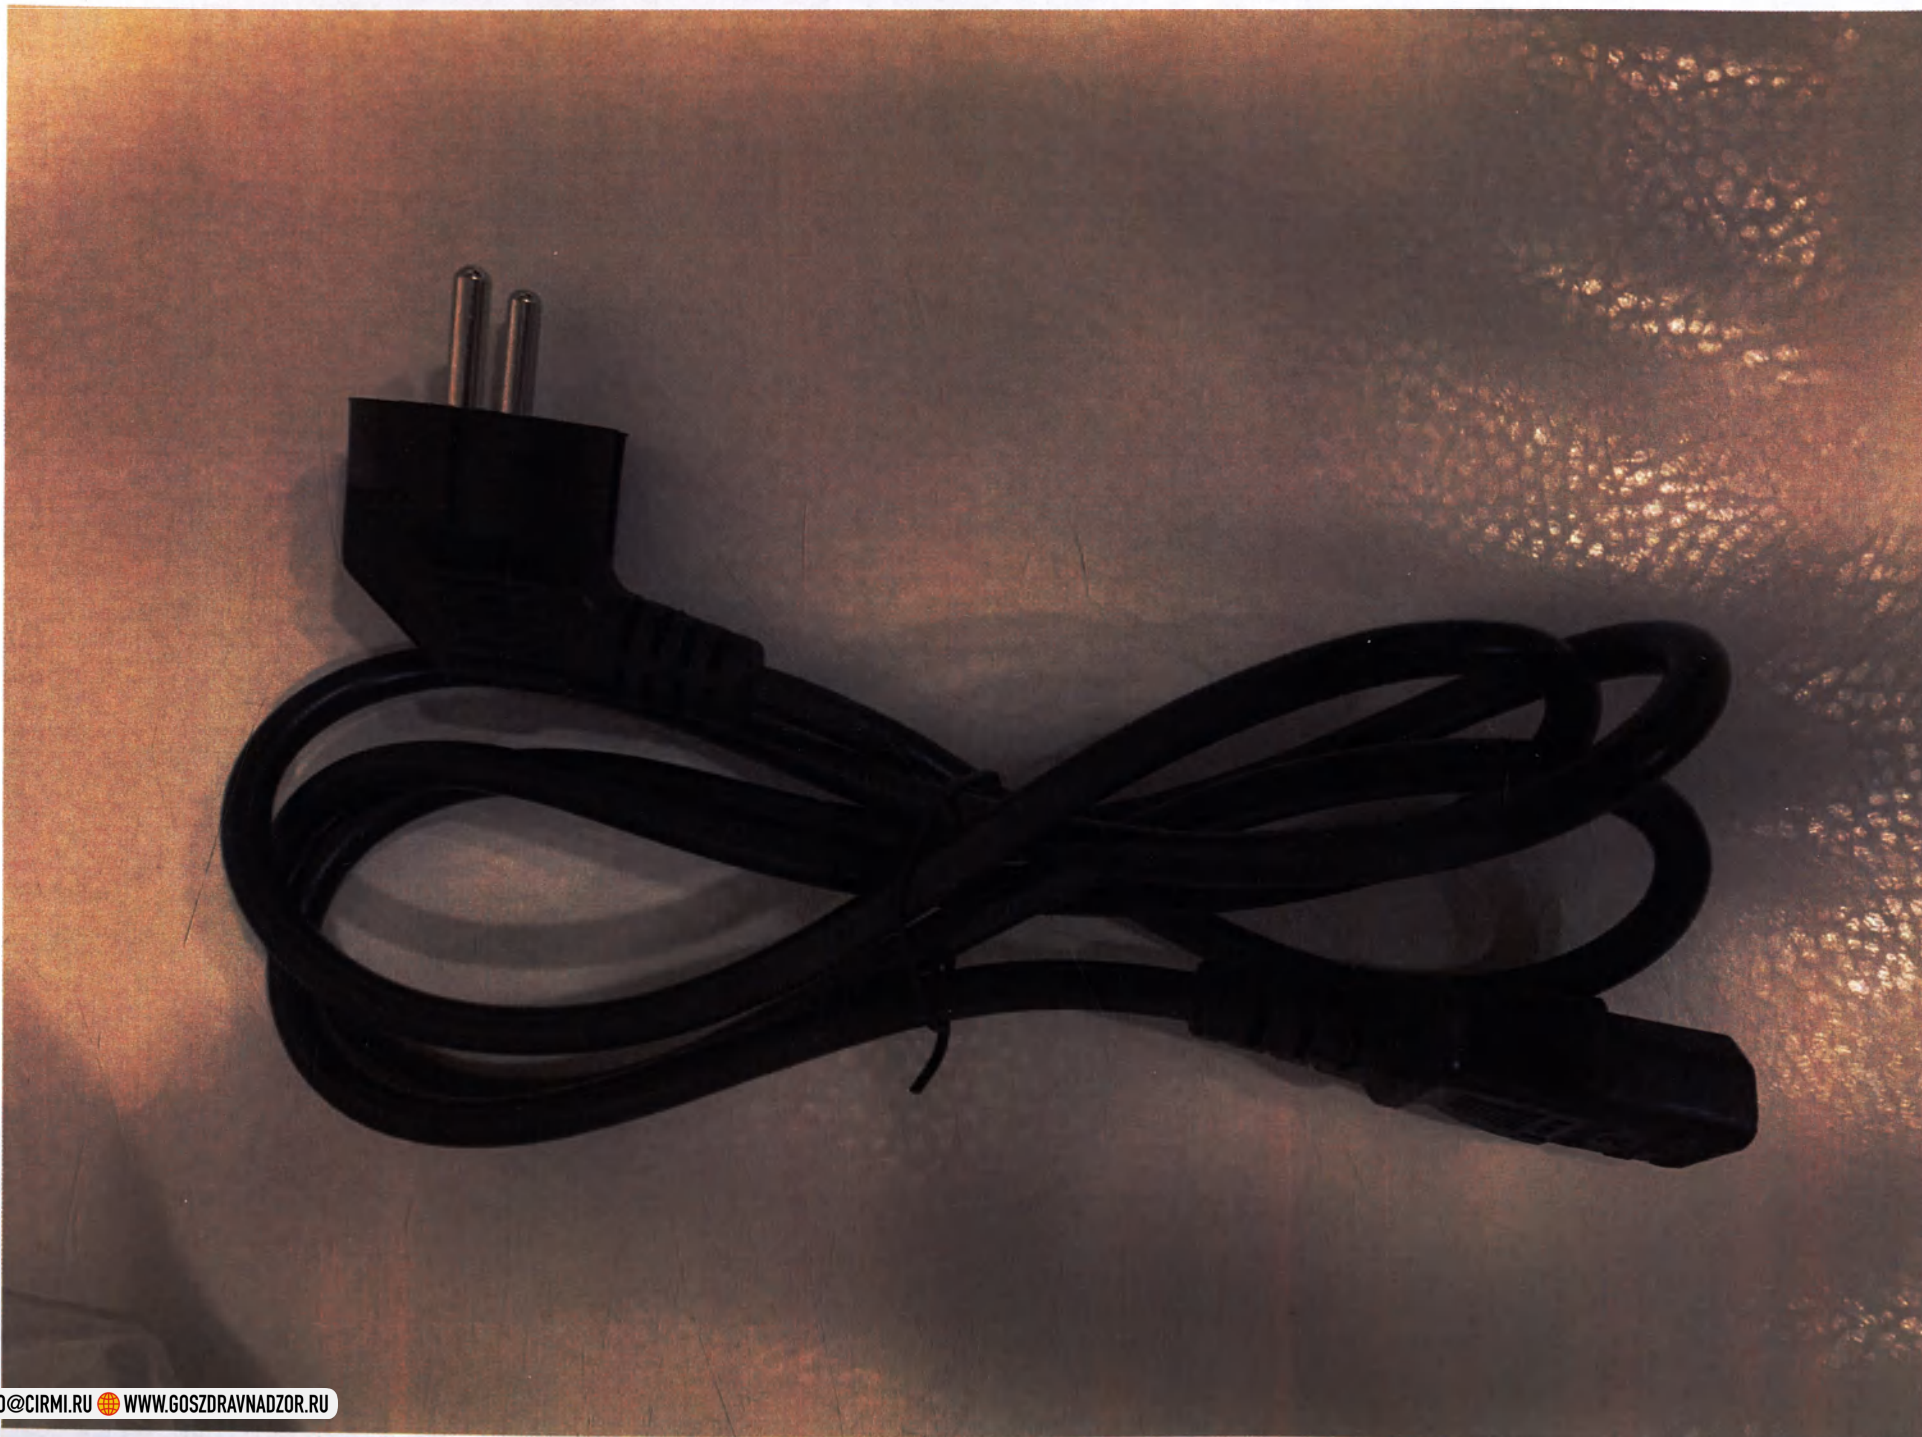

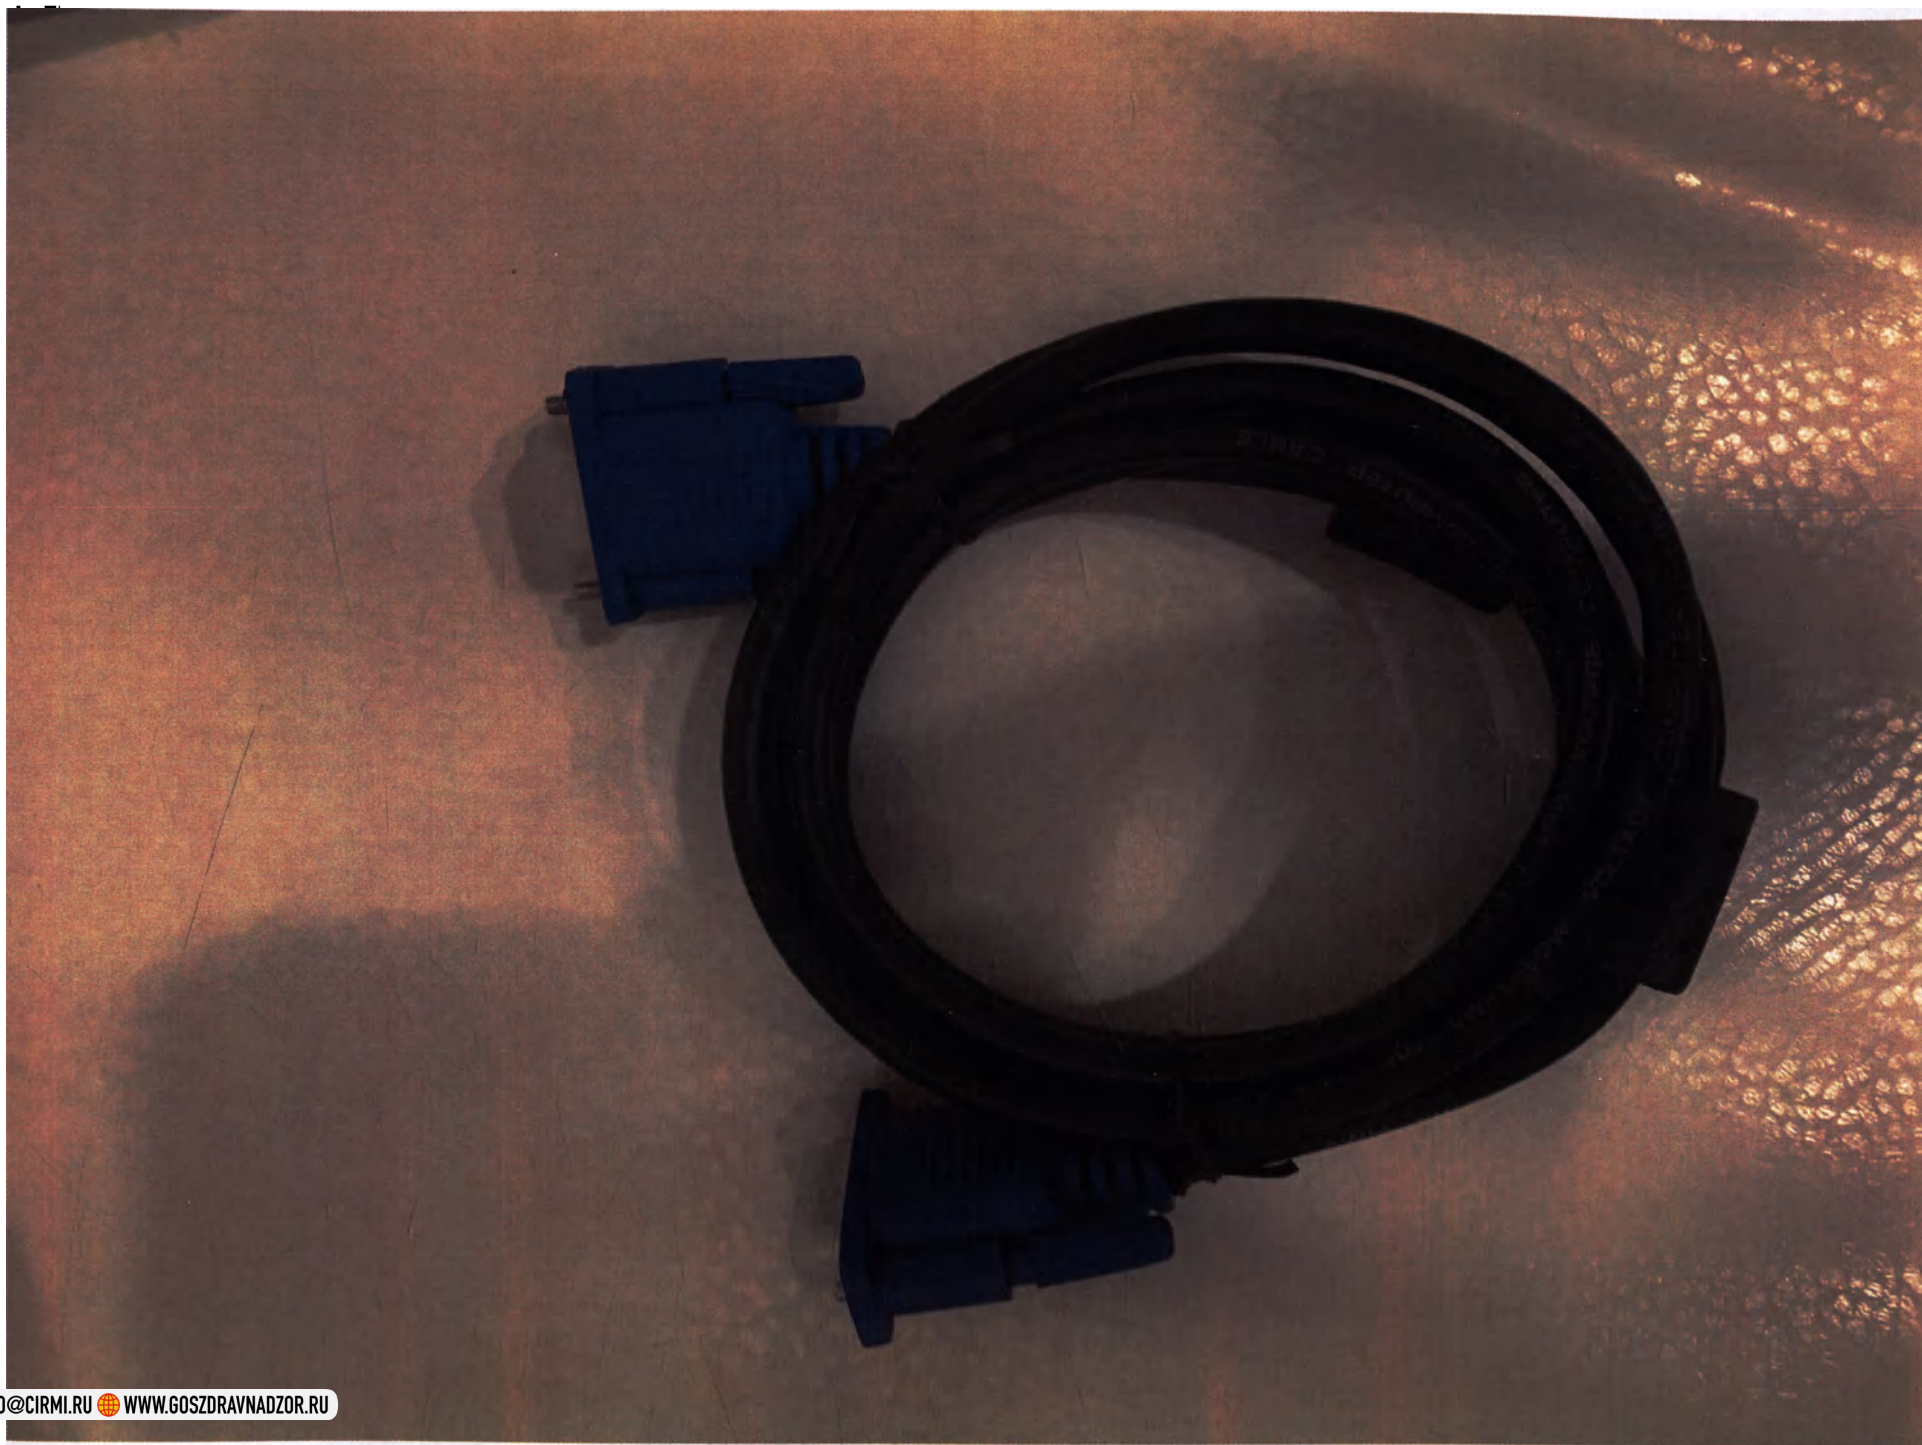


Подставка под монитор (Вид спереди)



Подставка под монитор (Вид сбоку)




II. Монитор медицинского назначения модель SC-MED2703 (Маркировка)

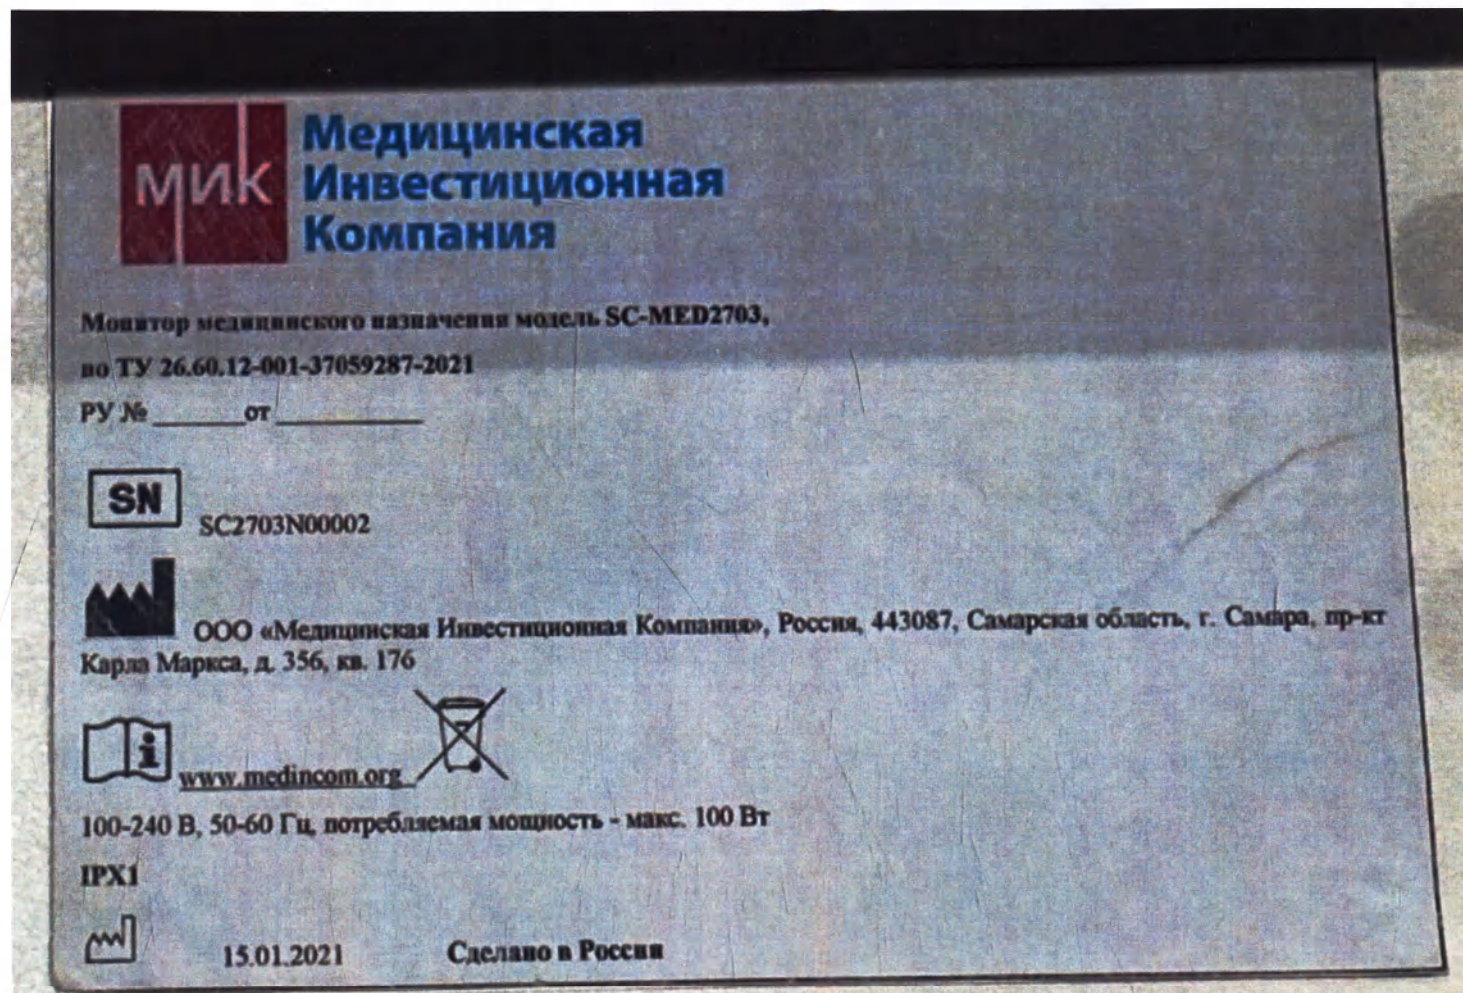


II. Монитор медицинского назначения модель SC-MED2703 (Вид спереди)




Монитор медицинского назначения модель SC-MED2703 (Вид сбоку)

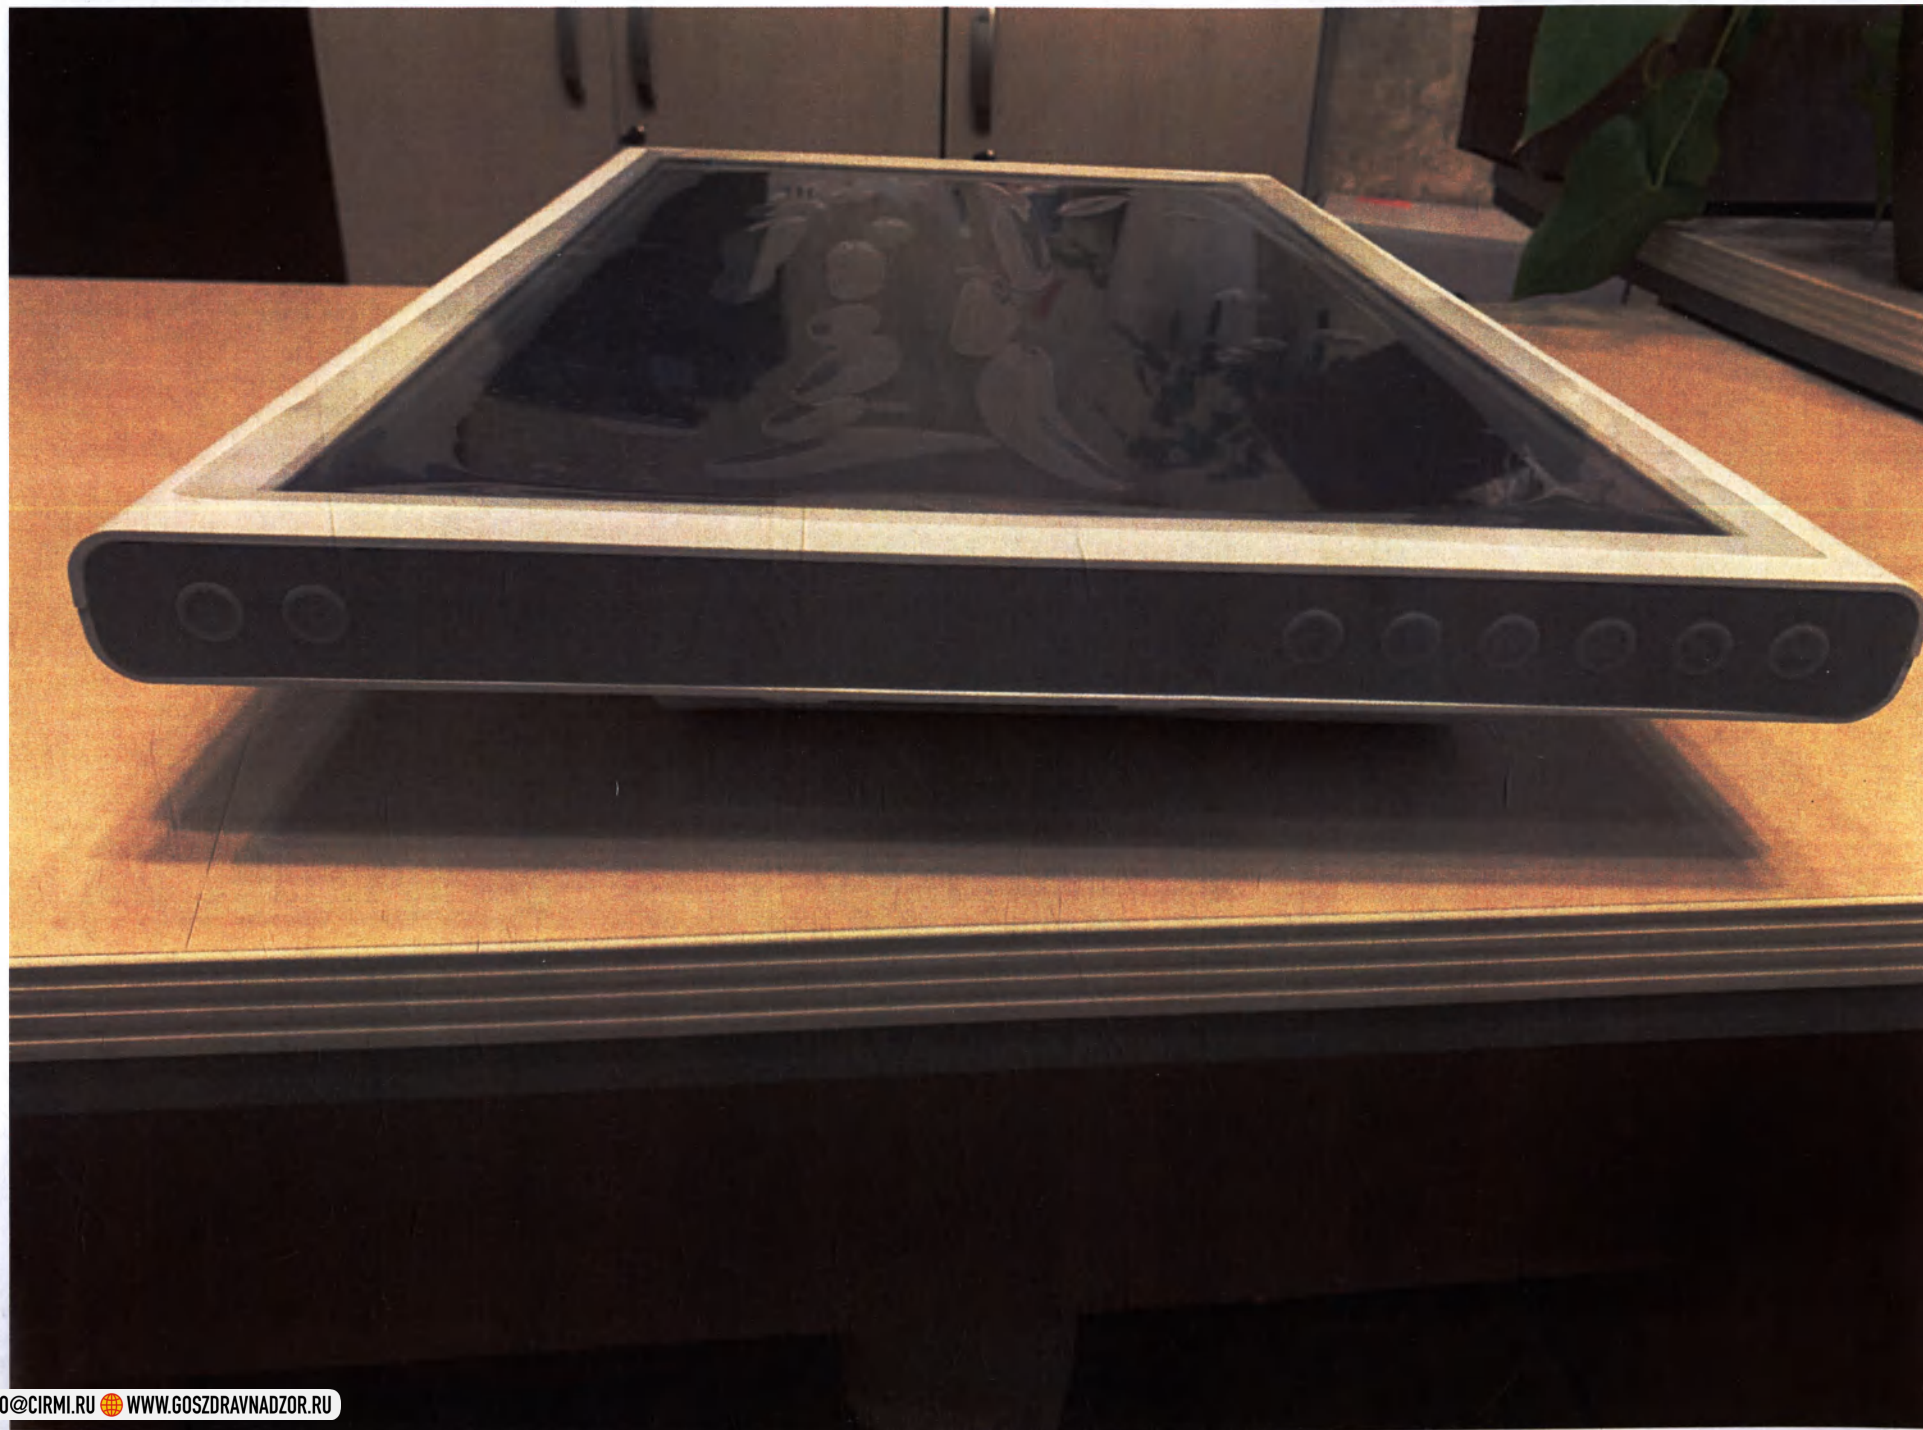

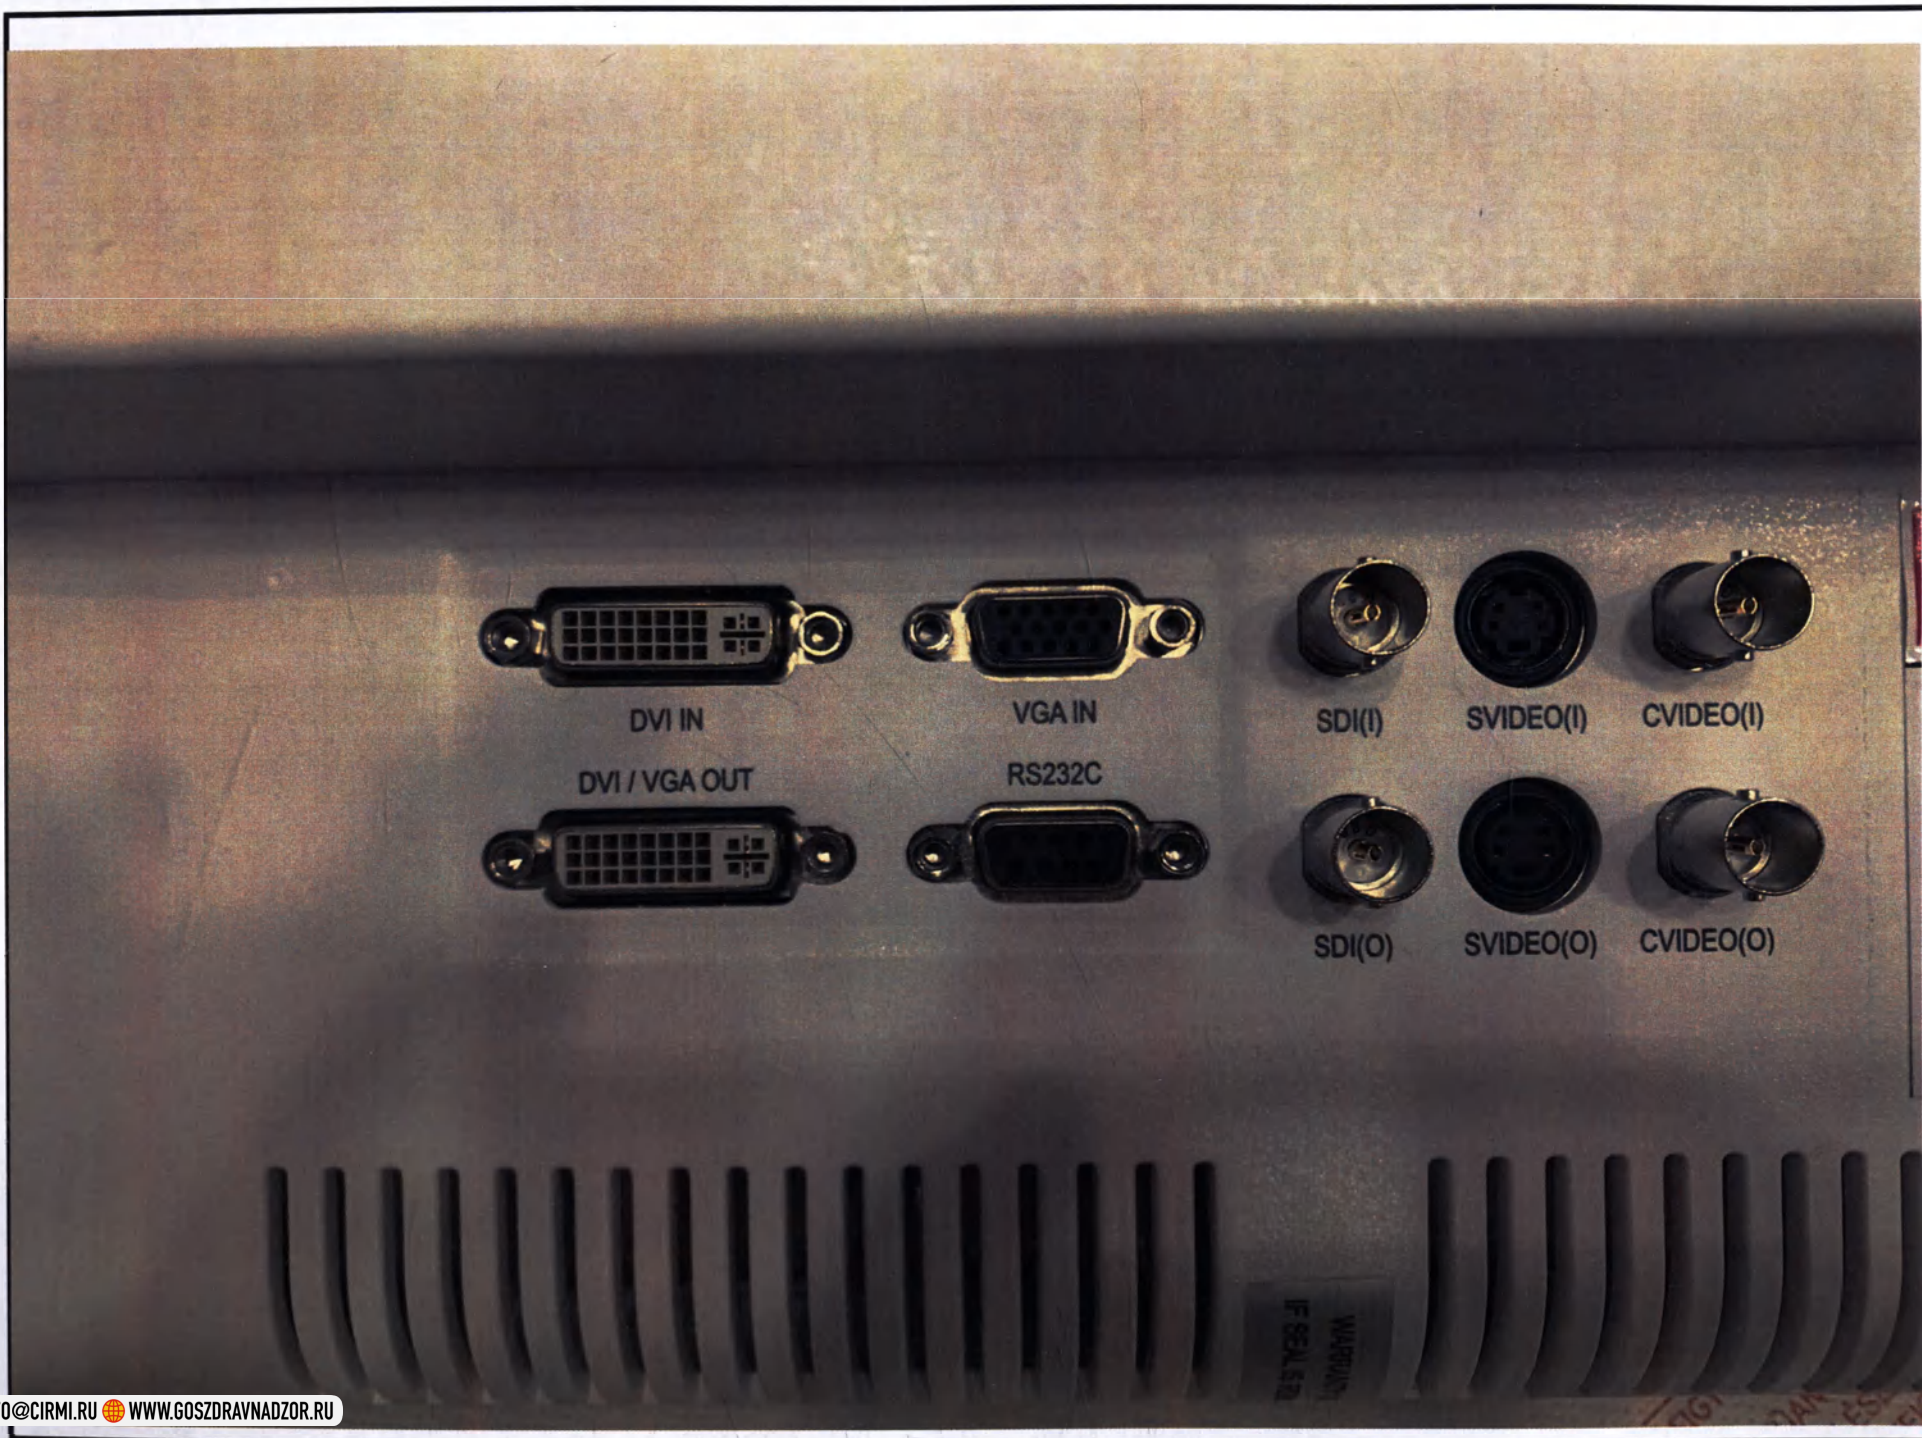


Монитор медицинского назначения модель SC-MED2703 (Вид сзади)



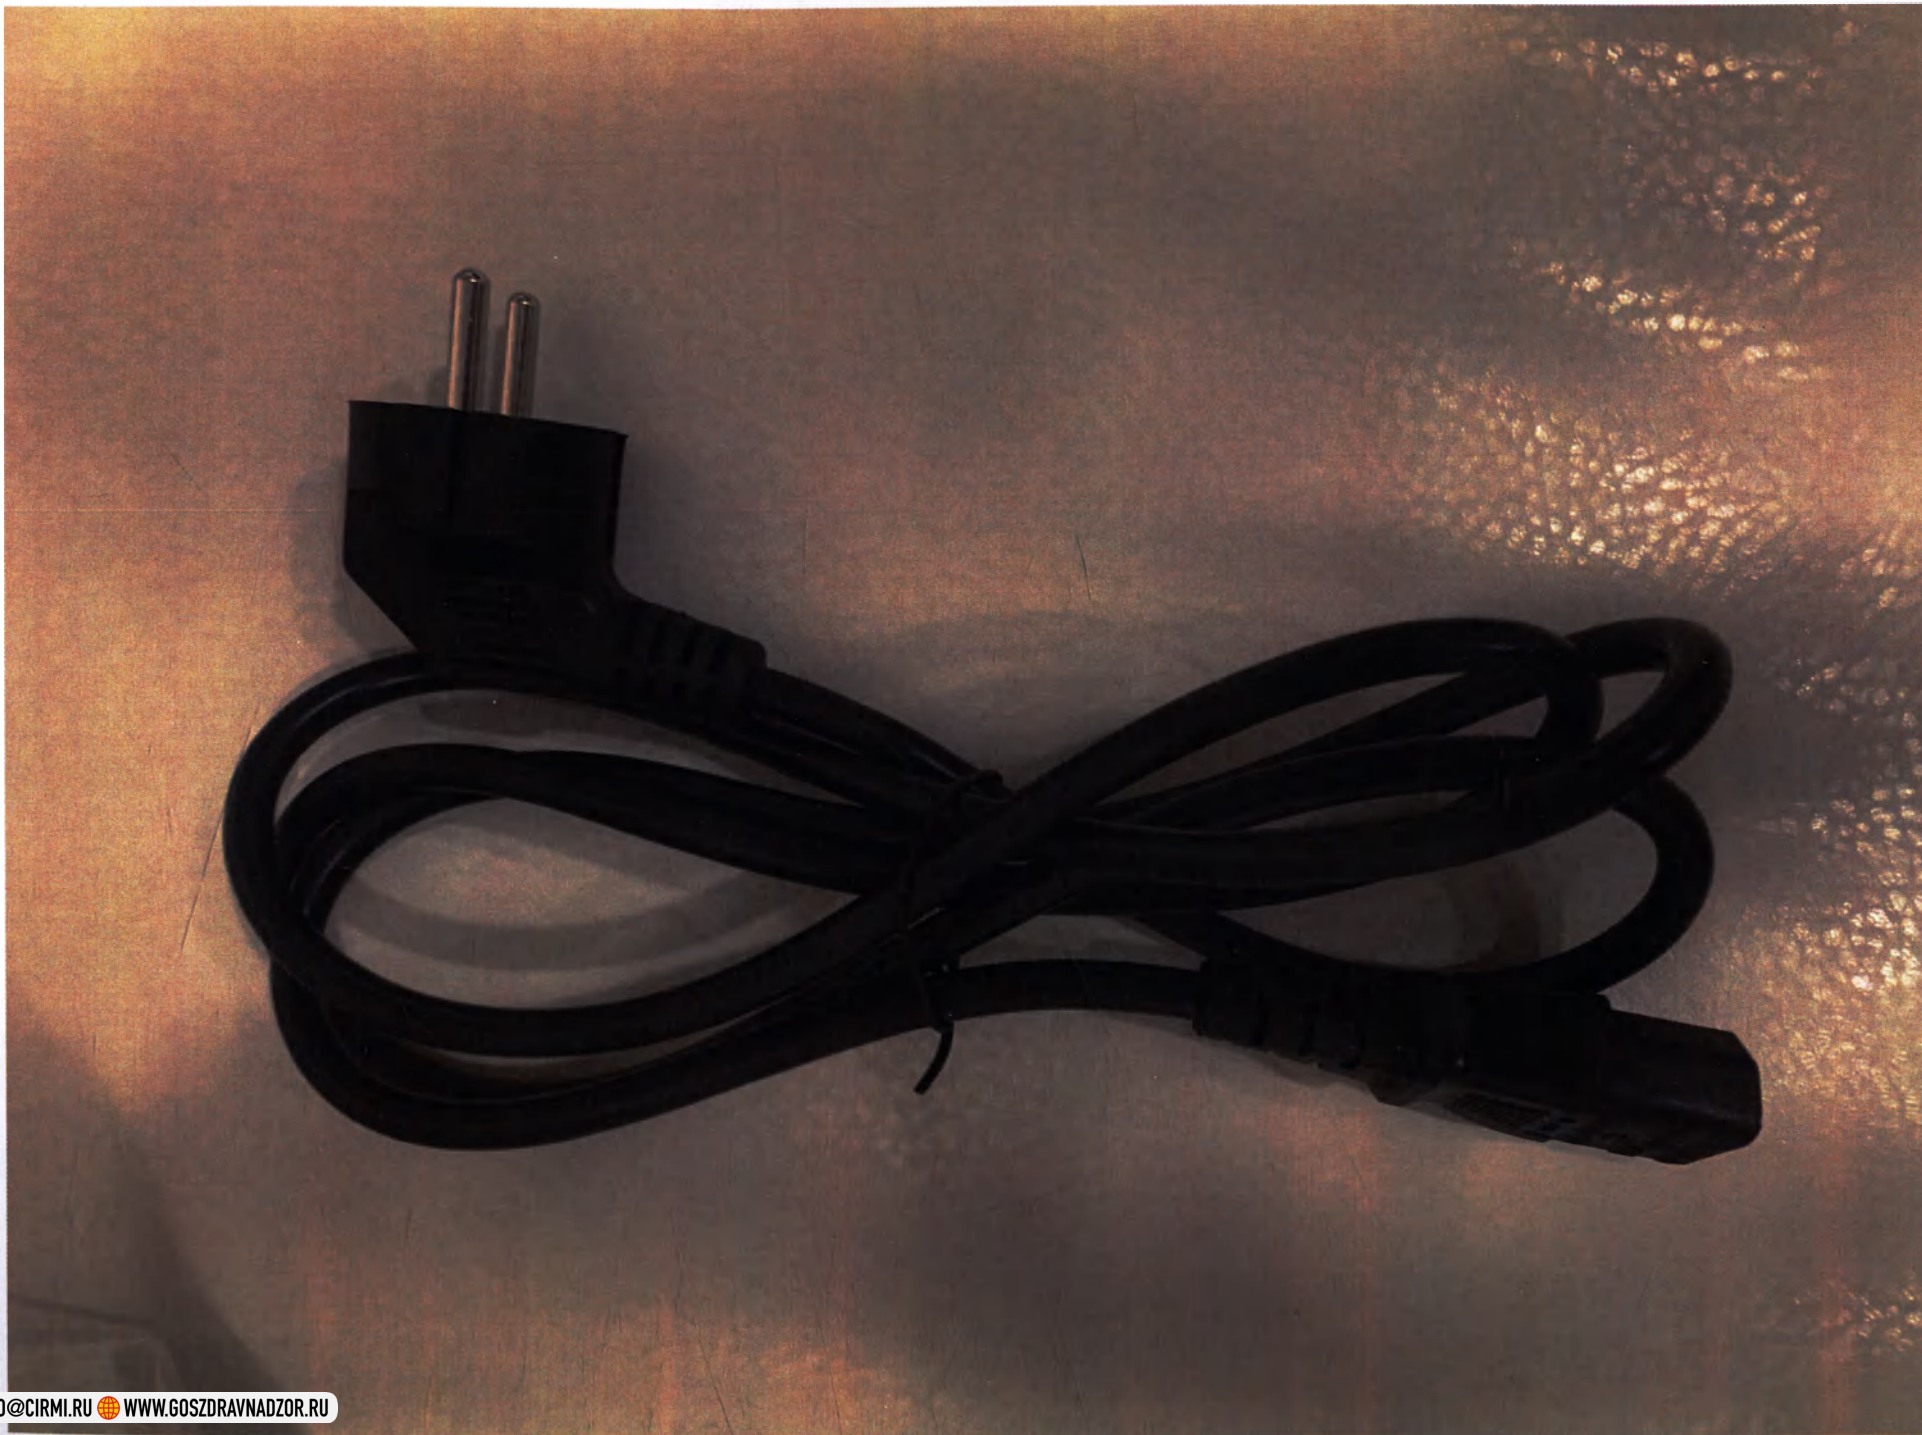

Кабель DVI

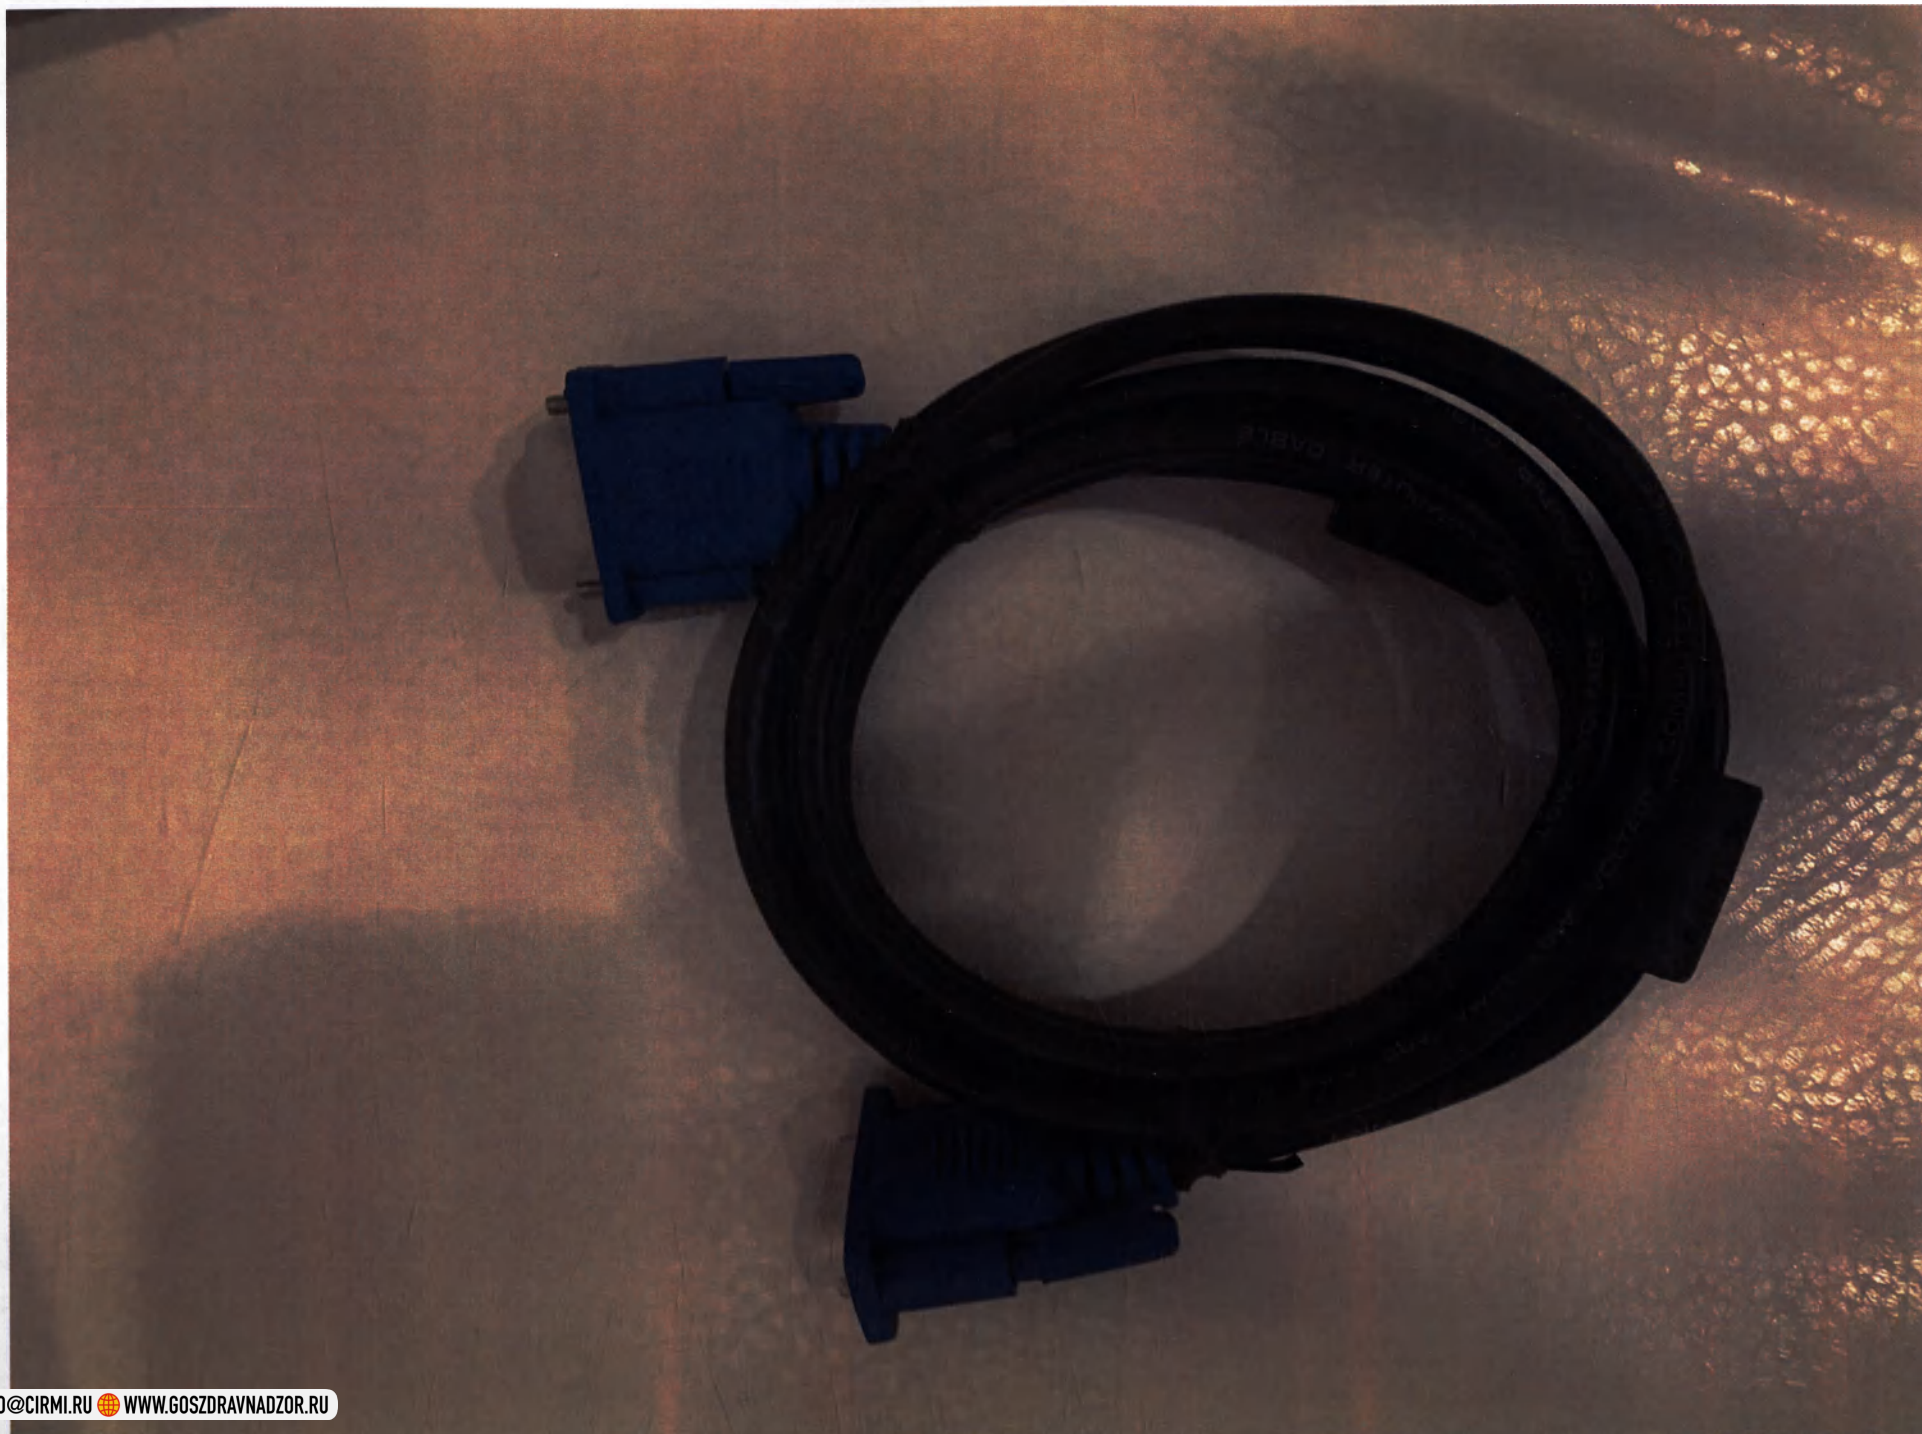


Подставка под монитор (Вид спереди)




Подставка под монитор (Вид сбоку)




III. Монитор медицинского назначения модель SC-MED2704 (Маркировка)

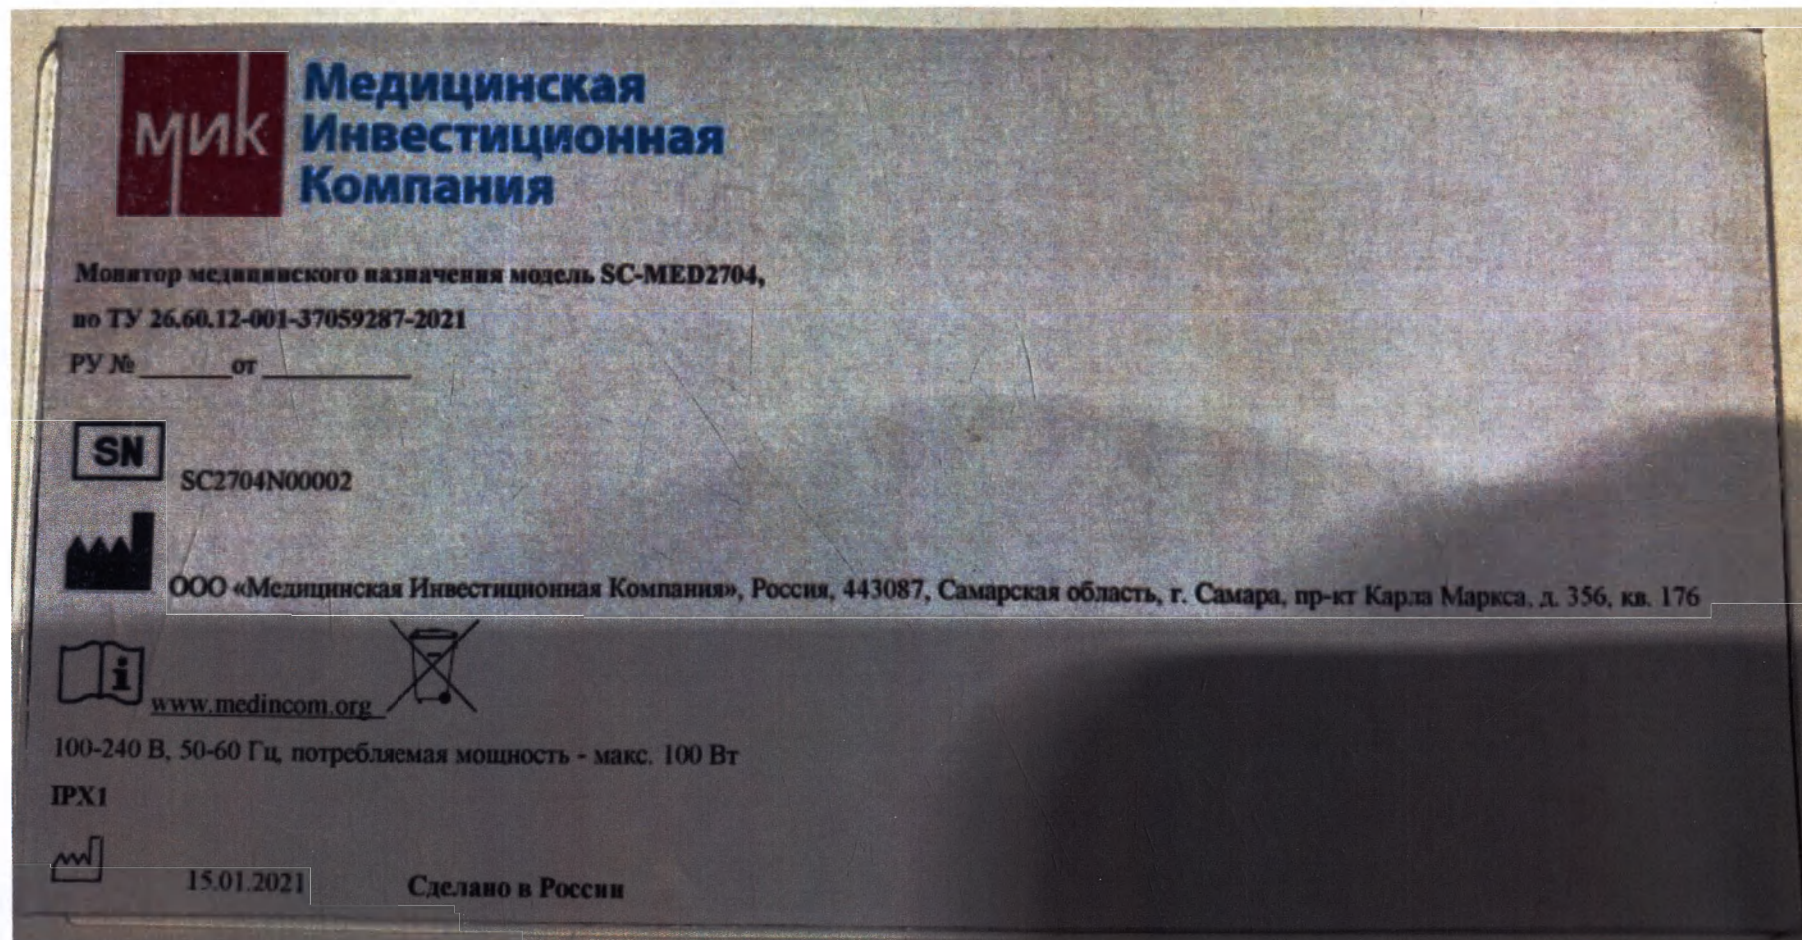



Монитор медицинского назначения модель SC-MED2704 (Вид спереди)

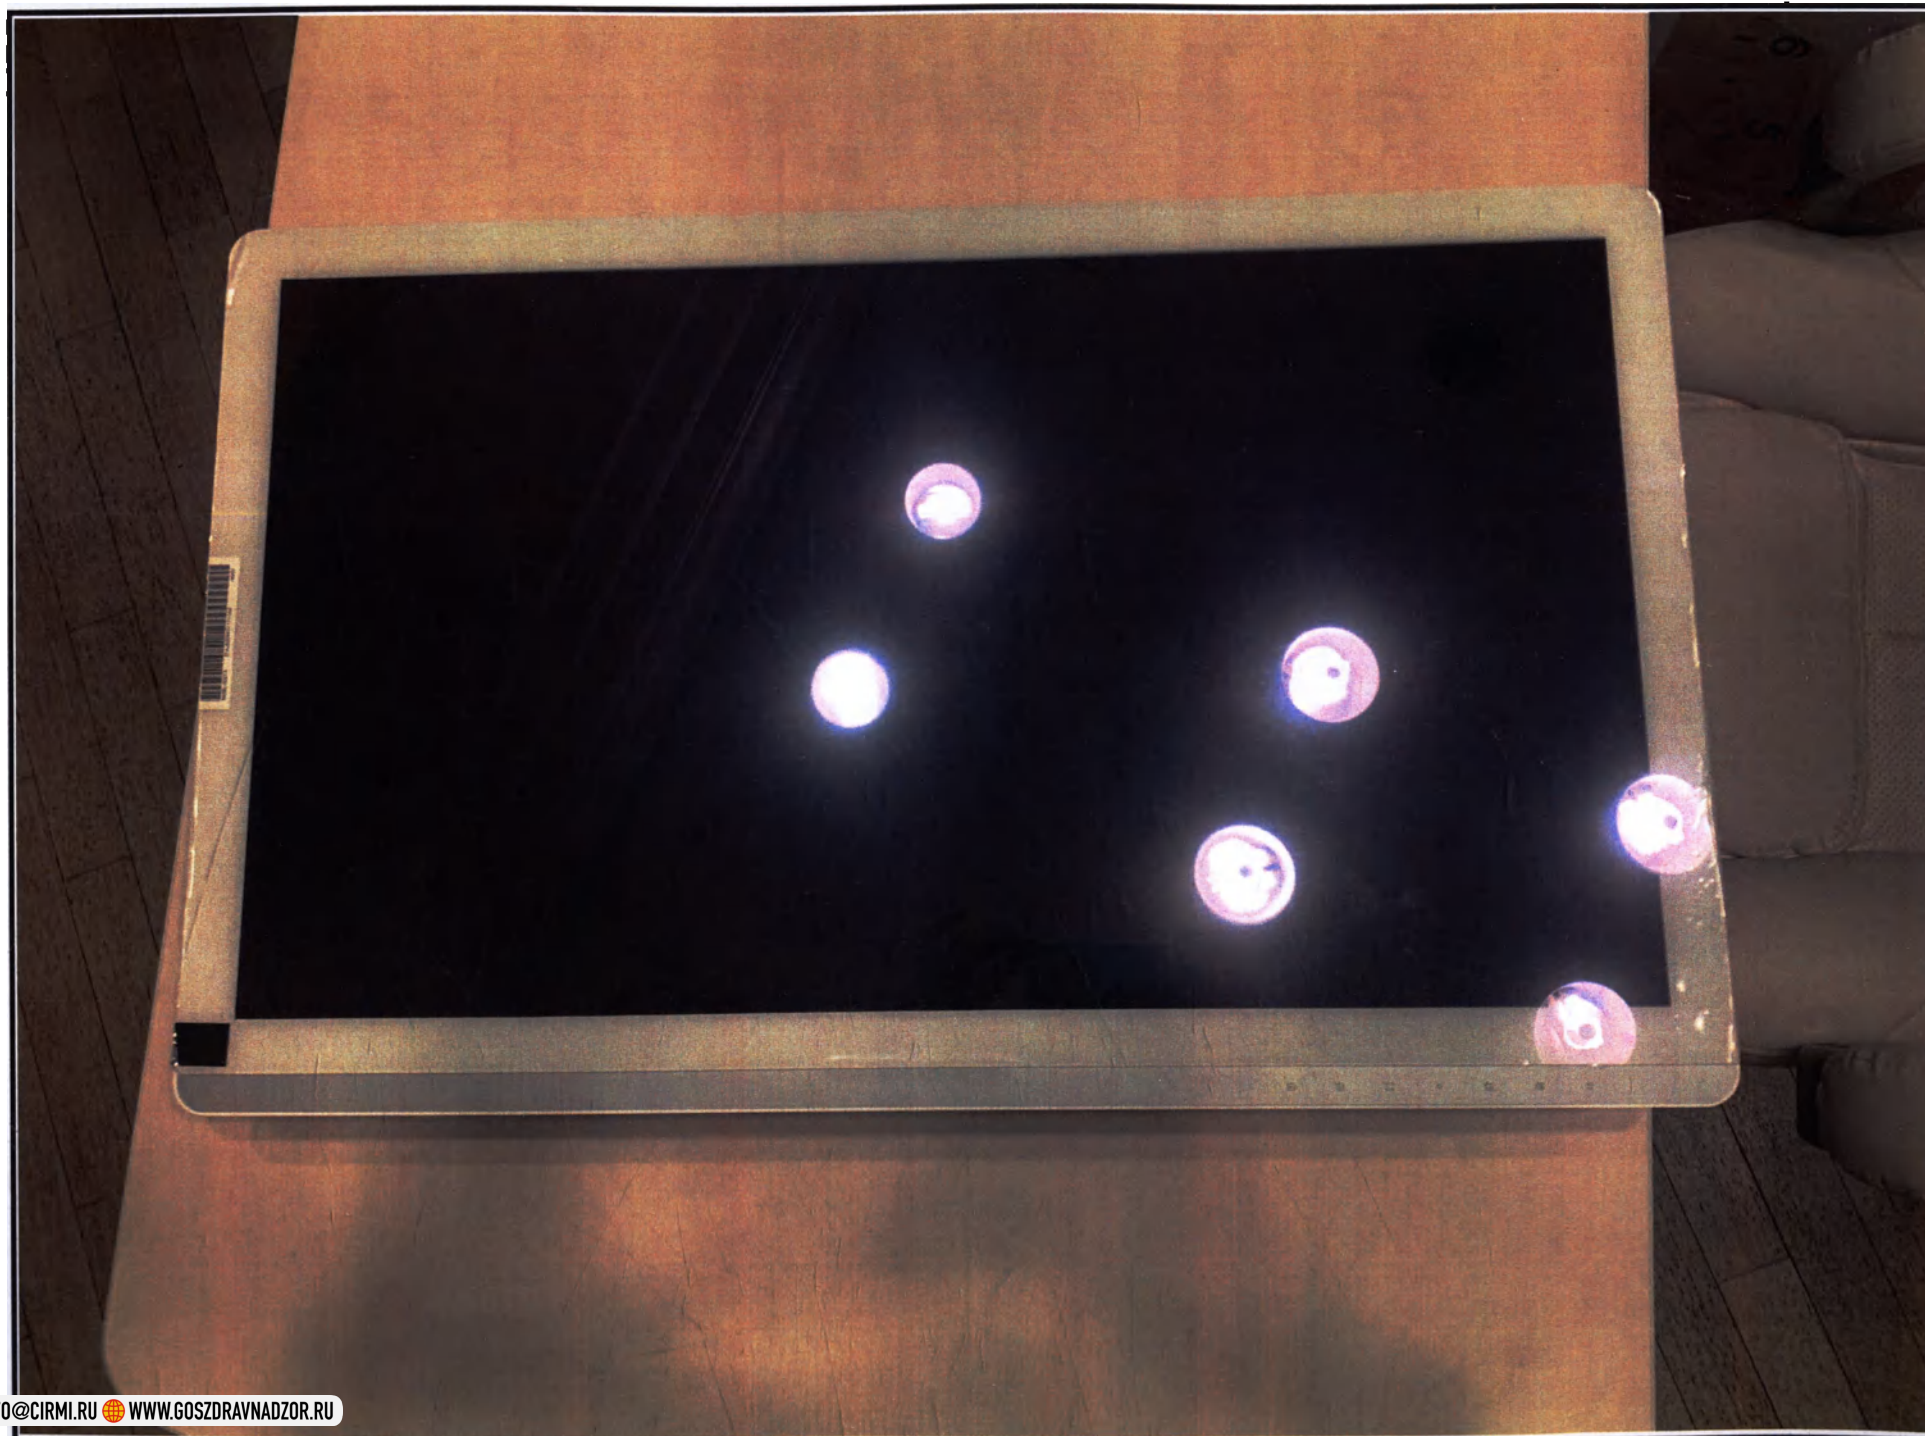


Монитор медицинского назначения модель SC-MED2704 (Вид сбоку)

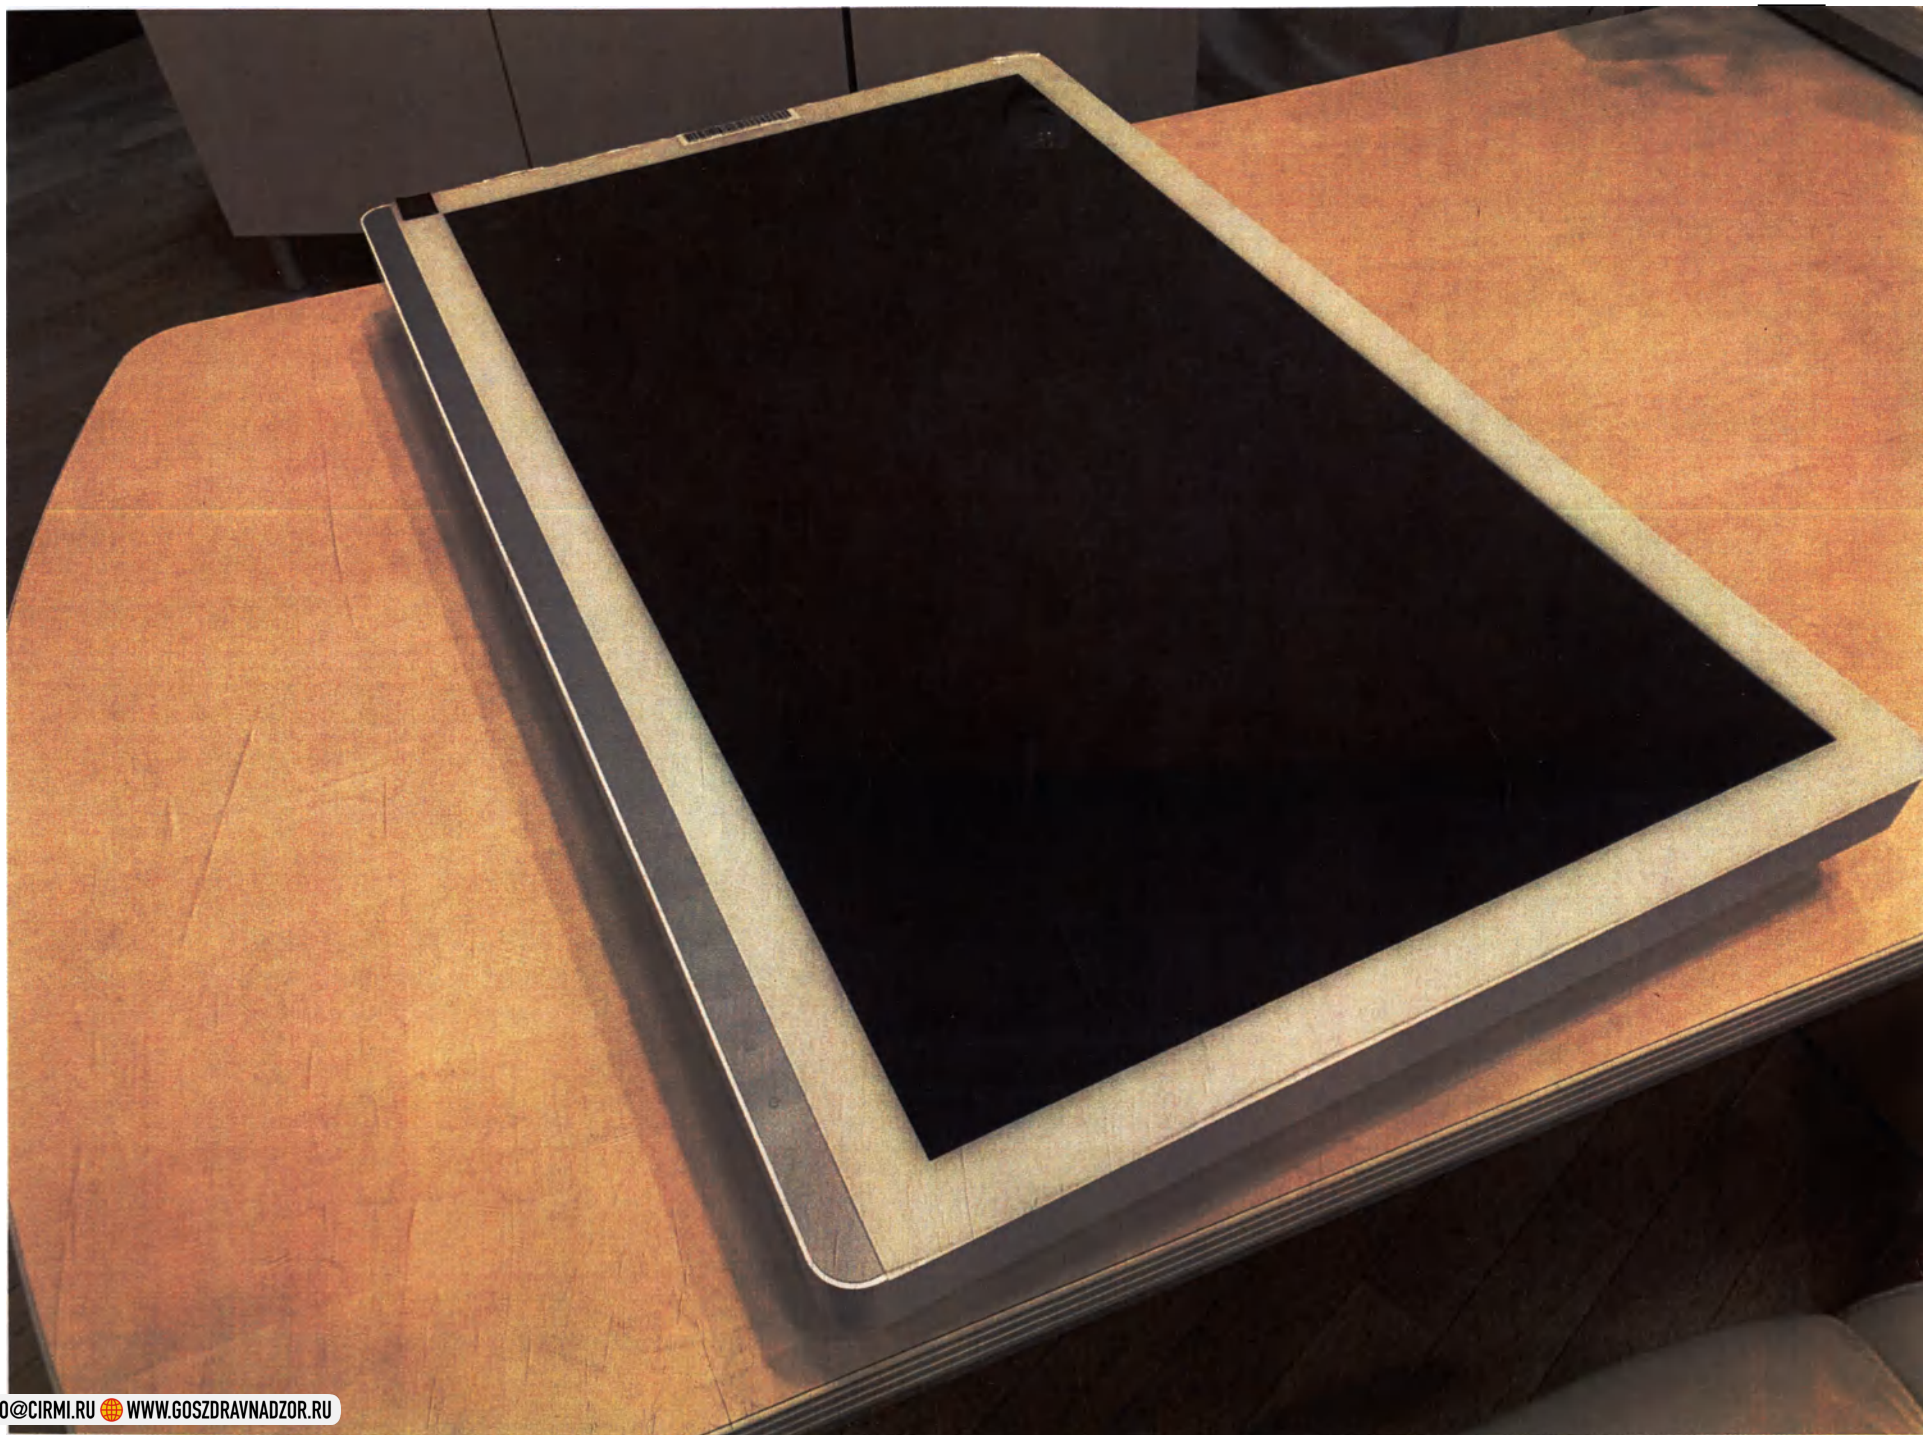

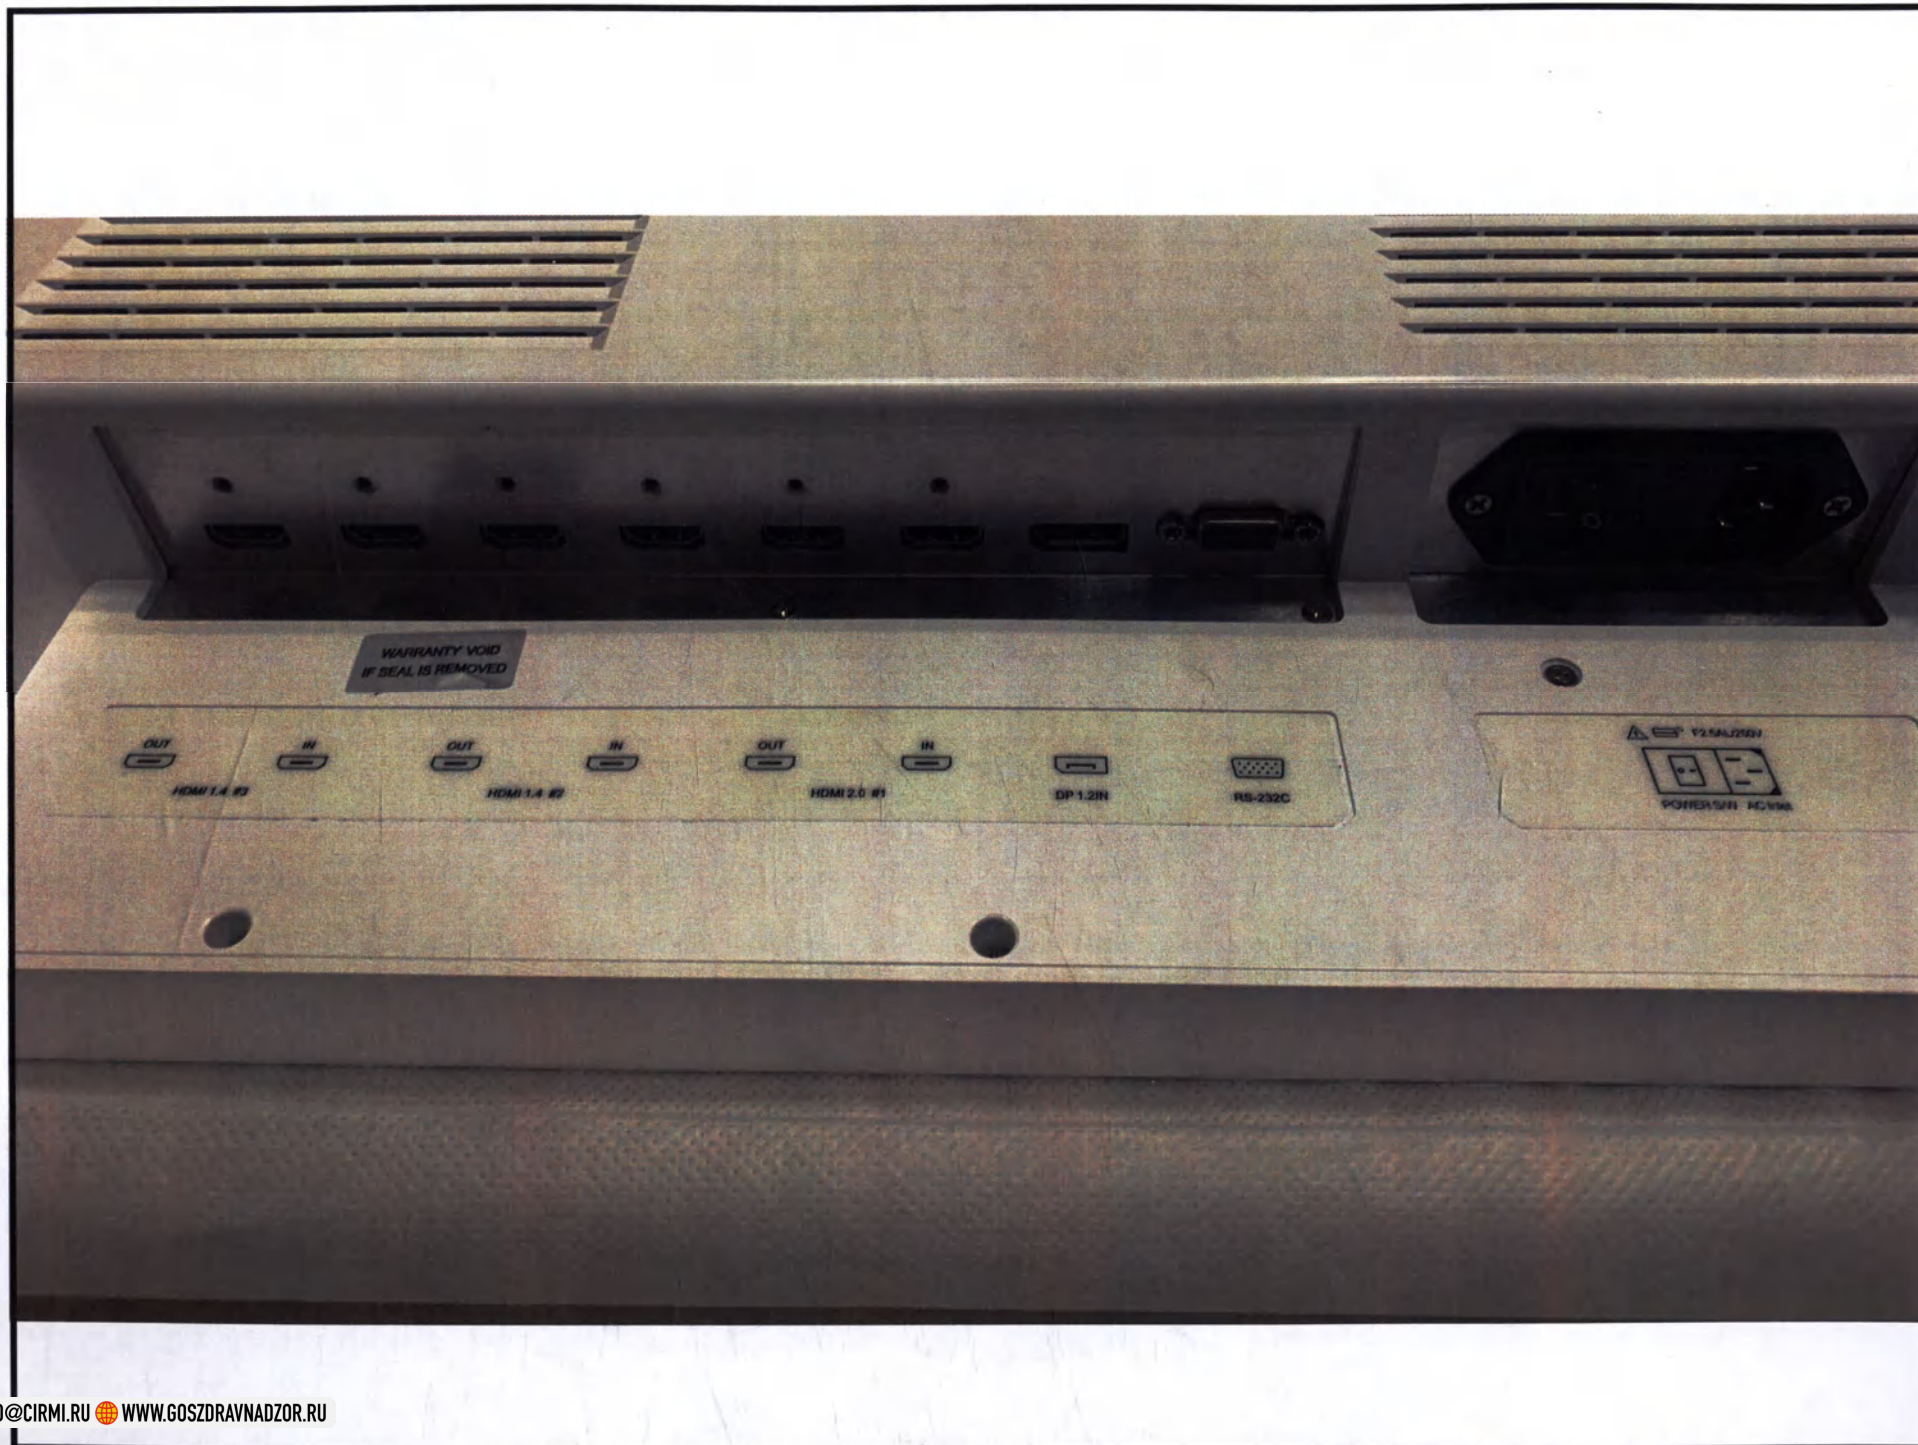

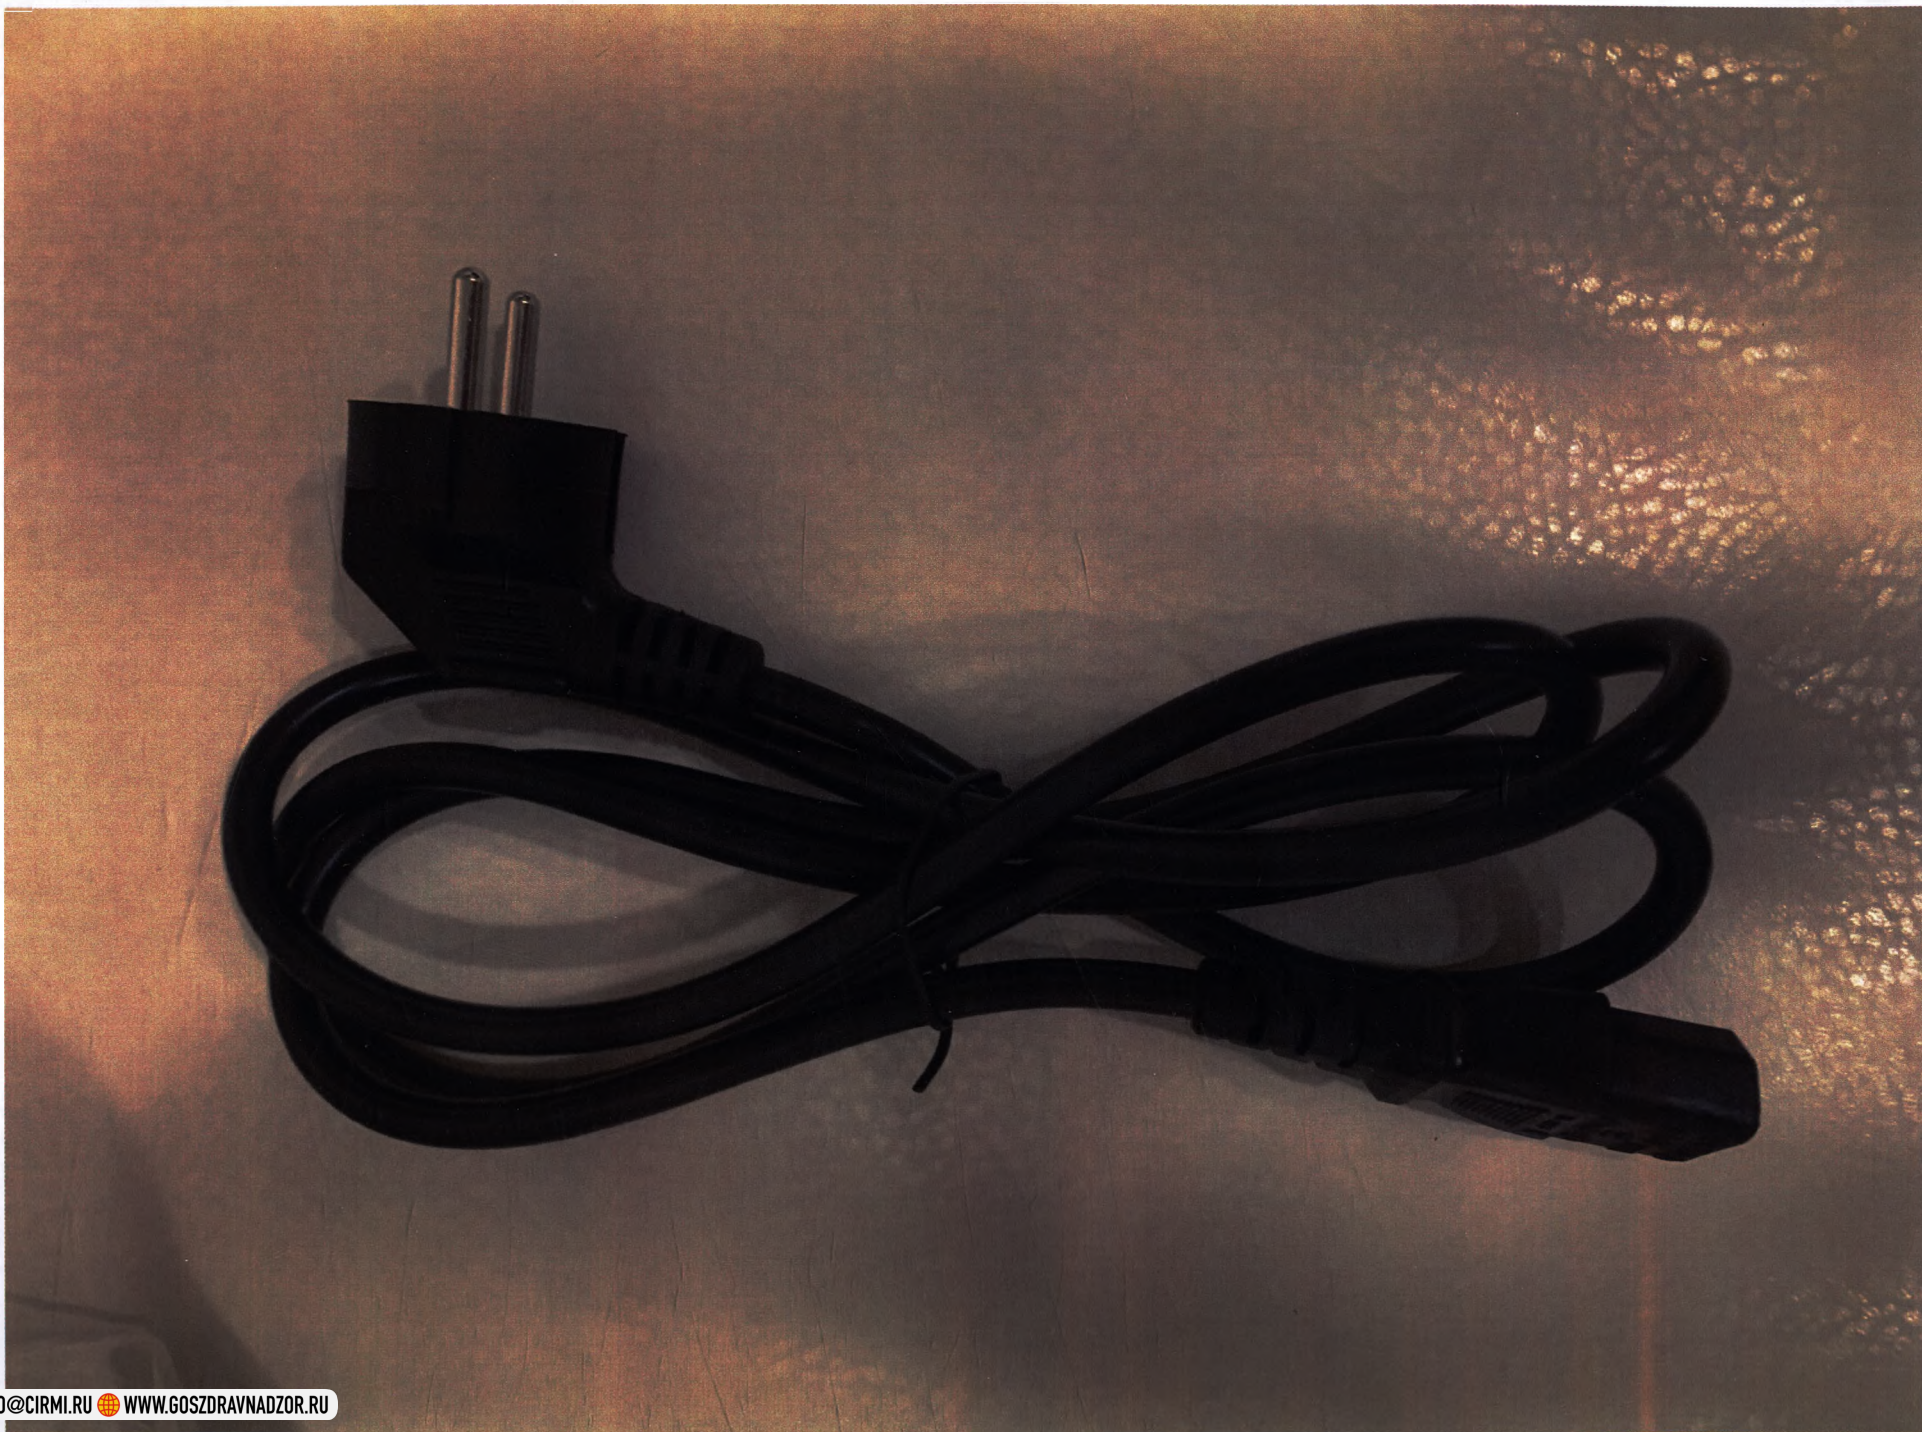

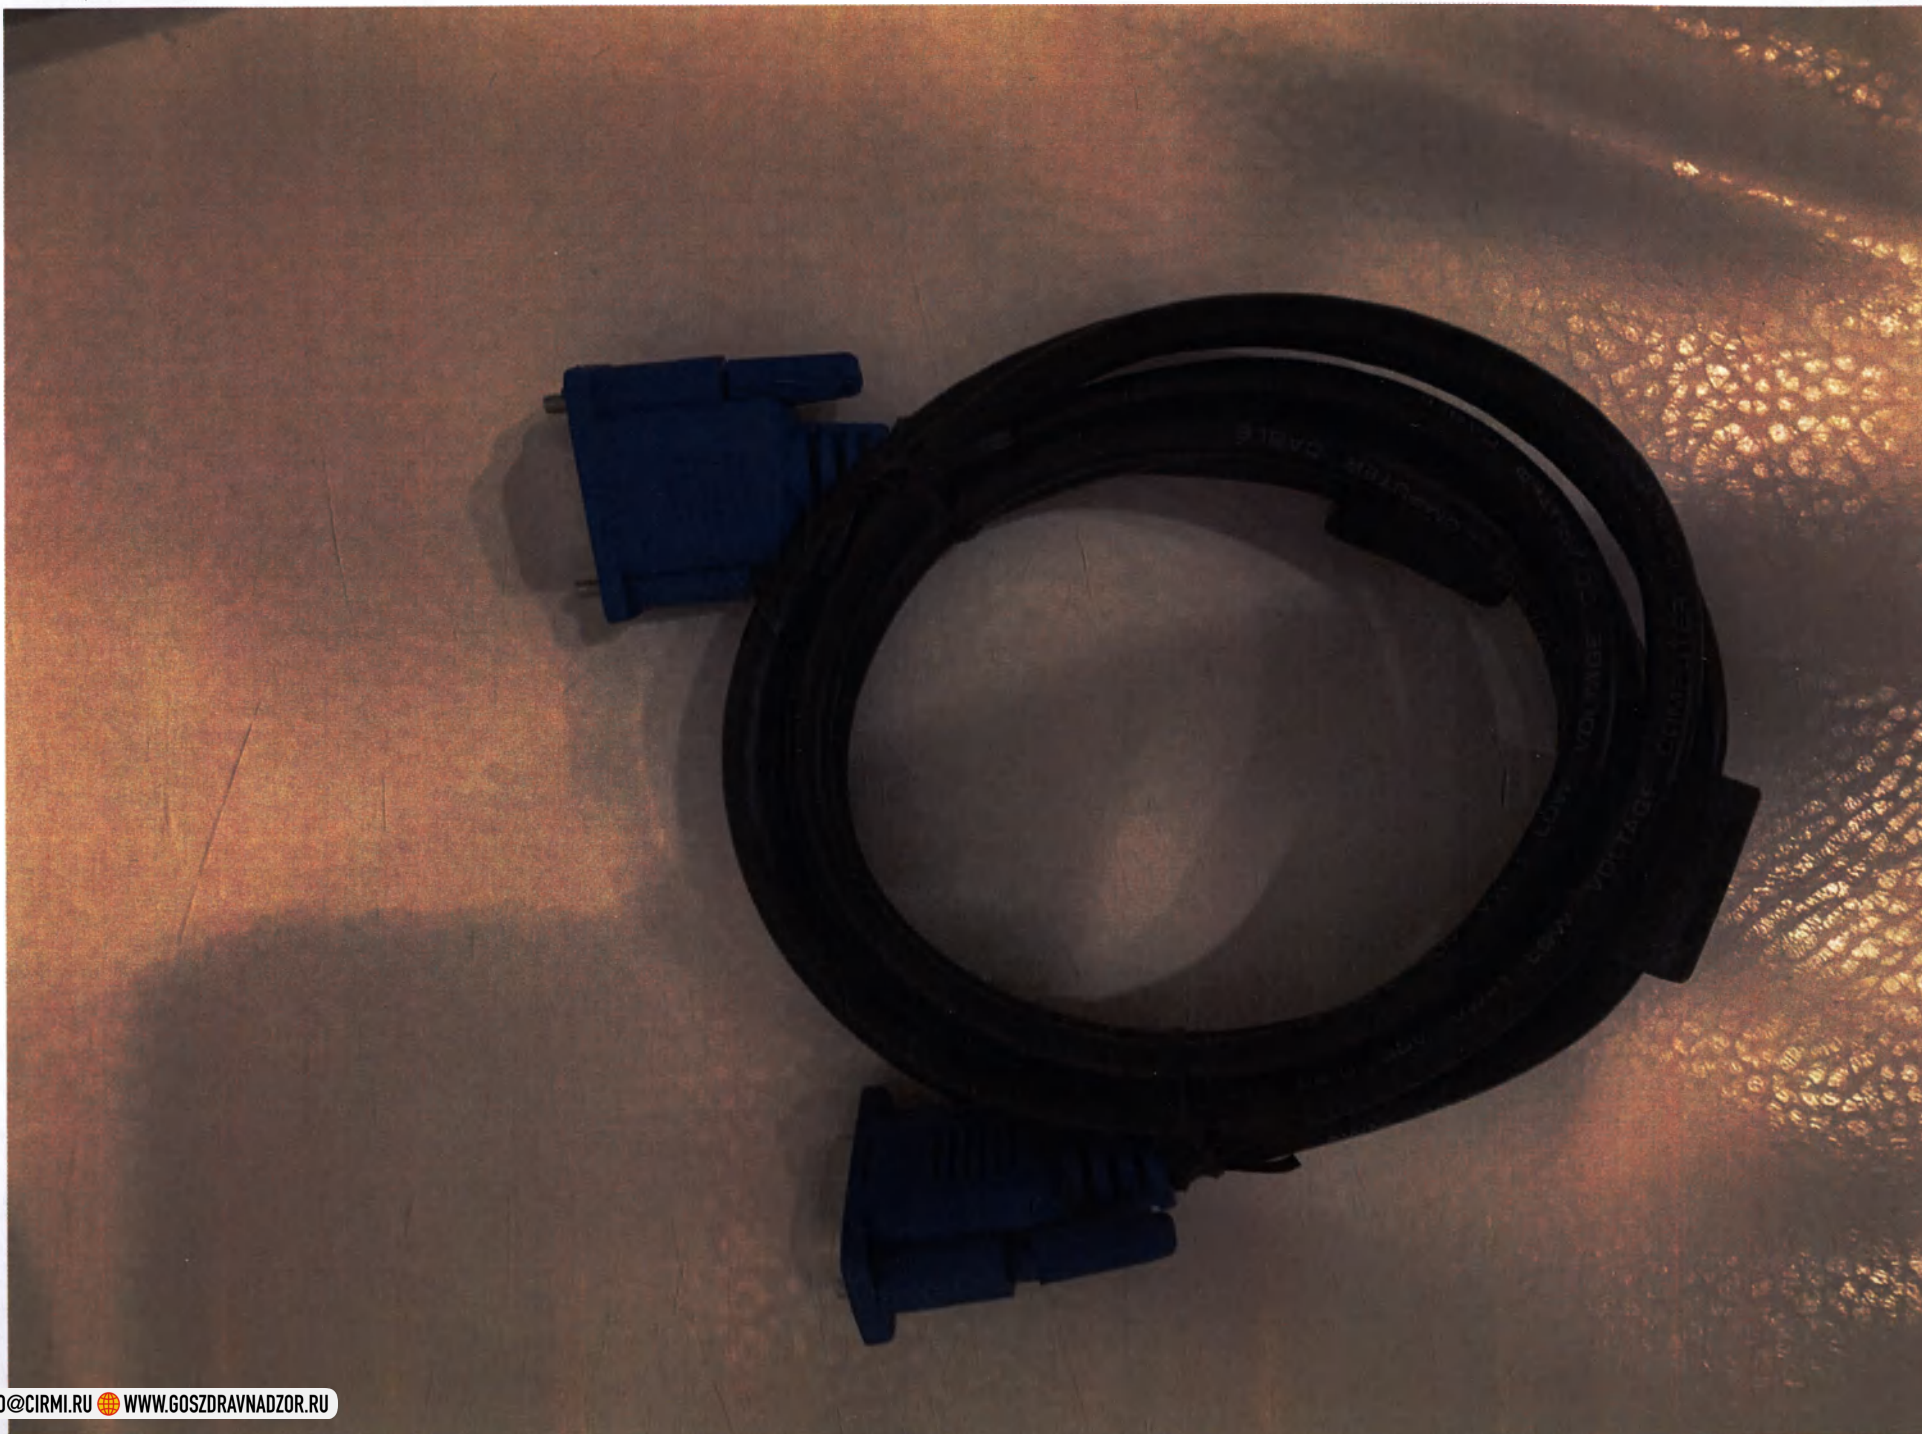


Подставка под монитор (Вид спереди)



Подставка под монитор (Вид сбоку)



IV. Монитор медицинского назначения модель SC-MED2705 (Маркировка)

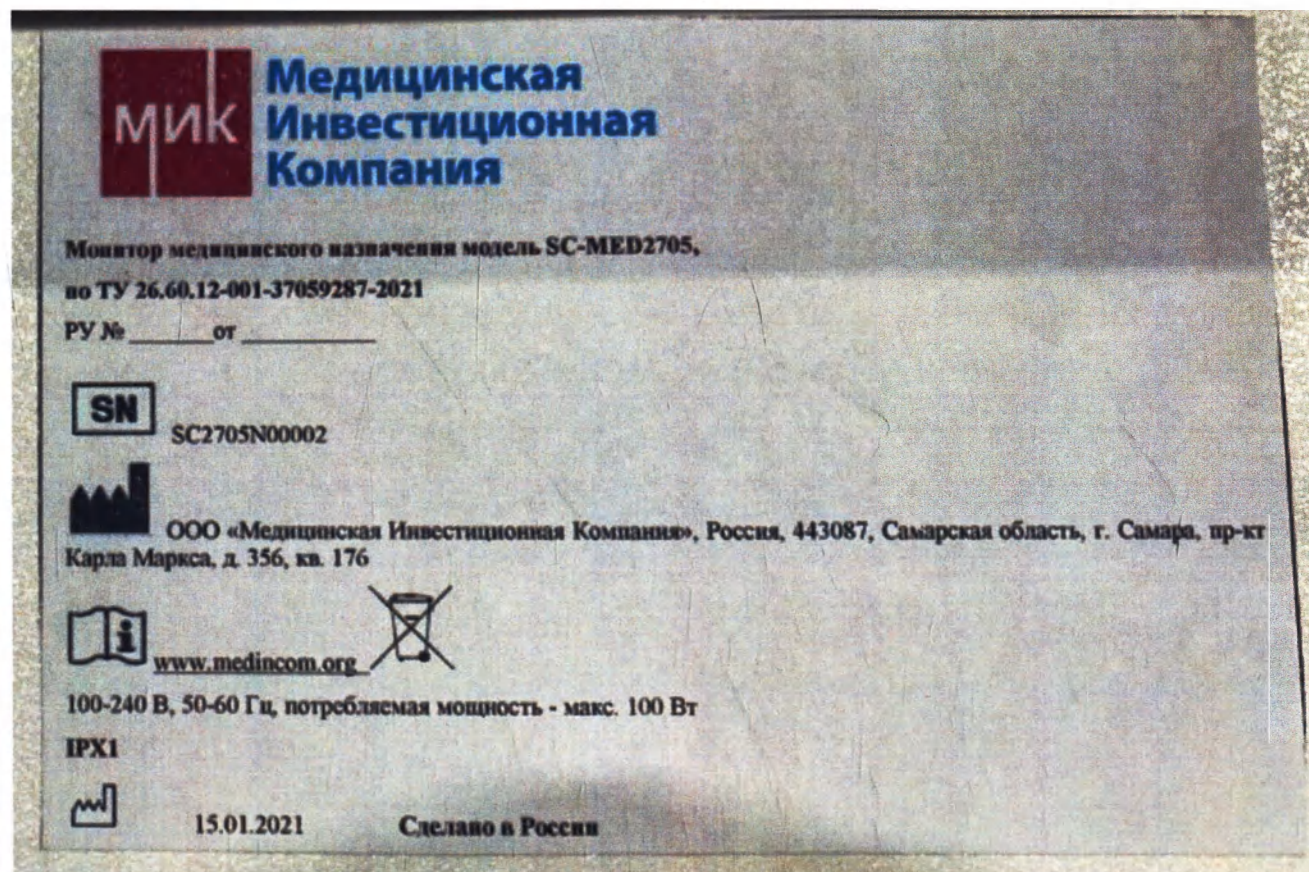


Монитор медицинского назначения модель SC-MED2705 (Вид спереди)



Монитор медицинского назначения модель SC-MED2705 (Вид сбоку)



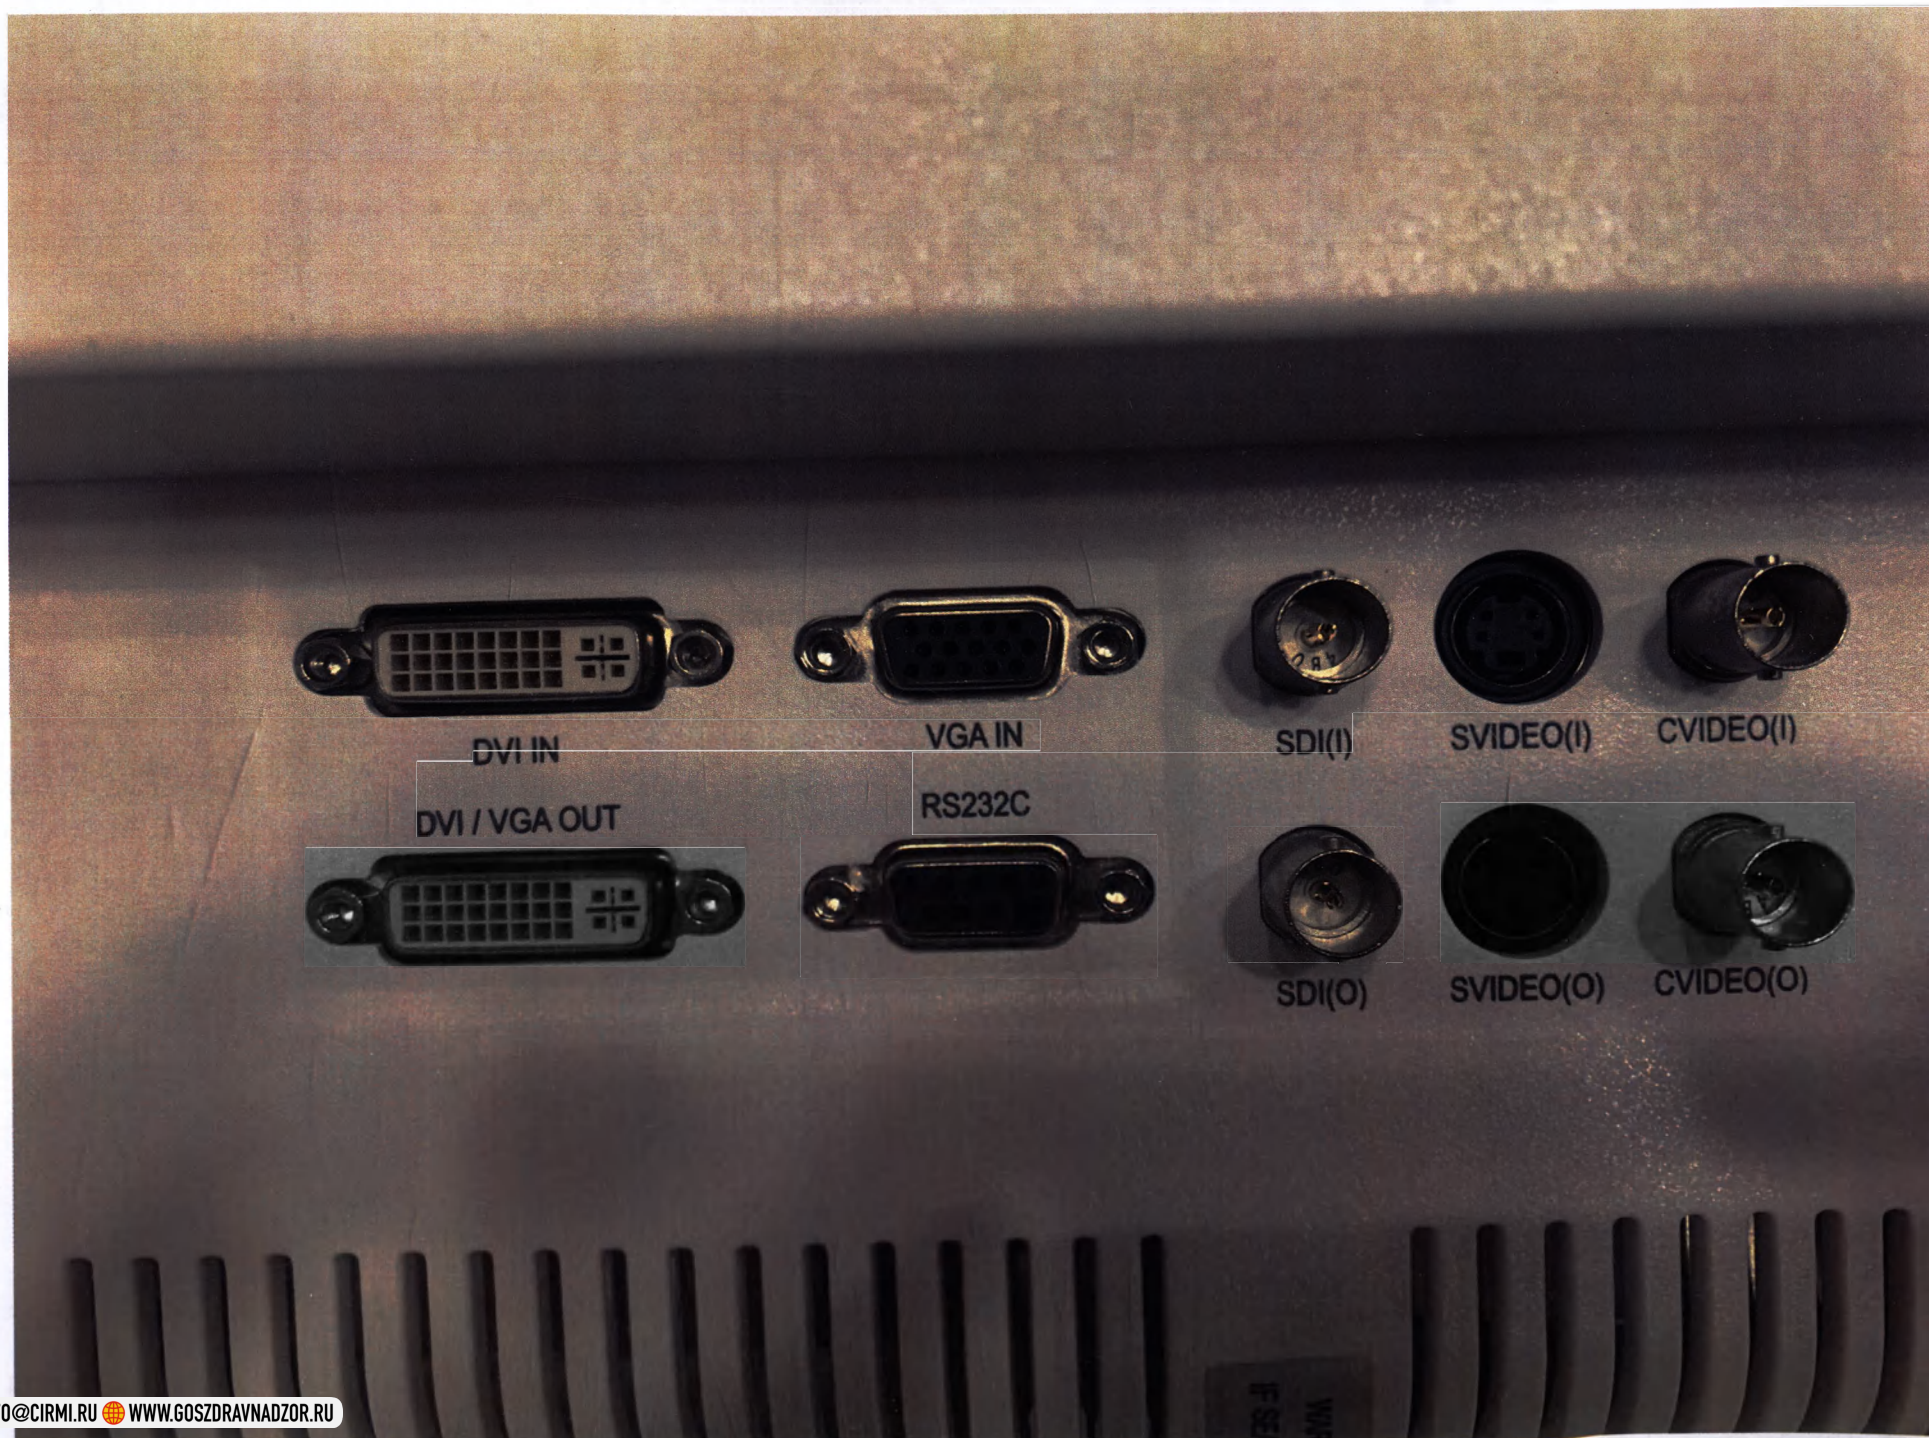





Монитор медицинского назначения модель SC-MED2705 (Вид сзади)



Кабель питания

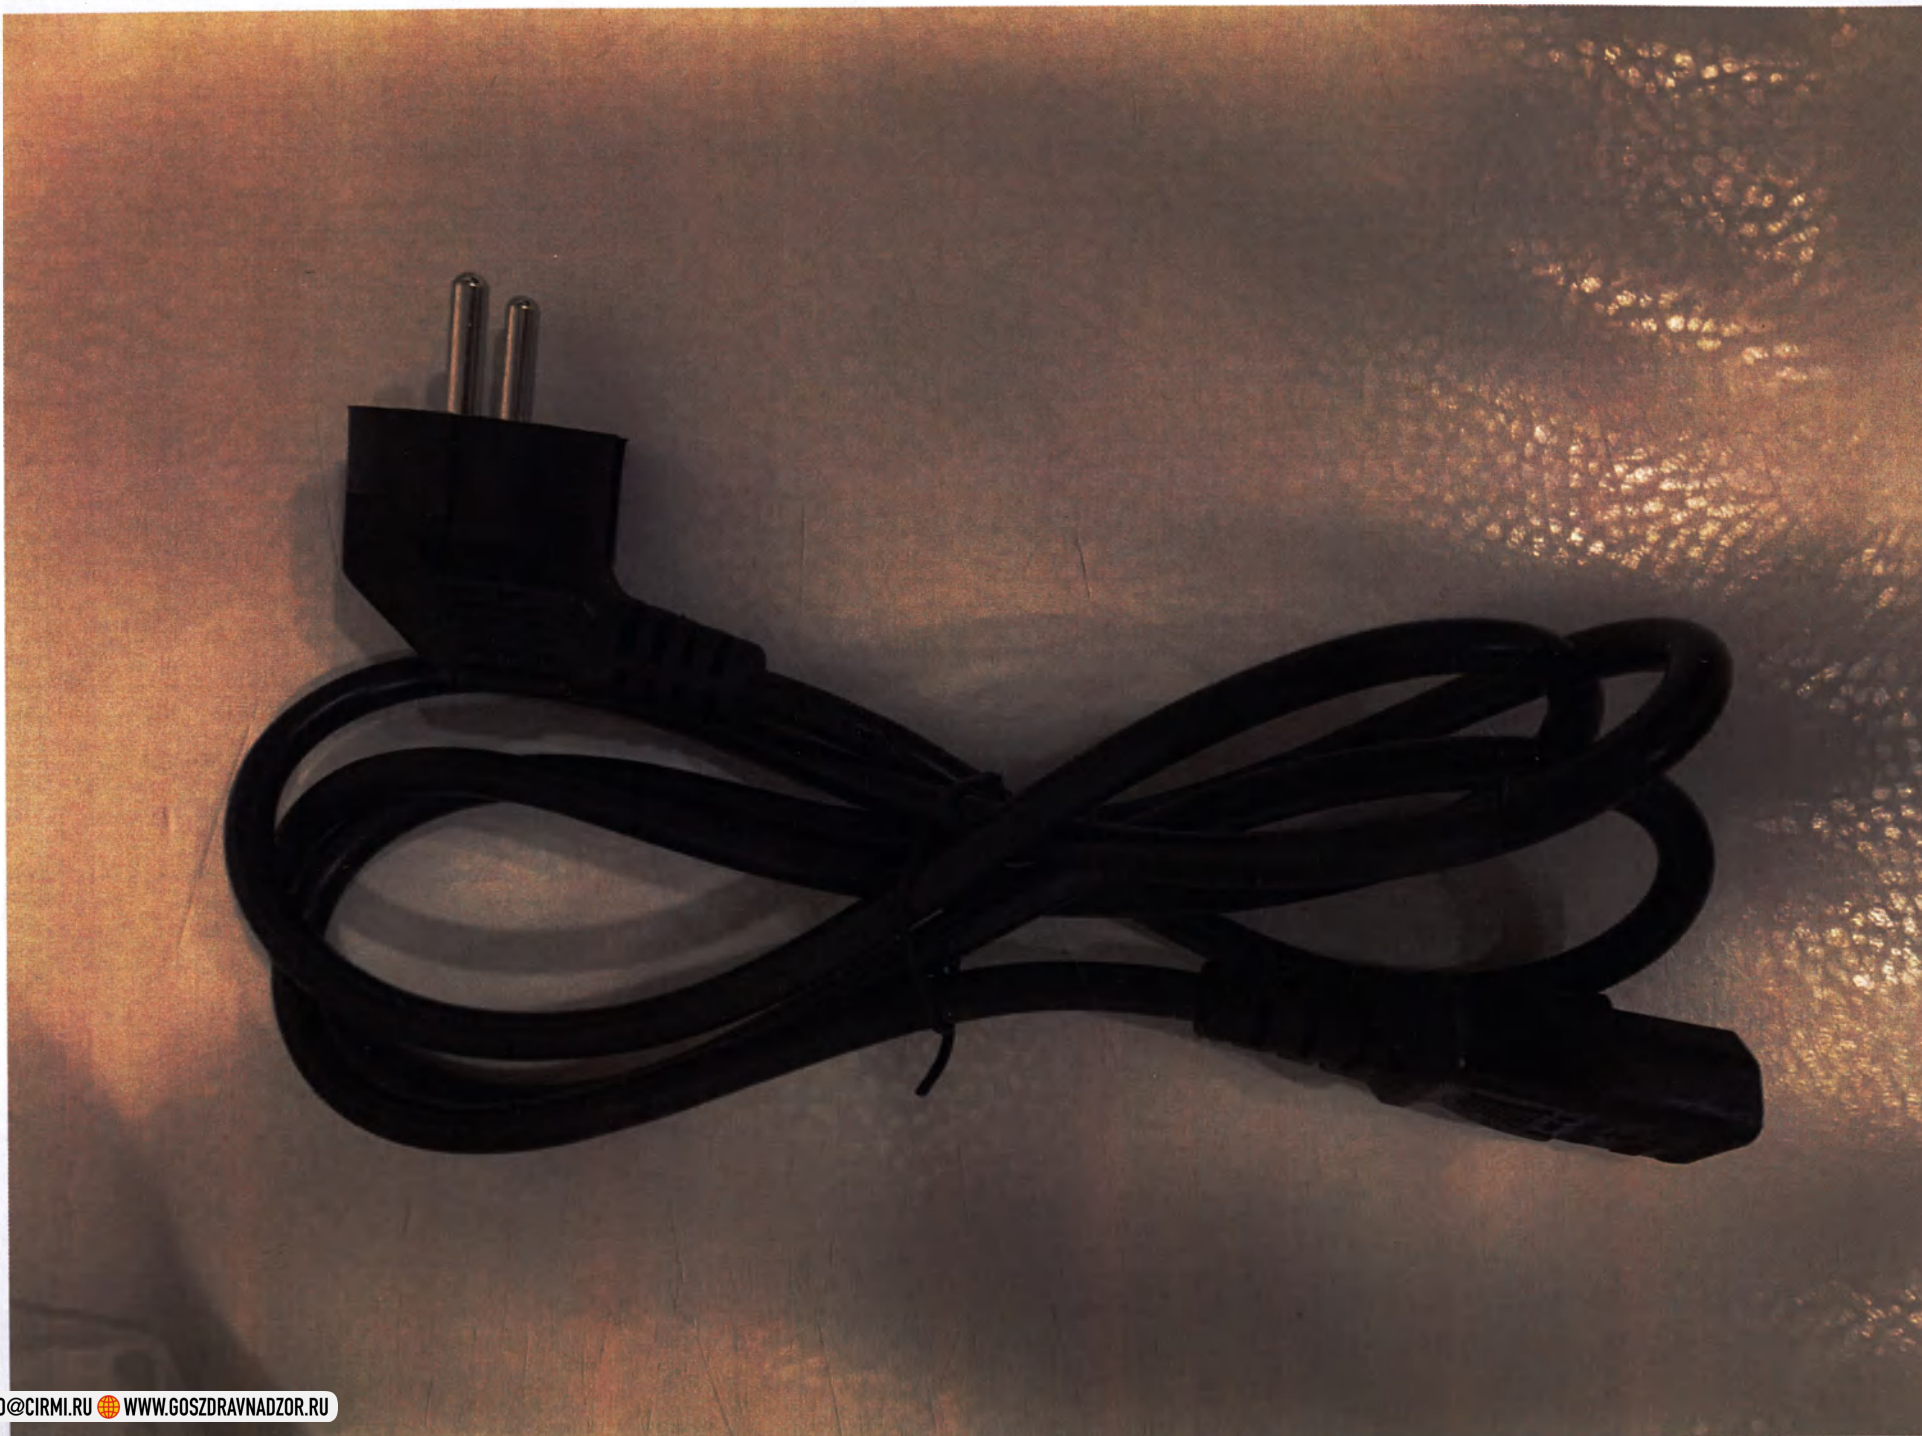

Кабель DVI

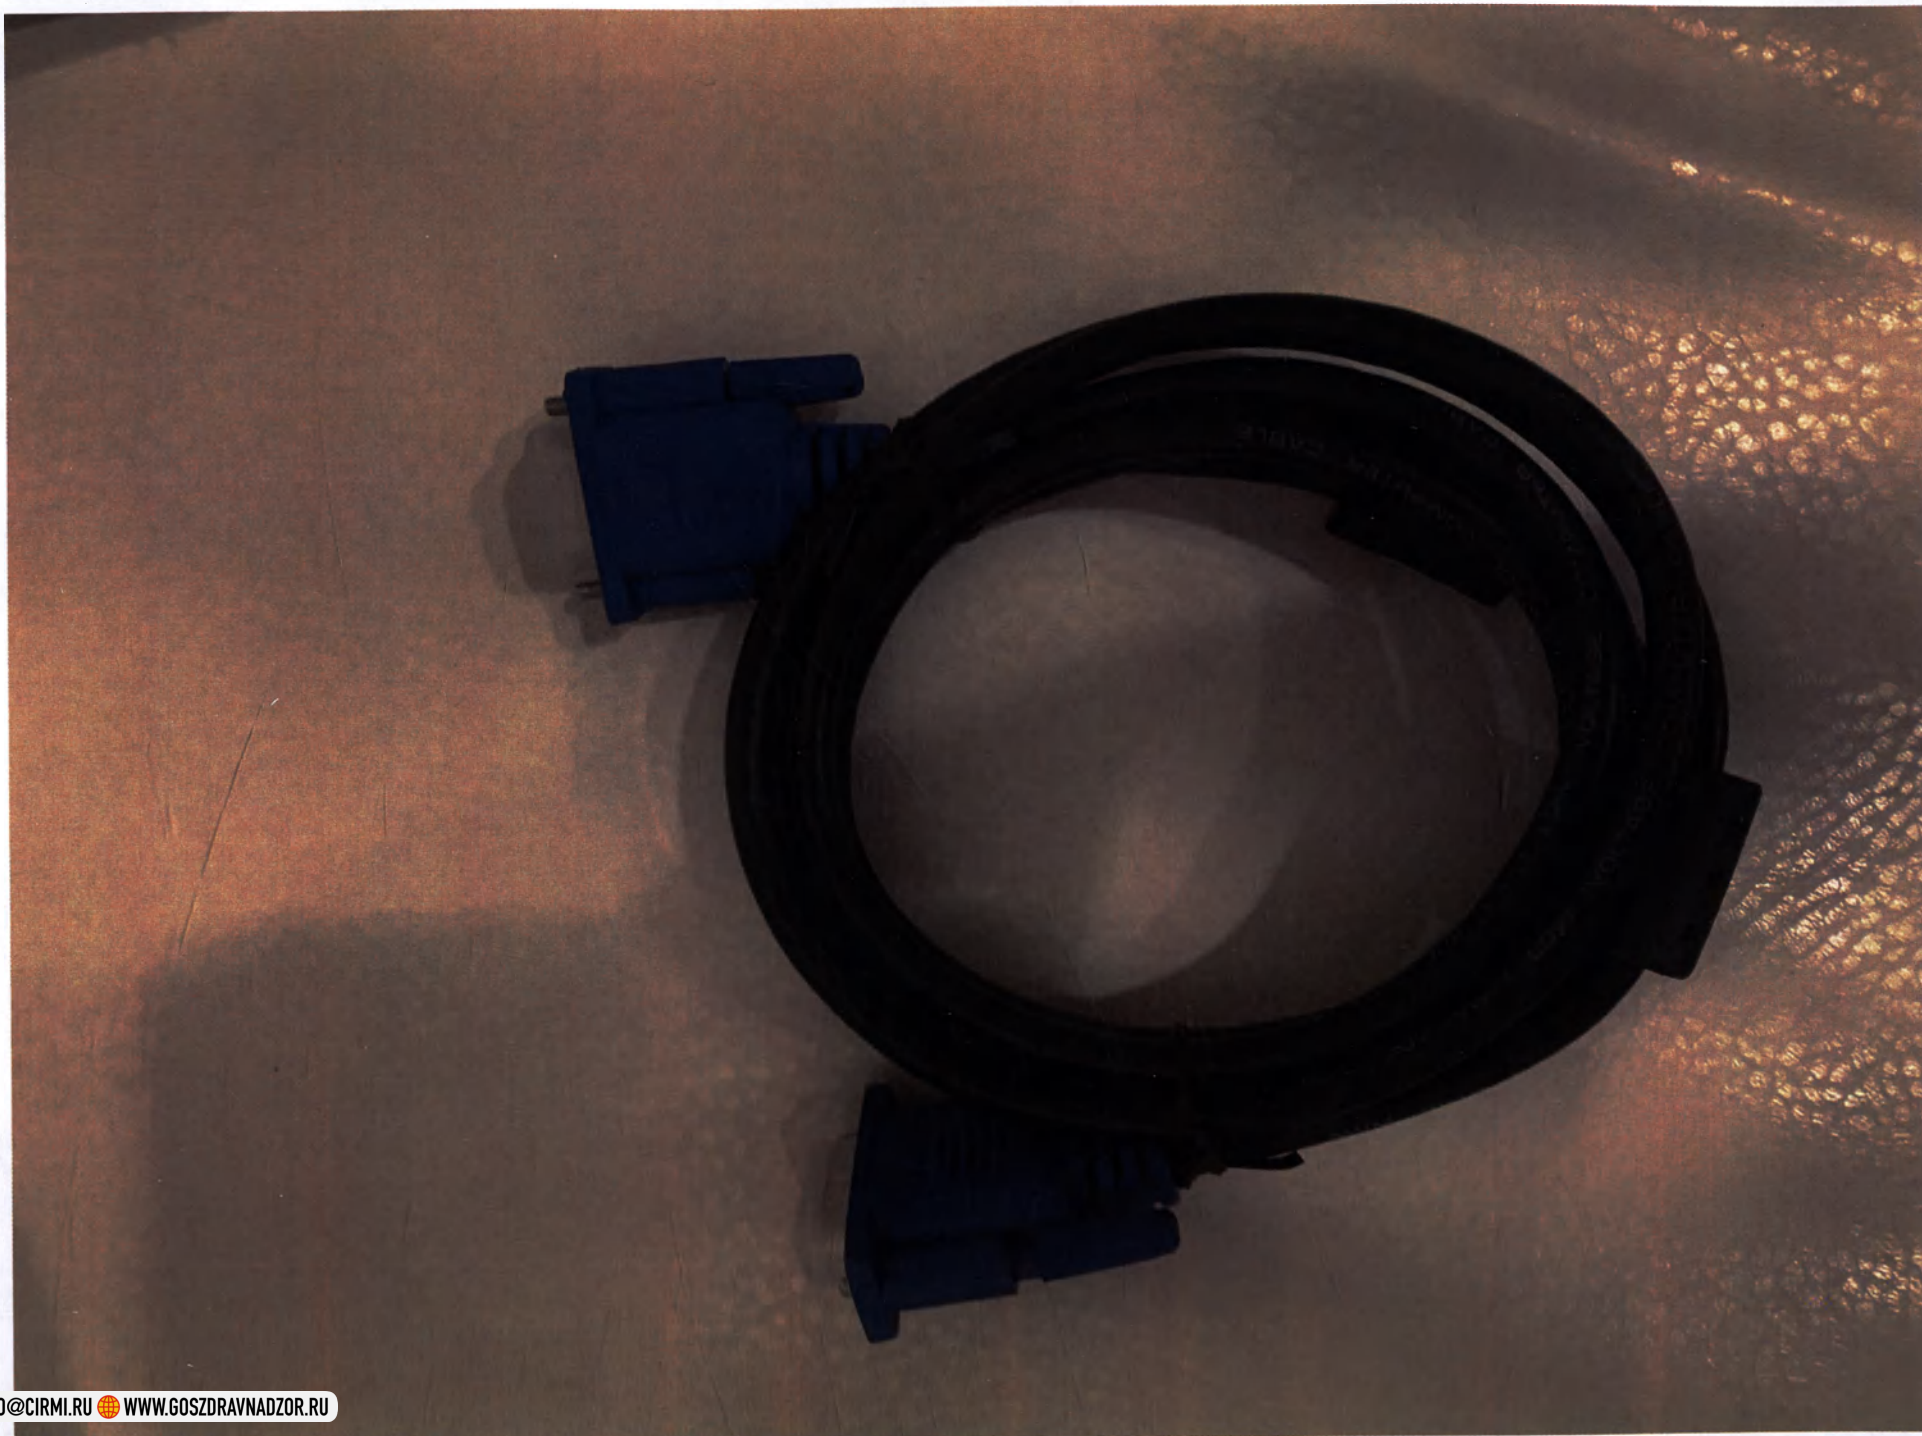


Подставка под монитор (Вид спереди)



Подставка под монитор (Вид сбоку)



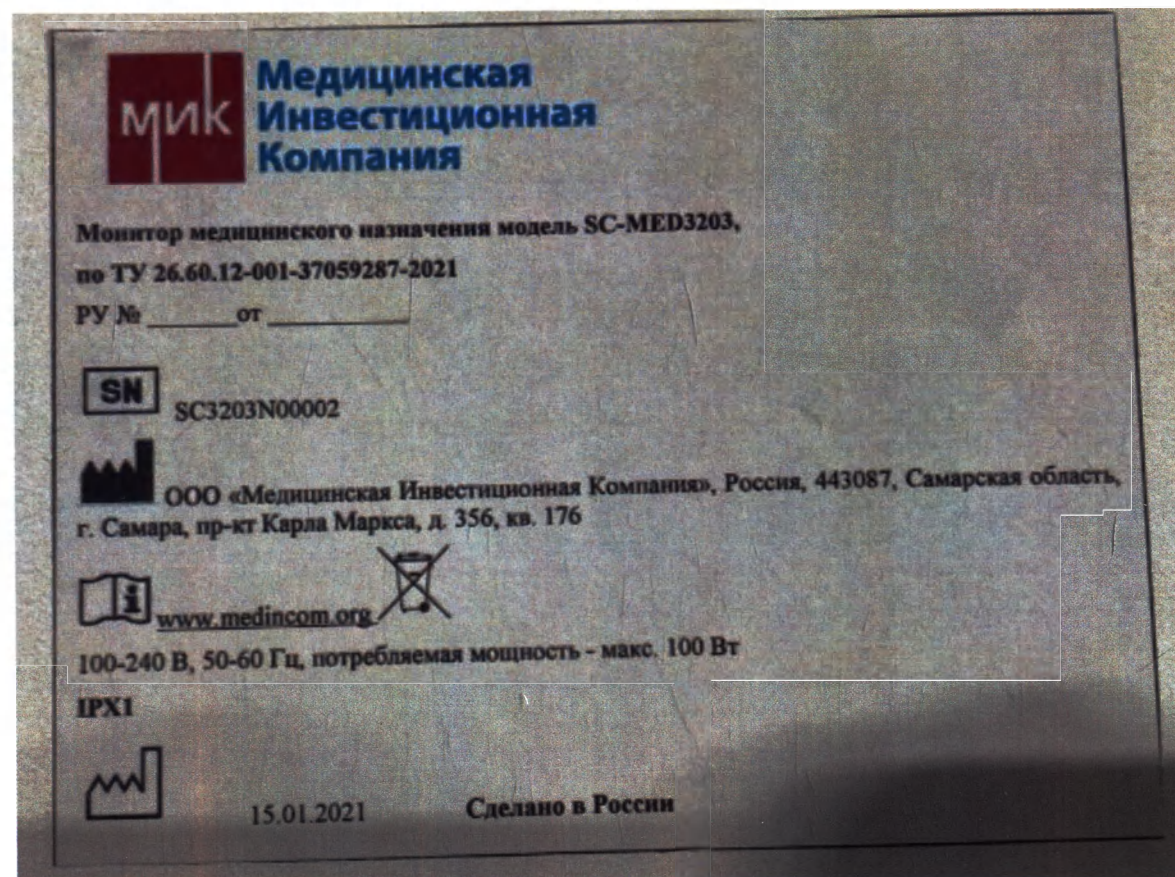


Монитор медицинского назначения модель SC-MED3203 (Вид спереди)




Монитор медицинского назначения модель SC-MED3203 (Вид сбоку)




Монитор медицинского назначения модель SC-MED3203 (Вид сзади)

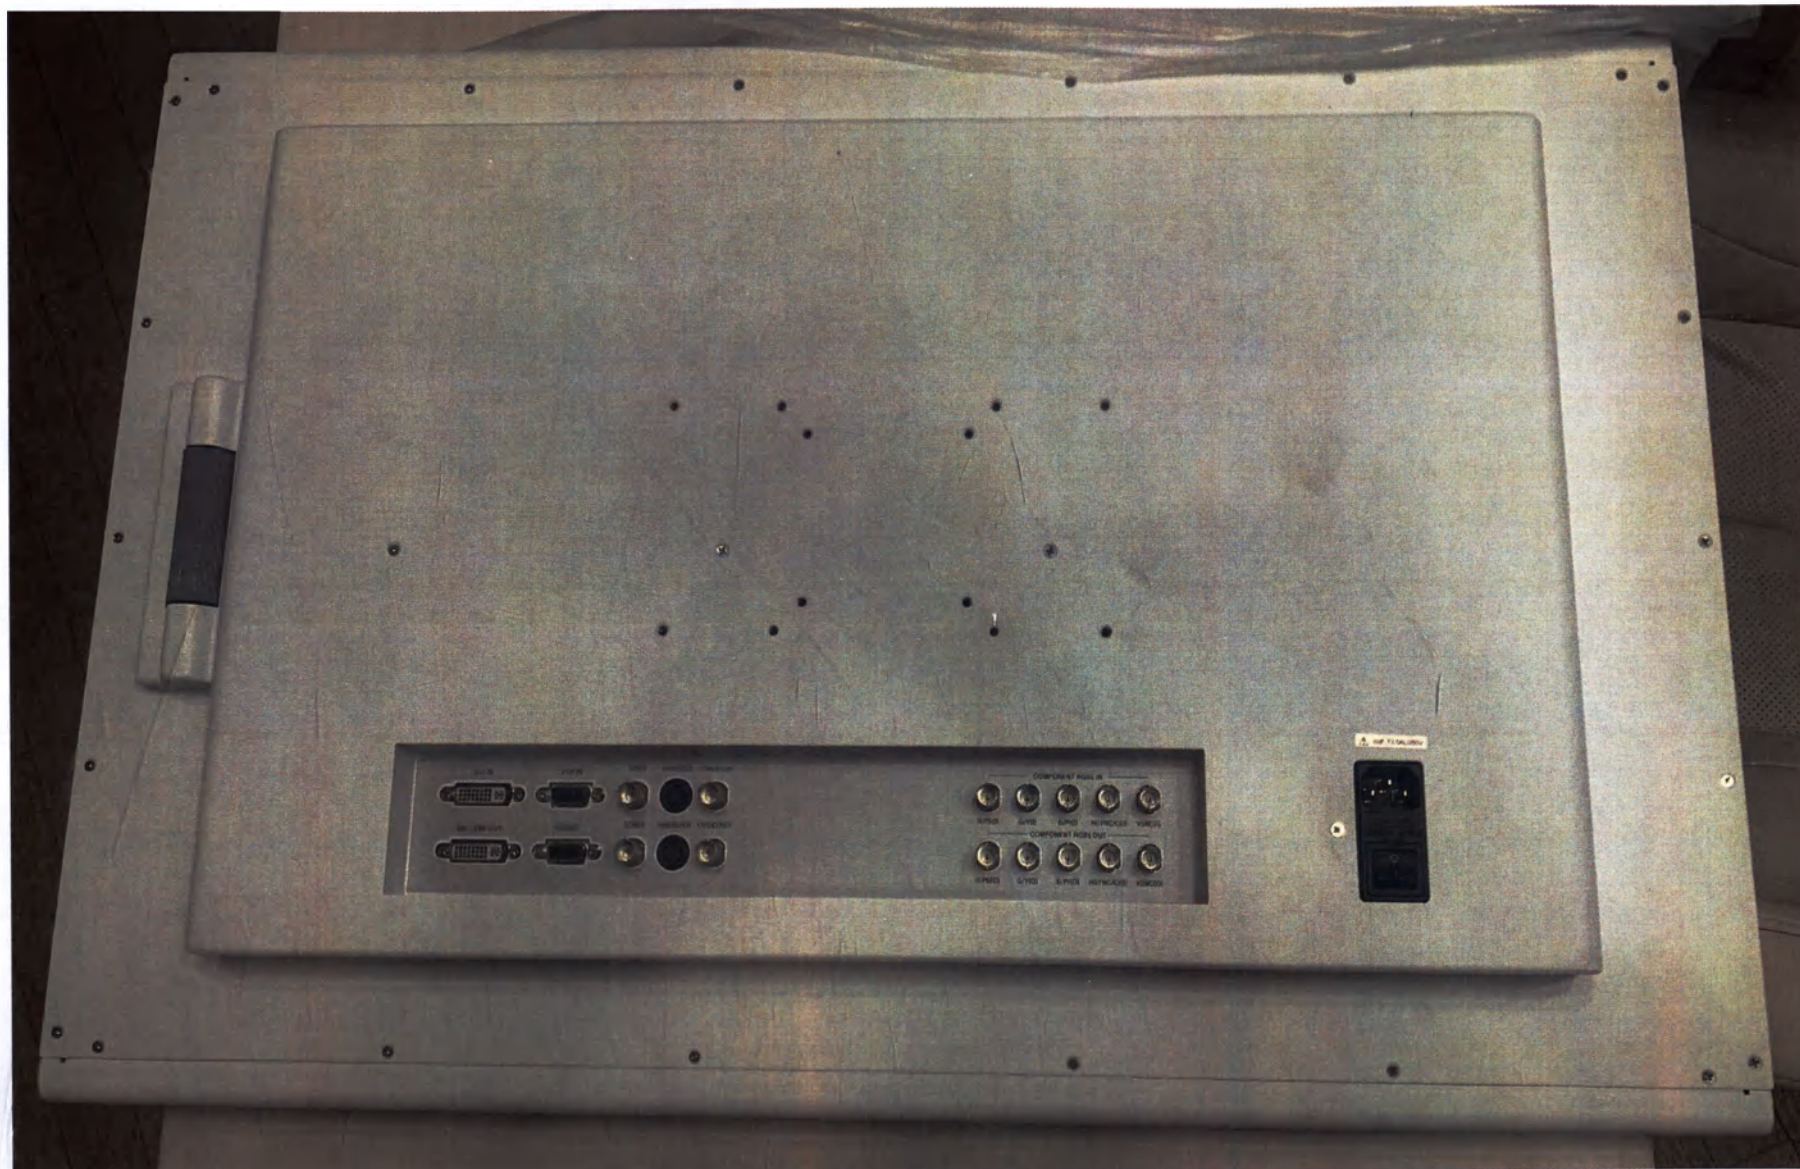

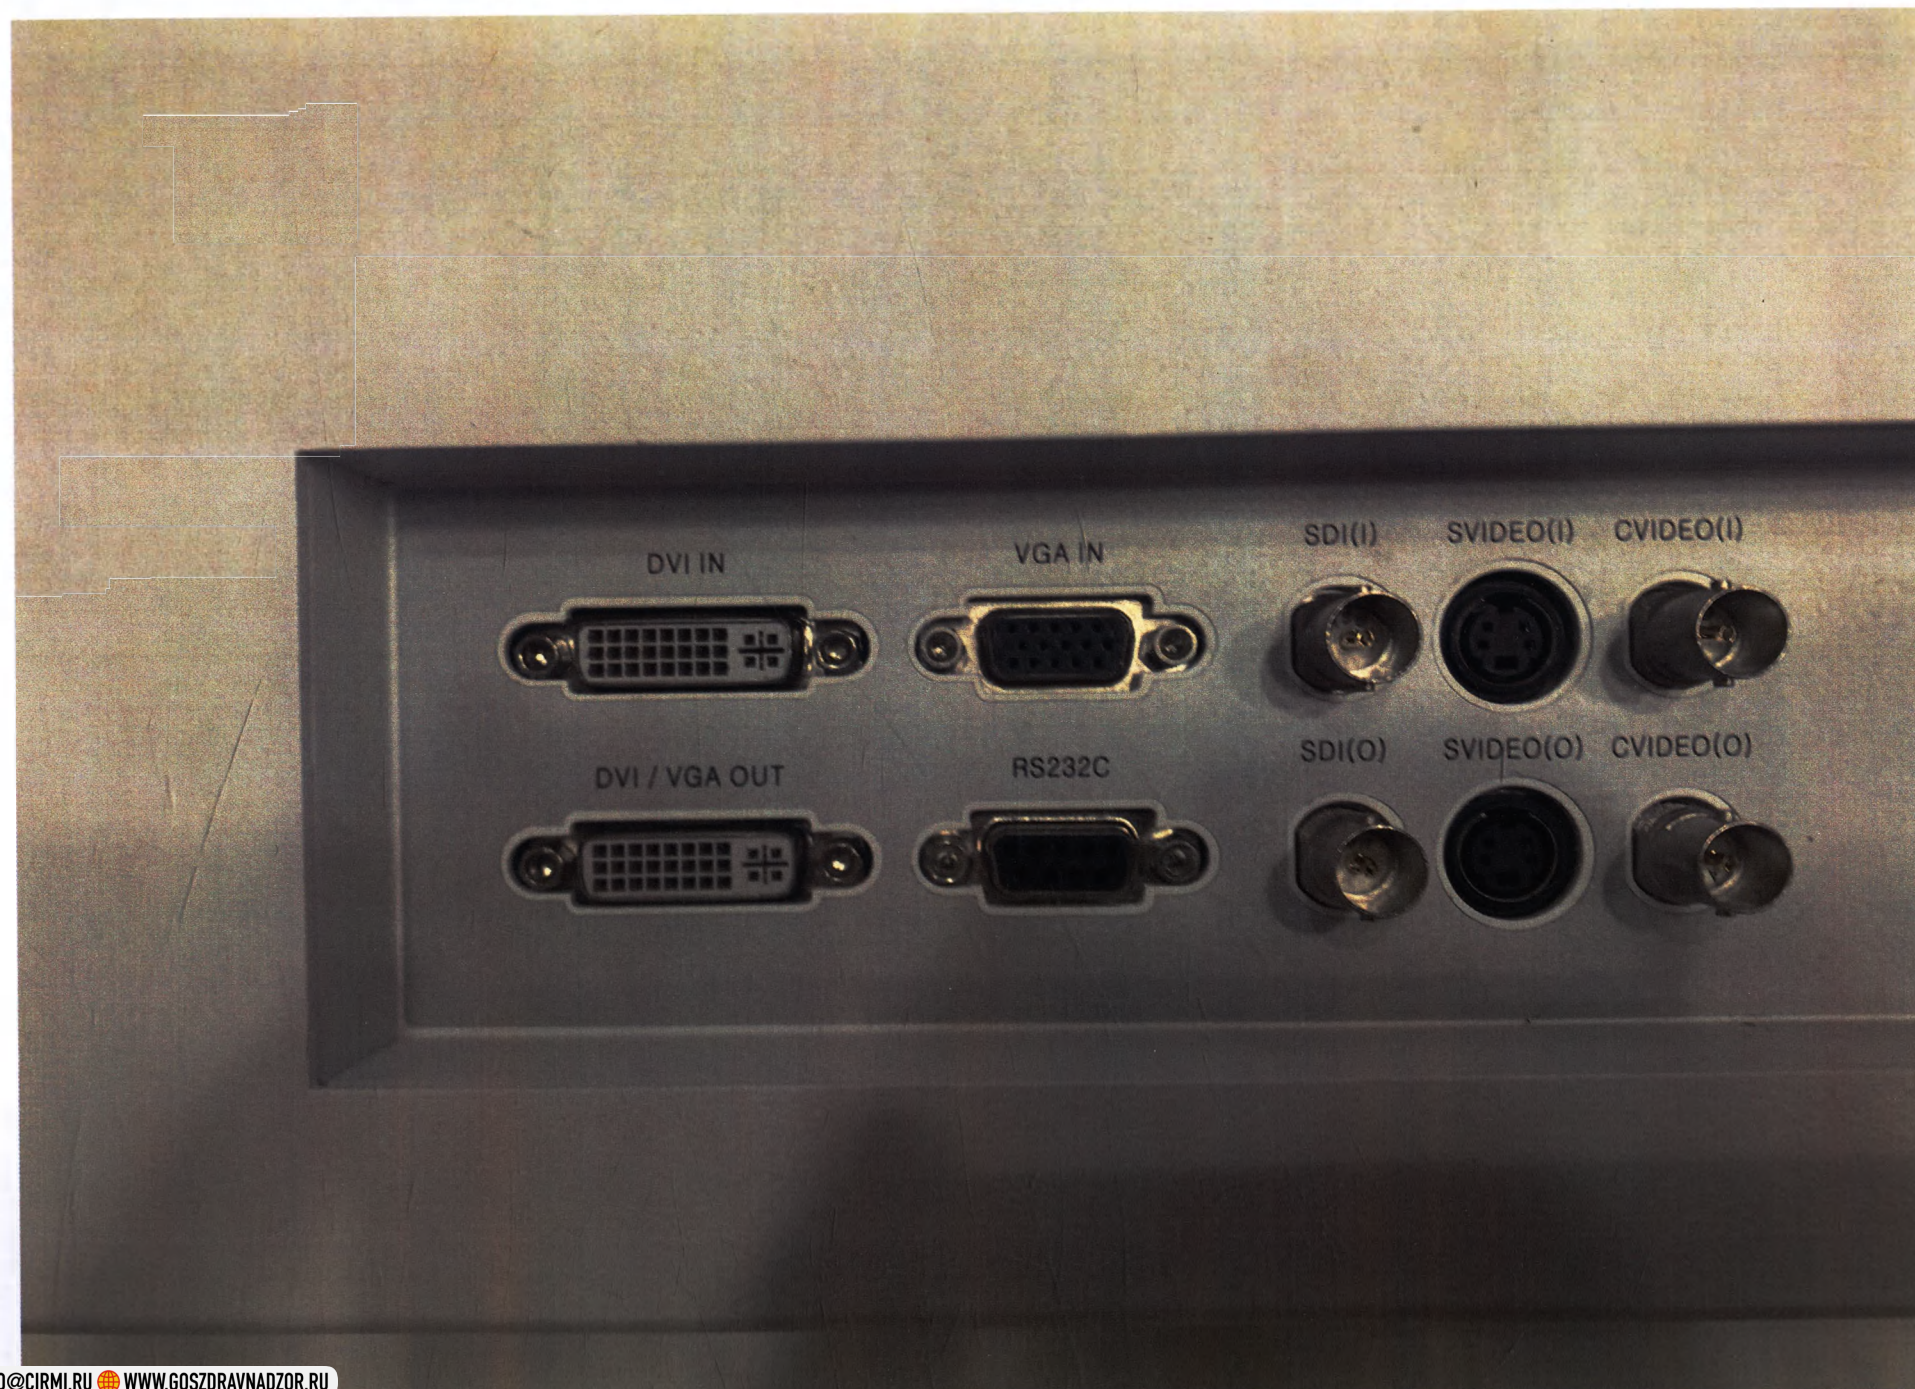




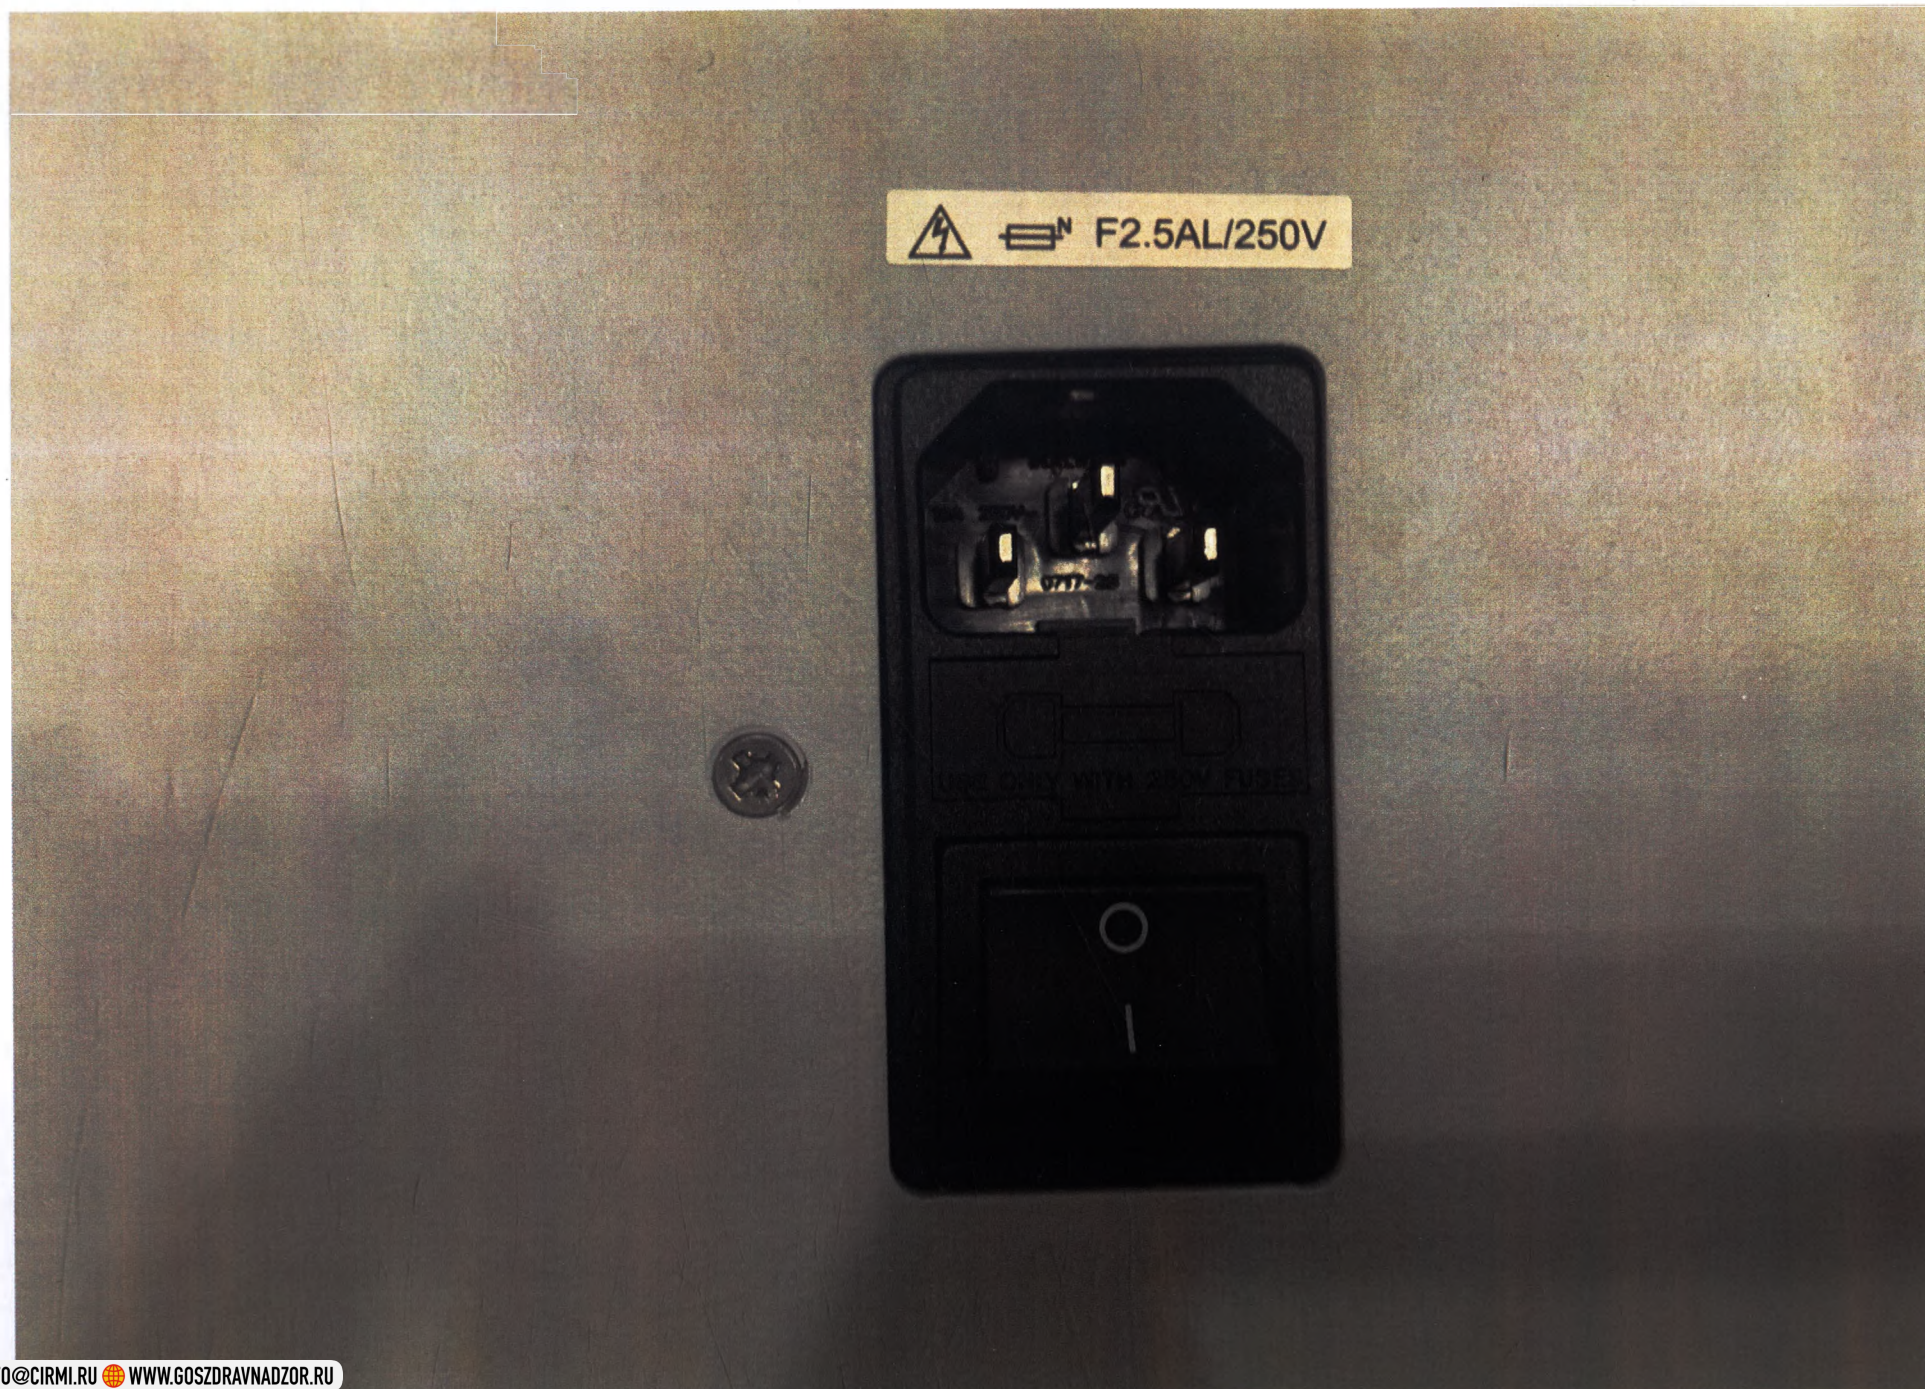



Кабель DVI

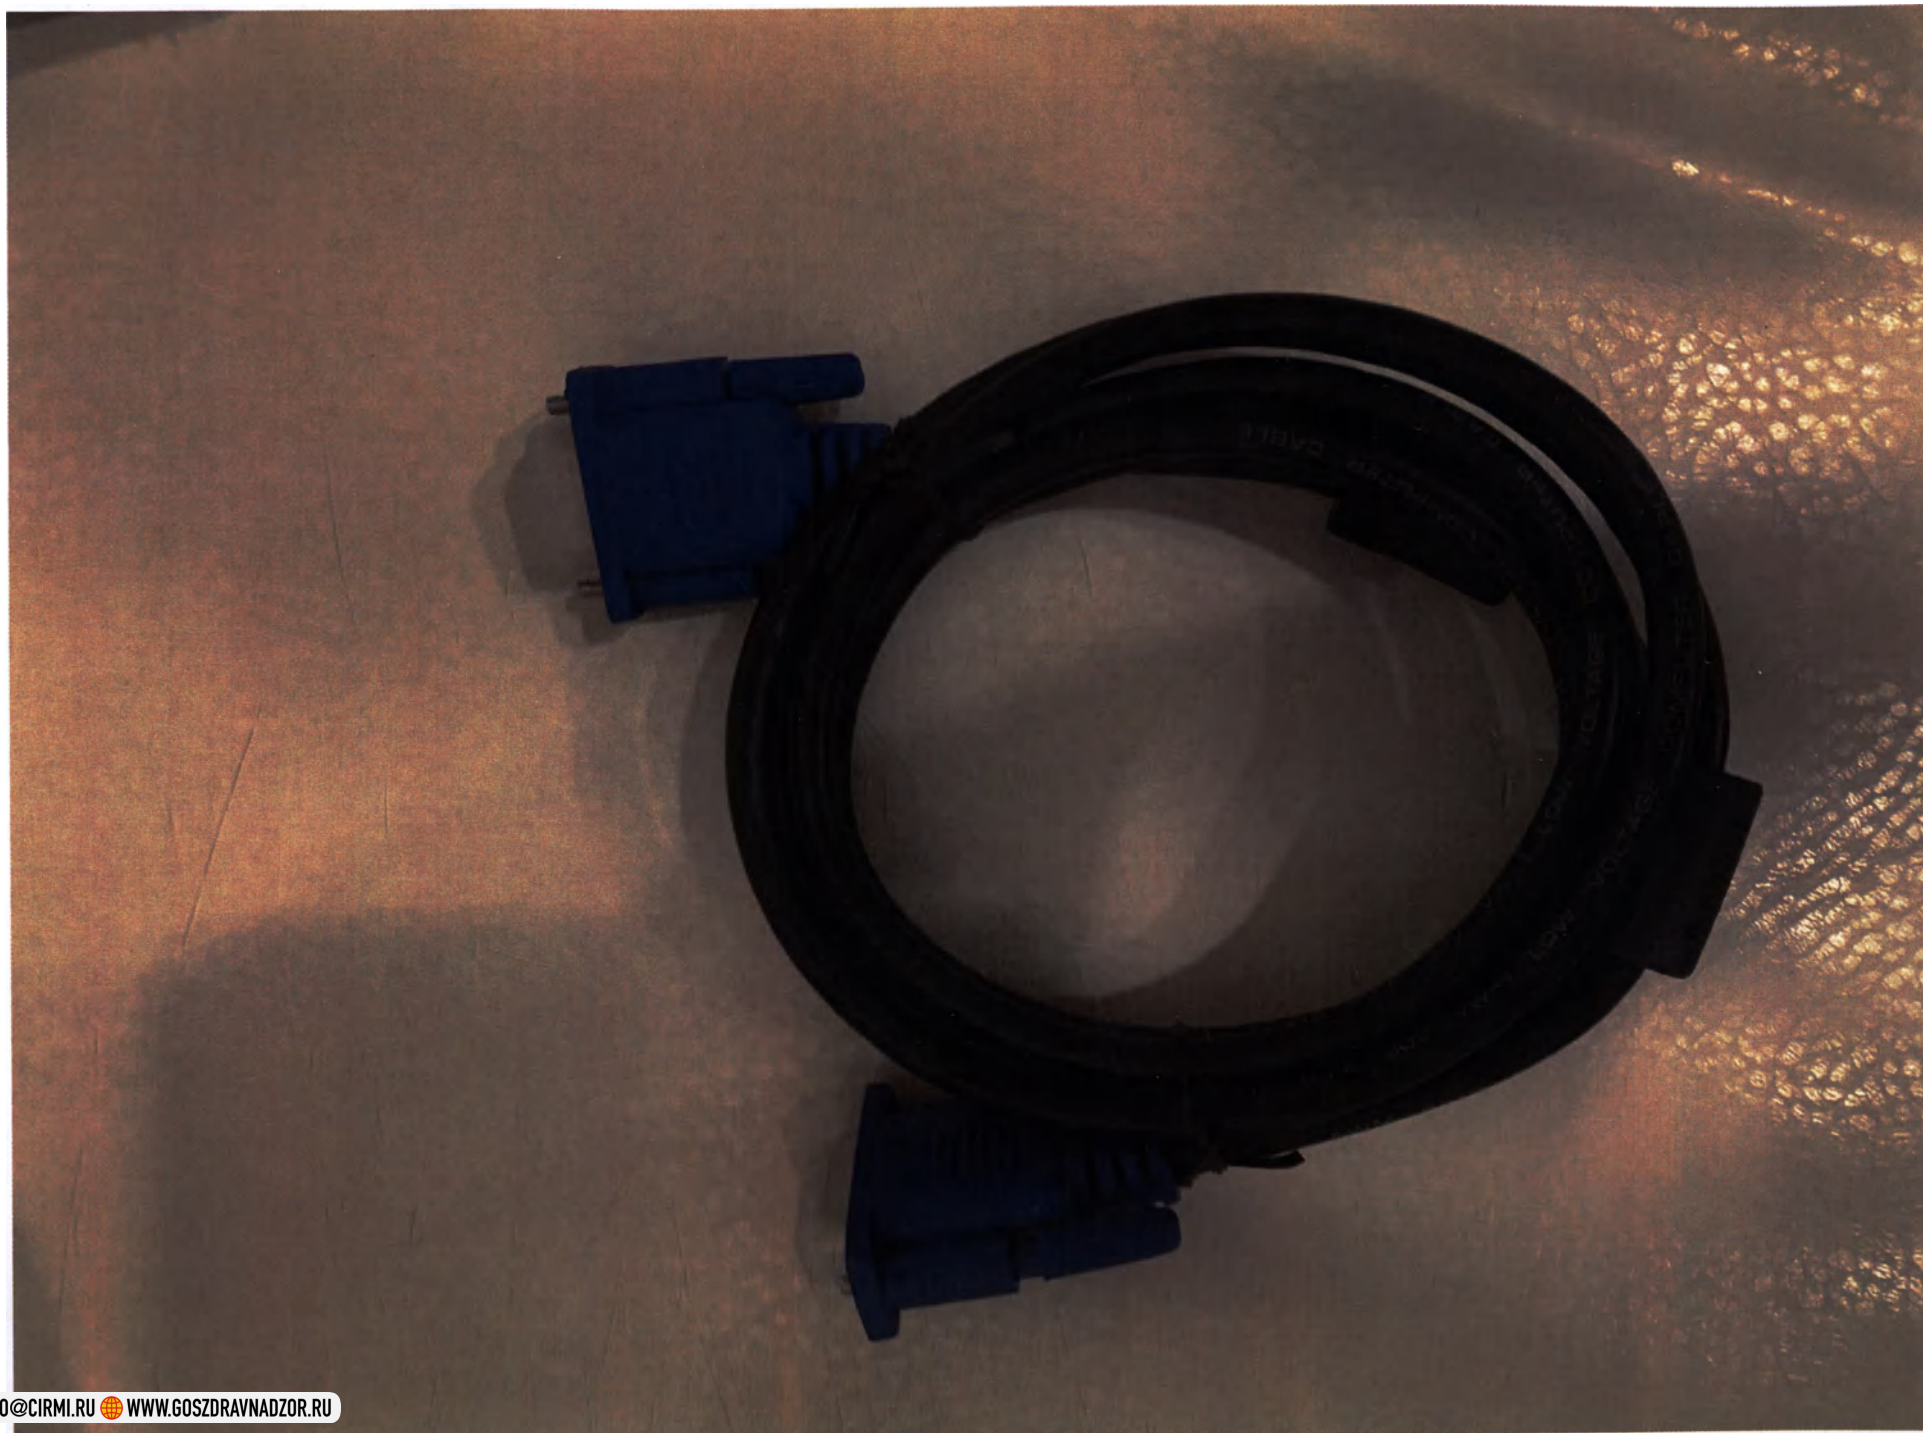


Подставка под монитор (Вид спереди)



Подставка под монитор (Вид сбоку)



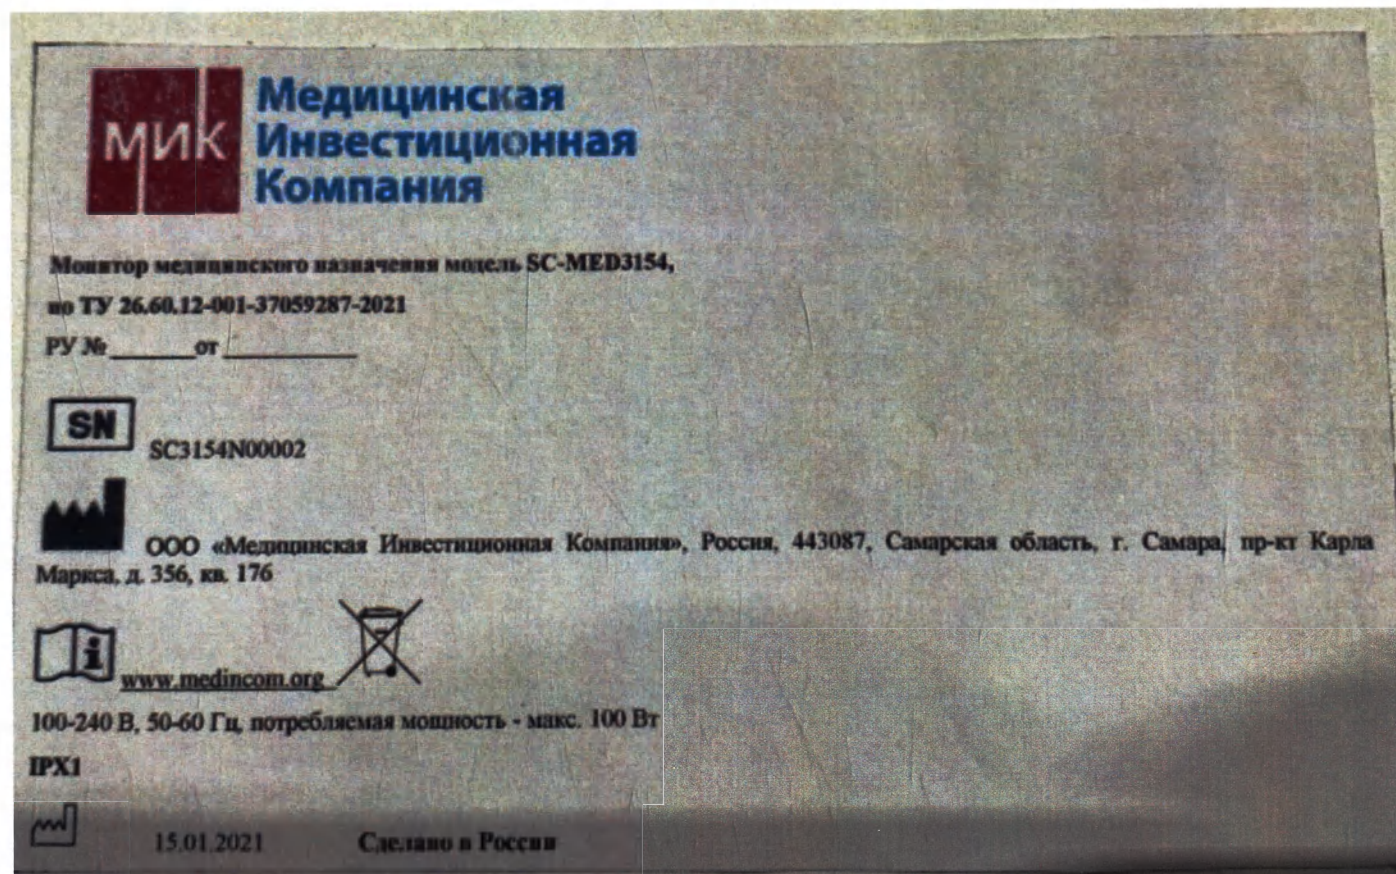

Монитор медицинского назначения модель SC-MED3154 (Вид спереди)



Монитор медицинского назначения модель SC-MED3154 (Вид сбоку)



Монитор медицинского назначения модель SC-MED3154 (Вид сбоку)




Монитор медицинского назначения модель SC-MED3154 (Вид сбоку)




Монитор медицинского назначения модель SC-MED3154 (Вид сзади)



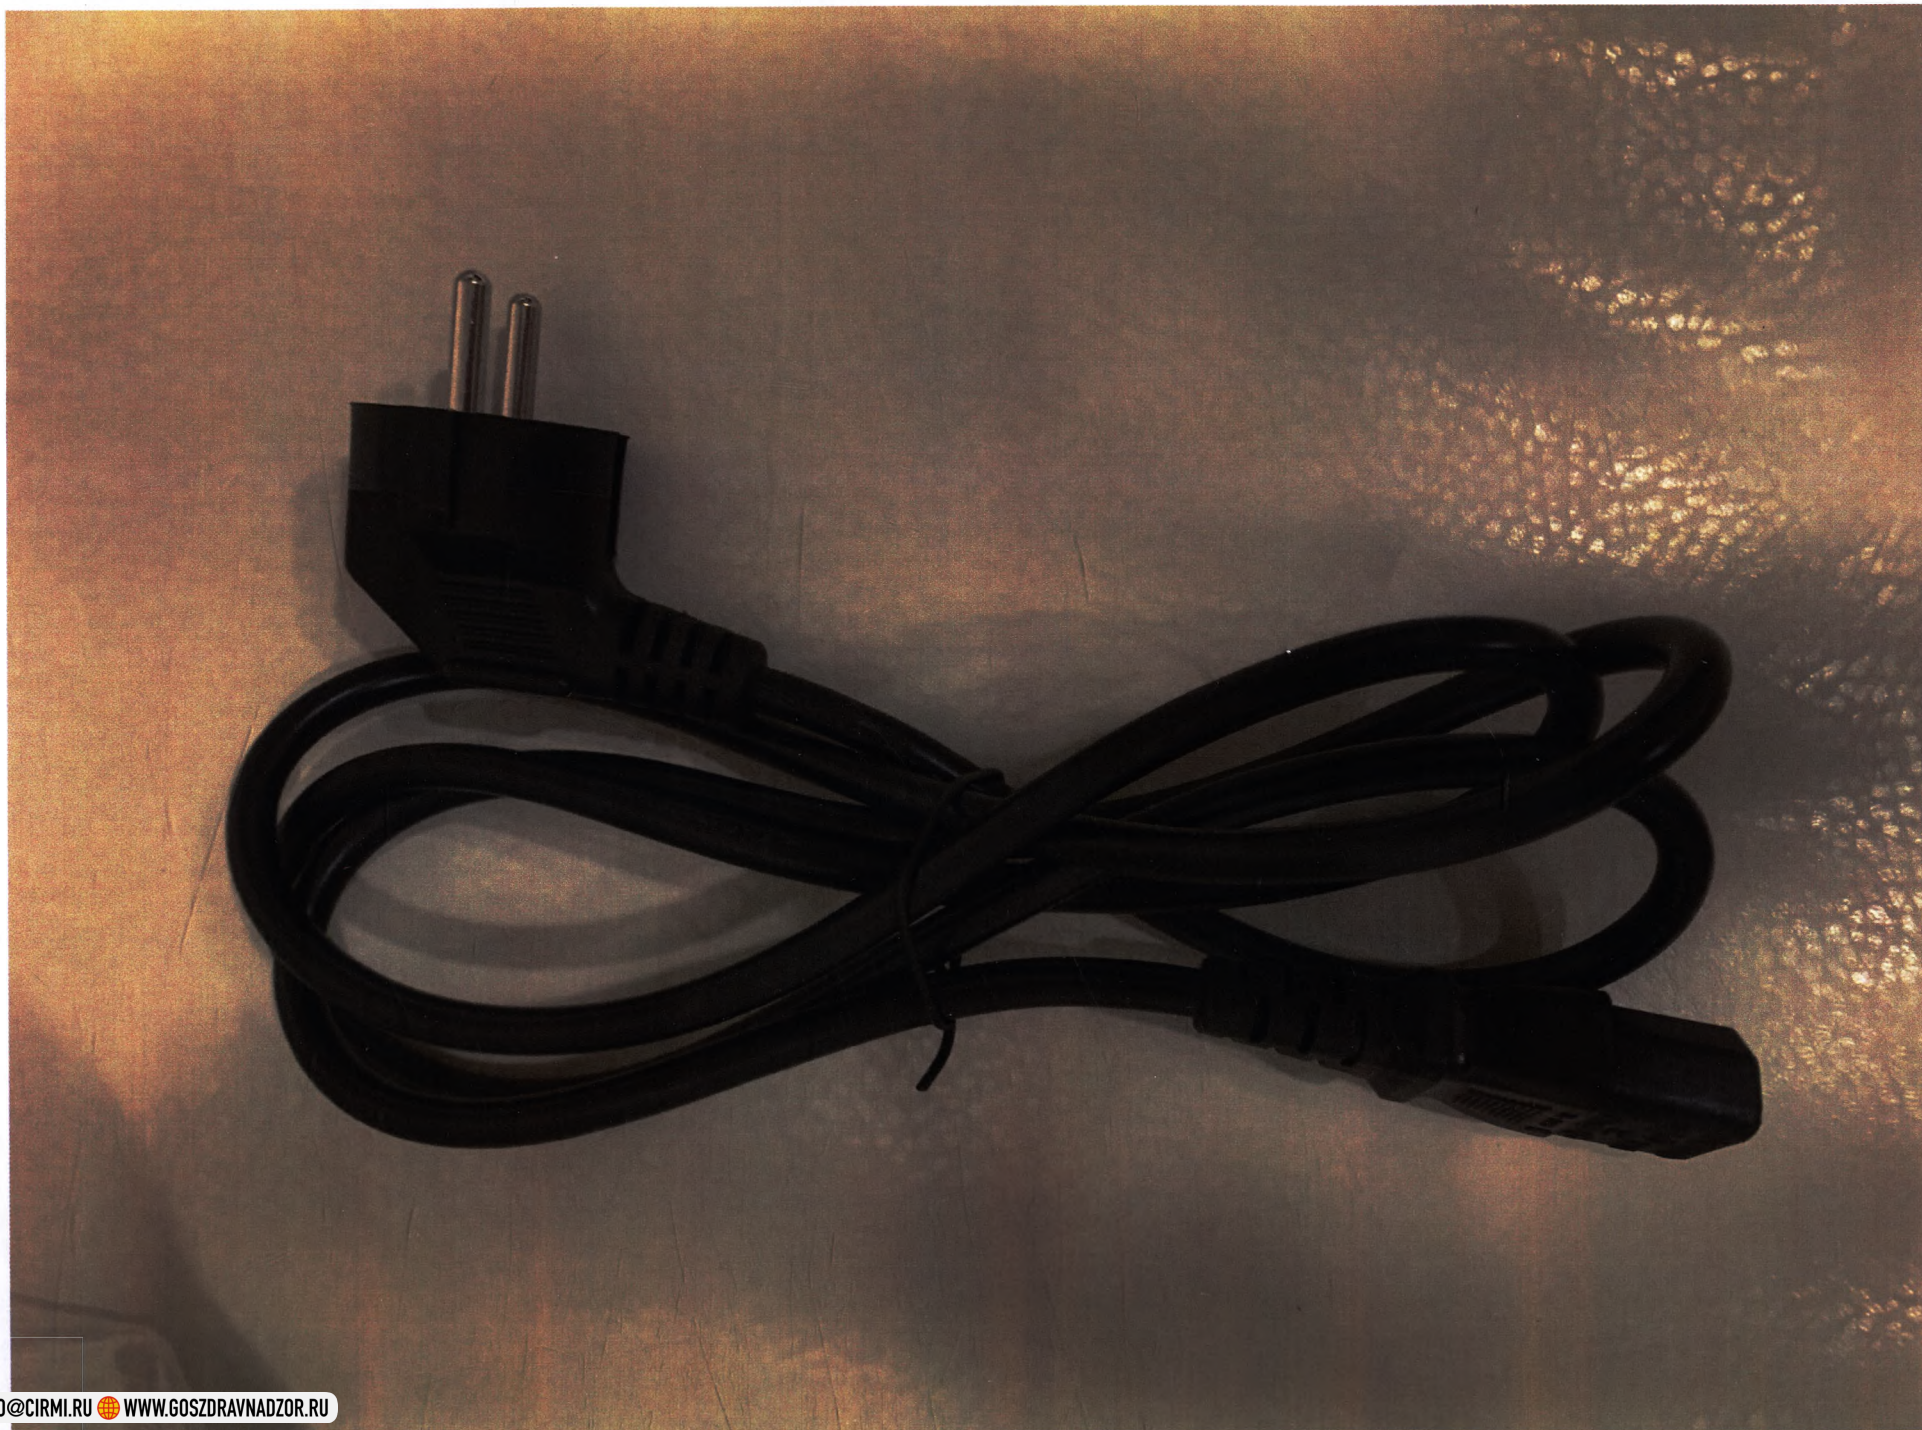

Кабель DVI

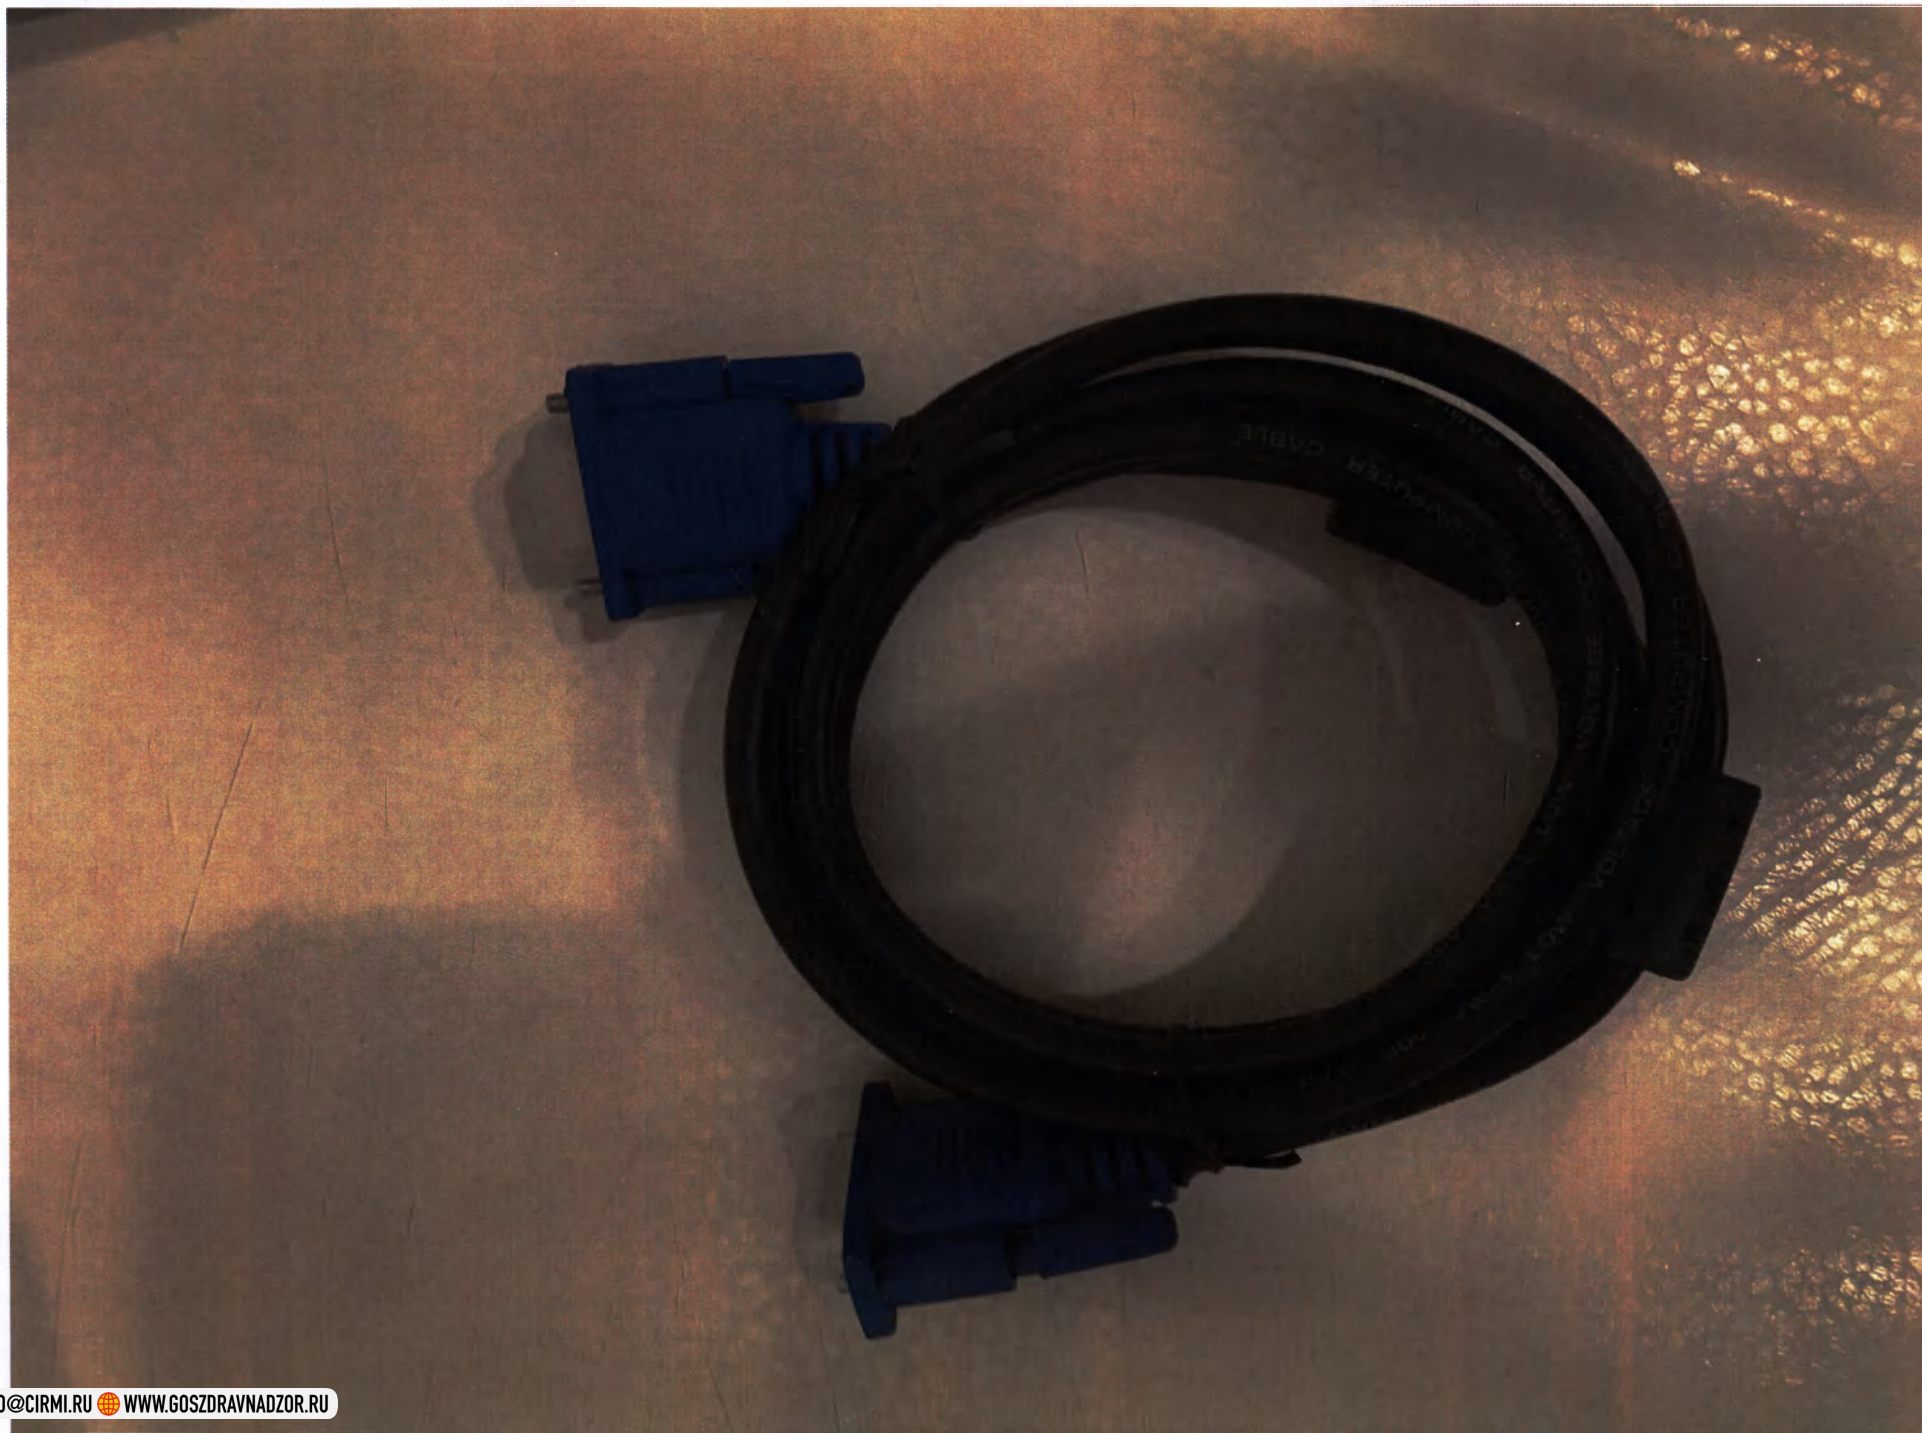

Подставка под монитор (Вид спереди)



Подставка под монитор (Вид сбоку)



ПРОШИТО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 57 ЛИСТА/ОВ

