

Medtronic

ООО «Медтроник»
Пресненская наб., д.10,
9 эт., пом. III, ком.41
Башня С
г. Москва, 123112
Россия

Tel: +7(495) 580 73 77
Fax: +7(495) 580 73 78

www.medtronic.com



УТВЕРЖДАЮ
ООО «Медтроник»
Генеральный директор
И.В. Плясунова
2021 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Закрытая система для дренирования DAR в вариантах исполнения
производства Covidien Llc, USA (Ковидиен Ллс, США)


Сменный катетер, закрытая система для дренирования DAR, эндотрахеальная длина 12 Fr/Ch (4.00 мм) x 580 мм,
в комплекте:
Катетер с клапаном для отсасывания,
Накладка на катетер.



Сменный катетер, закрытая система для дренирования DAR, эндотрахеальная длина 14 Fr/Ch (4.67 мм) x 580 мм,
в составе:
катетер с клапаном для отсасывания,
рыбка на катетер.

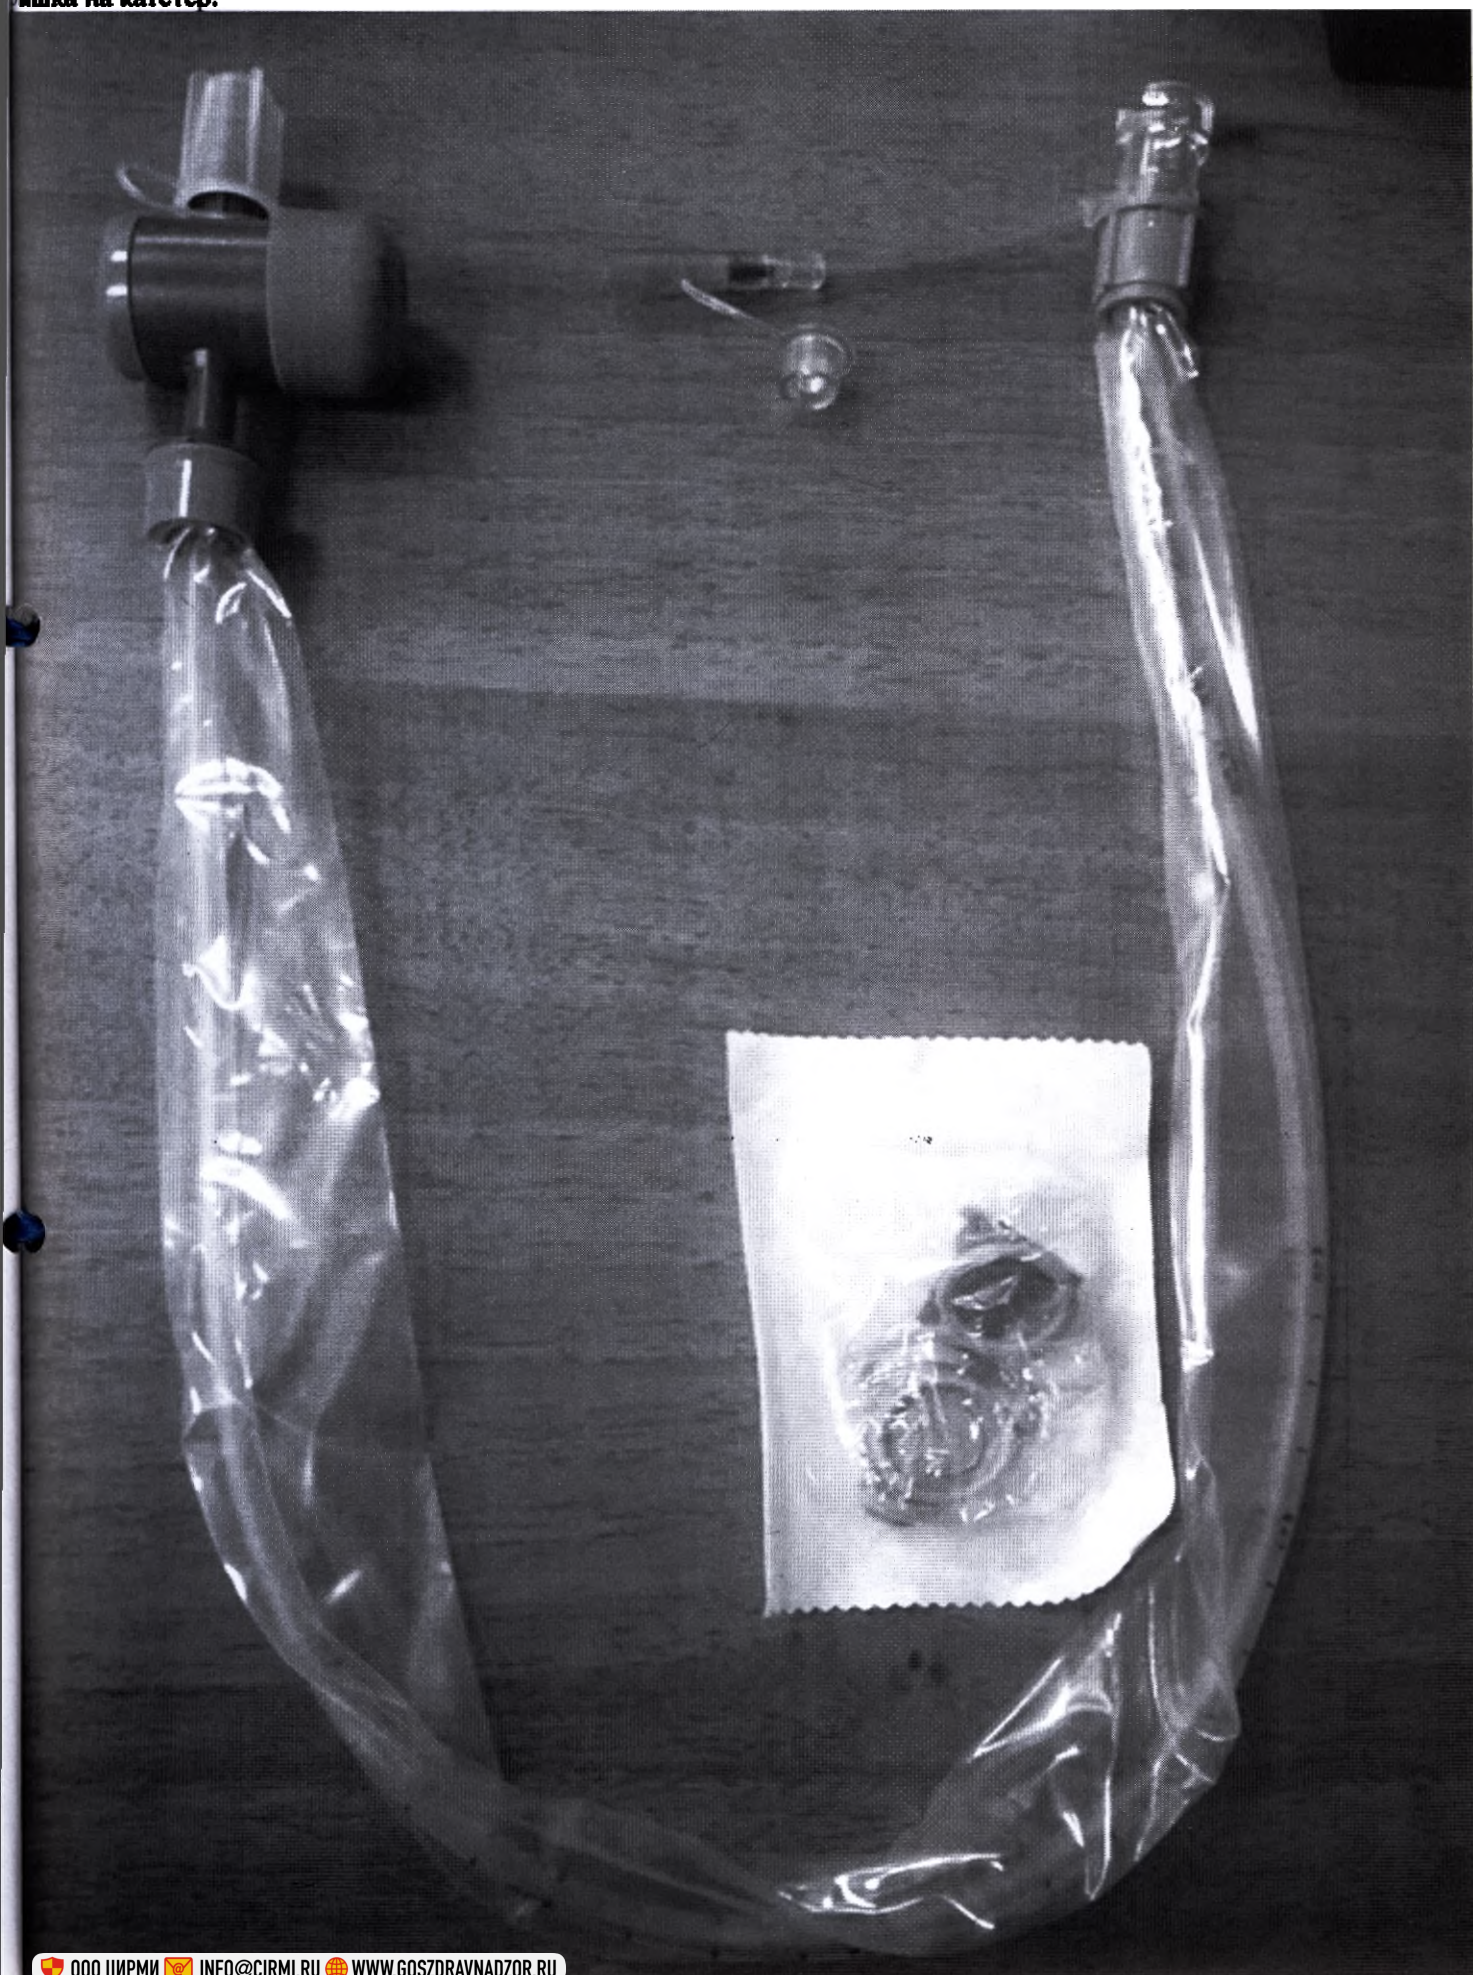


Сменный катетер, закрытая система для дренирования DAR, эндотрахеальная длина 16 Fr/Ch (5.33 мм) x 580 мм,
в комплекте:
катетер с клапаном для отсасывания,
насадка на катетер.

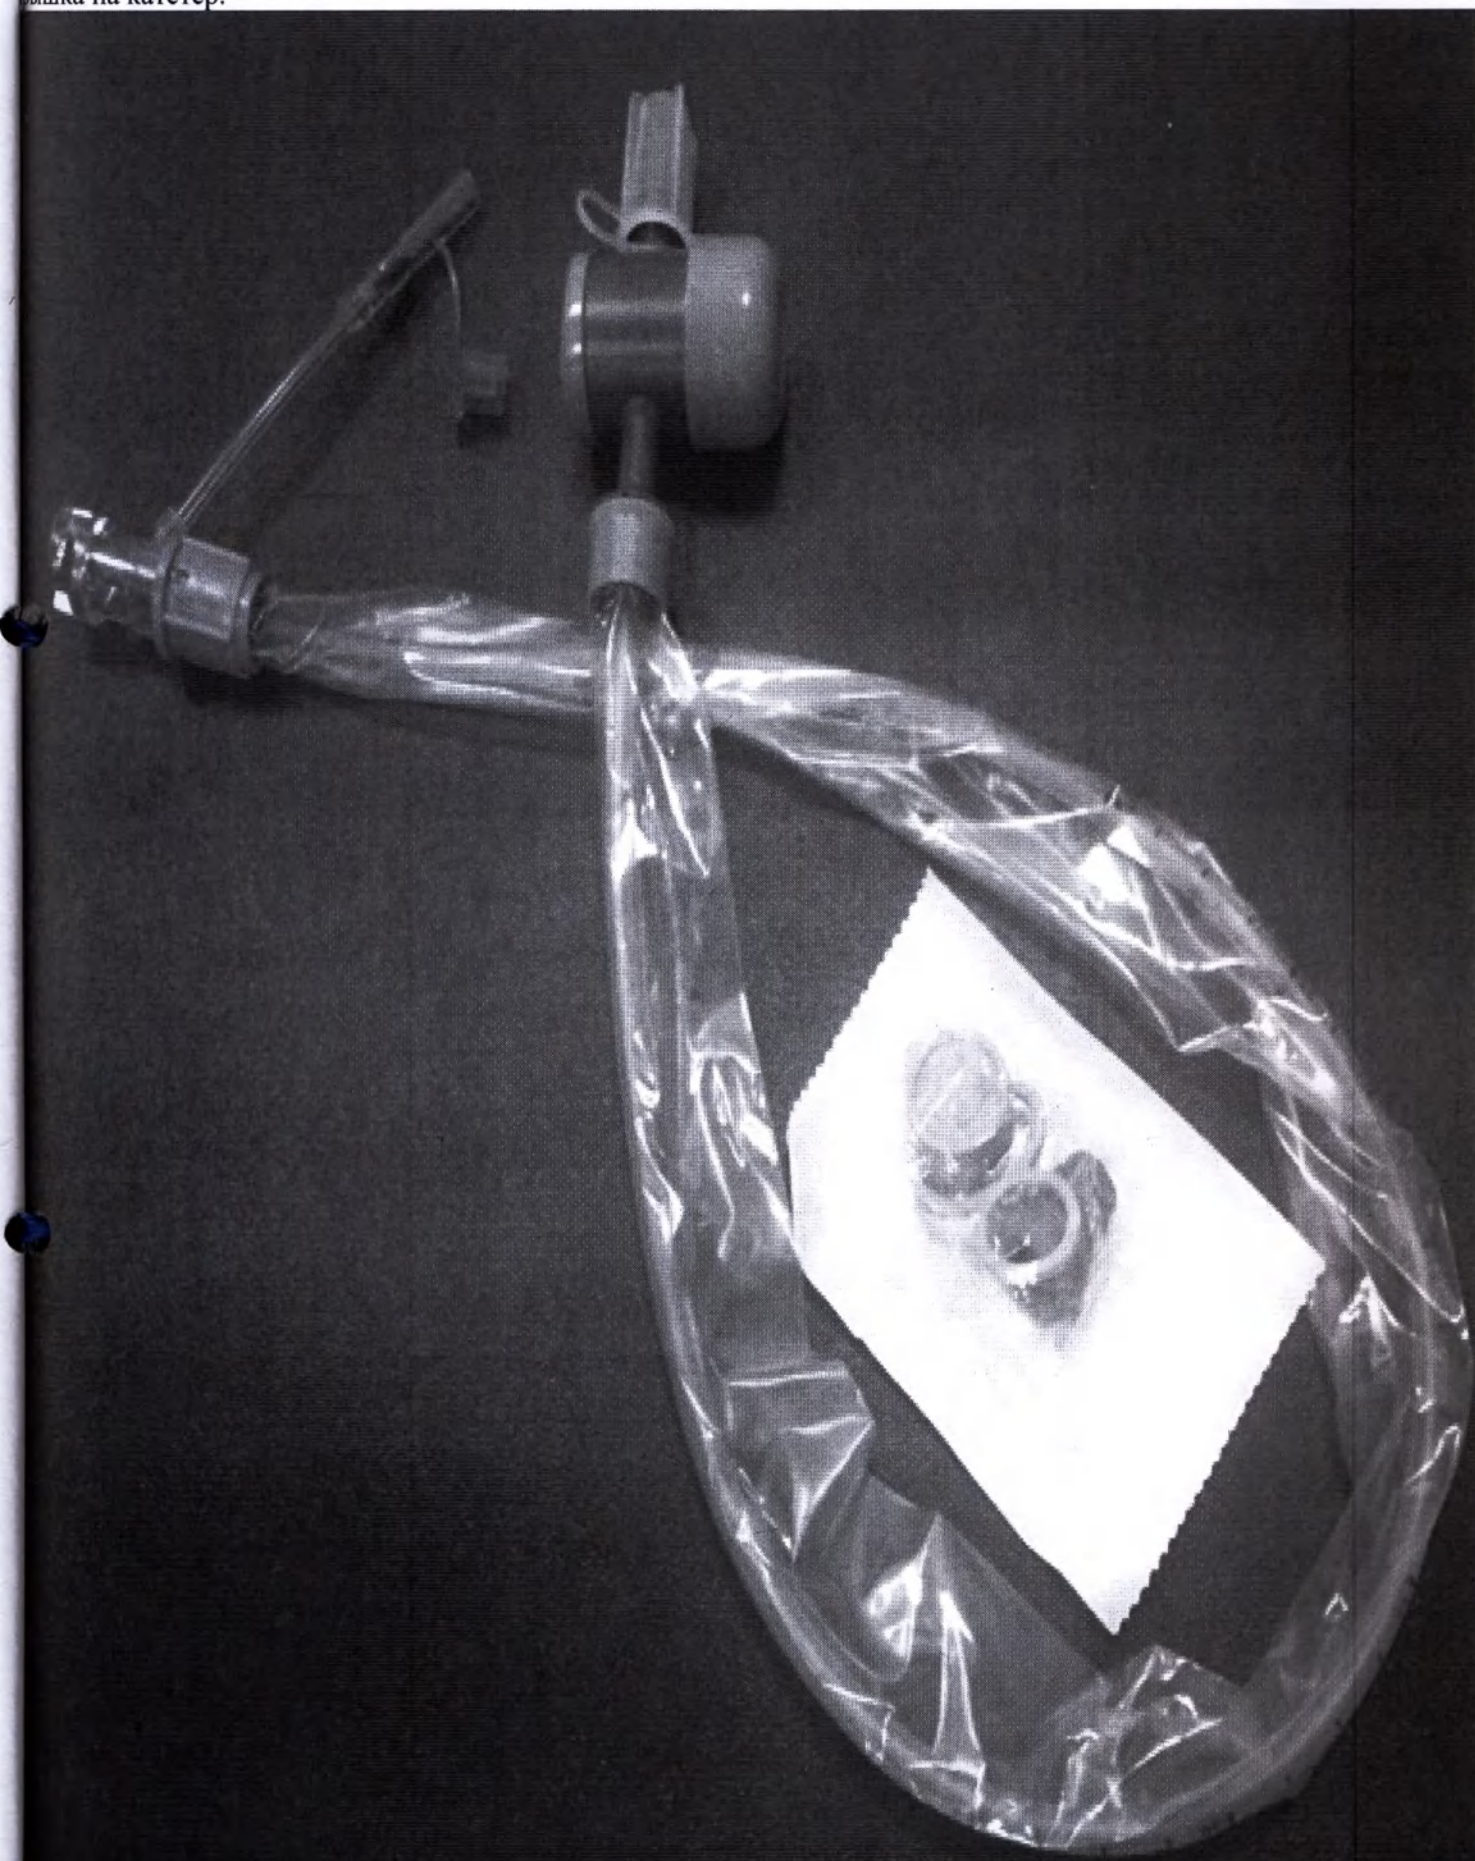

Закрытая система для дренирования DAR, сменный катетер; эндотрахеальная длина 10 Fr/Ch (3.33 мм) x 580 мм,
в составе:
катетер с клапаном для отсасывания,
крышка на катетер,
шпатель.



крытая система для дренирования DAR, сменный катетер; эндотрахеальная длина 14 Fr/Ch (4.67 мм) x 580 мм,
оставе:
етер с клапаном для отсасывания,
шка на катетер,
бка.

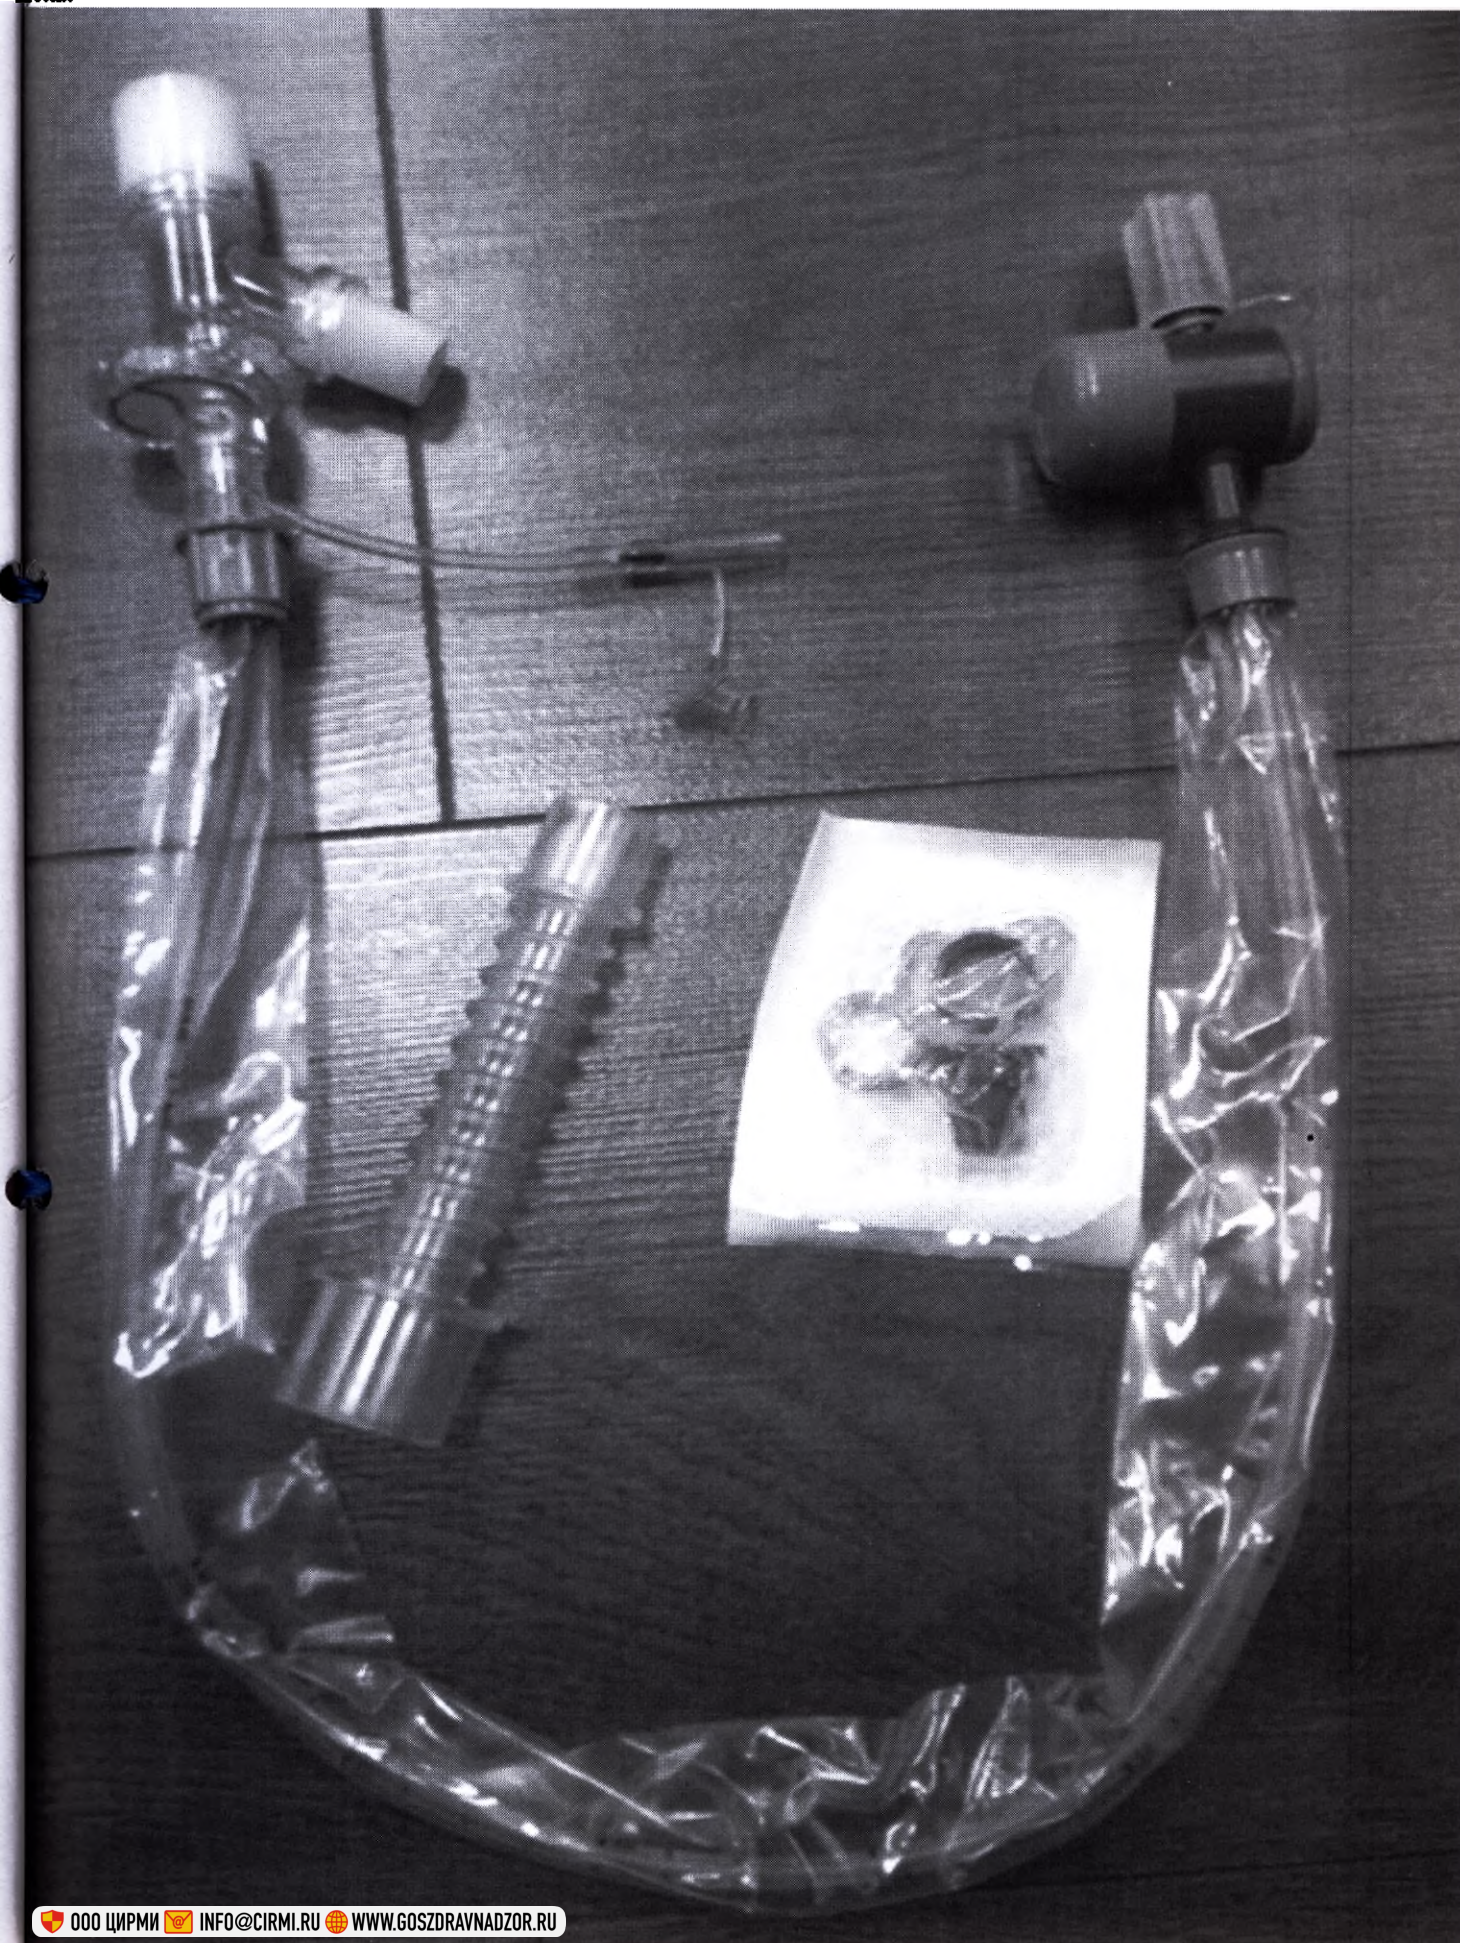


Закрытая система для дренирования DAR, сменный катетер; эндотрахеальная длина 16 Fr/Ch (5.33 мм) x 580 мм,
в составе:
катетер с клапаном для отсасывания,
крышка на катетер,
шпатель.



открытая система для дренирования ДАР, эндотрахеальная длина 12 Fr/Ch (4.00 мм) x 580 мм,
в составе:
катетер с клапаном для отсасывания,
шпатель.



Закрытая система для дренирования DAR, эндотрахеальная длина 14 Fr/Ch (4.67 мм) x 580 мм,
в составе:
катетер с клапаном для отсасывания,
шланг.

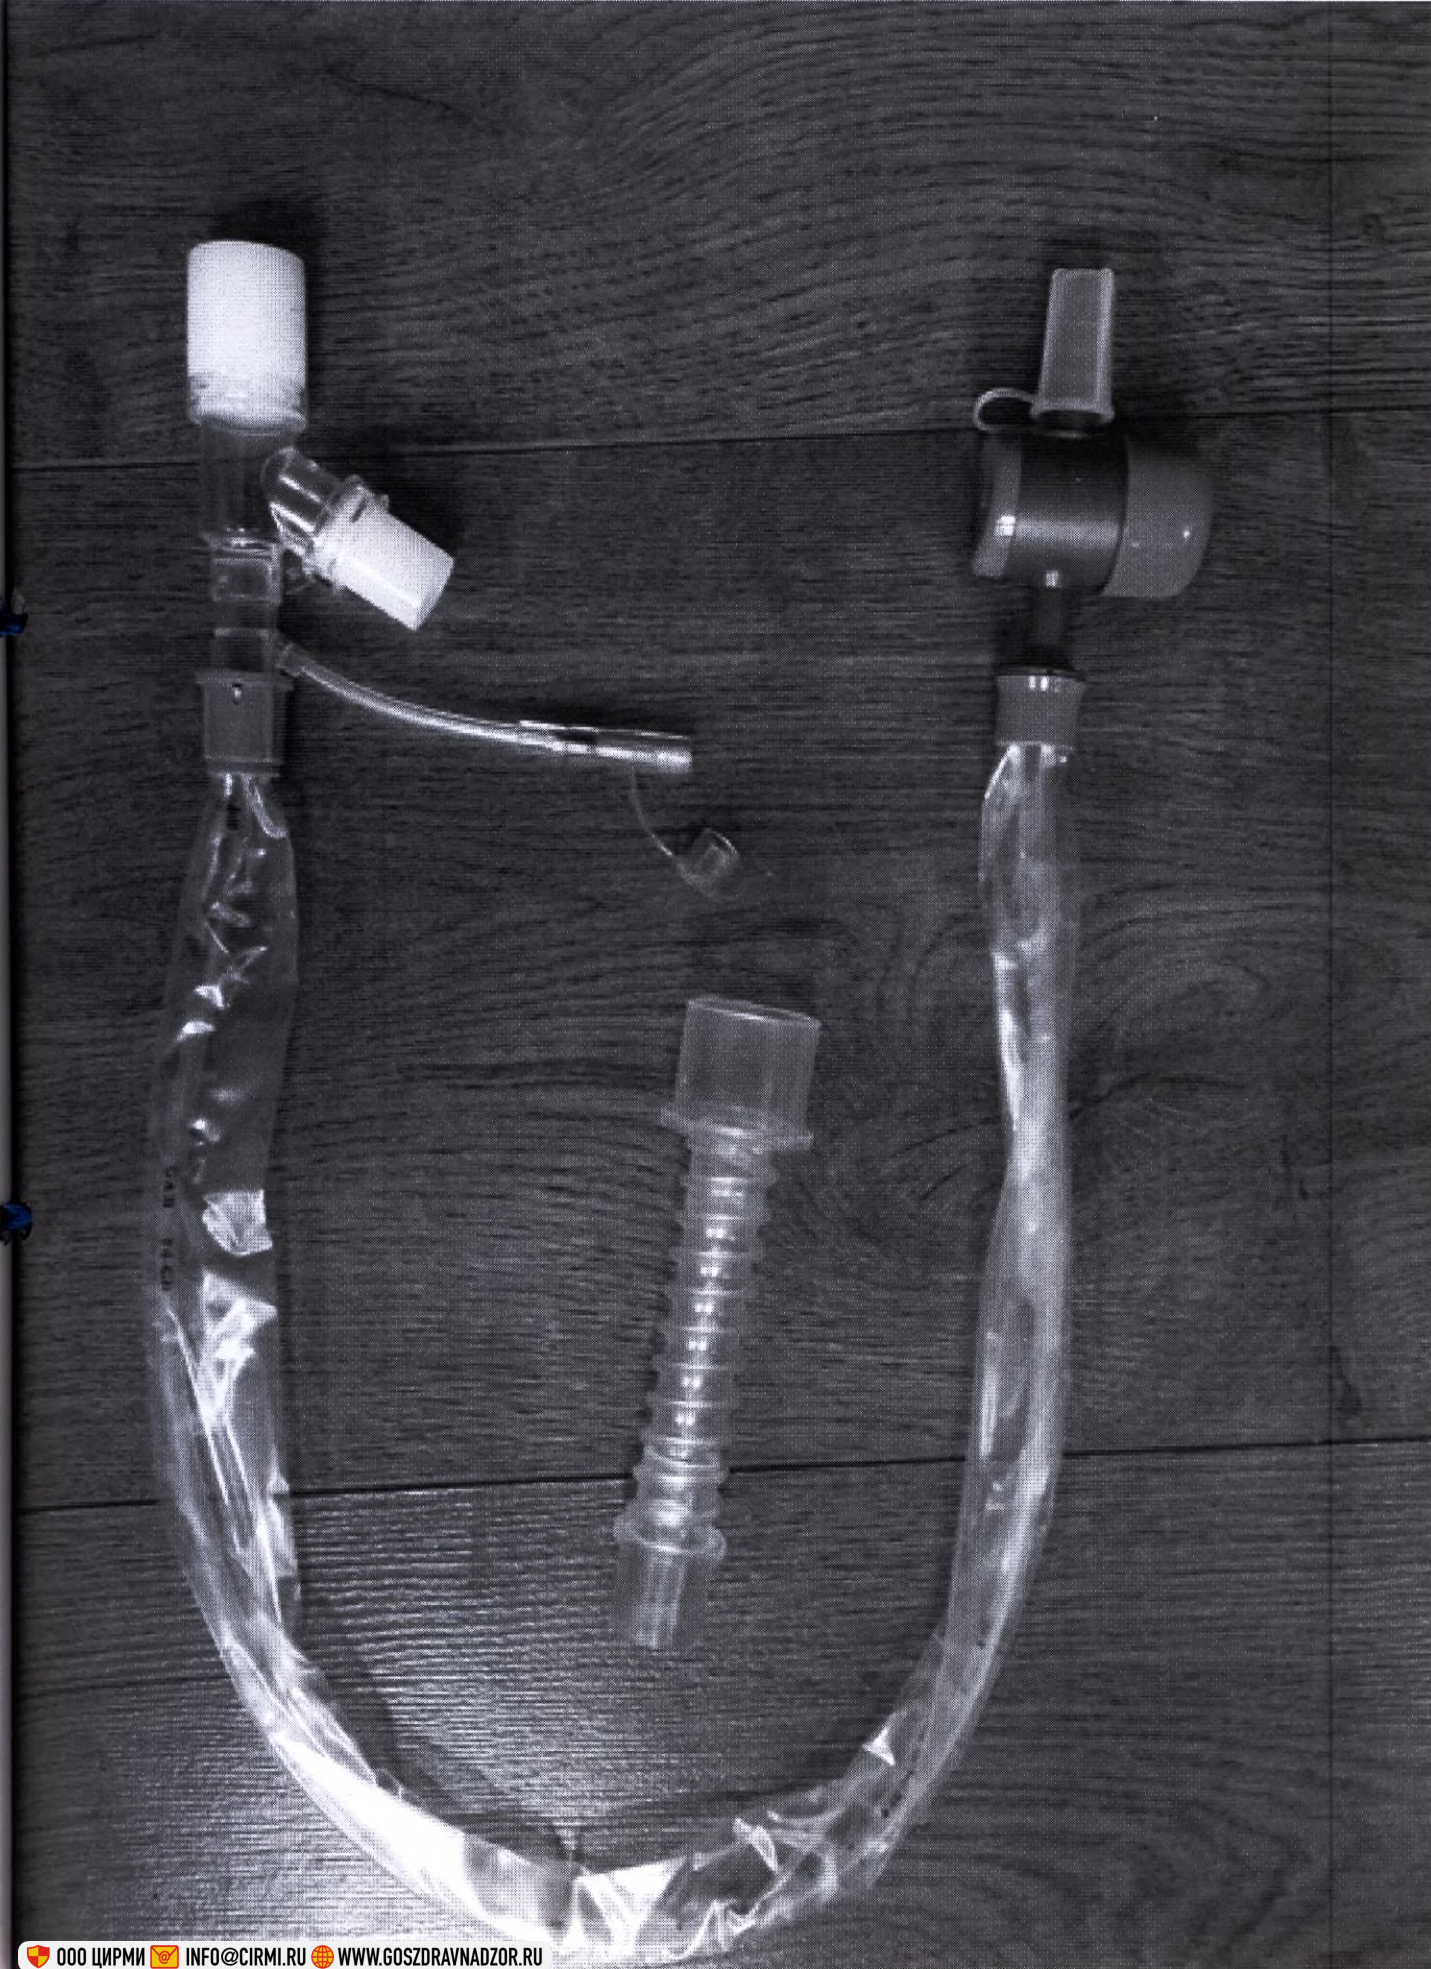


Закрытая система для дренирования DAR, эндотрахеальная длина 16 Fr/Ch (5.33 мм) x 580 мм,

составе:

с клапаном для отсасывания,

шлюза.

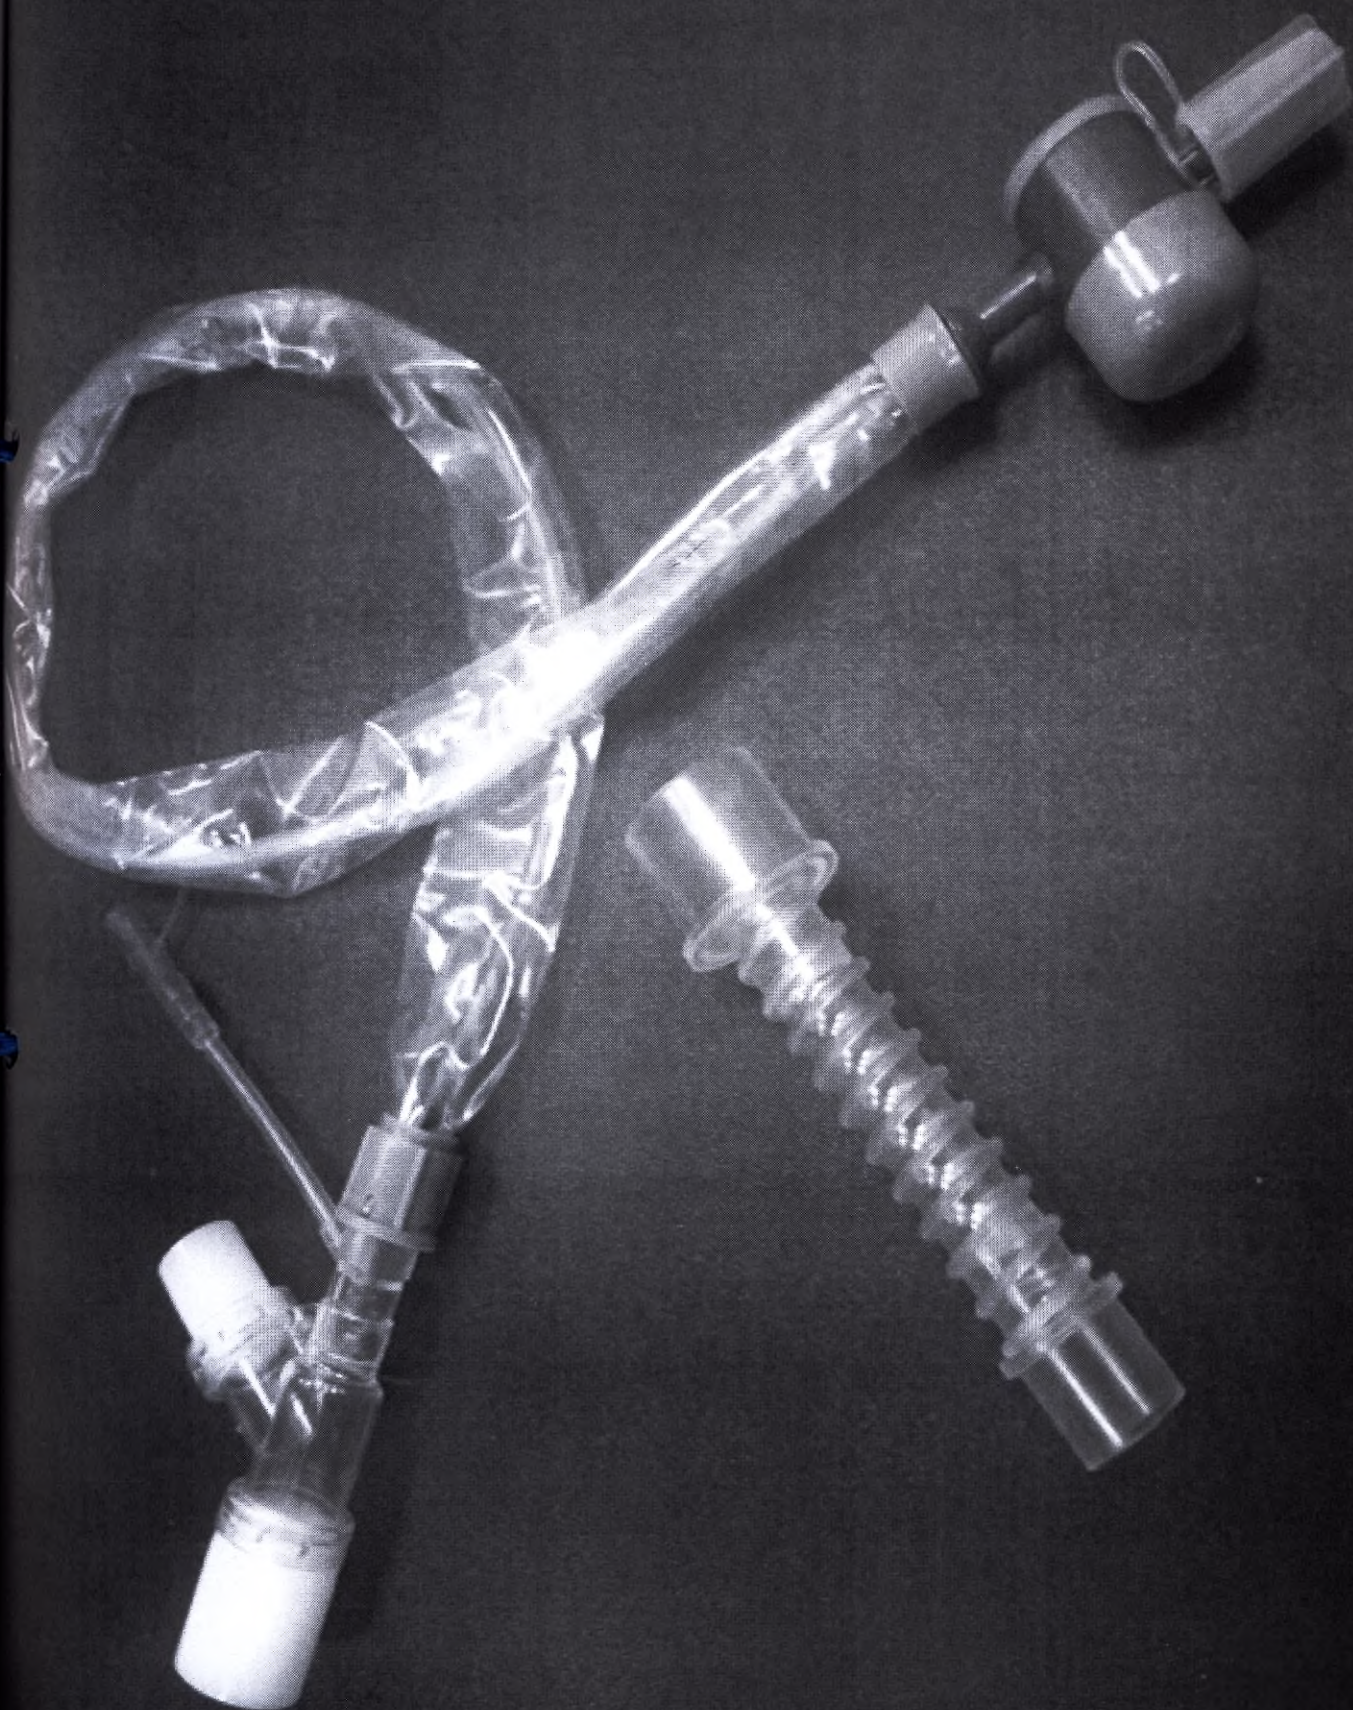

Закрытая система для дренирования DAR, эндотрахеальная длина, порт MDI 12 Fr/Ch (4.00 мм) x 580 мм,
составе:
с клапаном для отсасывания,
рубка.



1. Закрытая система для дренирования DAR, эндотрахеальная длина, порт MDI 14 Fr/Ch (4.67 мм) x 580 мм,
в составе:


катетер с клапаном для отсасывания,
трубка.




2. Закрытая система для дренирования DAR, эндотрахеальная длина, порт MDI 16 Fr/Ch (5.33 мм) x 580 мм,
в составе:
сифон с клапаном для отсасывания,
трубка.




Детская и неонатальная закрытая система для дренирования DAR; соединитель магистрали 5 Fr/Ch (1.67 мм)
10 мм,
в составе:
аппарат с клапаном для отсасывания,
соединитель магистрали.

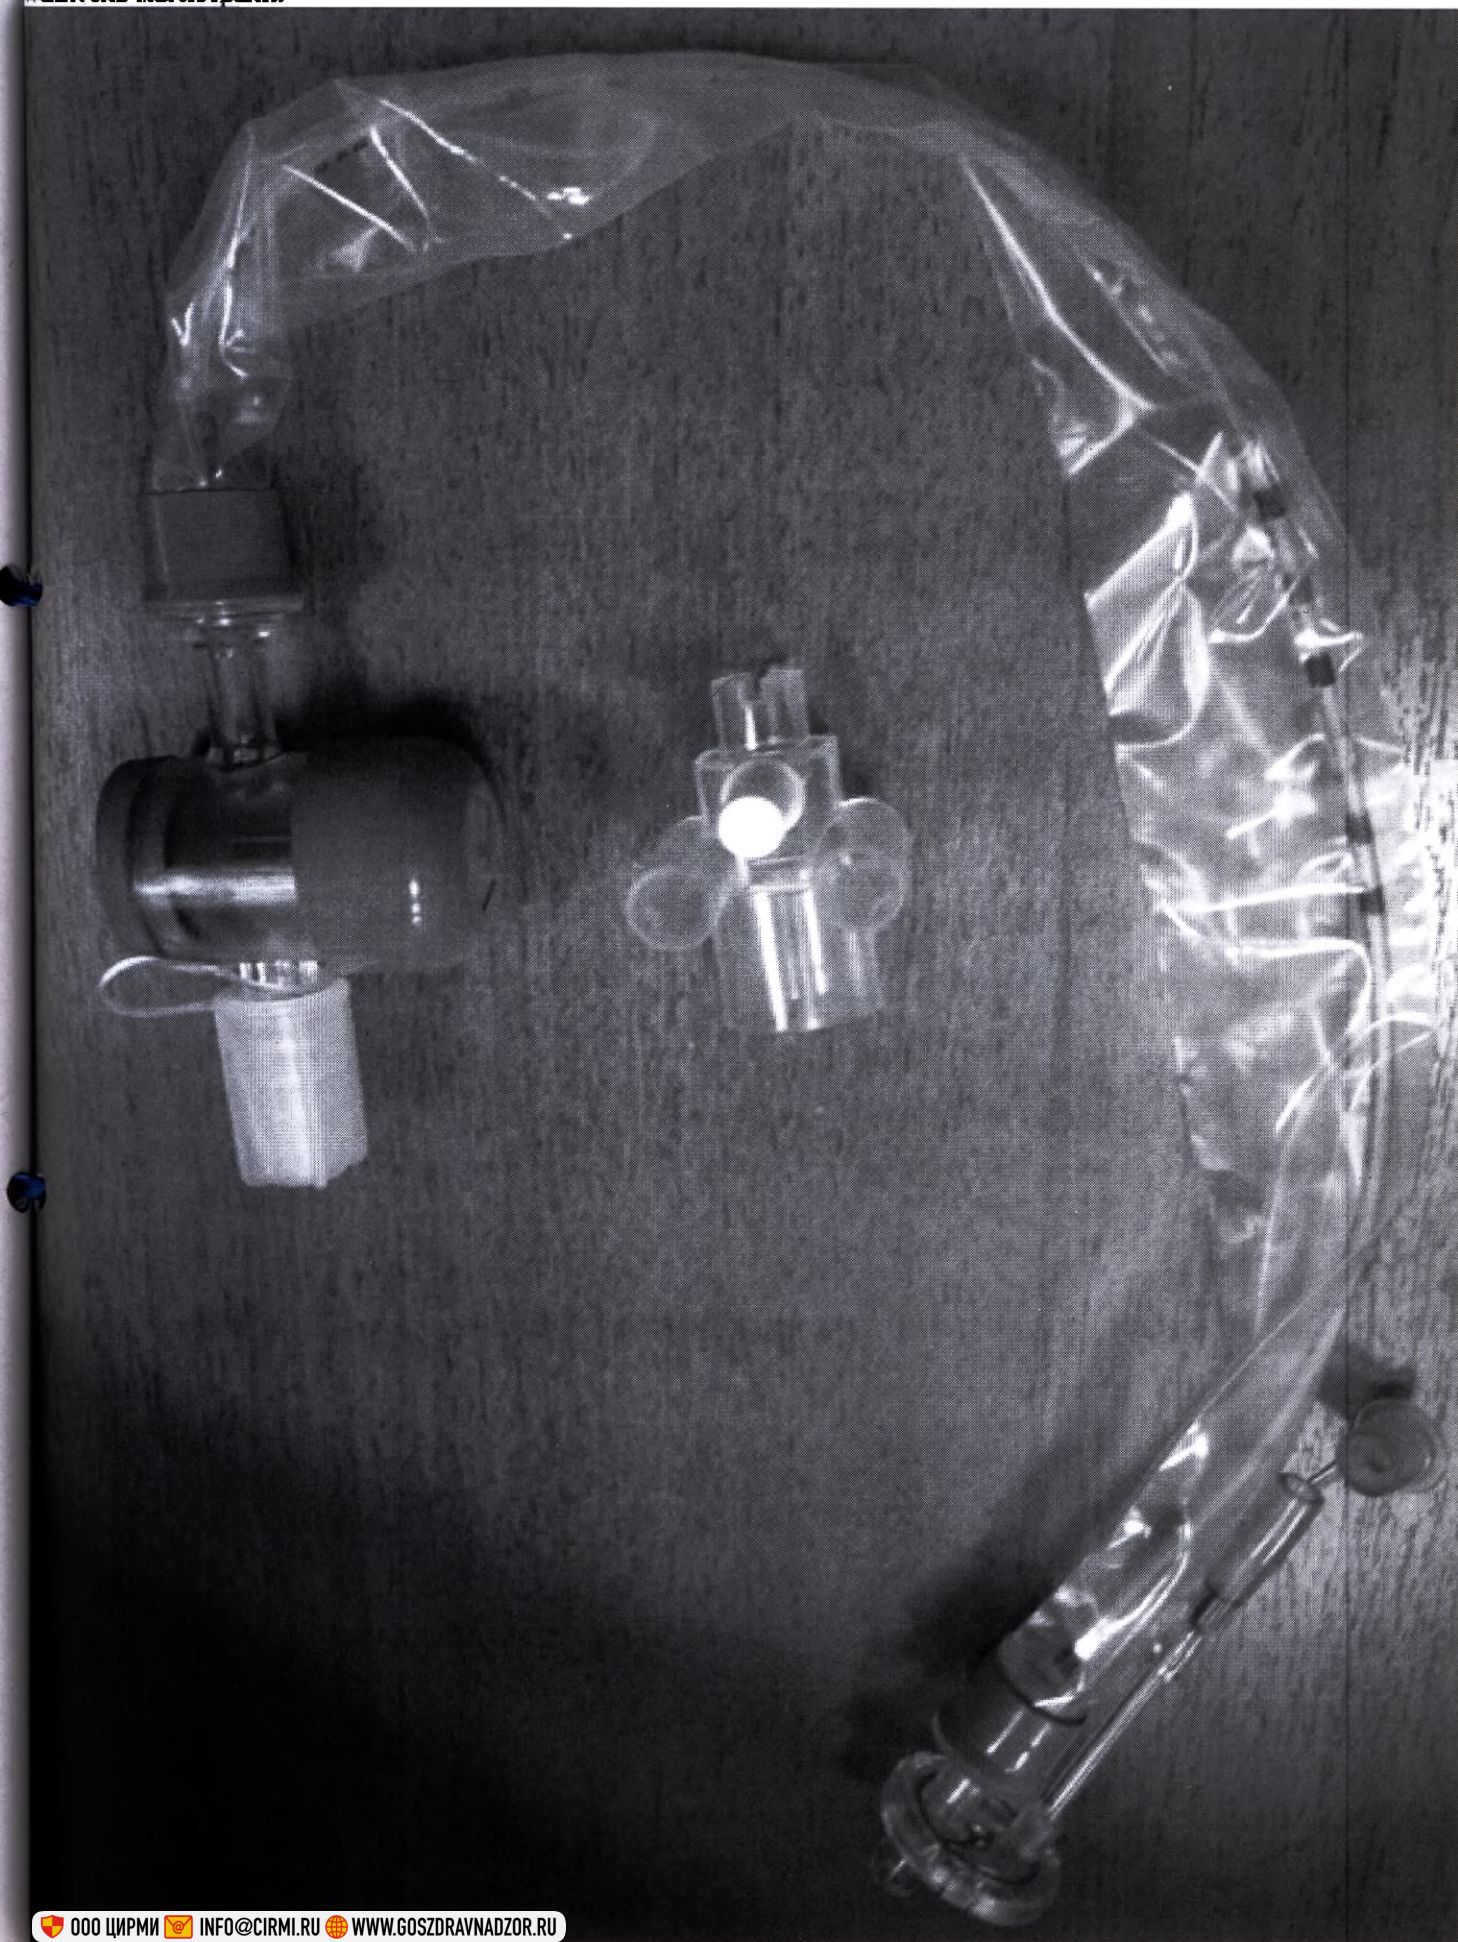

Детская и неонатальная закрытая система для дренирования DAR; соединитель магистрали 6 Fr/Ch (2.00 мм) х
м,
ставе:
тер с клапаном для отсасывания,
инитель магистрали.

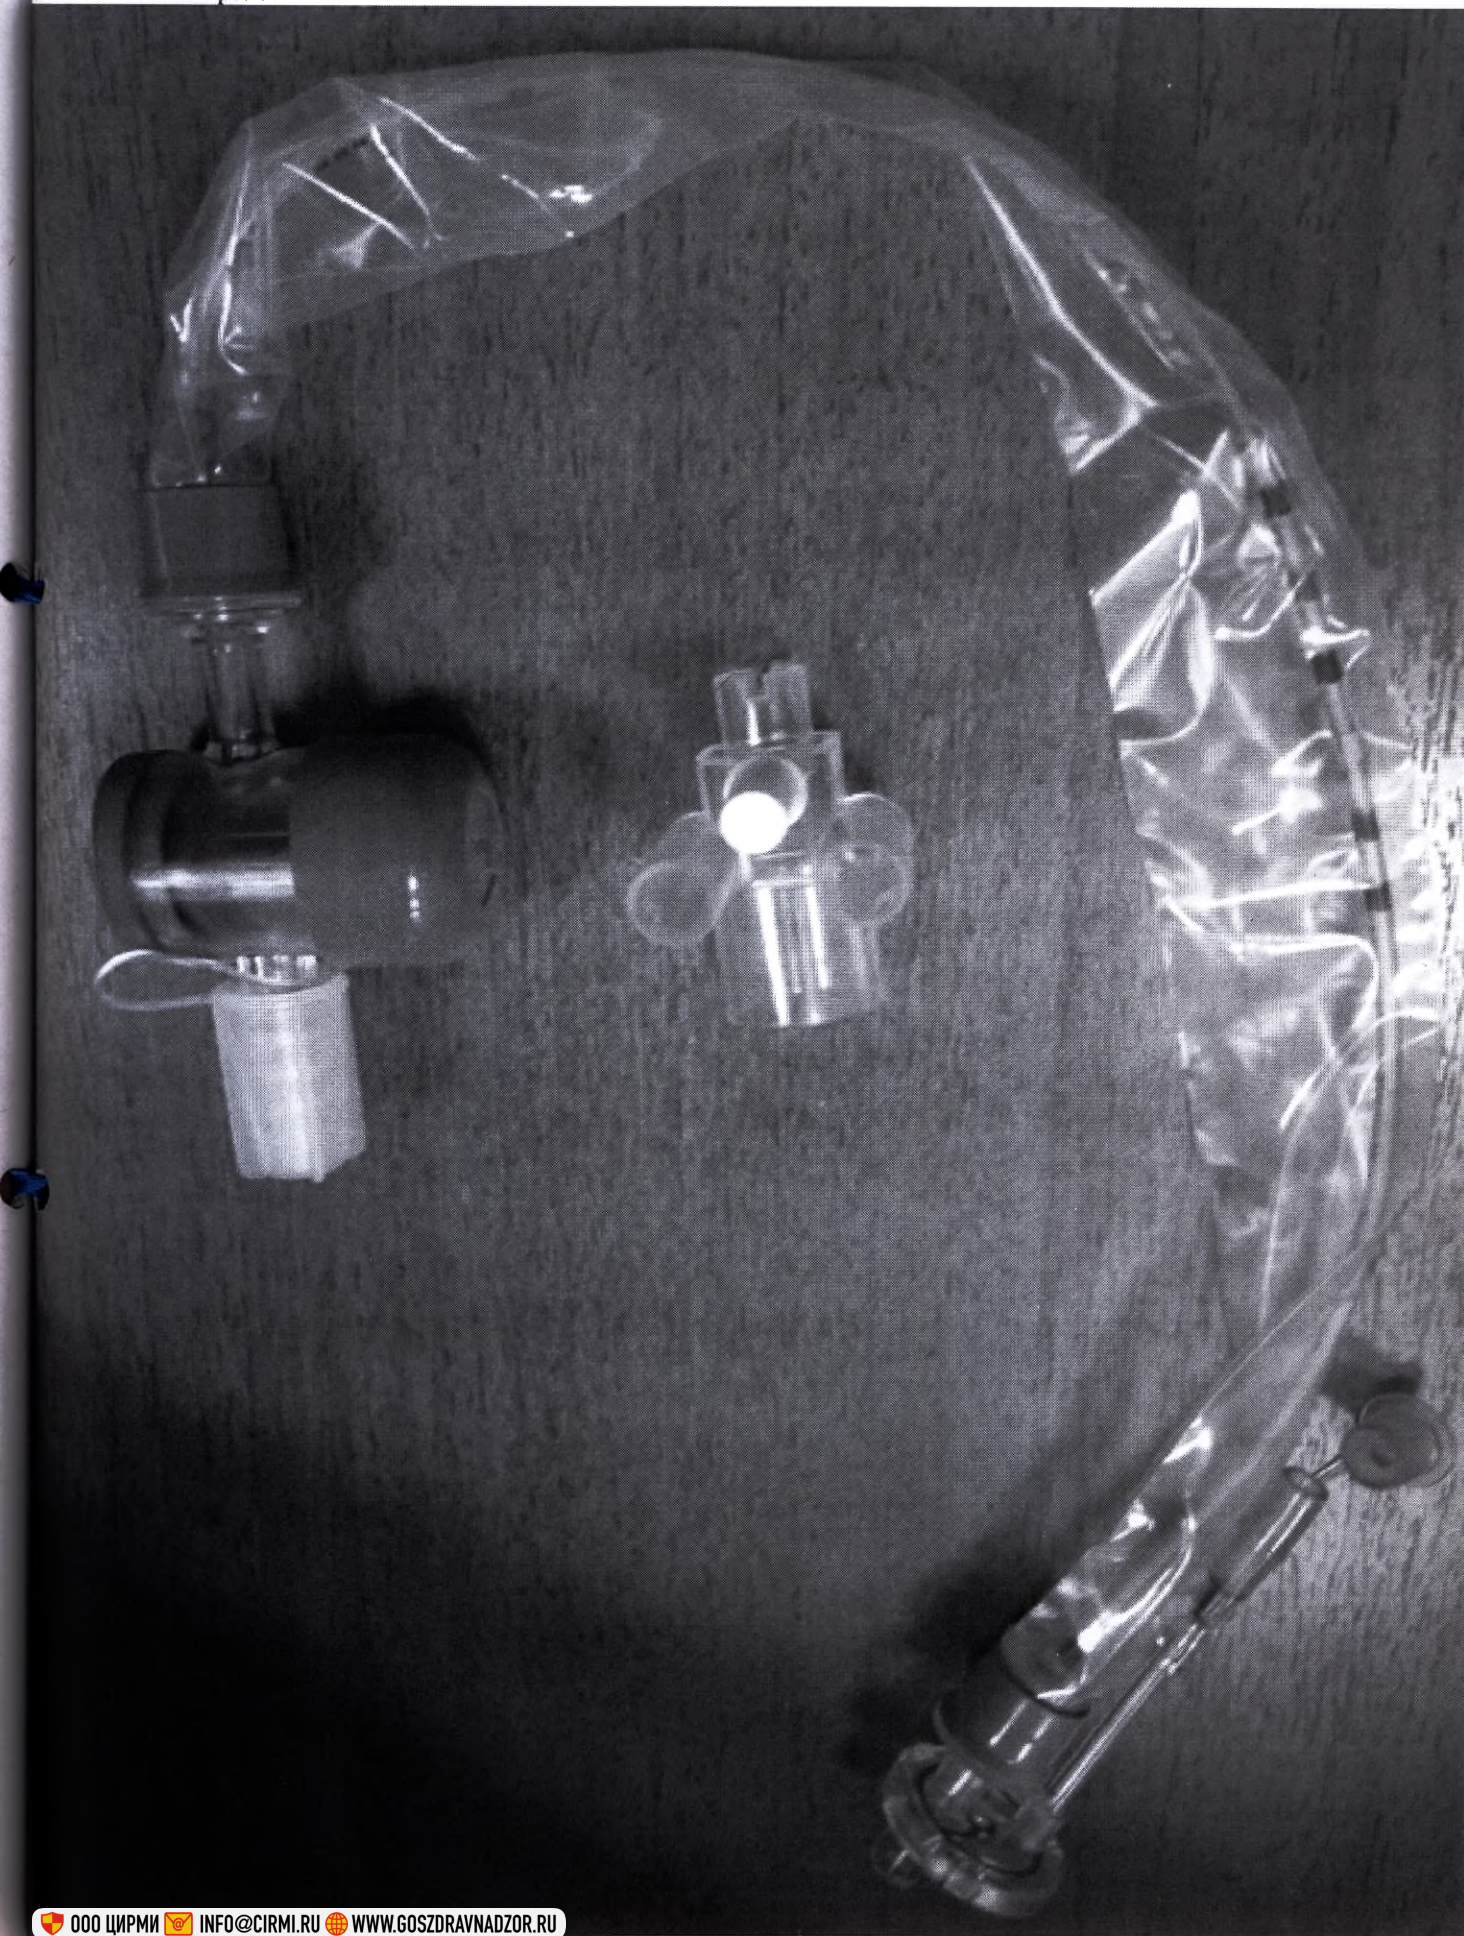

Детская и неонатальная закрытая система для дренирования DAR; соединитель магистрали 8 Fr/Ch (2.67 мм) x
м,
ставе:
дер с клапаном для отсасывания,
инитель магистрали.

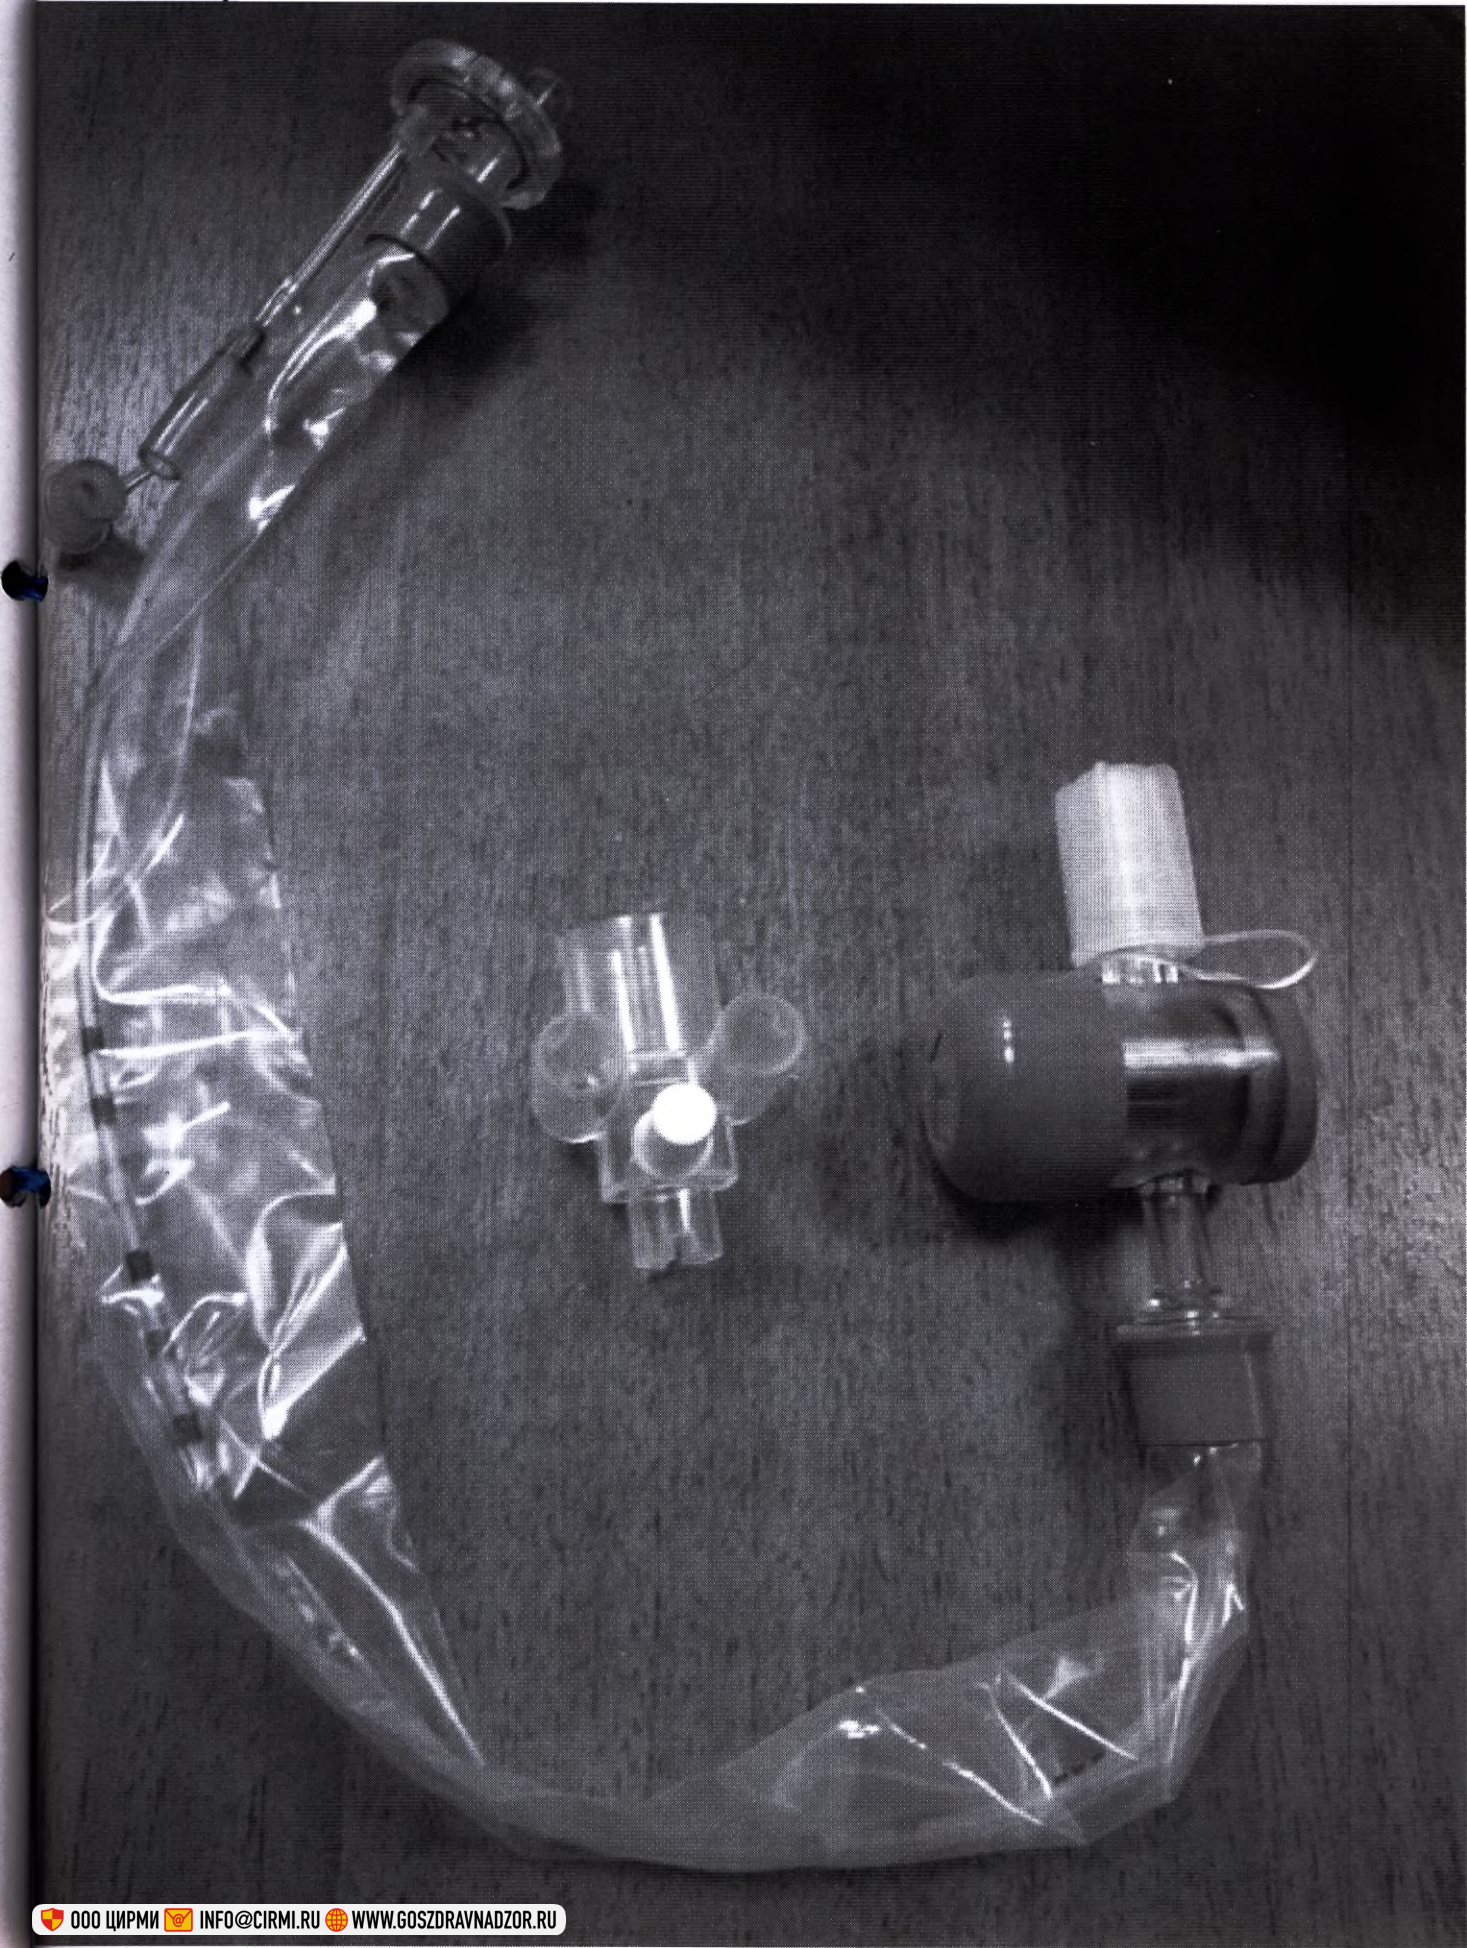


Закрытая система для дренирования DAR, сменный катетер; эндотрахеальная длина, порт MDI 10 Fr/Ch (3.33 мм
10 мм,
оставе:
катетер с клапаном для отсасывания,
рыбка на катетер,
убка.




Закрытая система для дренирования DAR, сменный катетер; эндотрахеальная длина, порт MDI 12 Fr/Ch (4.00 мм)
0 мм,
составе:
етер с клапаном для отсасывания,
ышка на катетер,
бка.



3. Закрытая система для дренирования DAR, сменный катетер; эндотрахеальная длина, порт MDI 14 Fr/Ch (4.67 м) x 580 мм,
в составе:
катетер с клапаном для отсасывания,
крышка на катетер,
трубка.

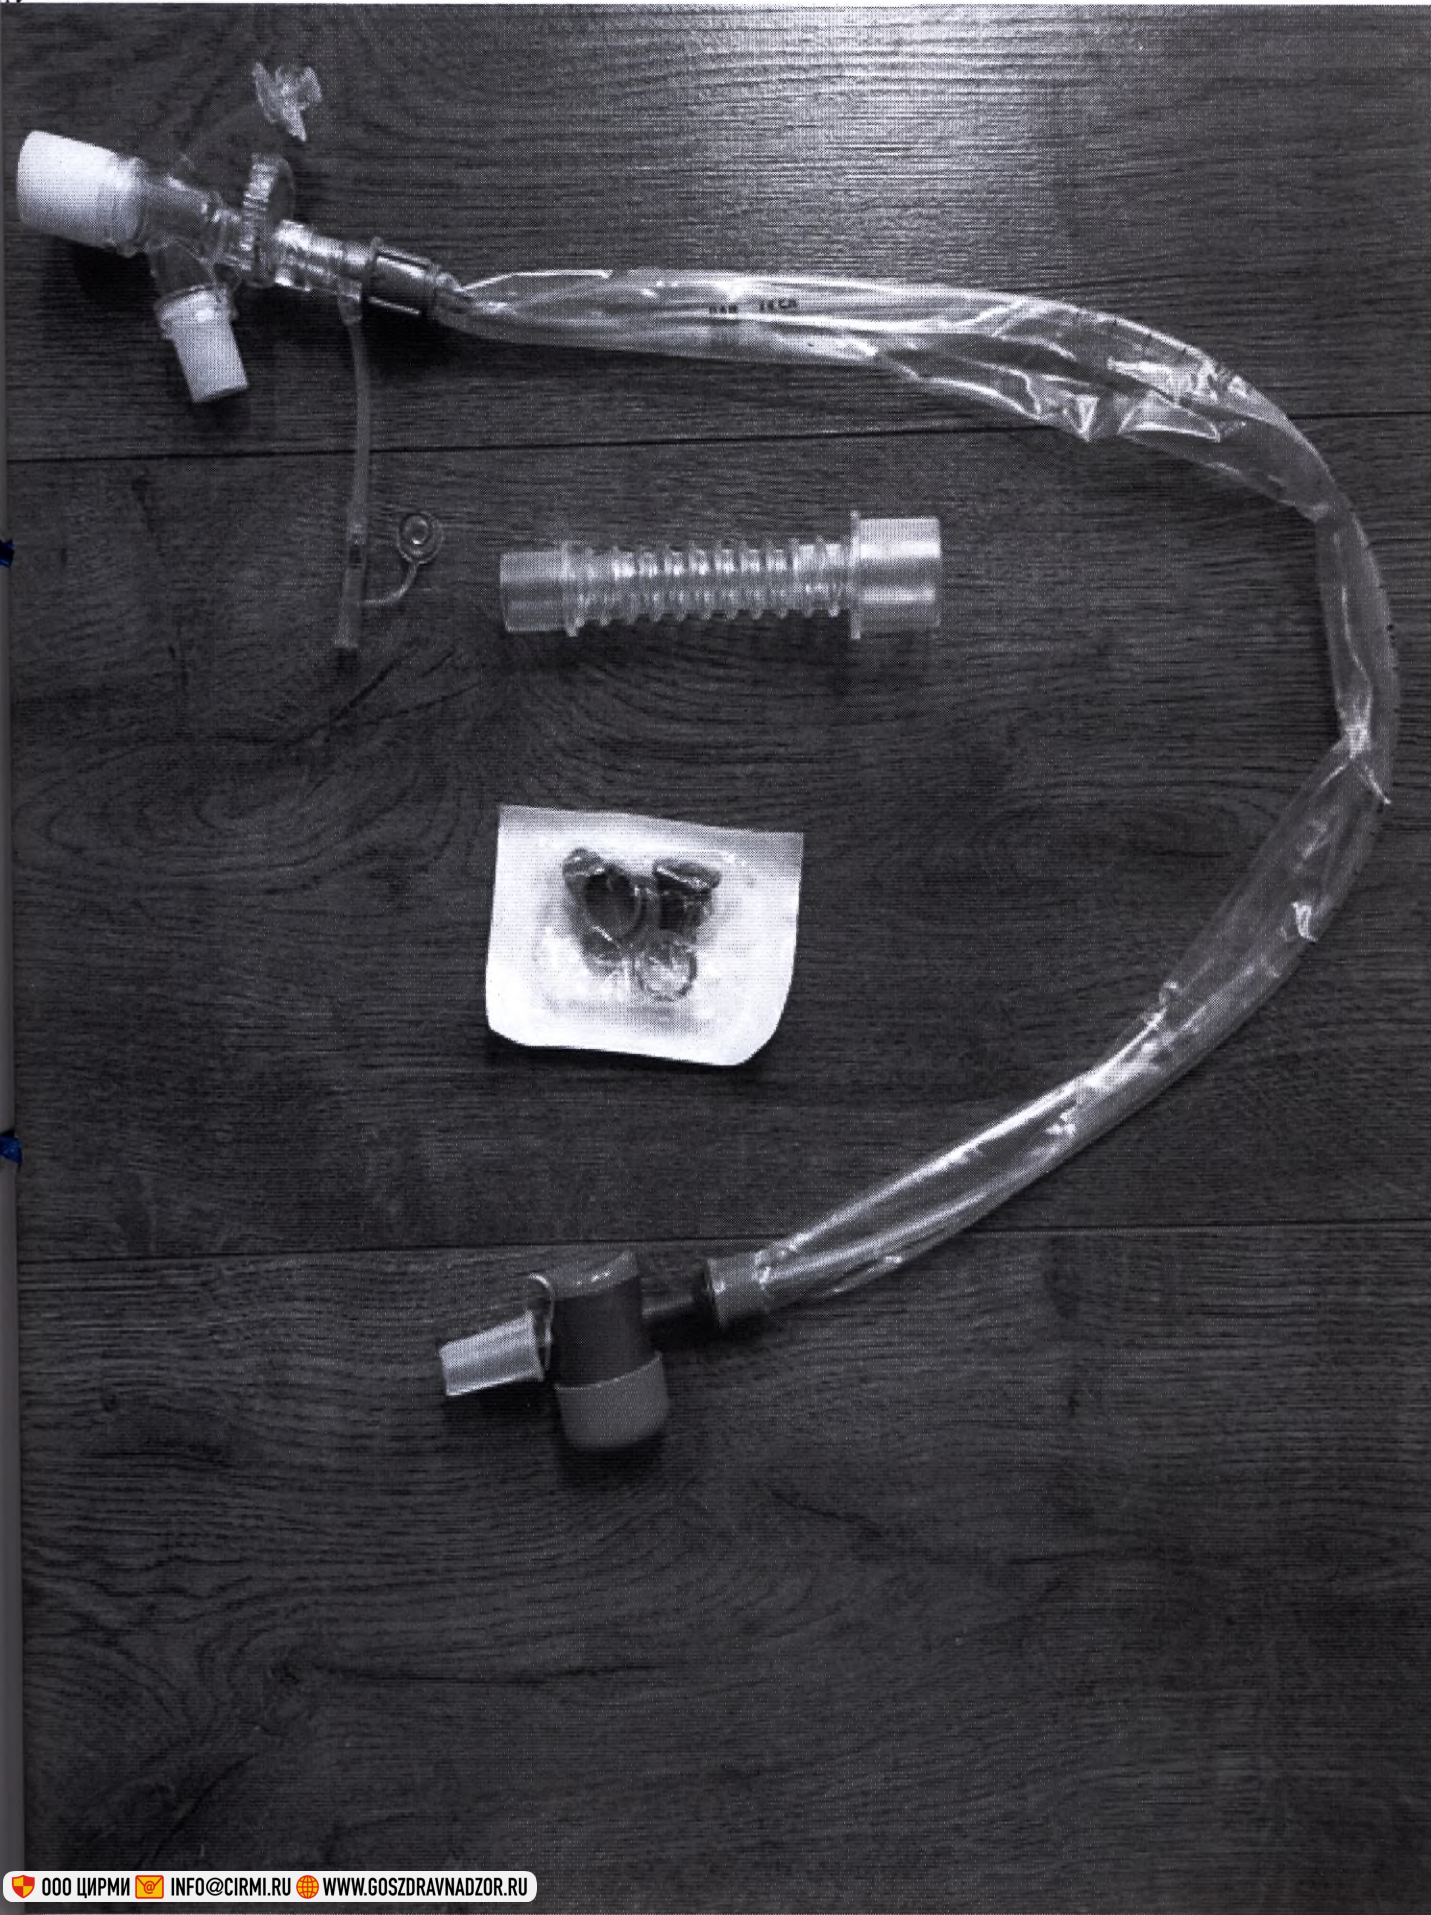


Закрытая система для дренирования DAR, сменный катетер; эндотрахеальная длина, порт MDI 16 Fr/Ch (5.33 мм
мм,
ставе:
тер с клапаном для отсасывания,
шка на катетер,
шка.

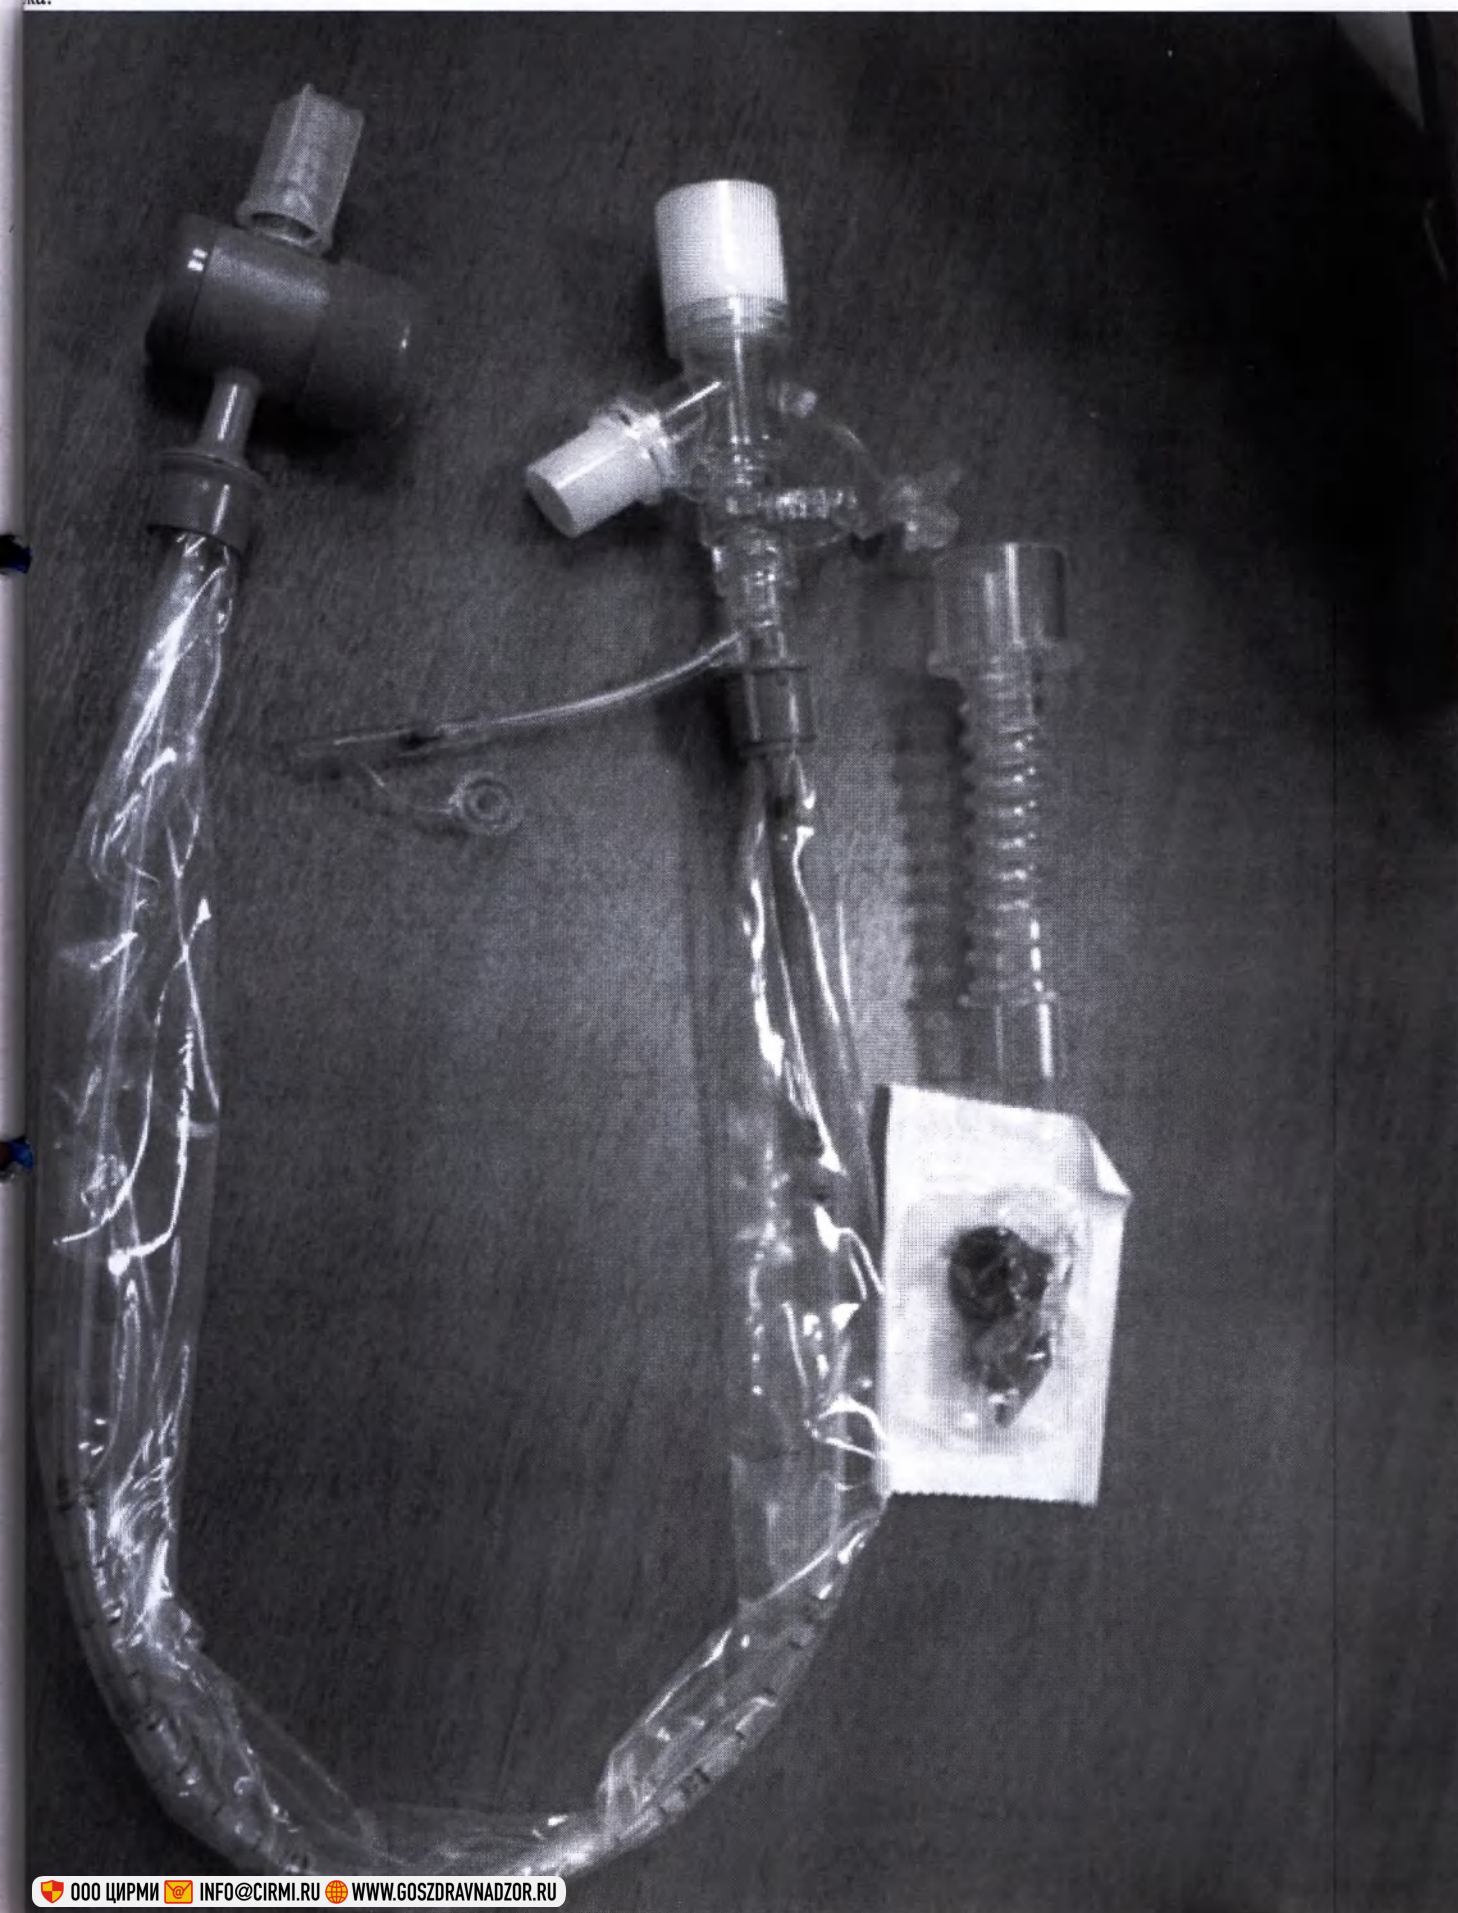

Закрытая система для дренирования DAR, сменный катетер; трахеостомическая длина, порт MDI 12 Fr/Ch (4.00
365 мм,
ставе:
тер с клапаном для отсасывания,
шпка на катетер.




1. Закрытая система для дренирования DAR, сменный катетер; трахеостомическая длина, порт MDI 14 Fr/Ch (4.67
м) x 365 мм,
составе:
катетер с клапаном для отсасывания,
крышка на катетер.

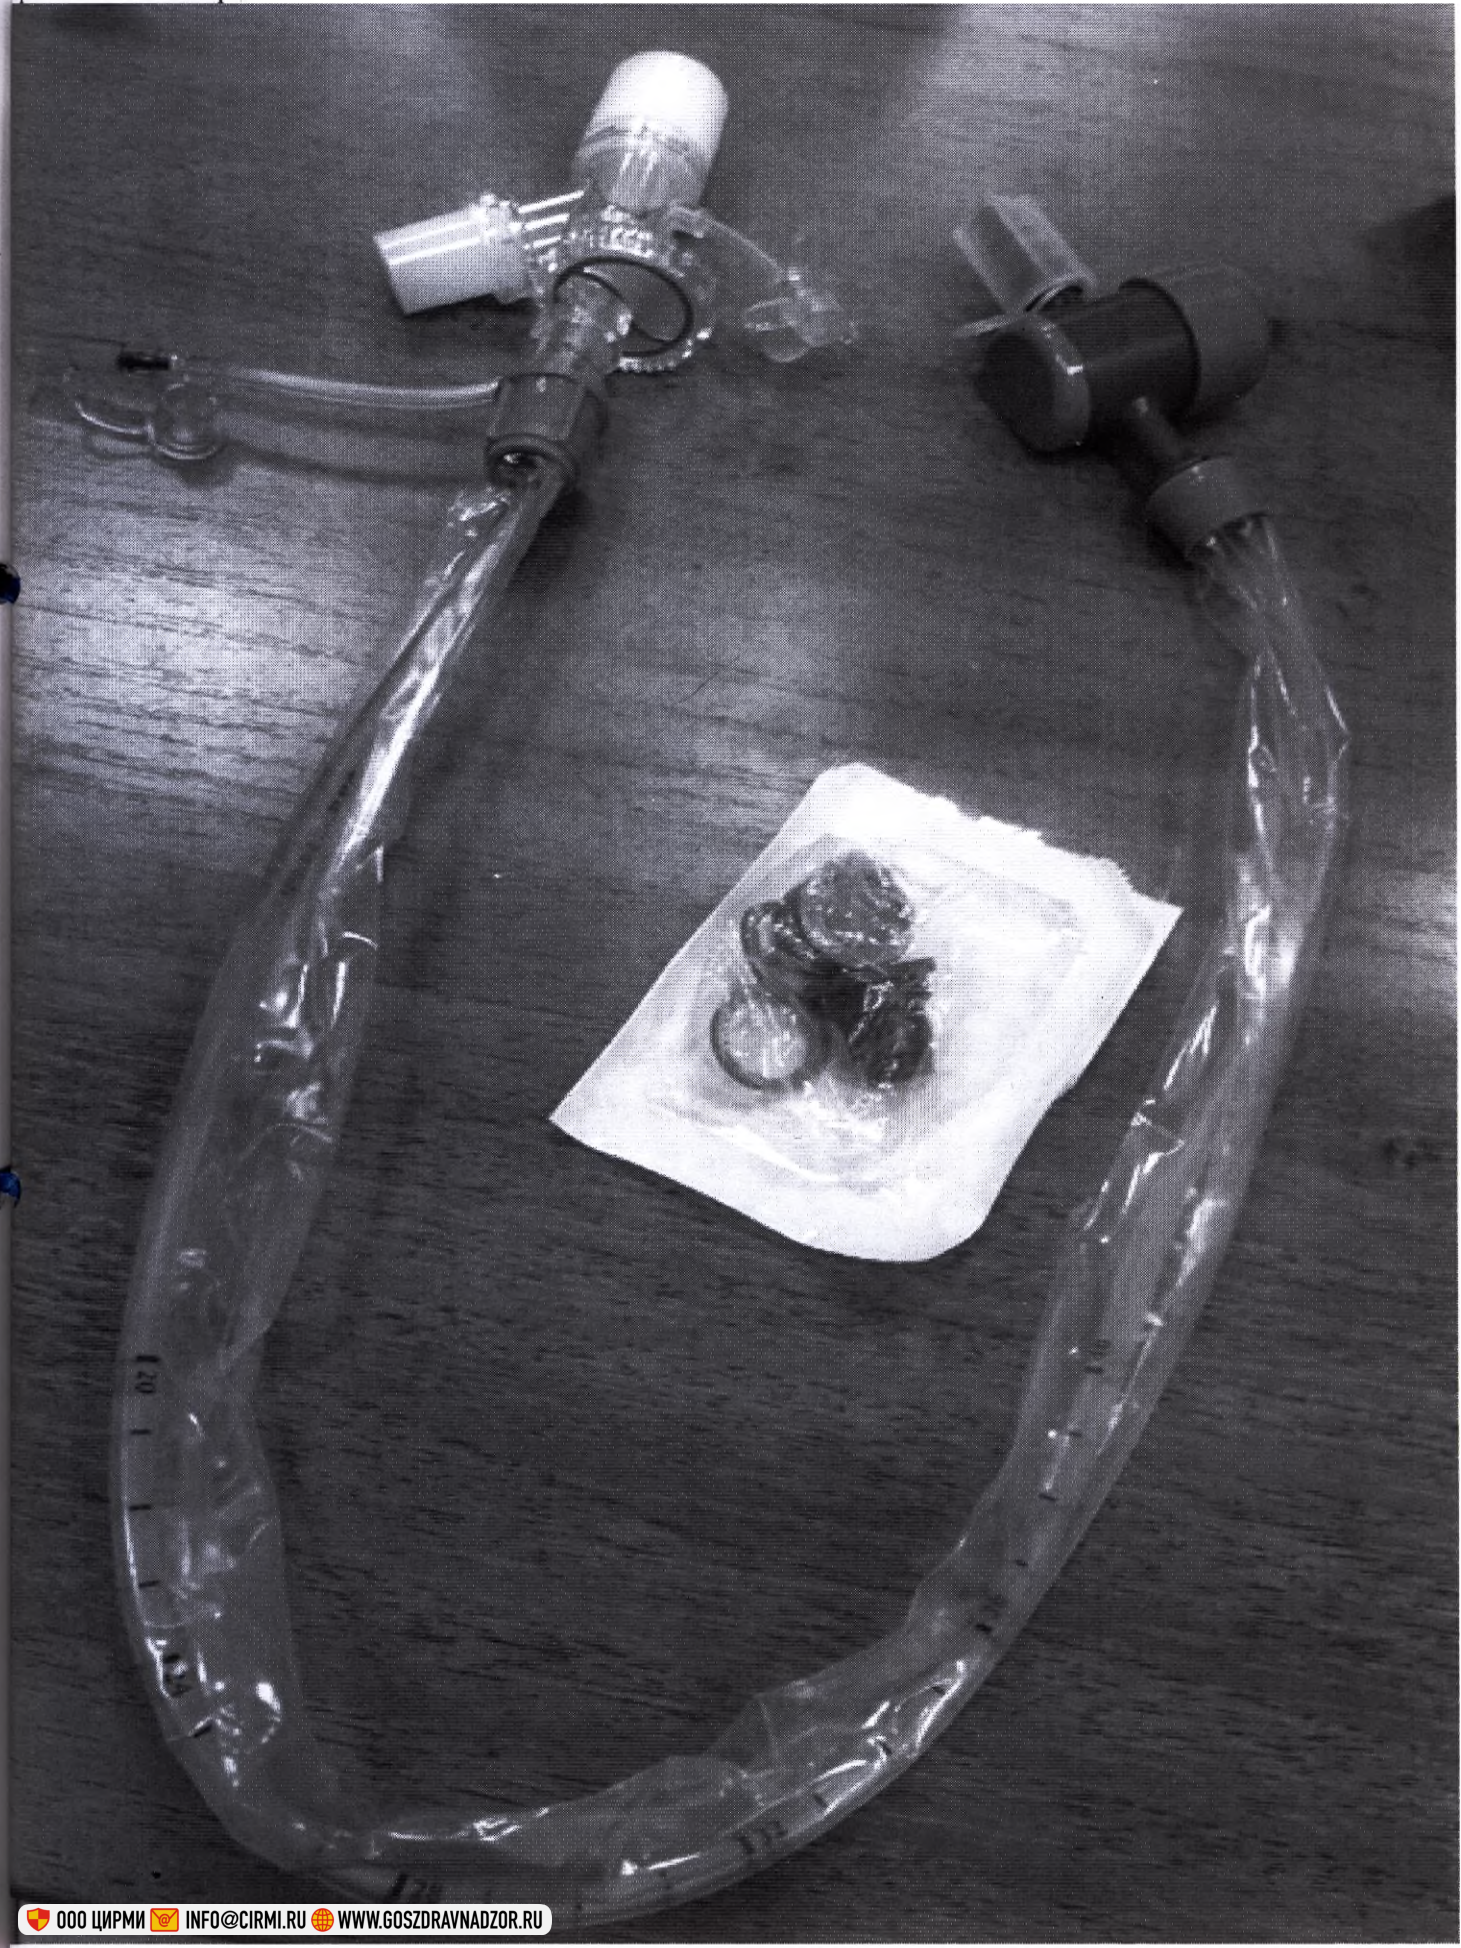

Детская и неонатальная закрытая система для дренирования DAR, Y-образный соединитель 5 Fr/Ch (1.67 мм) x 31'


в составе:

аспиратор с клапаном для отсасывания,
Y-образный соединитель объем 2,0 мл,
T-образный соединитель объем 2,5 мл.

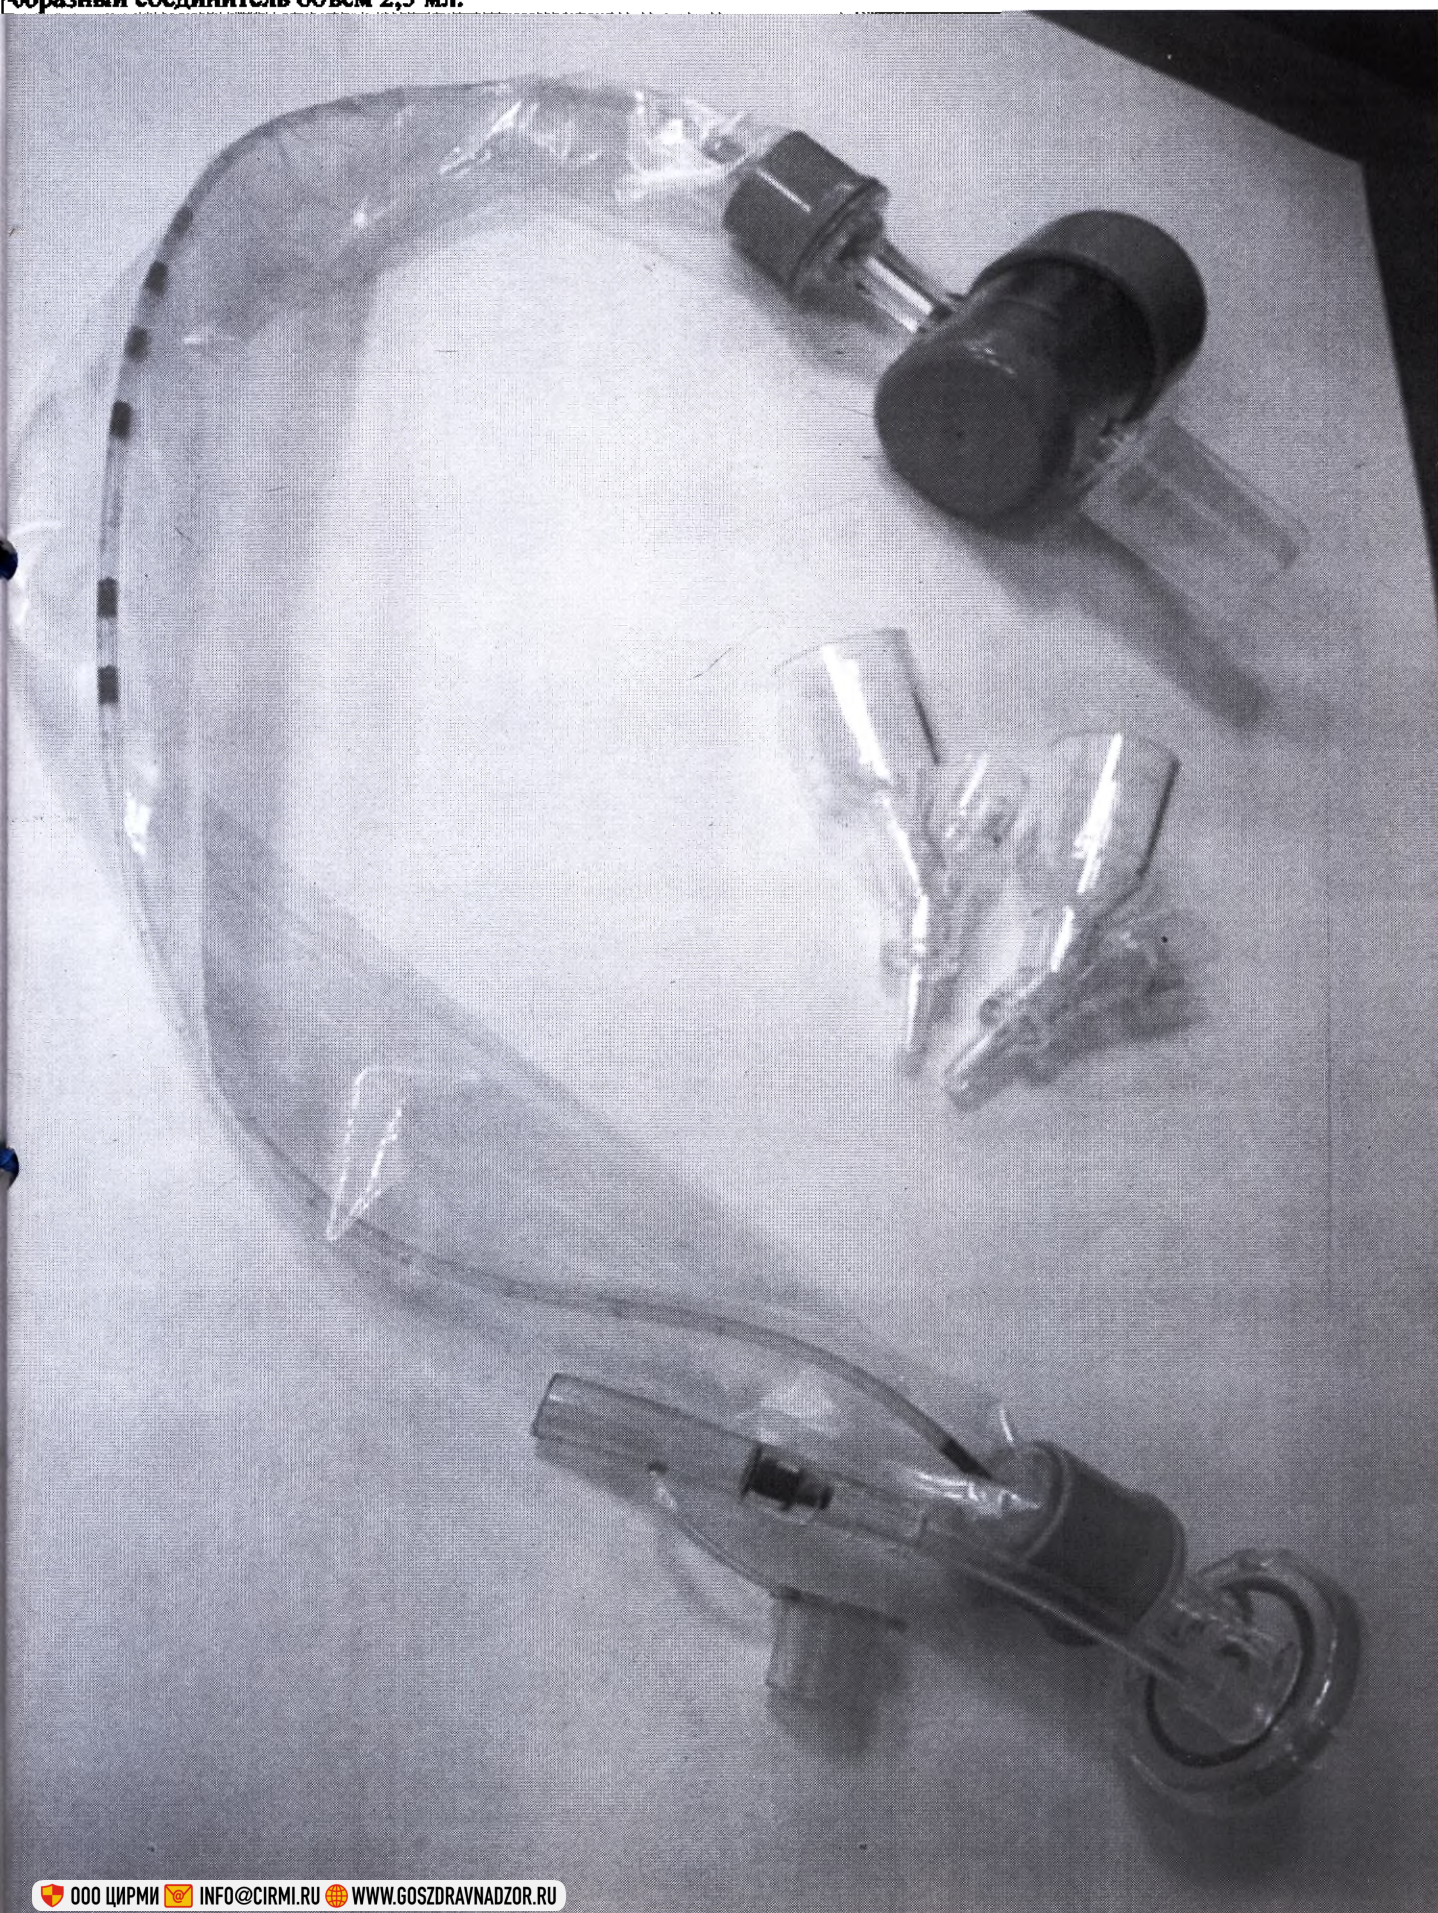

детская и неонатальная закрытая система для дренирования DAR, Y-образный соединитель 6 Fr/Ch (2.00 мм) x 320 мм в составе:

сифон с клапаном для отсасывания,
Y-образный соединитель объем 2,5 мл,
Y-образный соединитель объем 3,0 мл,
Y-образный соединитель объем 3,5 мл.

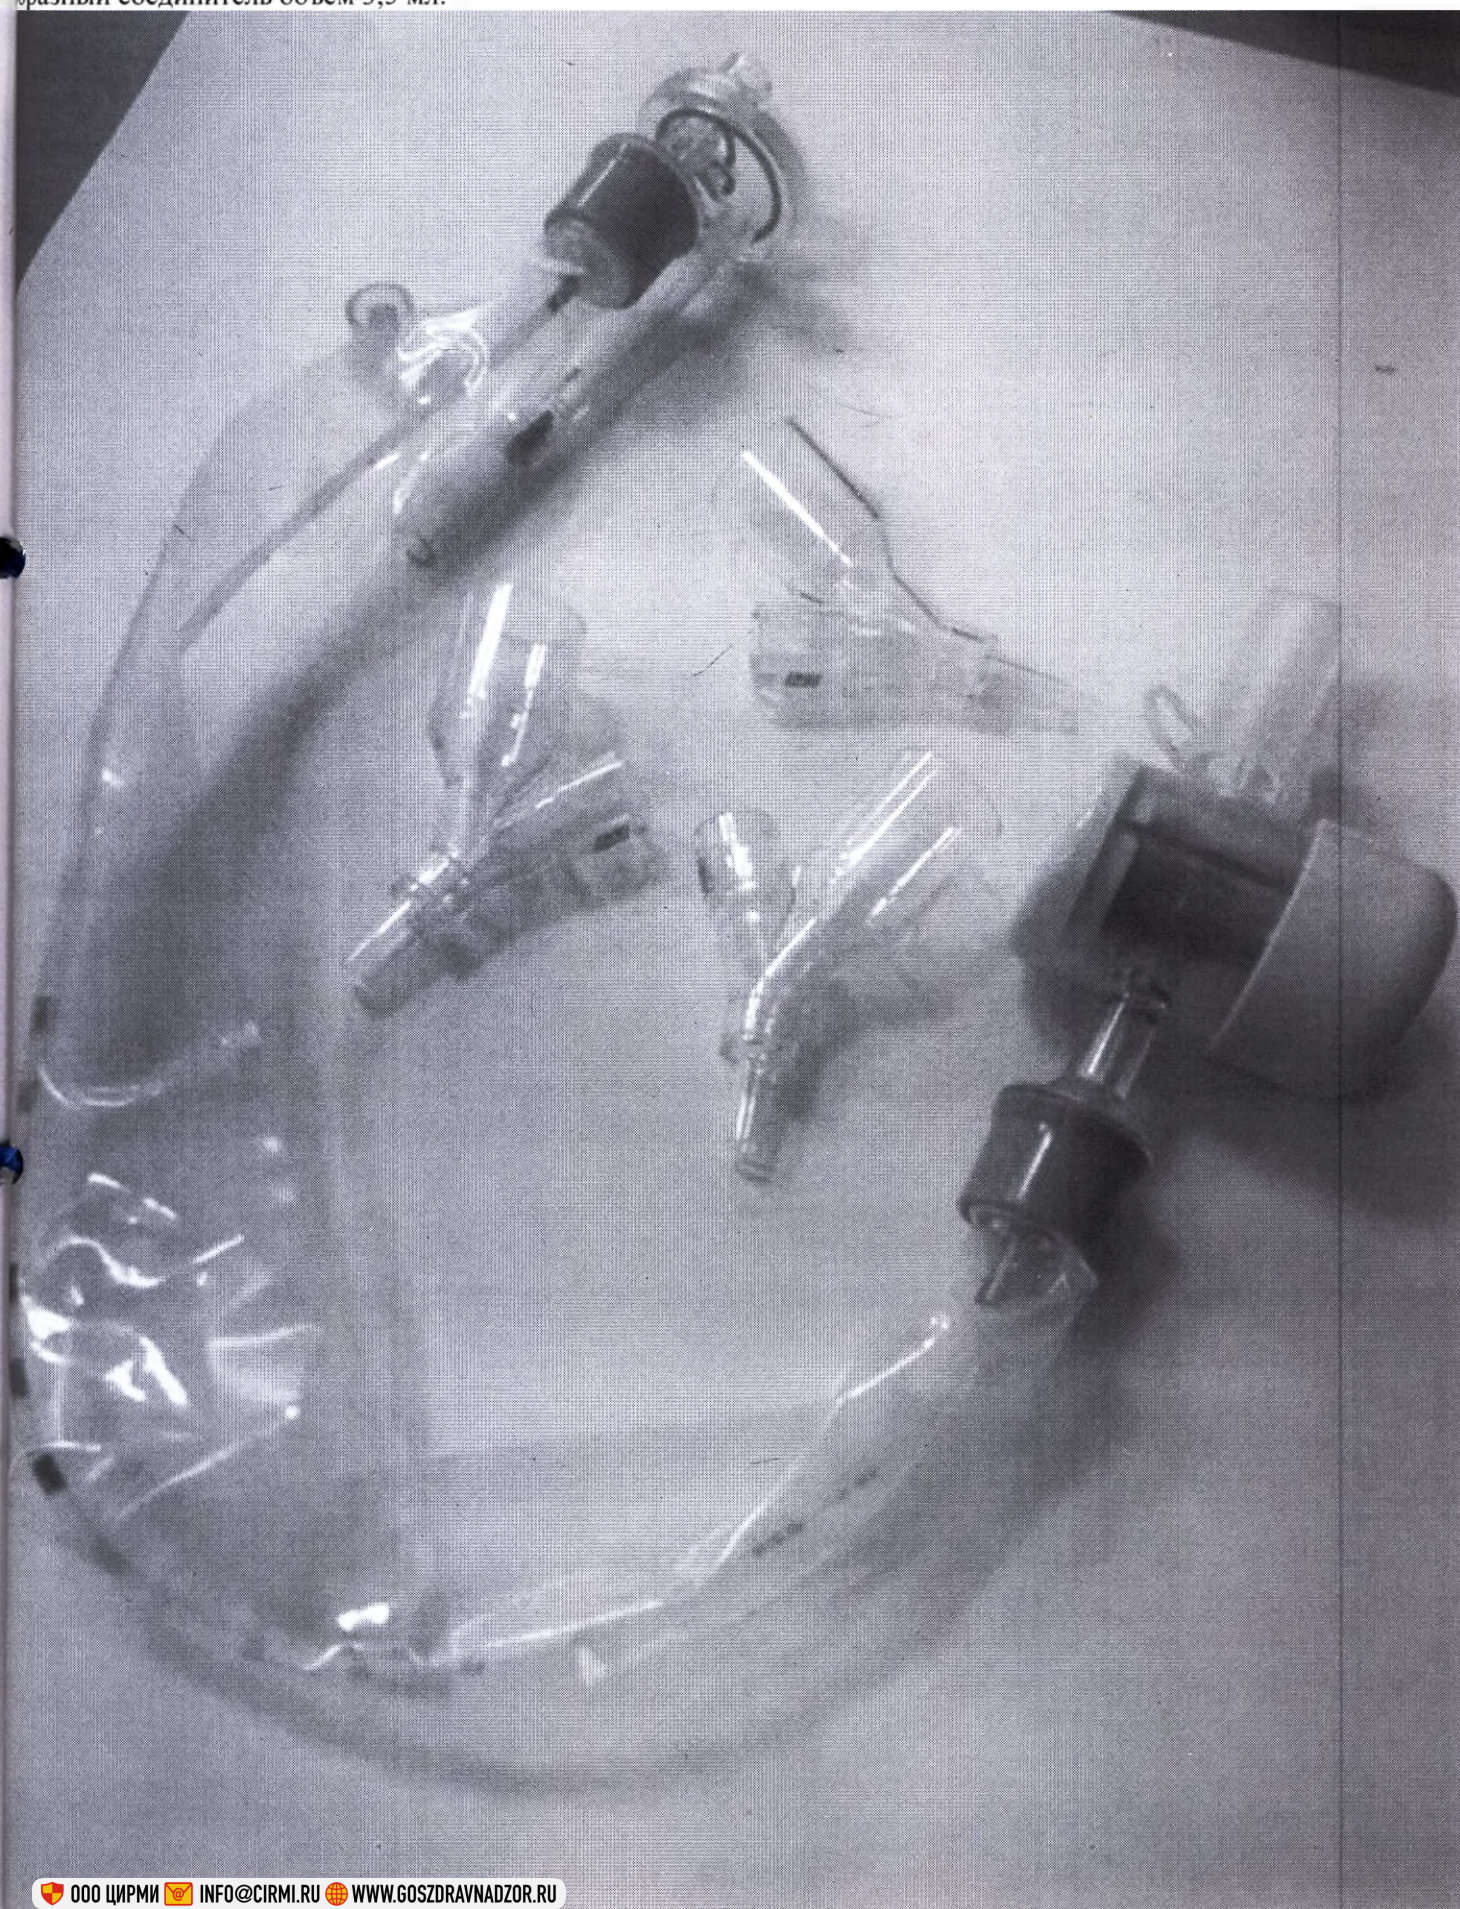

детская и неонатальная закрытая система для дренирования DAR, Y-образный соединитель 7 Fr/Ch (2.33 мм) x 320 мм в составе:

- клапан для отсасывания,
- Y-образный соединитель объем 3,0 мл,
- Y-образный соединитель объем 3,5 мл,
- Y-образный соединитель объем 4,0 мл.



ставе:


тер с клапаном для отсасывания,
Y-образный соединитель объем 3,5 мл,
Y-образный соединитель объем 4,0 мл,
Y-образный соединитель объем 4,5 мл.



Детская и неонатальная закрытая система для дренирования DAR, Y-образный соединитель 10 Fr/Ch (3.33 мм) x
мм,
ставе:
пер с клапаном для отсасывания,
бразный соединитель объем 4,5 мл,
бразный соединитель объем 5,0 мл,
бразный соединитель объем 5,5 мл.



Детская и неонатальная закрытая система для дренирования DAR, коленчатый соединитель 8 Fr/Ch
7 мм) x 360 мм,
ставе:
стер с клапаном для отсасывания,
енчатый соединитель.

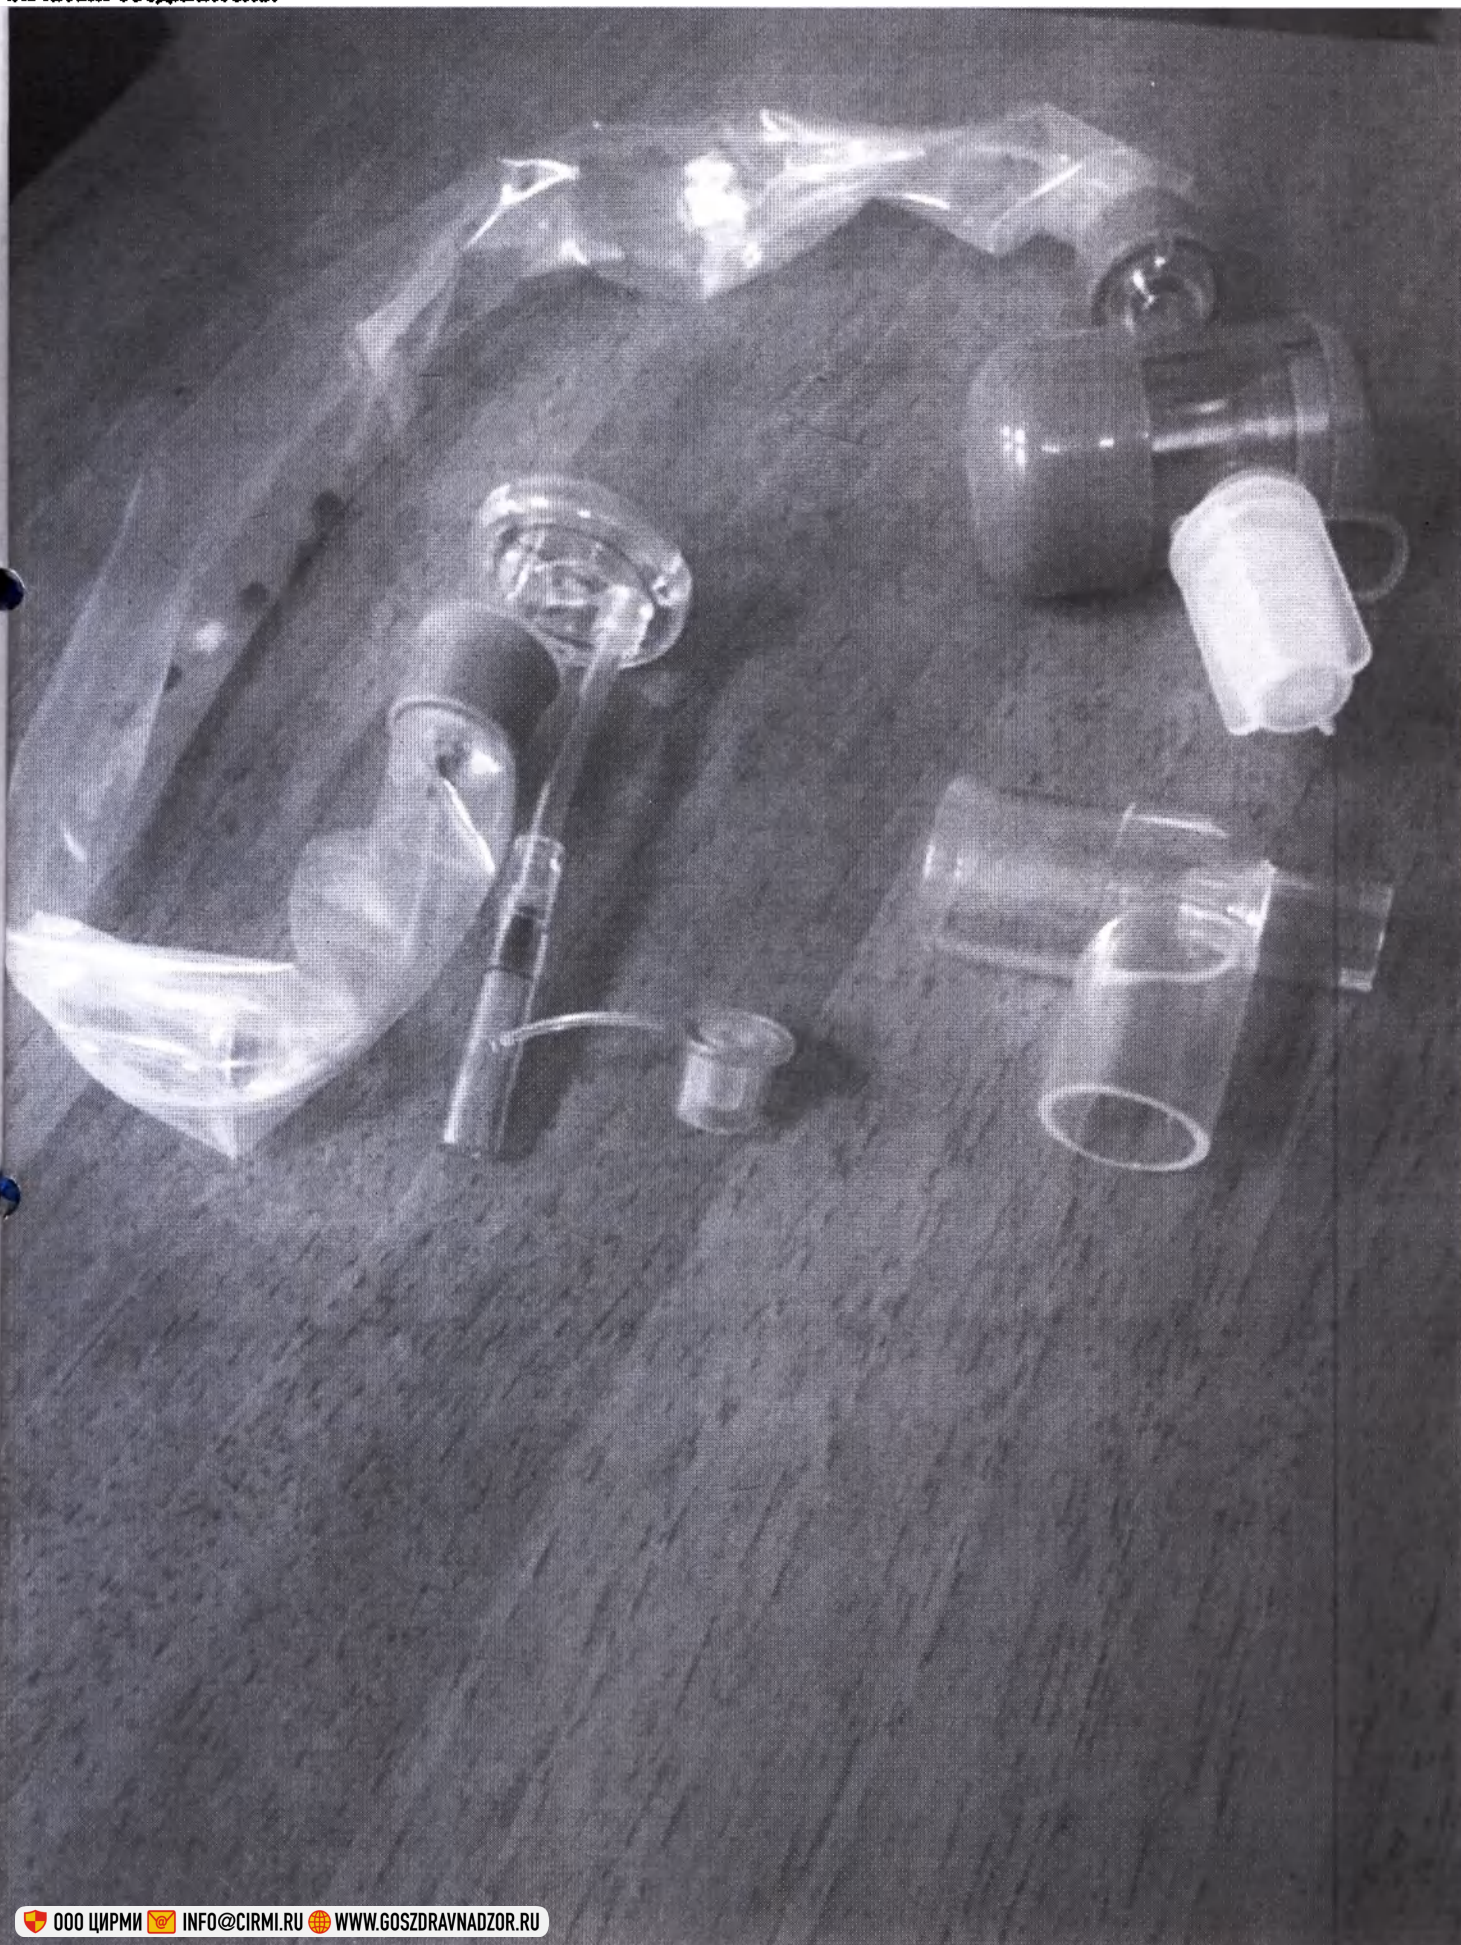

Образец русскоязычного стикера

Название медицинского изделия	
Производитель:	Код UPN
Страна происхождения:	REF
Представитель производителя в РФ:	
Регистрационное Удостоверение № _____ от _____	
Серия/Годен до:	См. Инструкцию
см. упаковку	См. символы на упаковке

Пример русскоязычного стикера МИ «Закрытая система для дренирования DAR в вариантах исполнения».

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью ООО "Медтроник"
29 листа(ов)

