


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к *Toxoplasma gondii* (ВектоТоксо-IgG-авидность)»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2021 г.

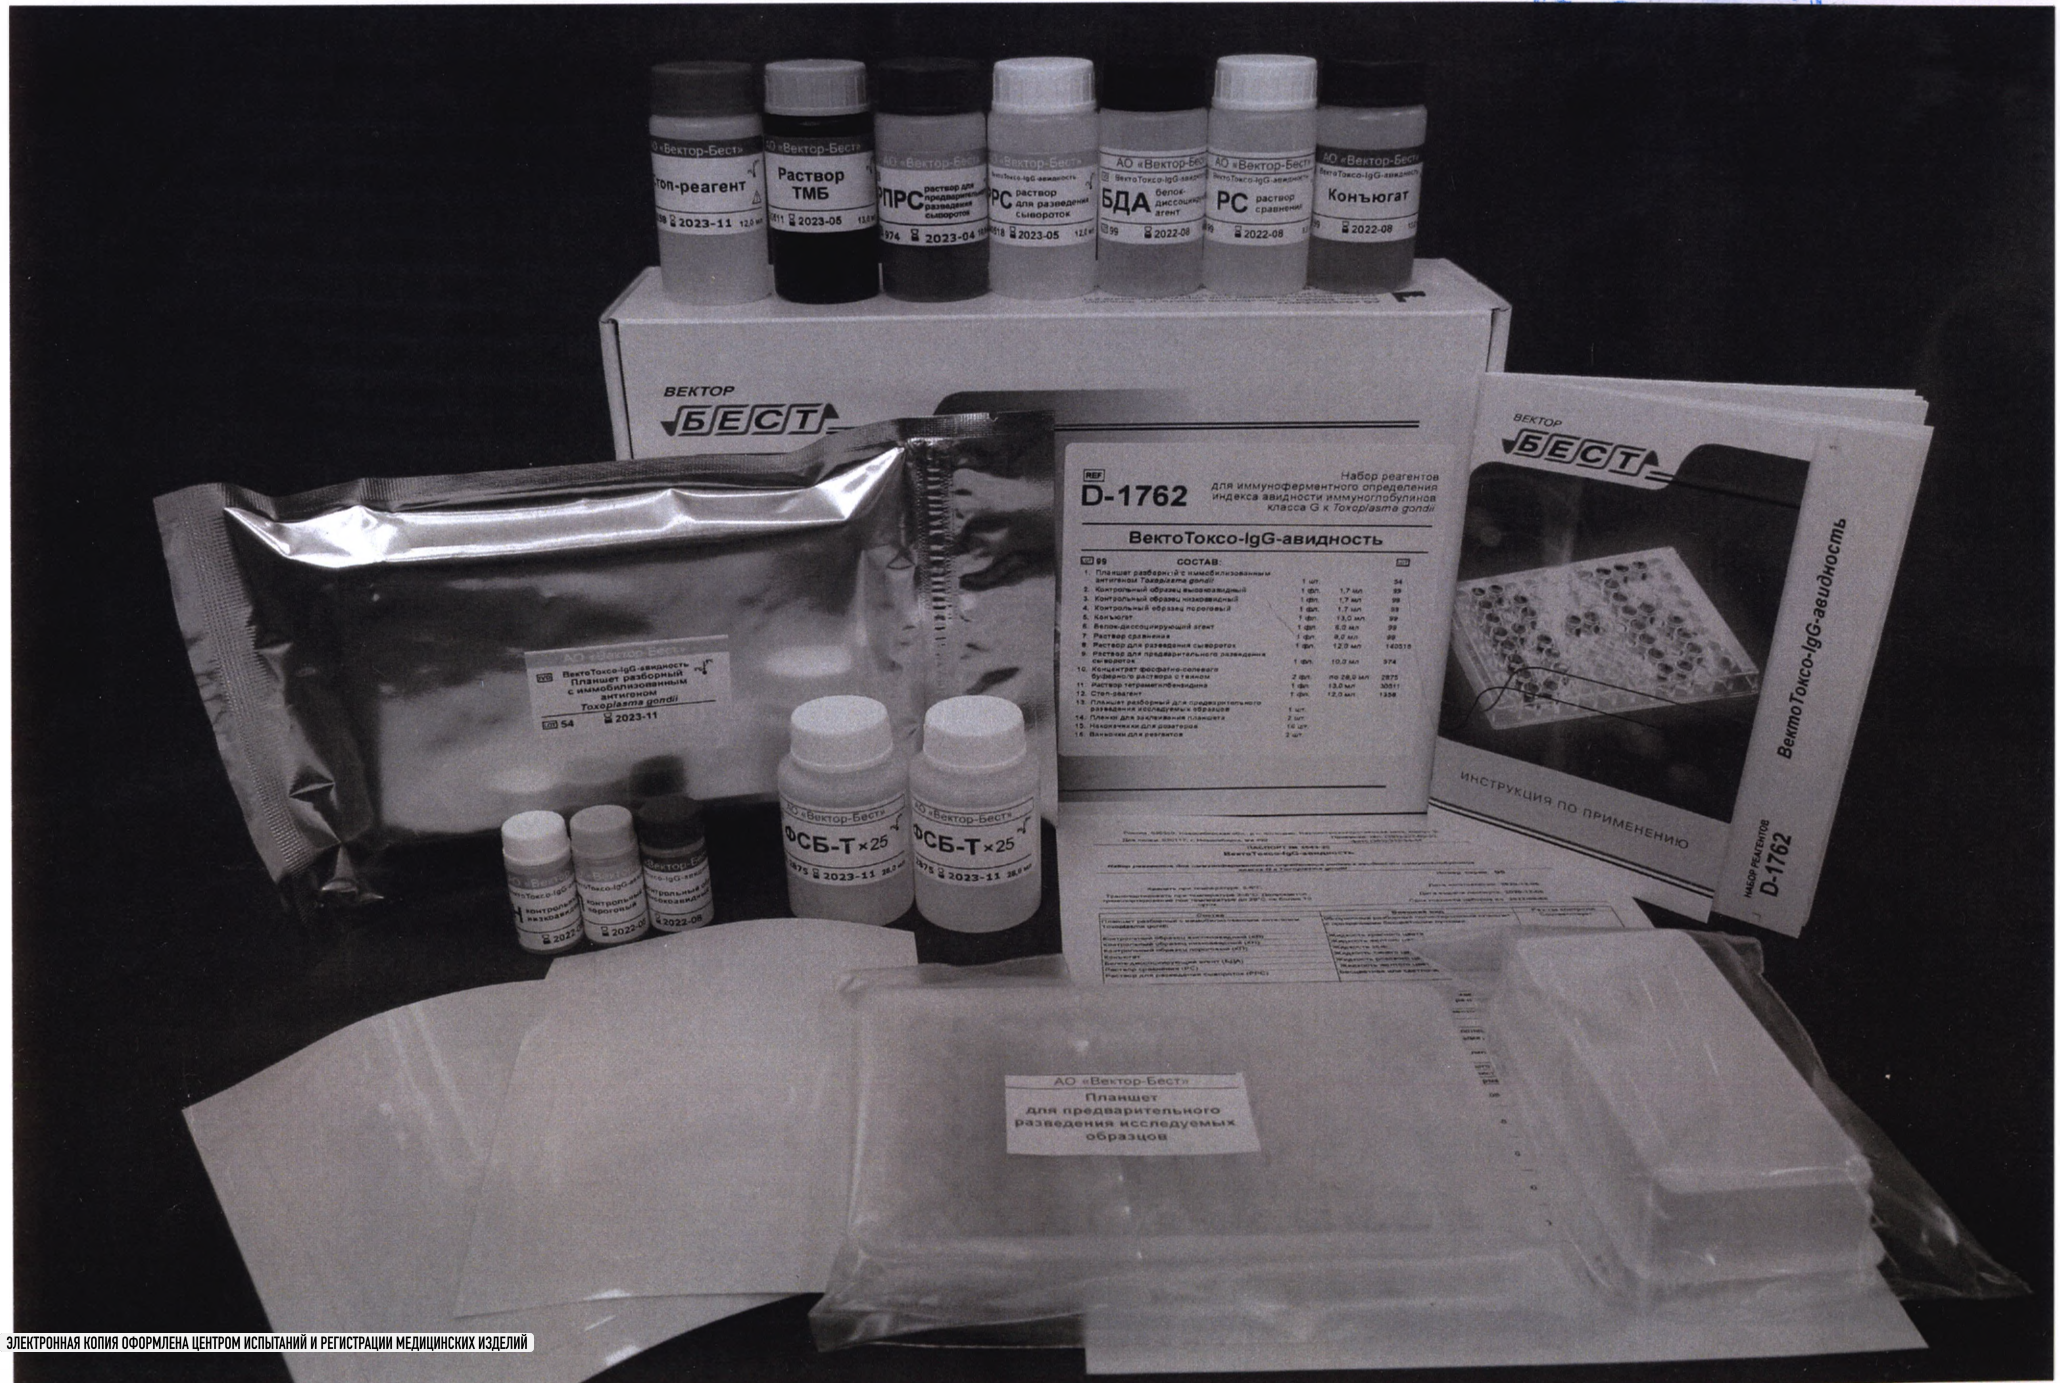

ВЕКТОР
БЕСТ



REF

D-1762

Набор реагентов
для иммуноферментного определения
индекса avidности иммуноглобулинов
класса G к *Toxoplasma gondii*

ВектоТоксо-IgG-авидность

LOT 99

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованным антигеном <i>Toxoplasma gondii</i>	1 шт.	54
2. Контрольный образец высокоавидный	1 фл. 1,7 мл	99
3. Контрольный образец низкоавидный	1 фл. 1,7 мл	99
4. Контрольный образец пороговый	1 фл. 1,7 мл	99
5. Конъюгат	1 фл. 13,0 мл	99
6. Белок-диссоциирующий агент	1 фл. 6,0 мл	99
7. Раствор сравнения	1 фл. 8,0 мл	99
8. Раствор для разведения сывороток	1 фл. 12,0 мл	140518
9. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл. 10,0 мл	974
10. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл. по 28,0 мл	2875
11. Раствор тетраметилбензидаина	1 фл. 13,0 мл	30511
12. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл	1358
13. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.	
14. Пленки для заклеивания планшета	2 шт.	
15. Наконечники для дозаторов	16 шт.	
16. Ванночки для реагентов	2 шт.	


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii (ВектоТоксо-IgG-авидность)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
«Вектор-Бест» 2021 г.

ВЕКТОР

БЕСТ

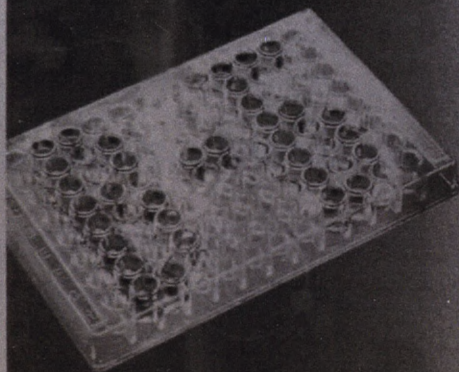

REF **D-1762**

Σ 6×8

LOT

99

ТУ 21.20.23-014-23548172-2018

ПУ № РЗН 2019/8630 от 18.07.2019



2020-12-06



2022-06-06

ВектоТоксо-IgG-авидность

IVD



17620606220009900008


Контрольные образцы инаktivированы

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к *Toxoplasma gondii* (ВектоТоксо-IgG-авидность)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


Хусайнов М.Д.
2021 г.
Вектор-Бест

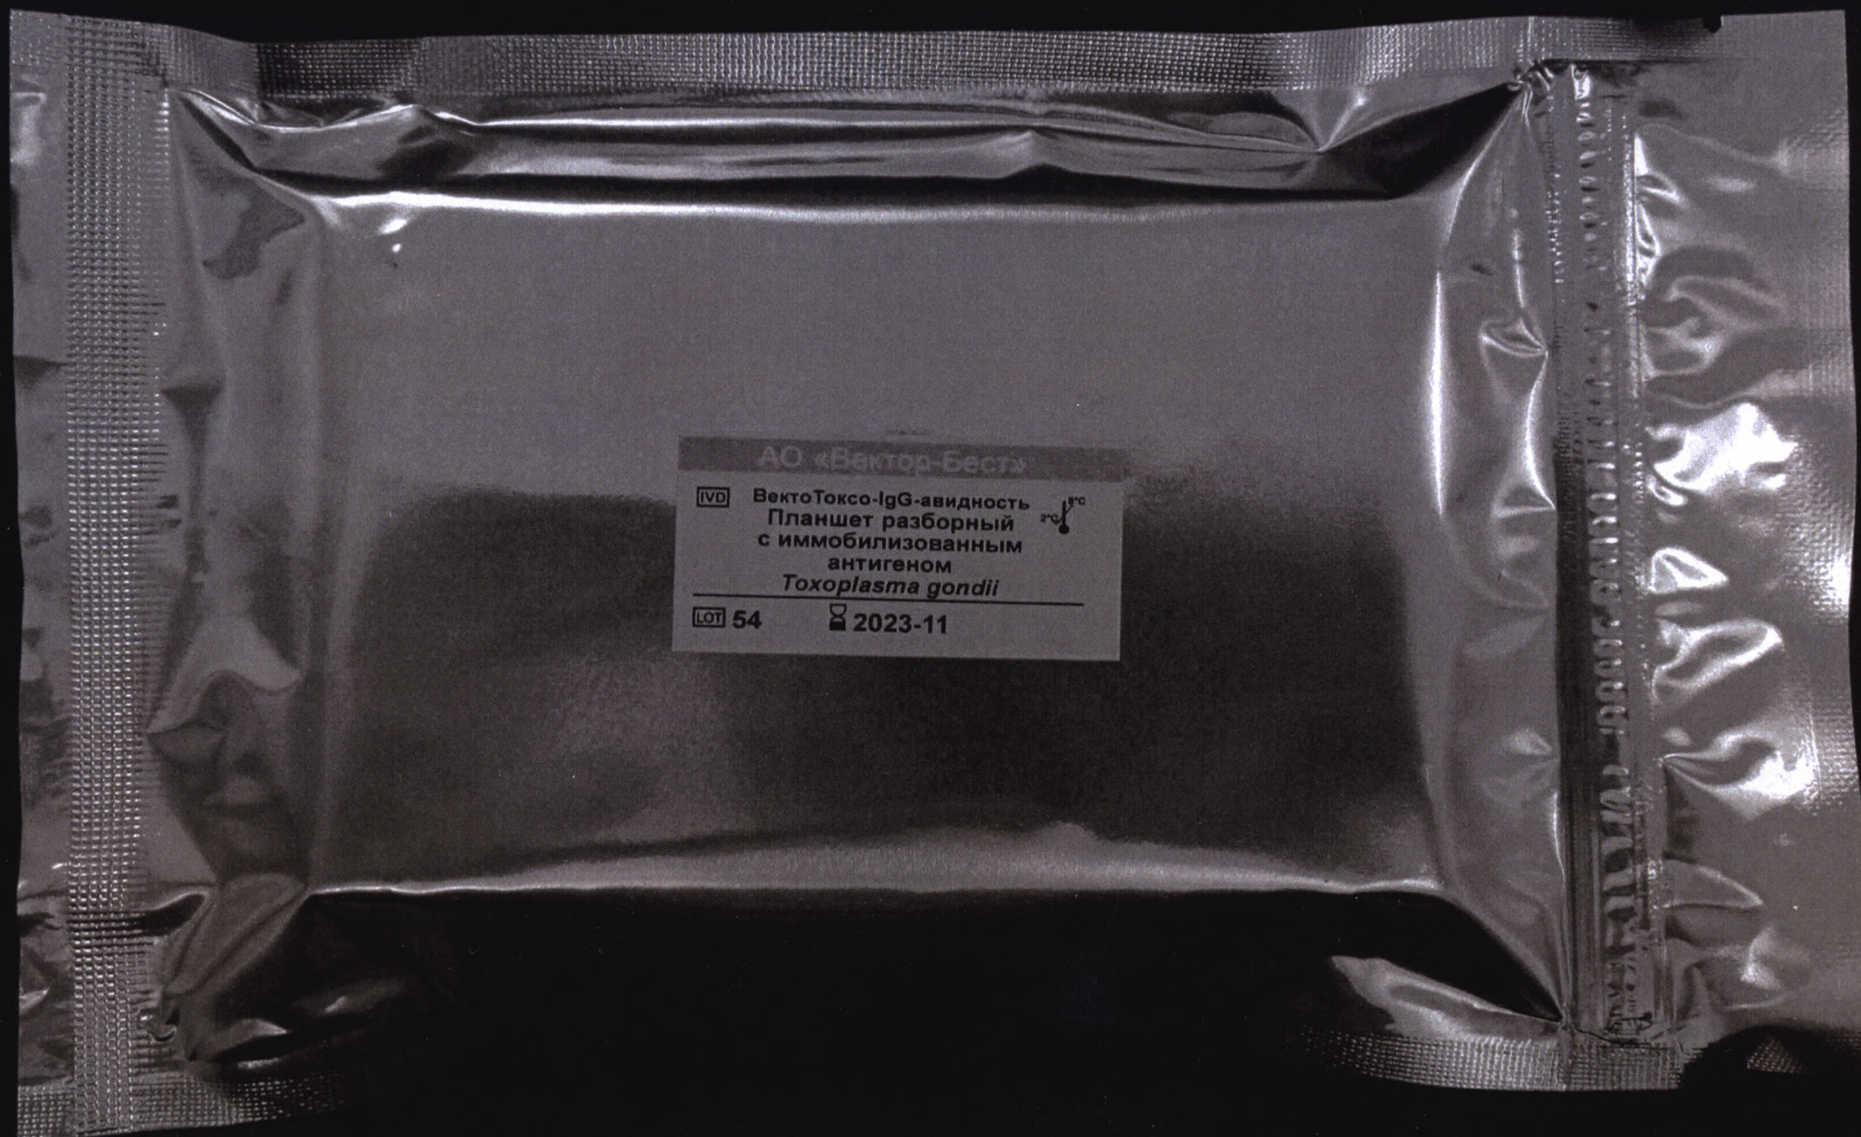


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор
реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности
иммуноглобулинов класса G к *Toxoplasma gondii* (ВектоТоксо-IgG-авидность)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
2021 г.

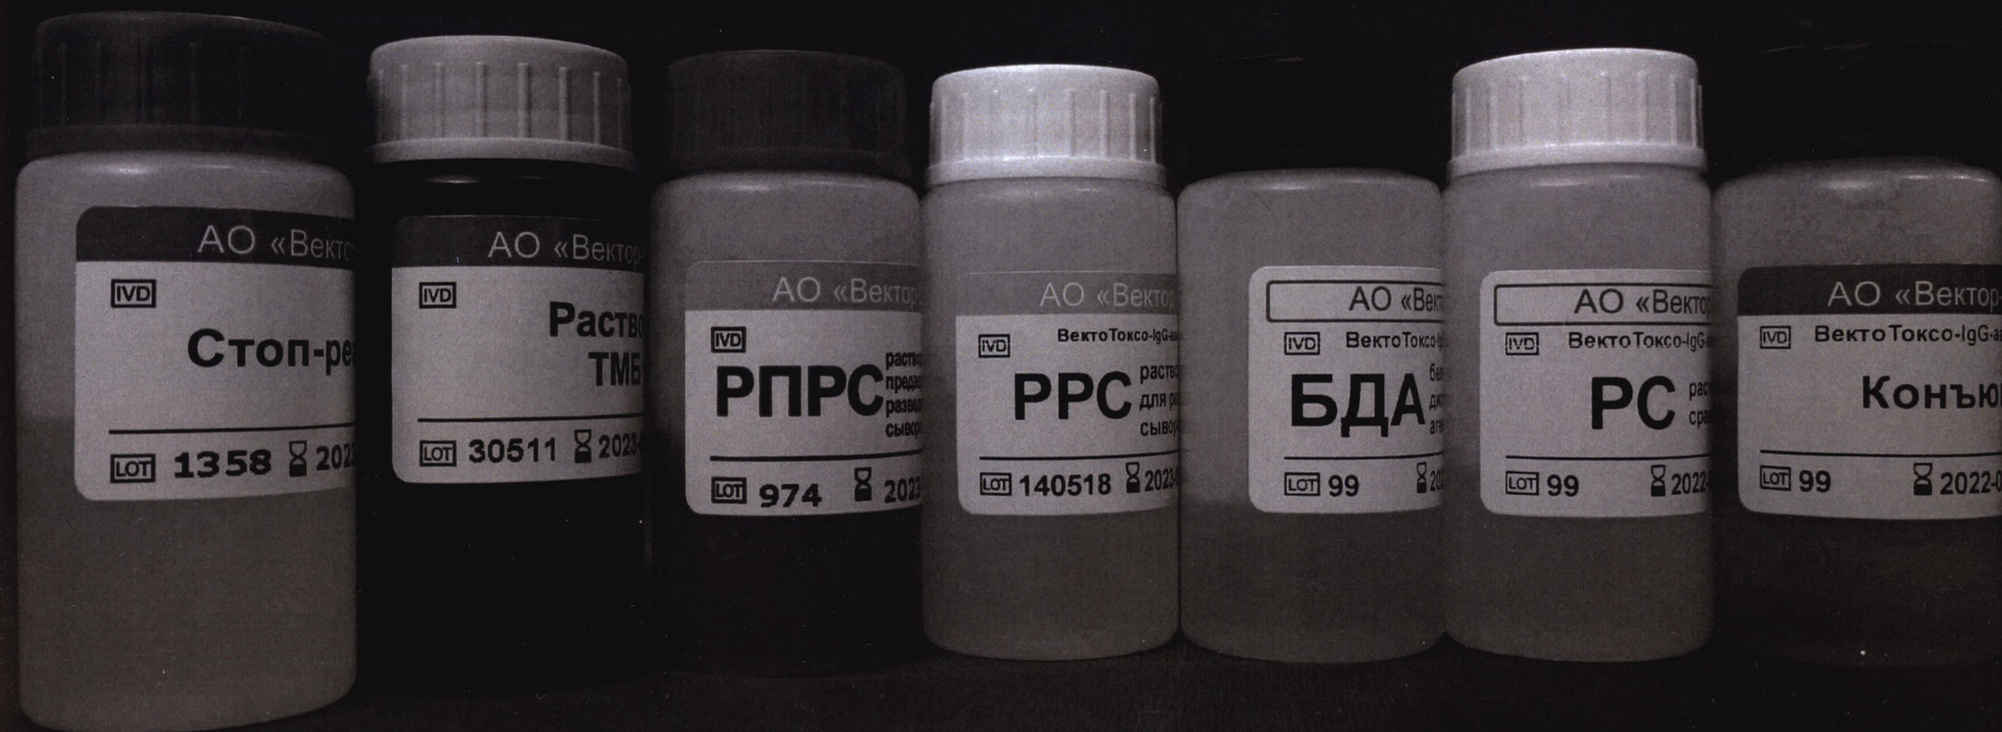

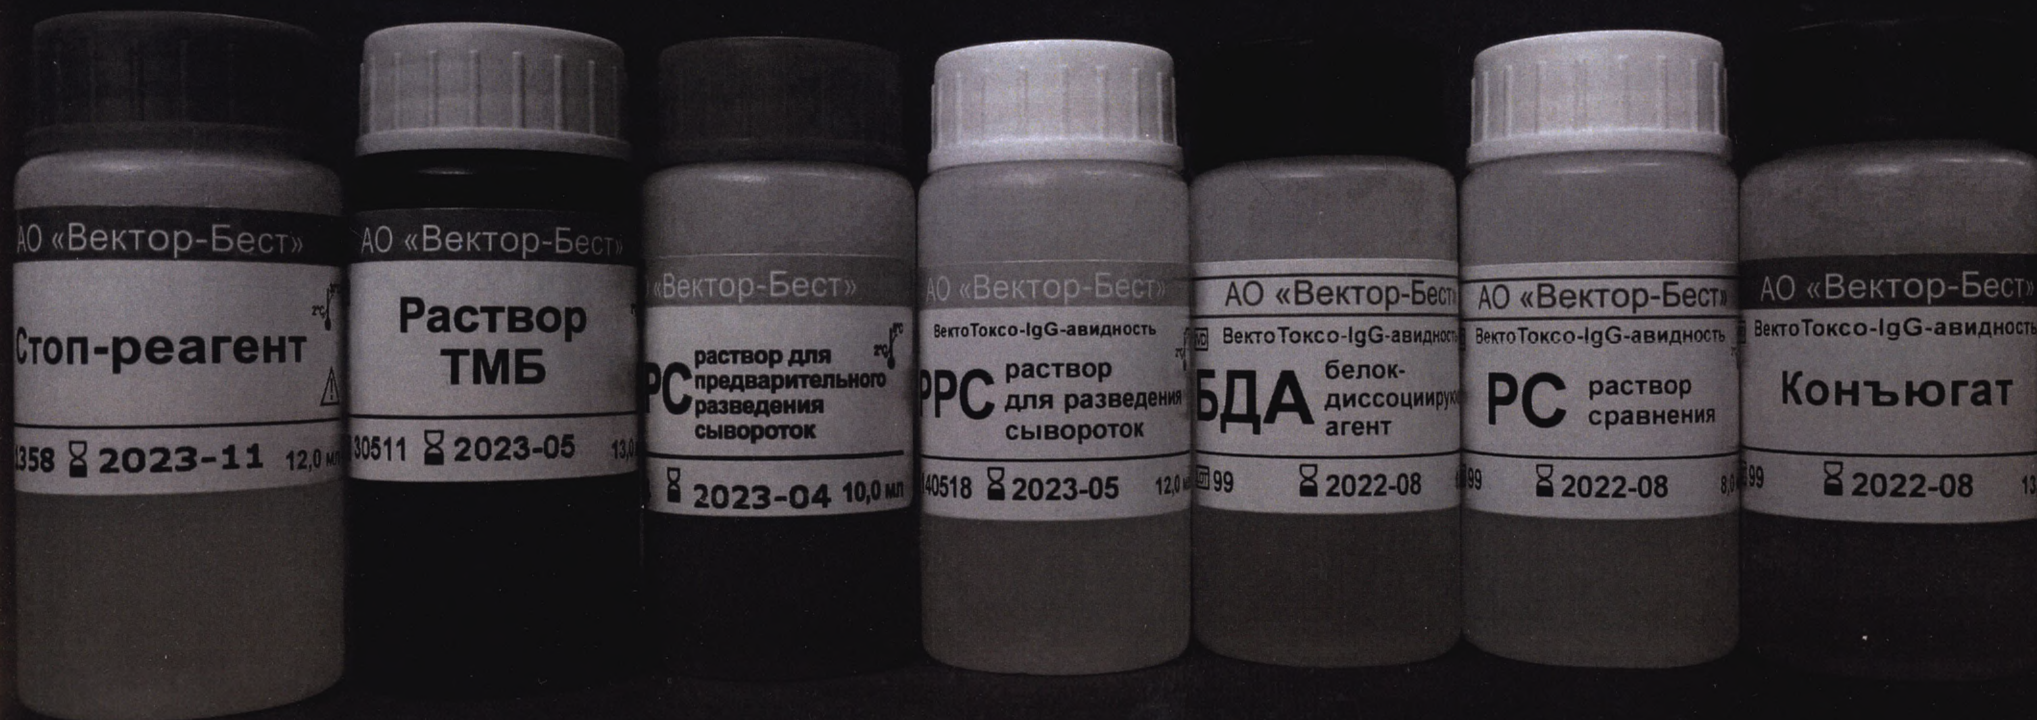




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к *Toxoplasma gondii* (ВектоТоксо-IgG-авидность)» № 5

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
2021 г.



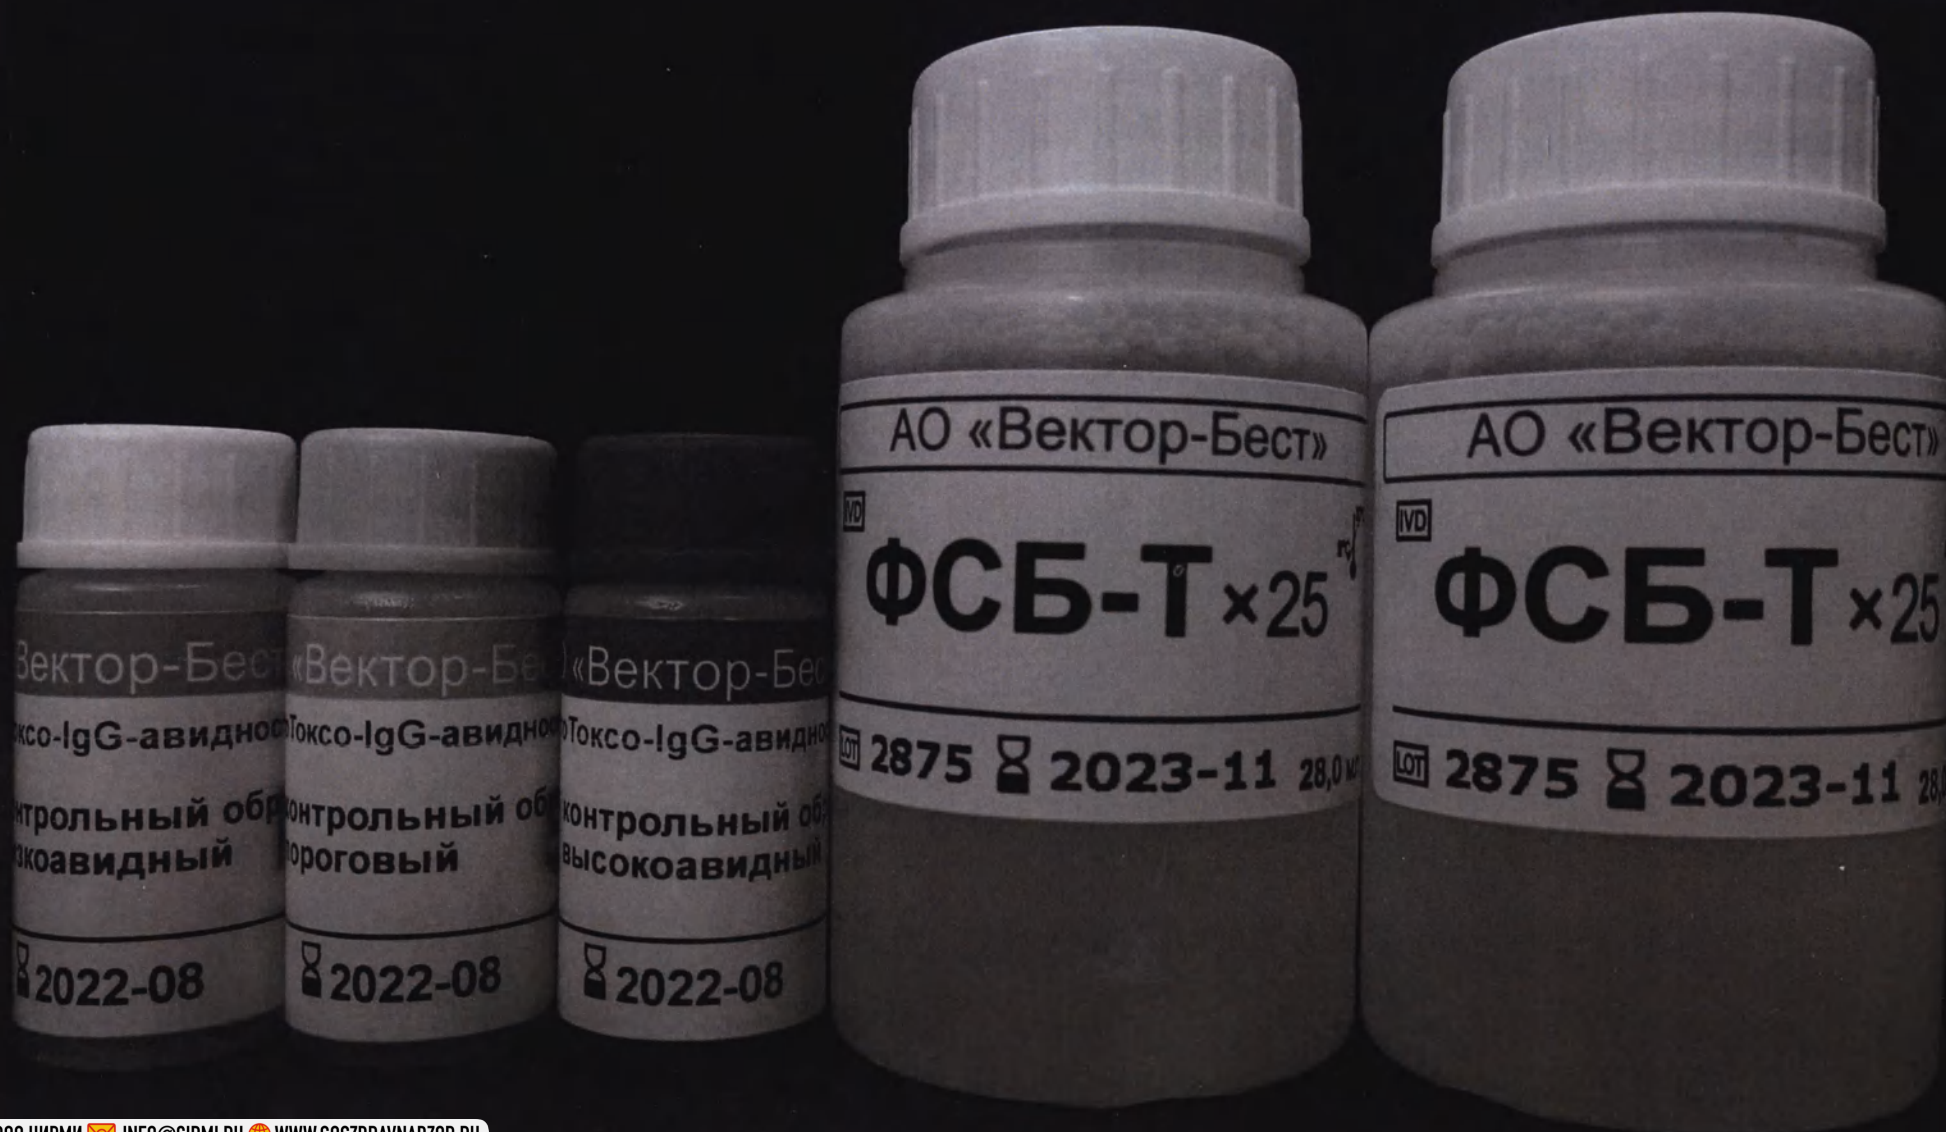

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к *Toxoplasma gondii* (ВектоТоксо-IgG-авидность)» № 7

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2021 г.

