

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
АО «ШИЛЛЕР.РУ»

Казанчян К.П.

_____ 2021 г.

Фотографические материалы медицинского изделия
Система электрокардиографическая CARDIOVIT CS-104 для
мониторинга показателей функционального состояния в покое и
при проведении стресс-теста с нагрузкой

Файлы для скачивания Система Cardiovit CS-104



ДРАЙВЕР

ZIP. 951.76 KB




CARDIOVIT CS-104

ZIP. 275.63 MB


Программное обеспечение ЭКГ покоя, включая ритм покоя



Регистратор ЭКГ беспроводной MS-12 blue

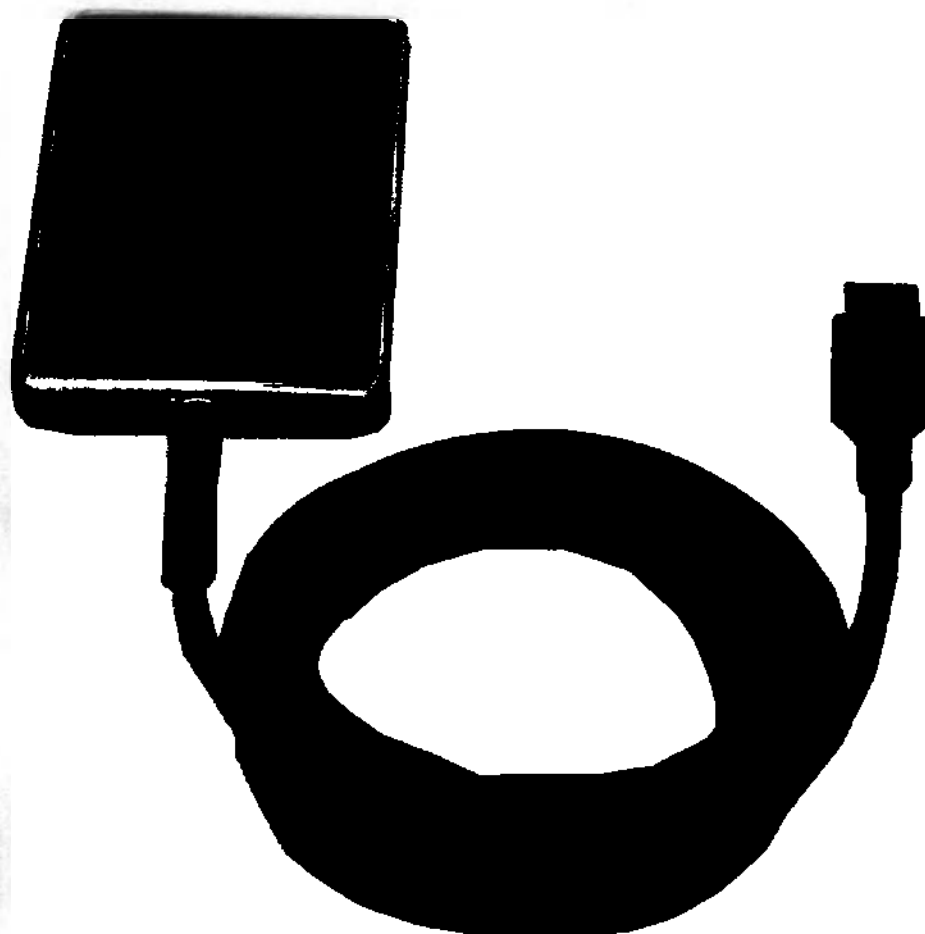

Регистратор ЭКГ проводной MS-12 USB

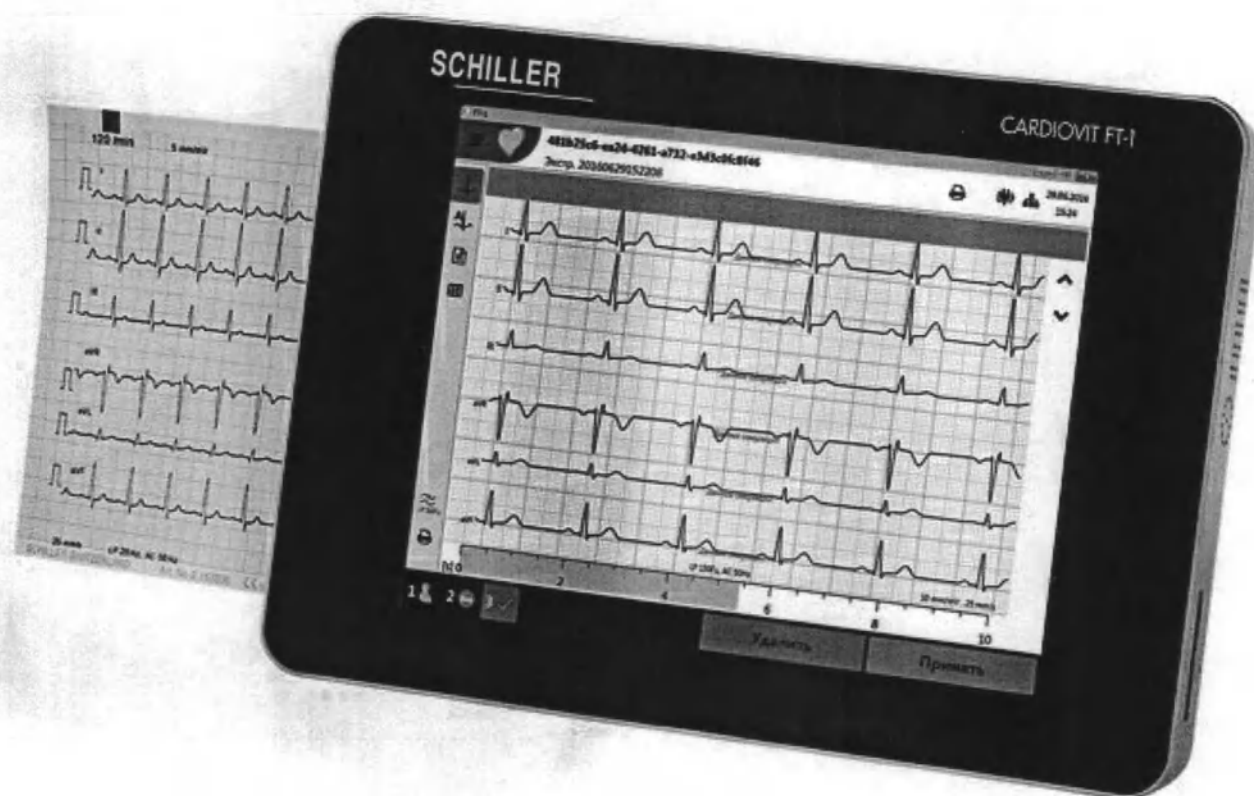

Электрокардиограф CARDIOVIT FT-1



Кабель пациента 10-ти жильный кнопочный



Кабель пациента 10-ти жильный банановый




Кабель пациента 10-ти жильный кнопочный для MS-12 blue




Кабель пациента 10-ти жильный банановый для MS-12 blue



Кабель пациента 10-ти жильный клипсовый для MS-12 blue

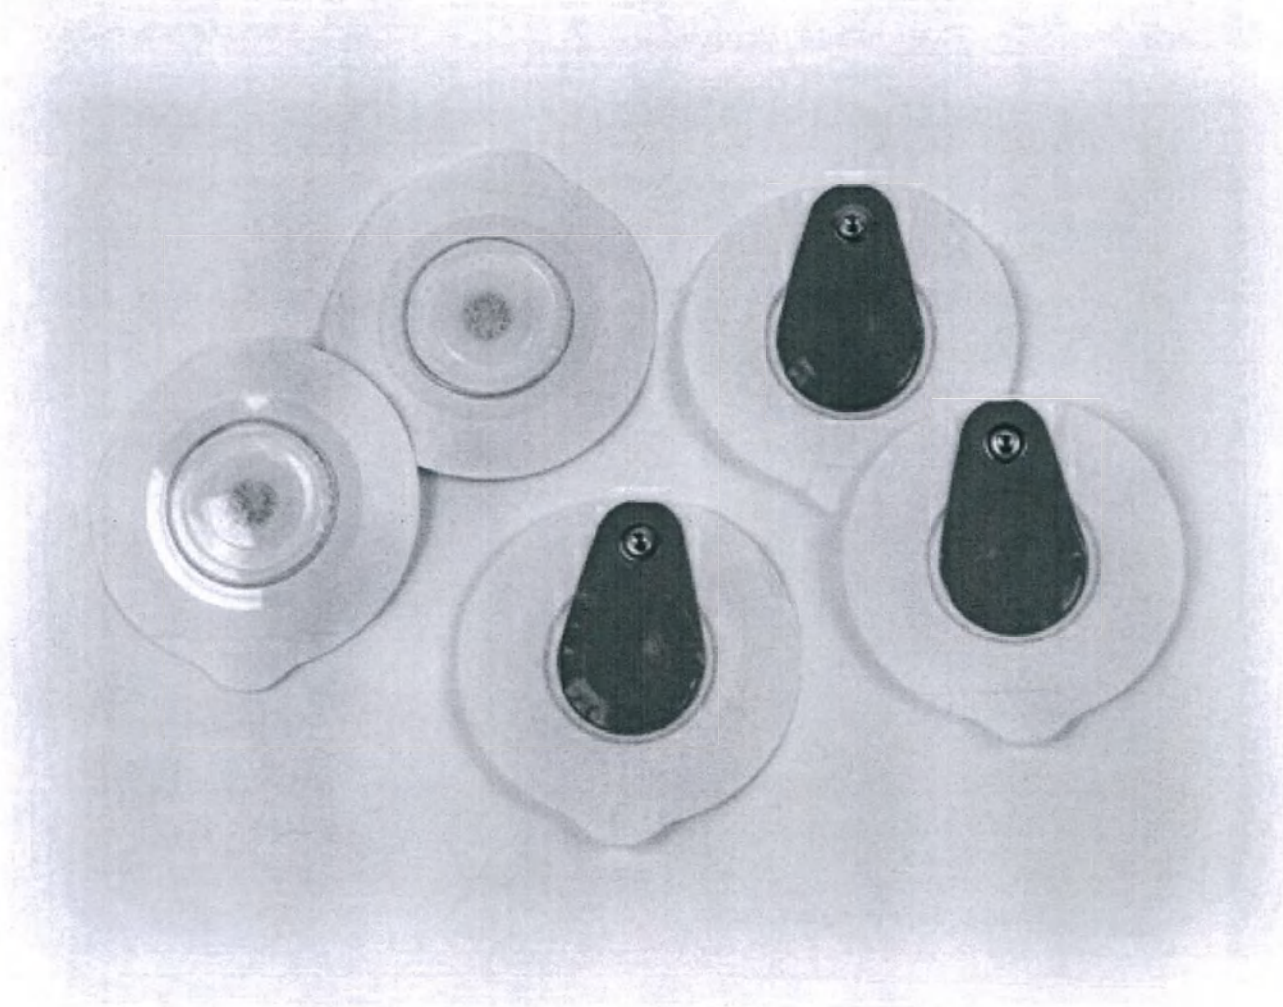


ЭКГ электроды одноразовые

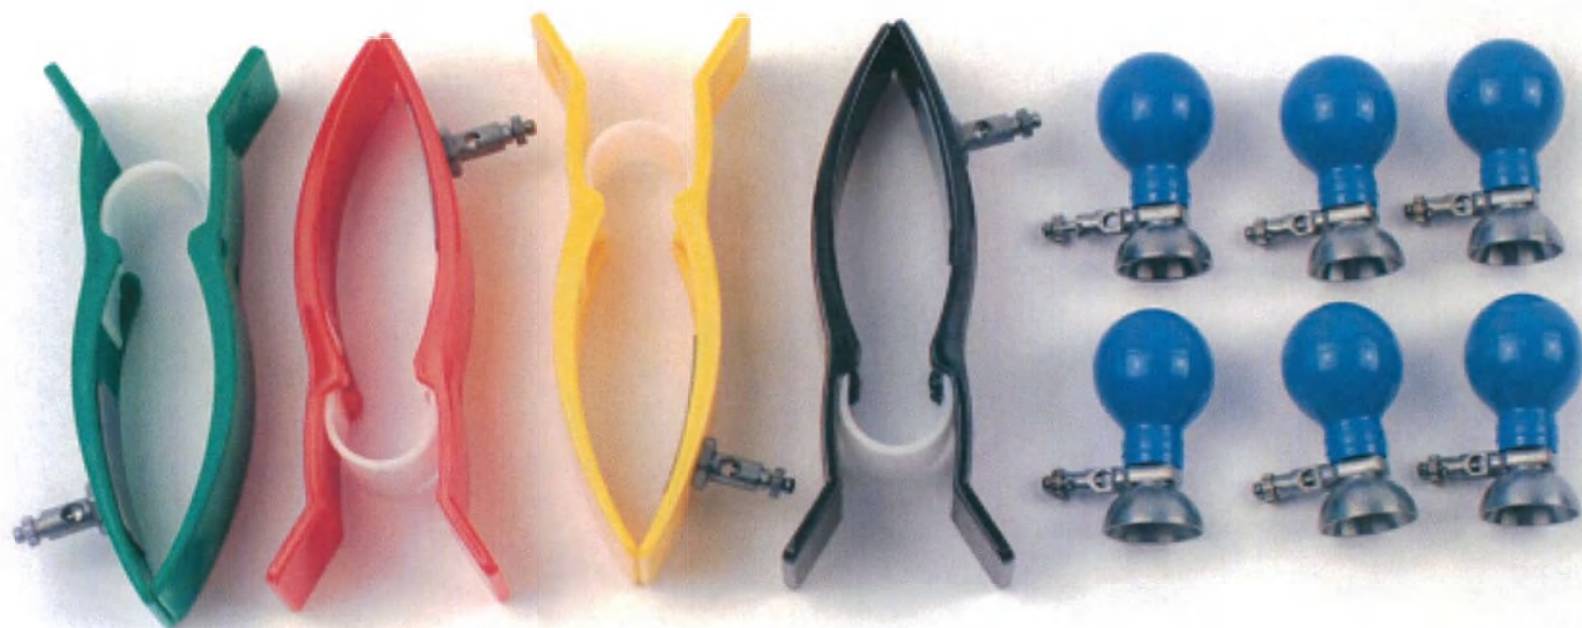

Комплект электродов для взрослых:- грудные; - для конечностей




Комплект электродов для детей: :- грудные; - для конечностей

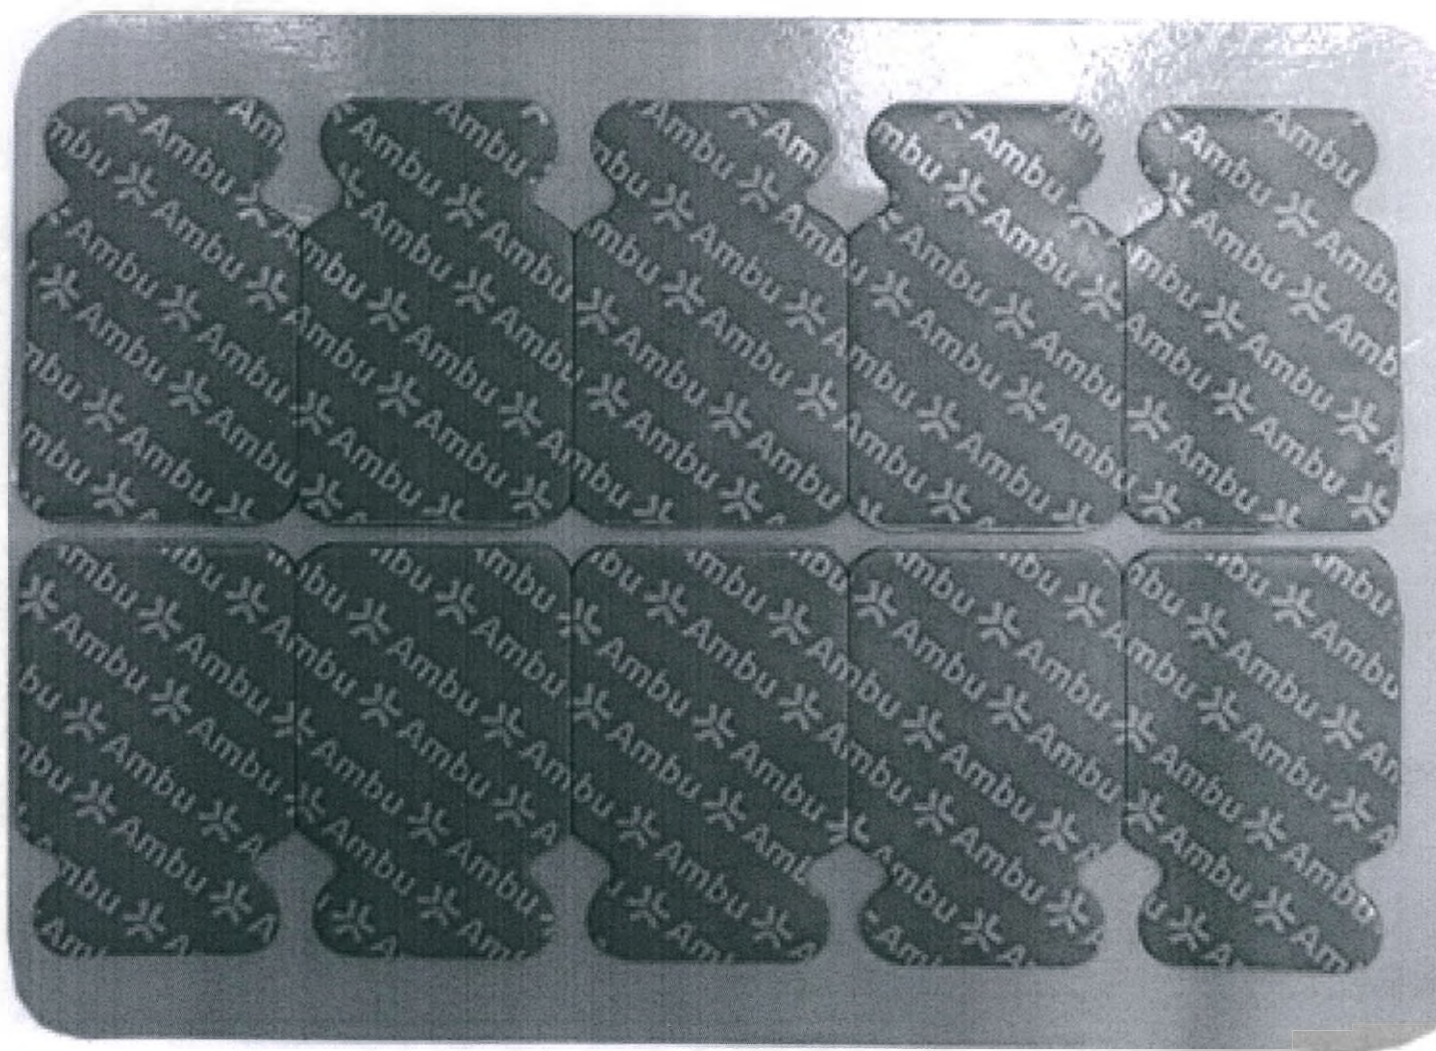


Биоадгезивные электроды



Переходники для электродов

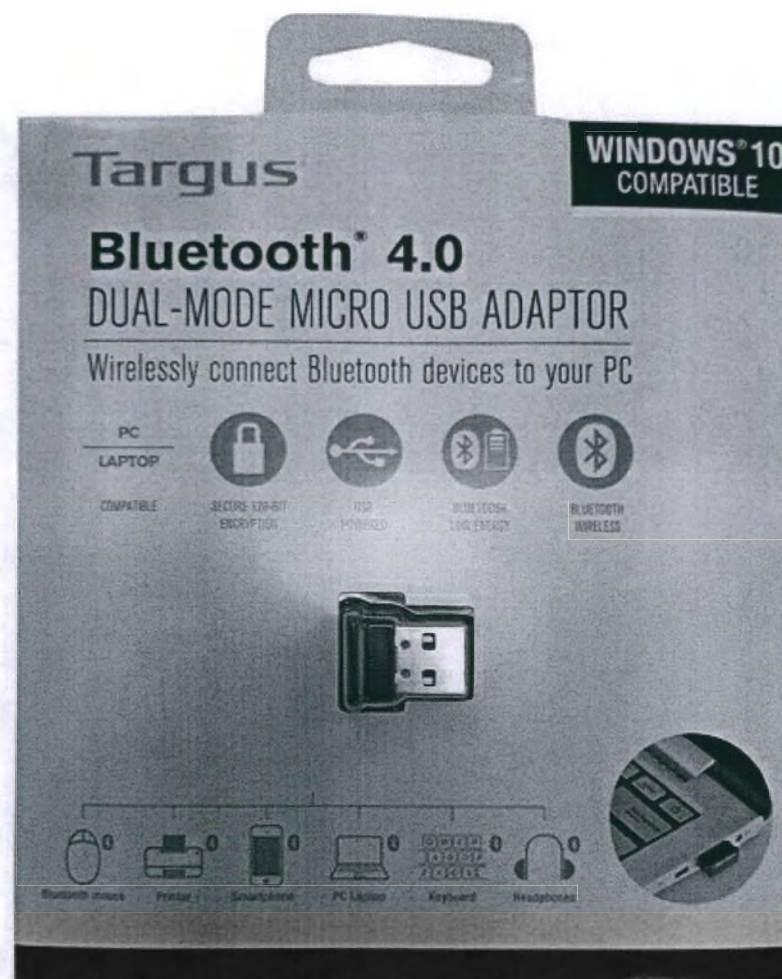

USB-адаптер Bluetooth

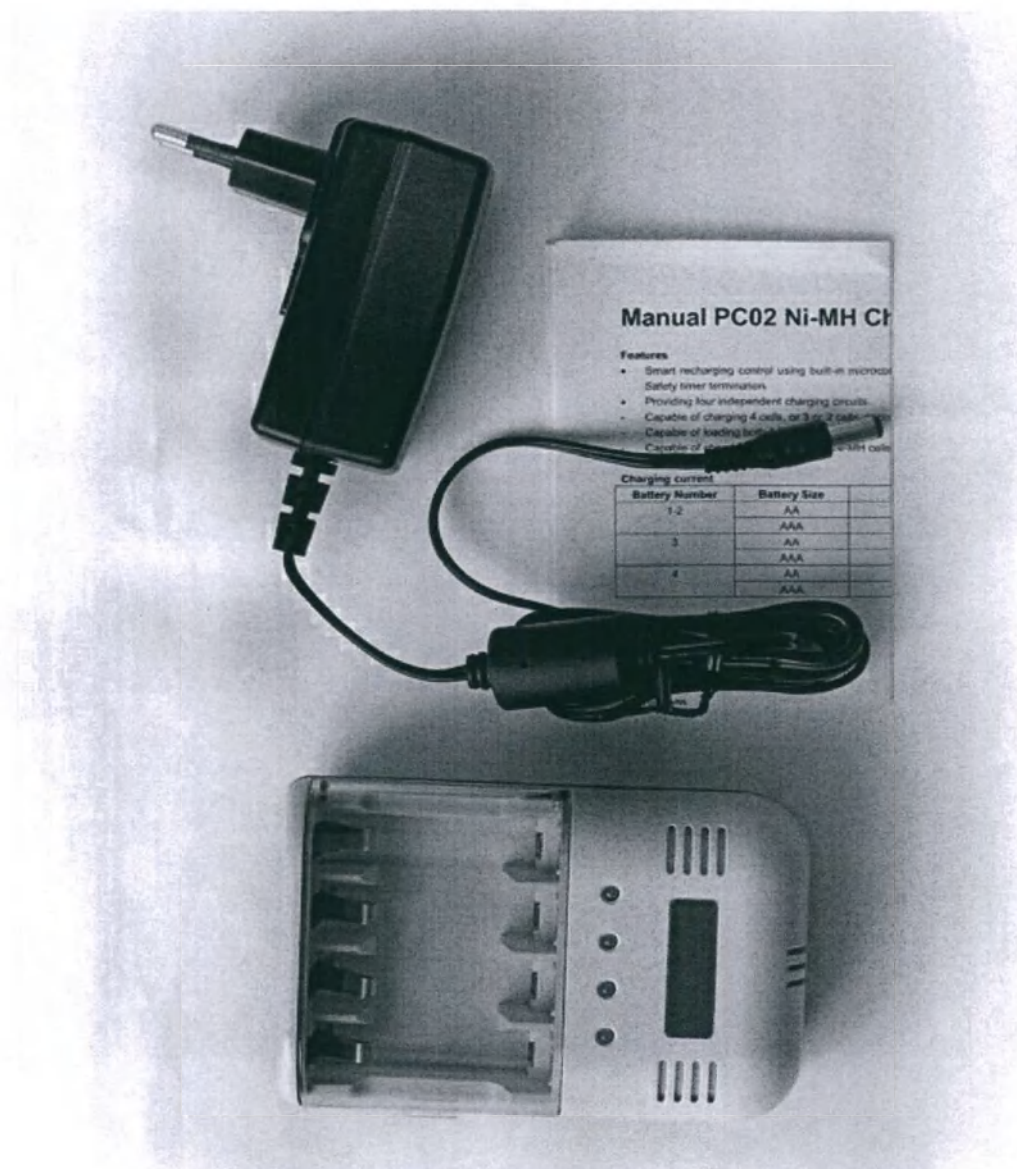

Зарядное устройство




Батареи аккумуляторные тип AA



Защитный чехол



Блок питания медицинского назначения

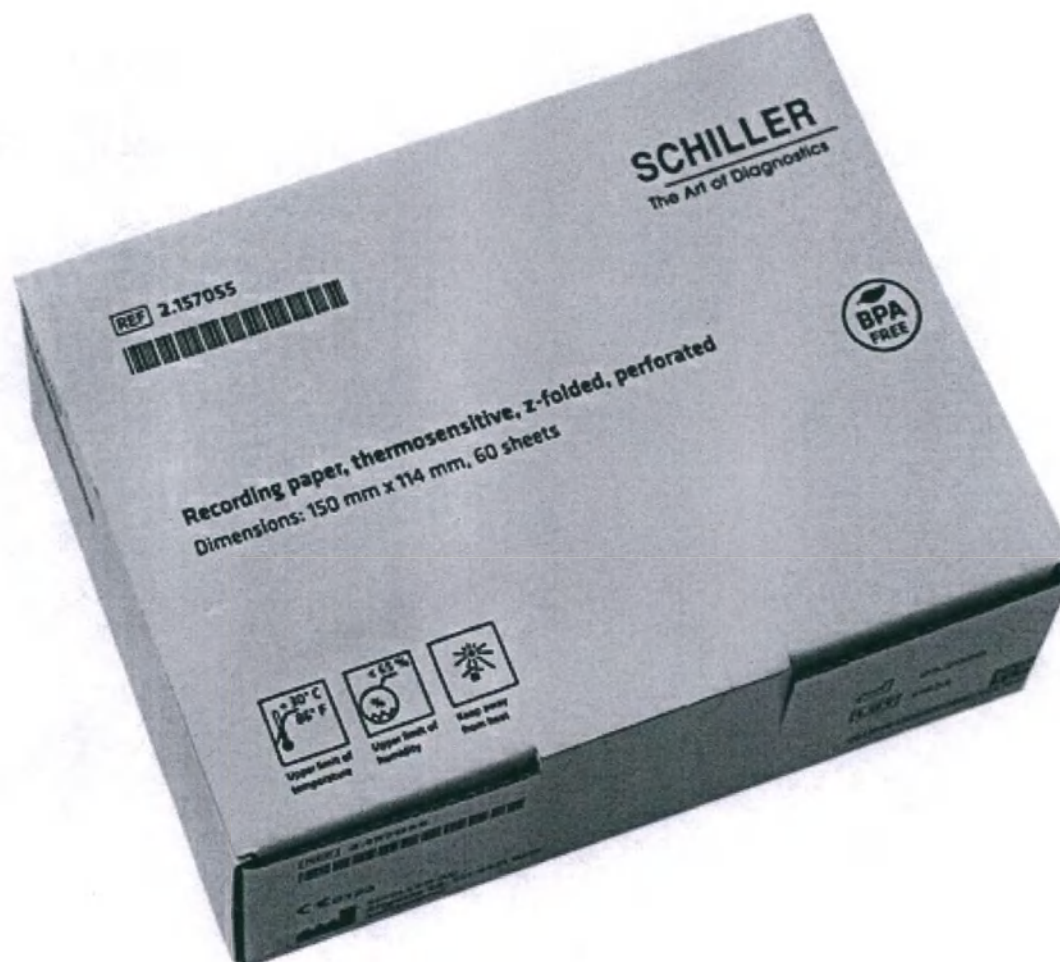



Регистрационная бумага




USB-кабель



Пояс для эргометрии

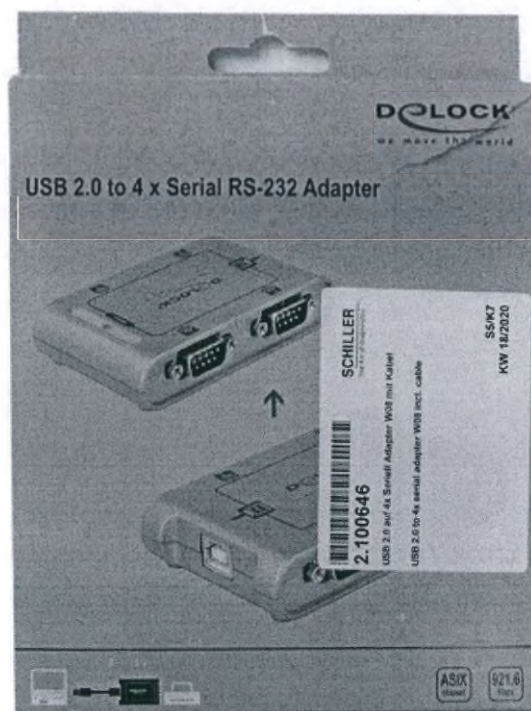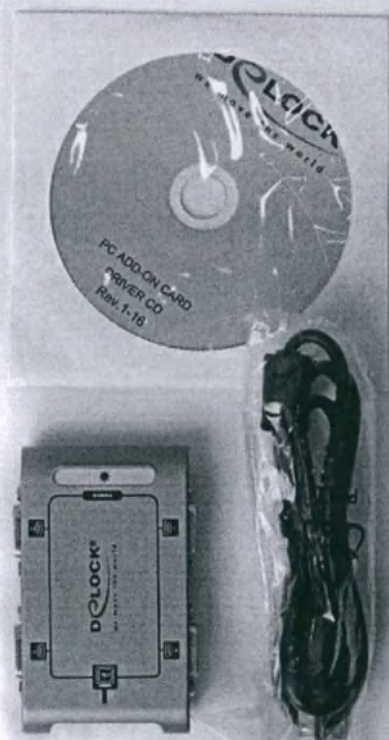

Адаптер USB - RS-232

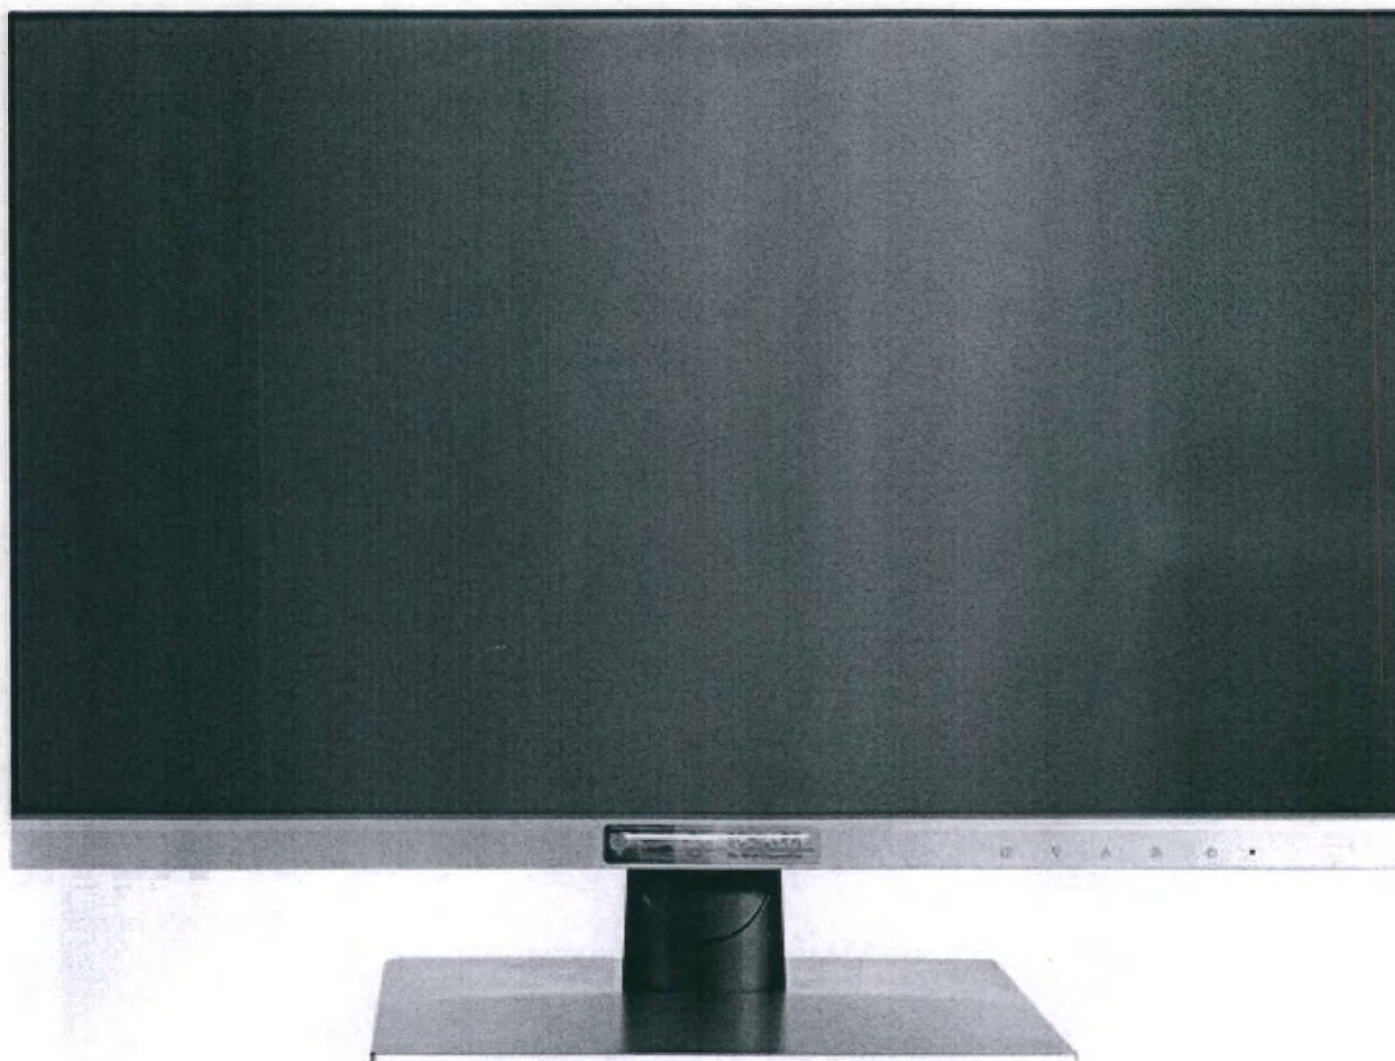


Монитор



ПК



Принтер

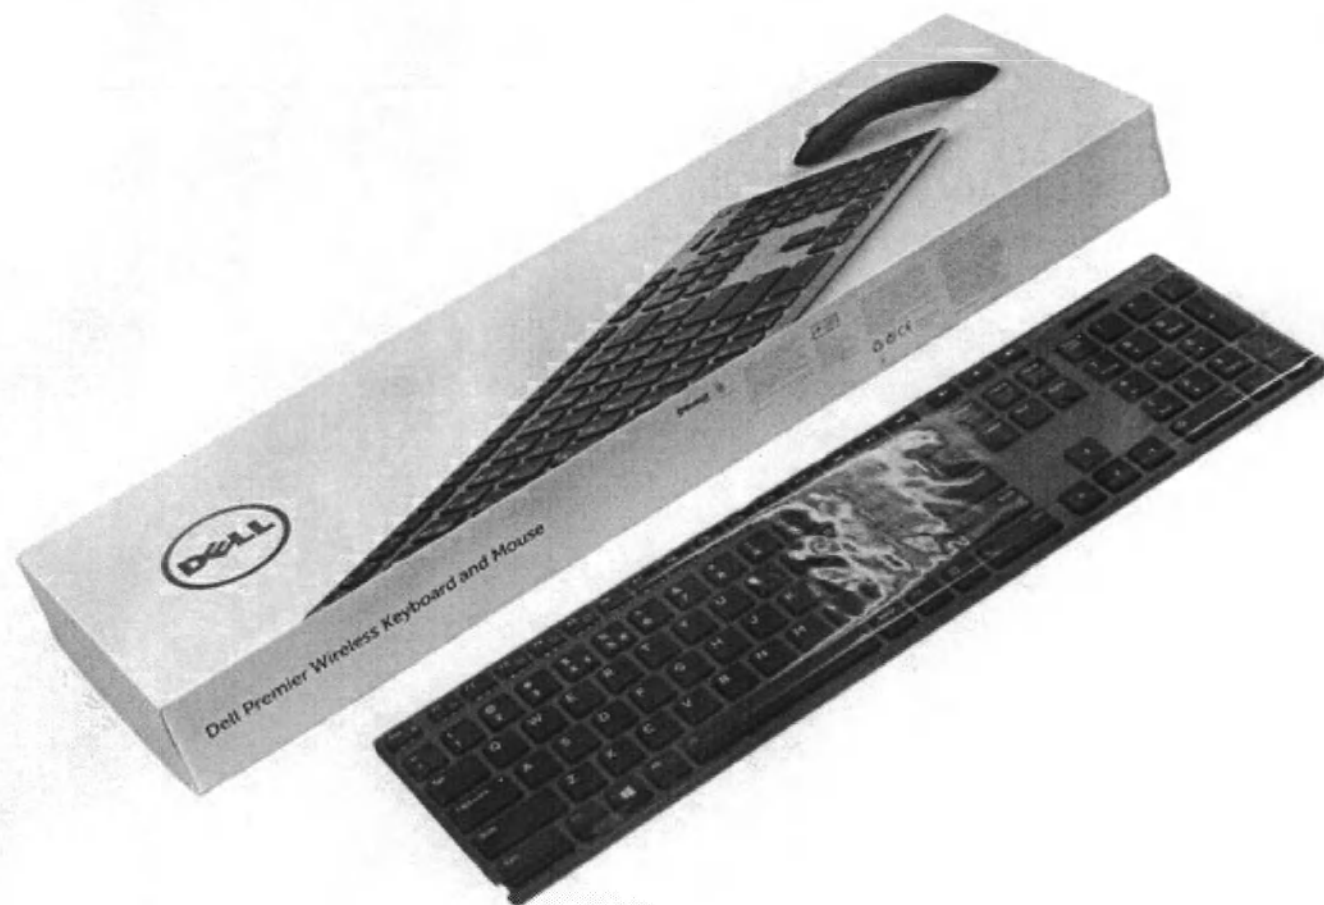

Клавиатура




Мышь компьютерная




Кабель сетевой




Тележка, вариант исполнения: Х4

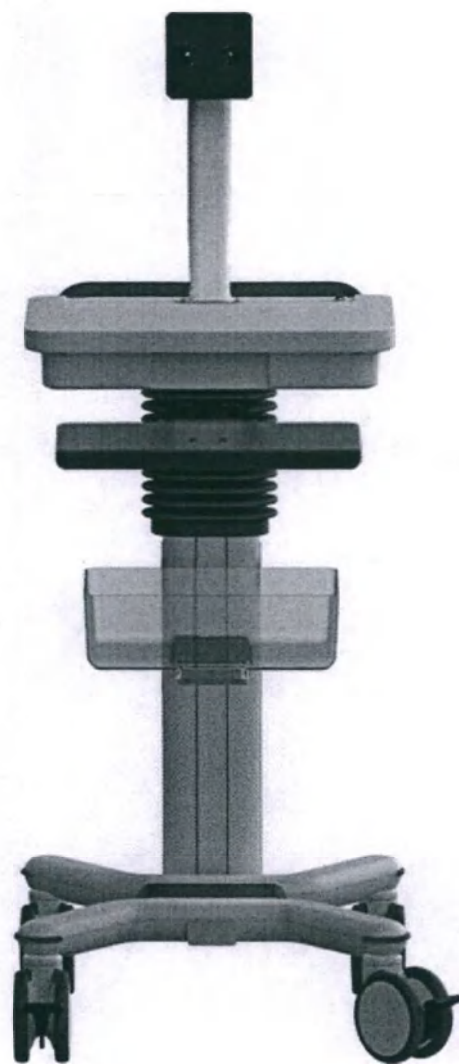


Тележка, вариант исполнения: X5

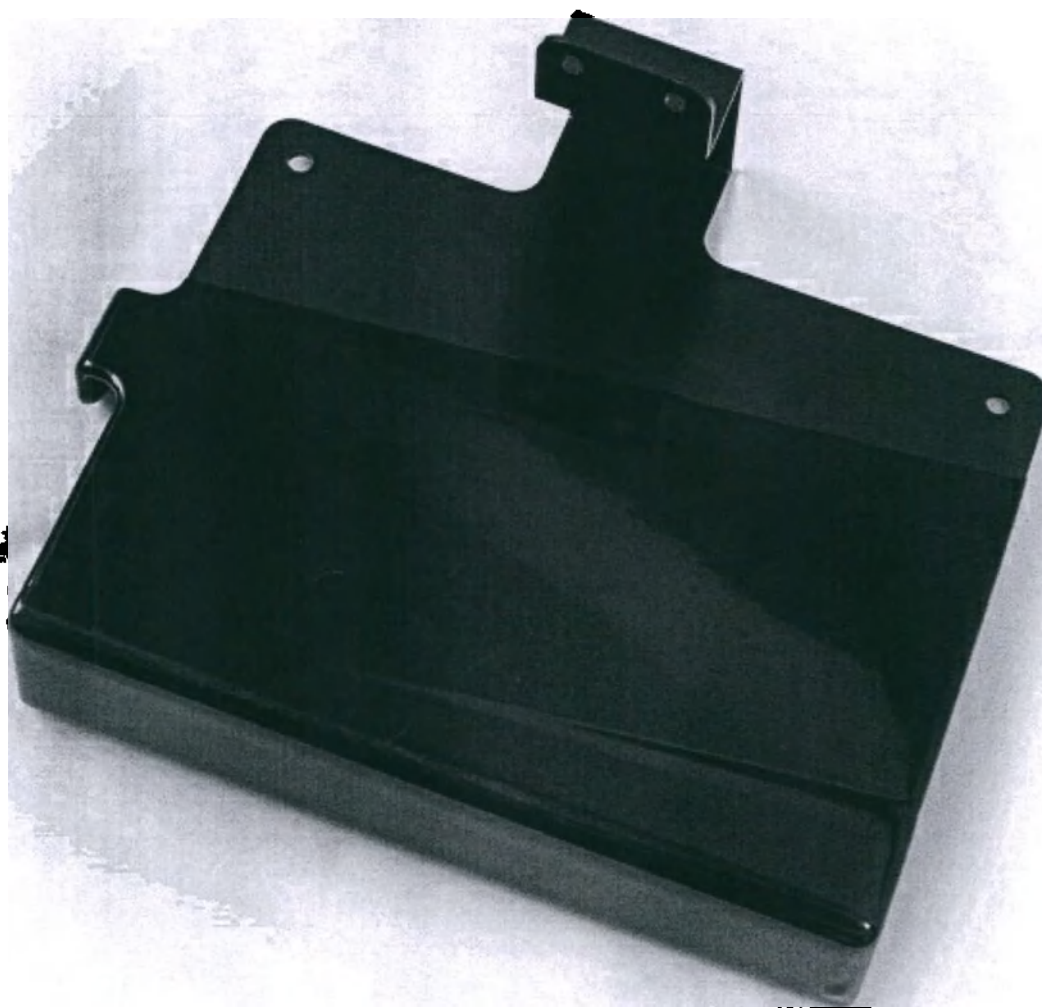


Держатель электрокардиографа FT-1 для тележки

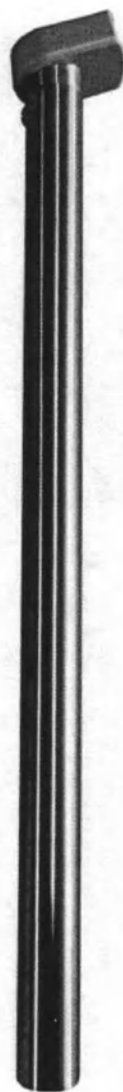


Держатель кабеля пациента для тележки

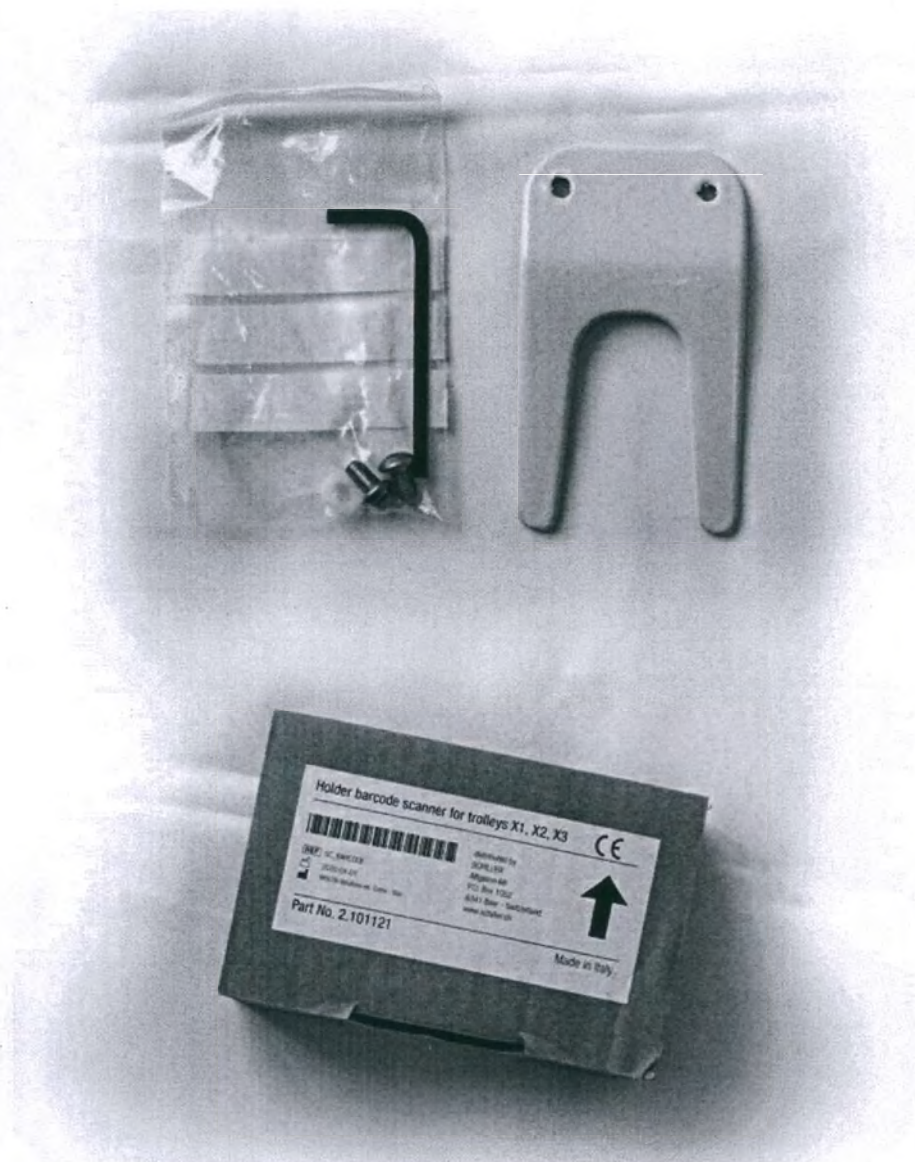

Держатель сканера штрих-кода для тележки

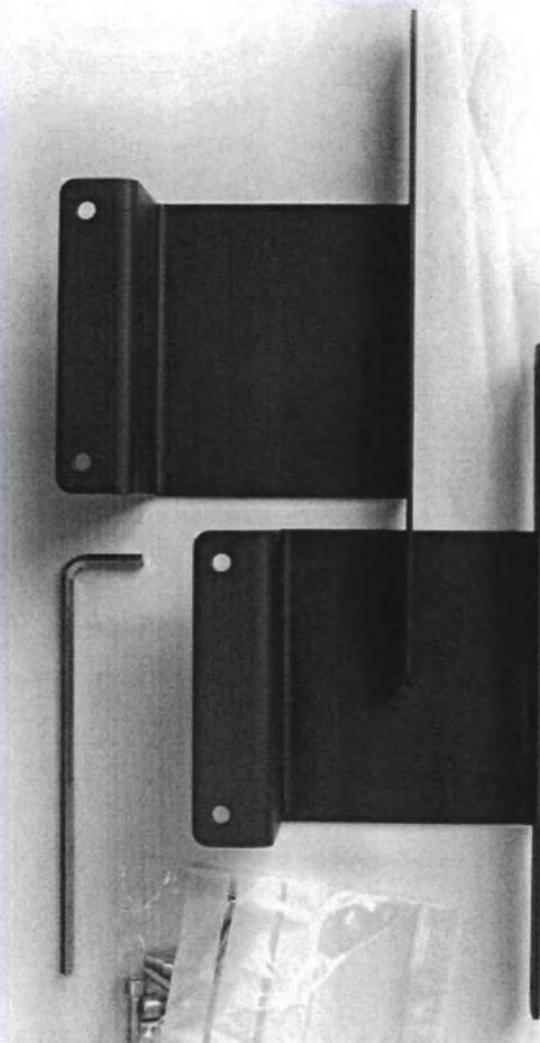

Держатель изолирующего трансформатора для тележки

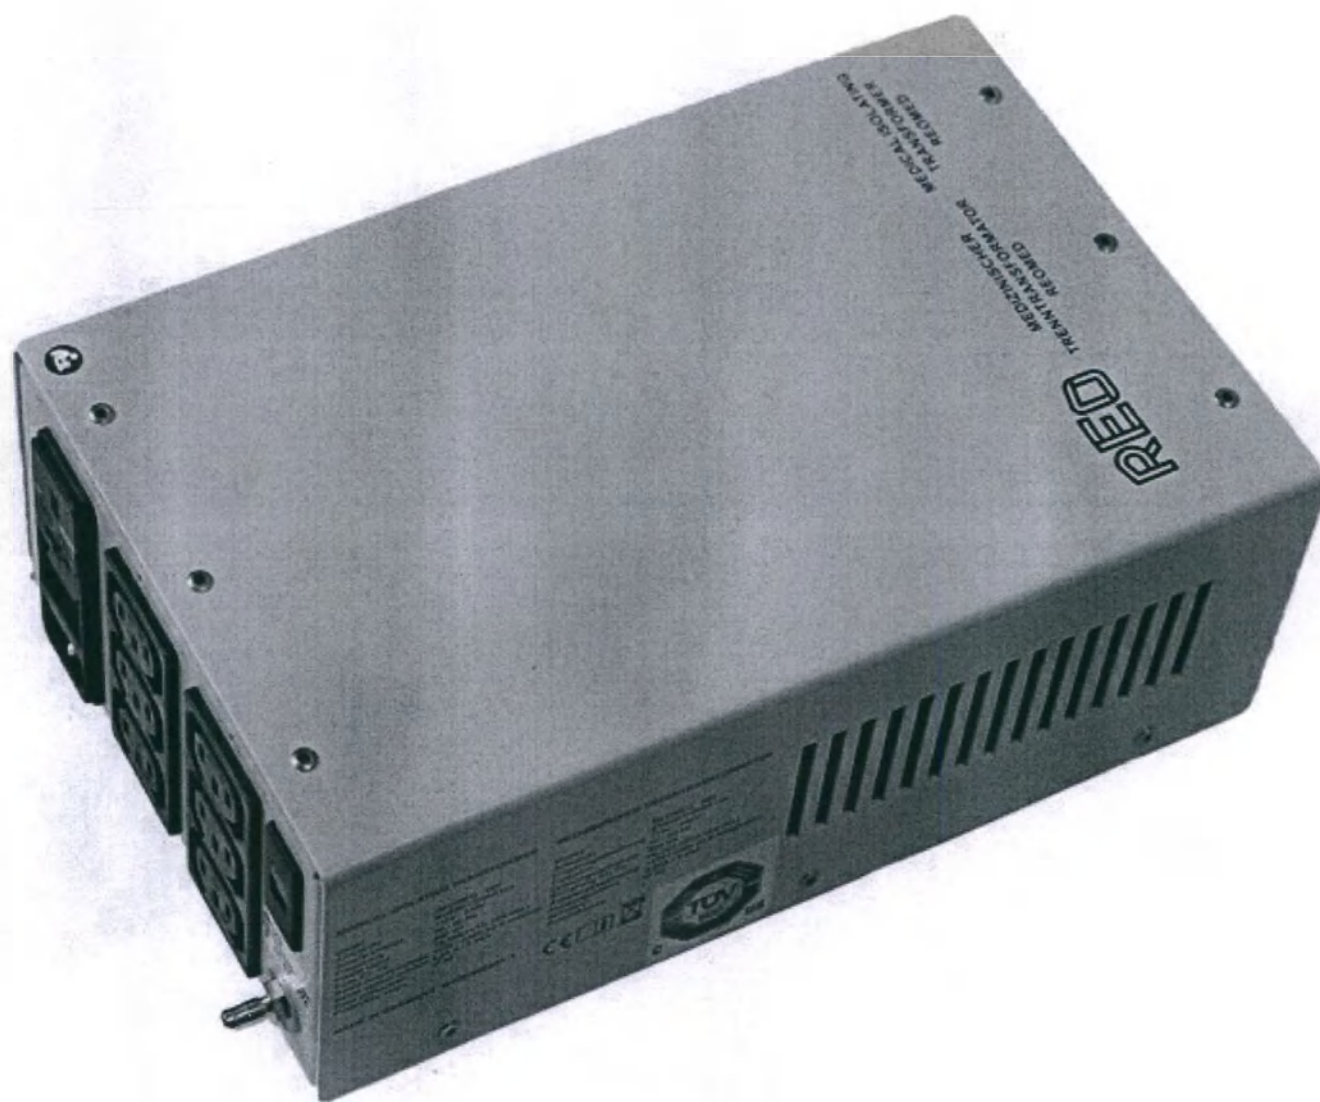

Трансформатор изолирующий медицинского назначения



SCHILLER
SWITZERLAND

Сертификат на активацию

Серийный номер:

XXXX.XXXXXX

CARDIOVIT CS-104

Ключ активации:

XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

Ключ активации лицензии программного обеспечения
(предоставляется на бумажном или электронном носителе или по электронной почте)



Велозргомметр ERG 910 S, РУ №ФСЗ 2010/0604



Велозргометр ERG 911, варианты исполнения: S, BP, PY №ФСЗ 2010/06043



Велозргометр ERG 911, варианты исполнения: S/L, BP/L, PУ №ФСЗ 2010/06043




Велоэргометр ERG 911, варианты исполнения: S/LS, BP/LS, РУ №ФСЗ 2010/06043



Велозергометр ERG 911, варианты исполнения: S/SEAT, BP/SEAT, РУ №ФСЗ 2010/06043




Велозргометр ERG 911, варианты исполнения: S/НК, РУ №ФСЗ 2010/06043

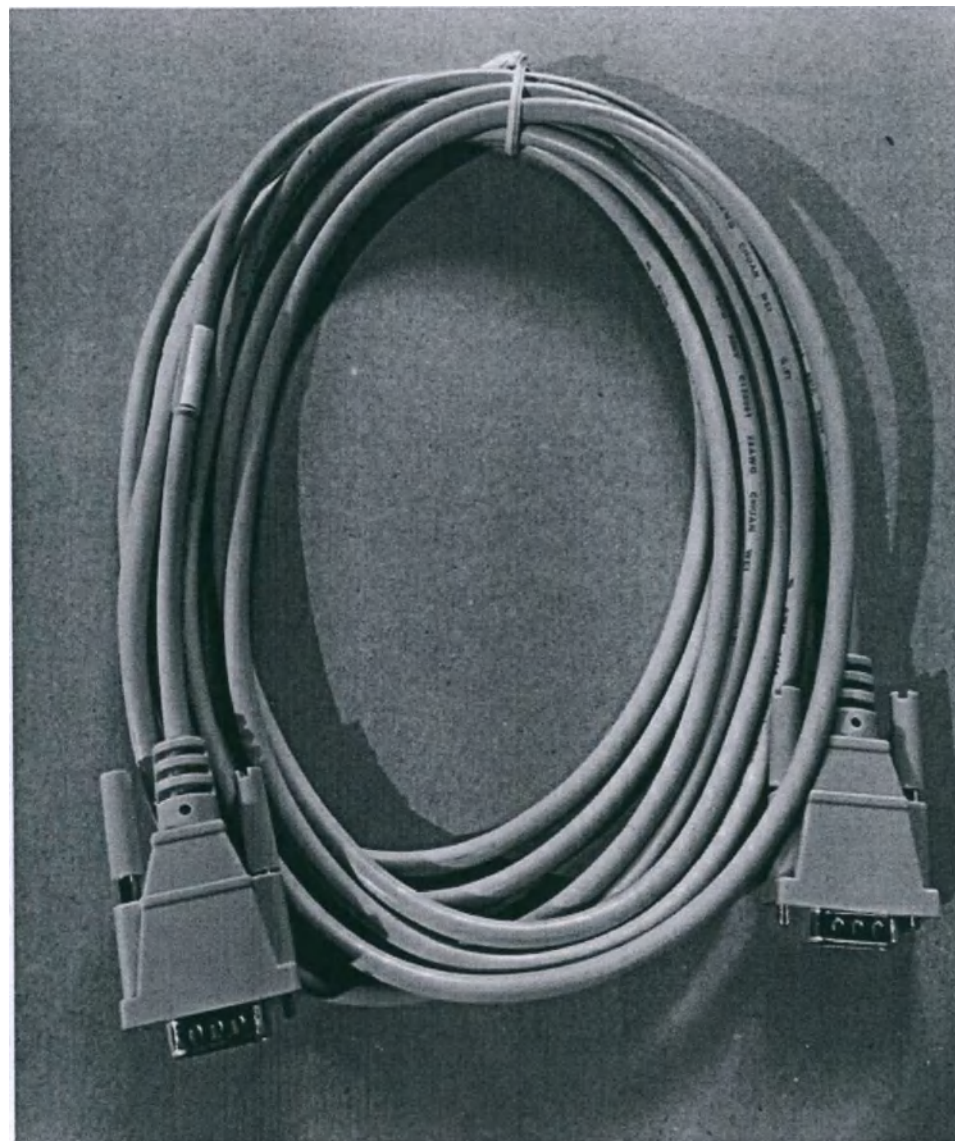

Кабель для велоэргометра, соединительный, РУ №ФСЗ 2010/06043




Манжета для измерения НИАД: стандартная, большая и малая (детская), РУ №ФСЗ 2010/06043

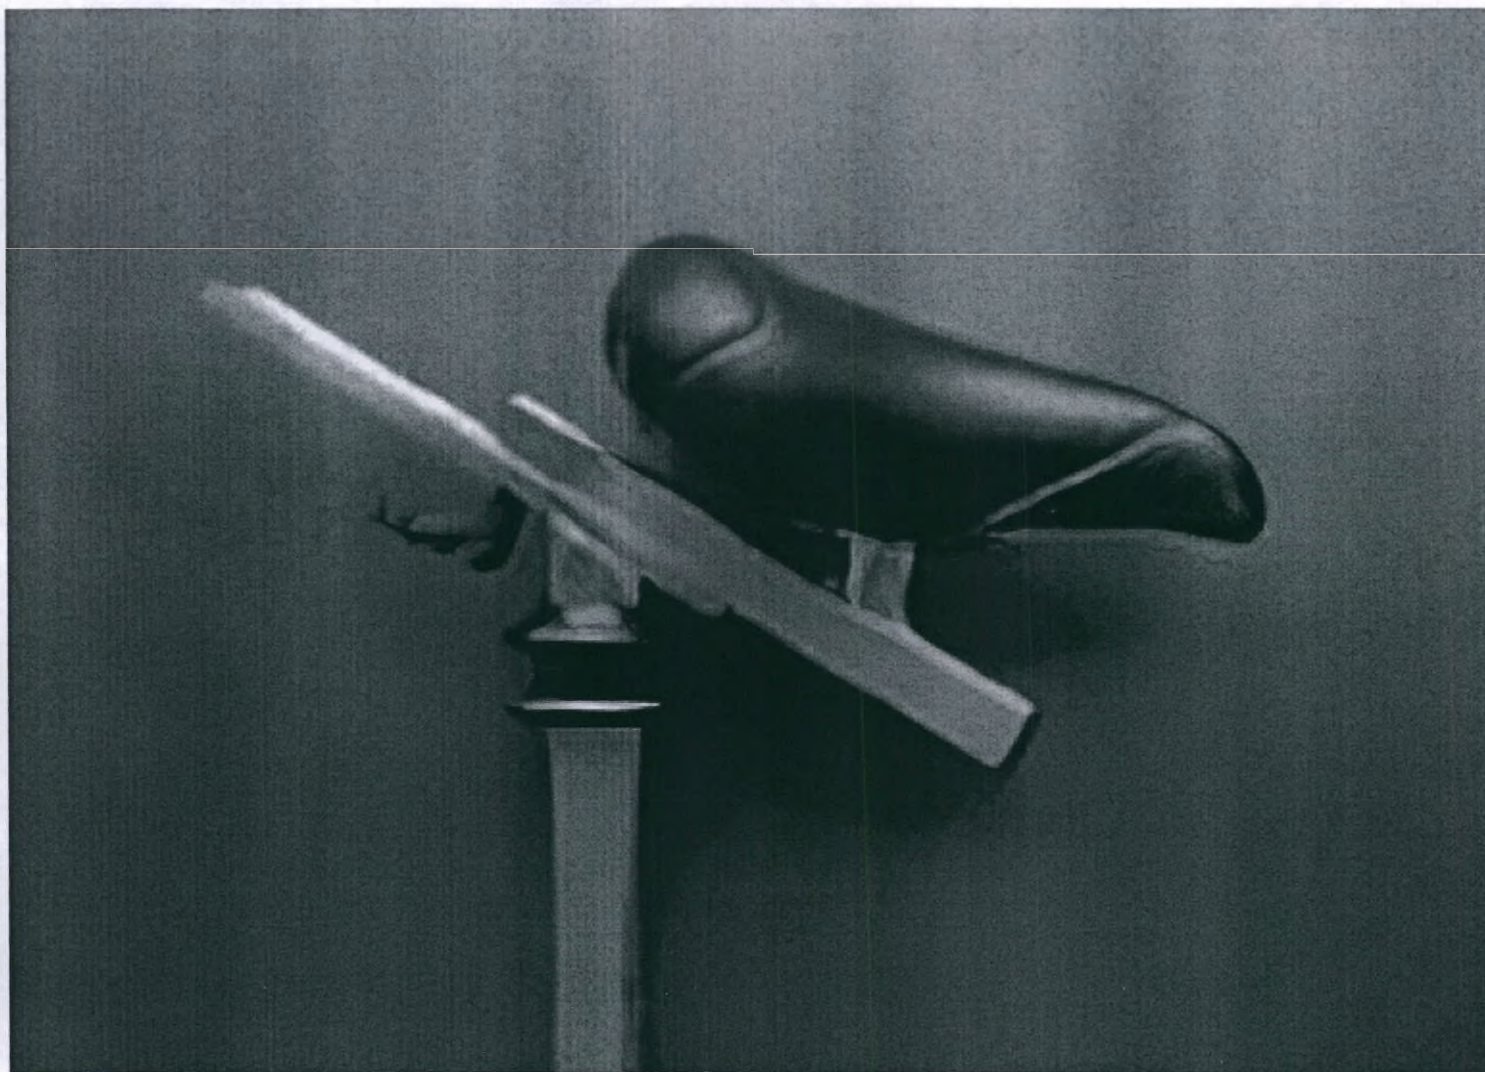

Сидение для детей, РУ №ФСЗ 2010/06043




Педали с фиксаторами для детей, РУ №ФСЗ 2010/06043

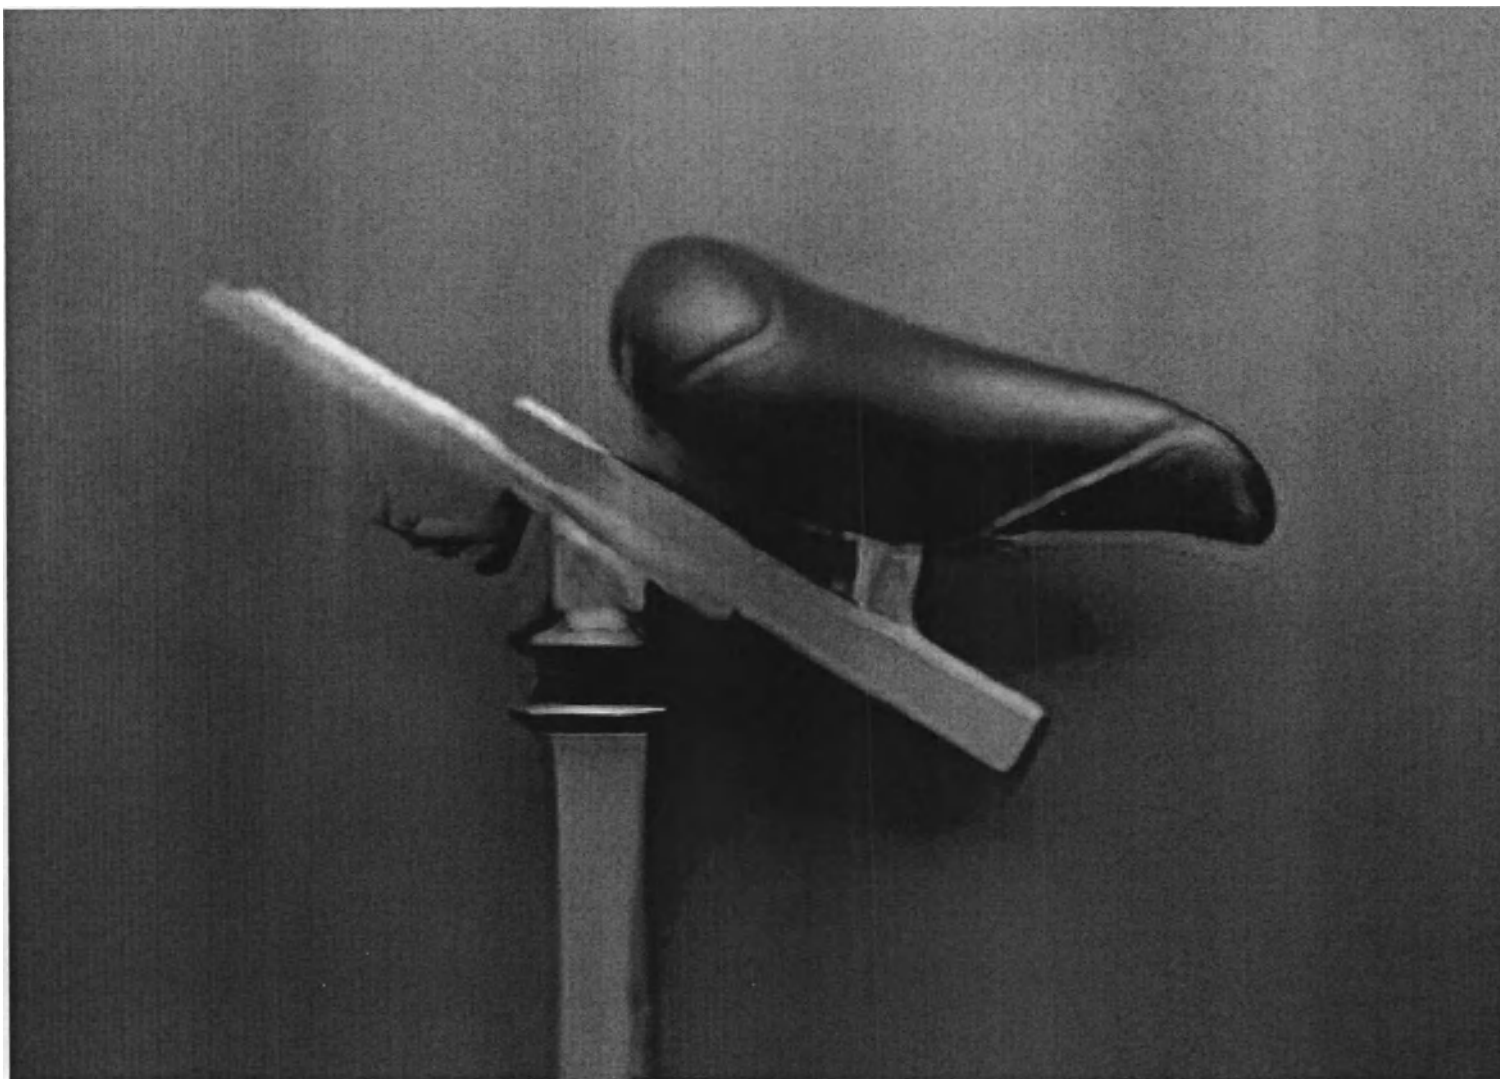


Устройство для настройки детского сидения, РУ №ФСЗ 2010/06043



Датчик пульсоксиметрический, РУ №ФСЗ 2010/06043

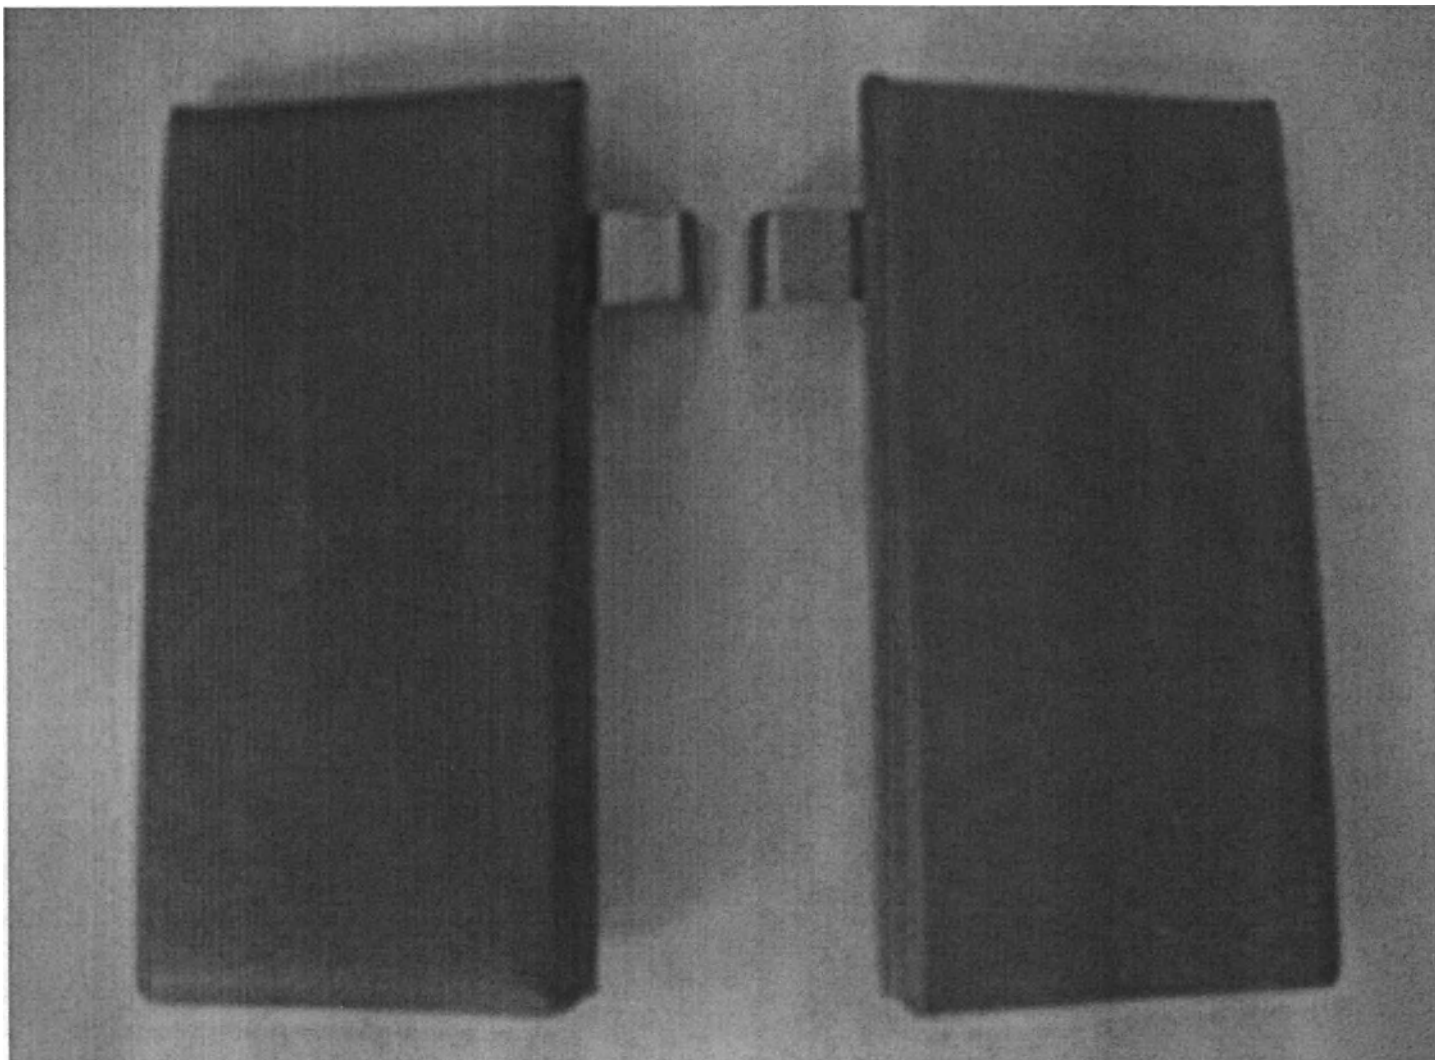

Опора для ног, РУ №ФСЗ 2010/06043

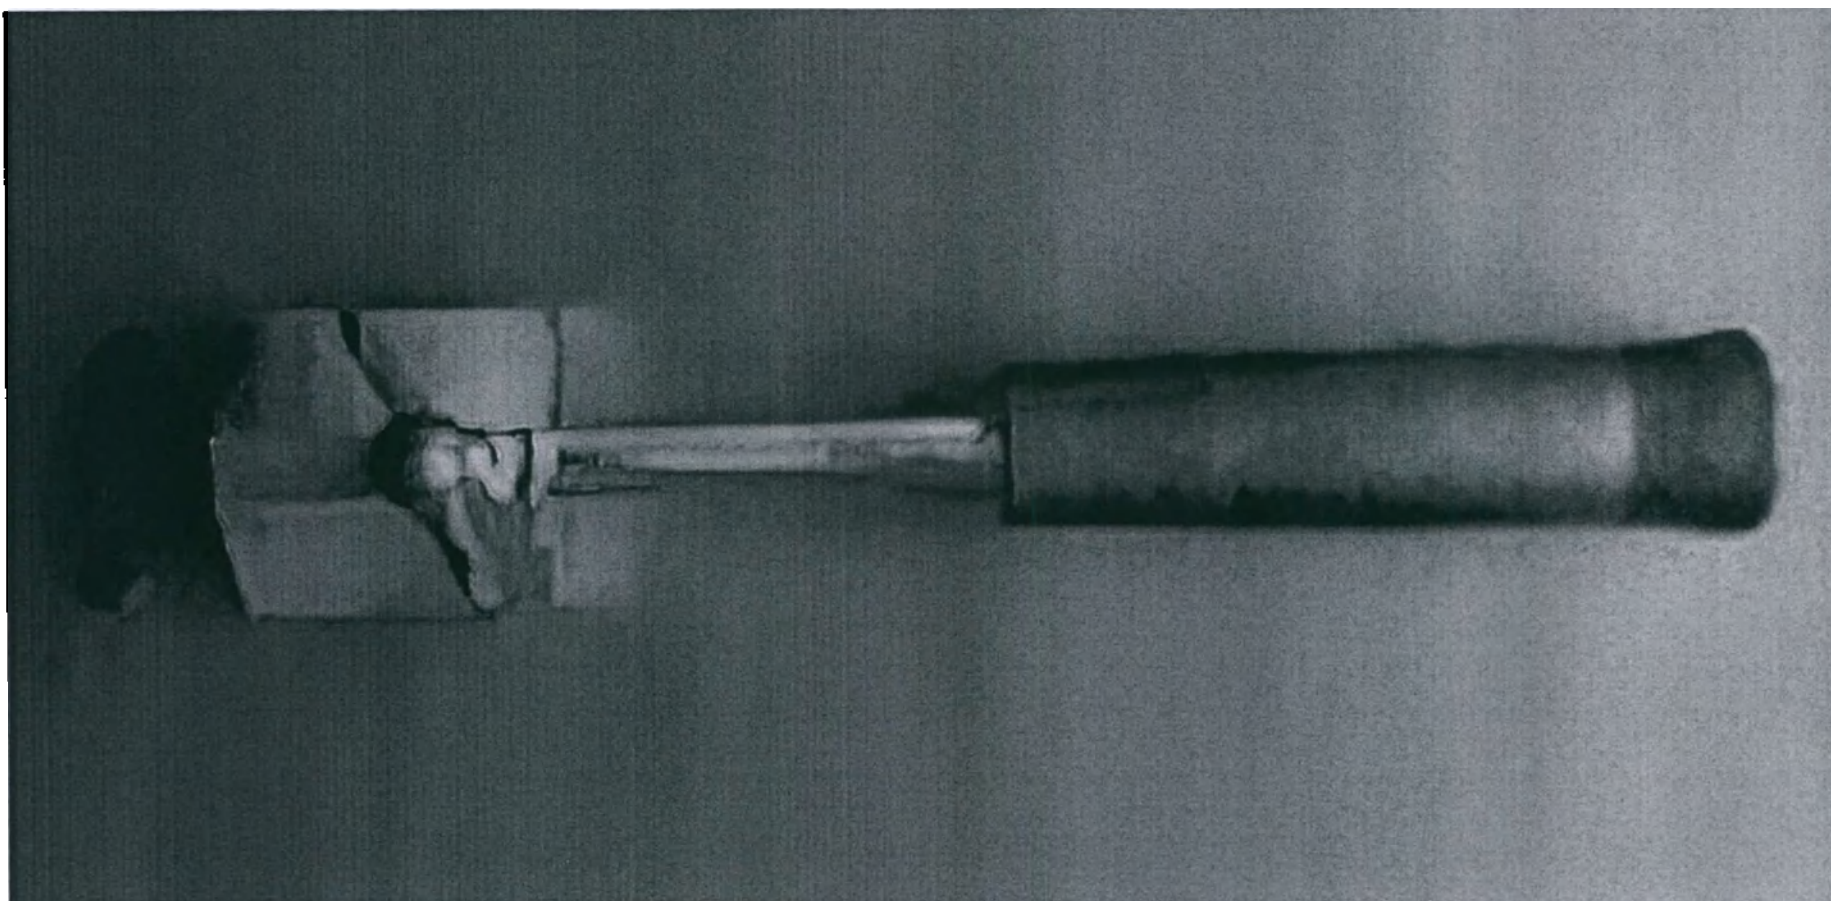


Рукоятка для лежащего велоэргометра, РУ №ФСЗ 2010/06043



Опора для руки с подставкой, РУ №ФСЗ 2010/06043




Контроллер управления для велоэргометра (BP, S), РУ №ФСЗ 2010/06043

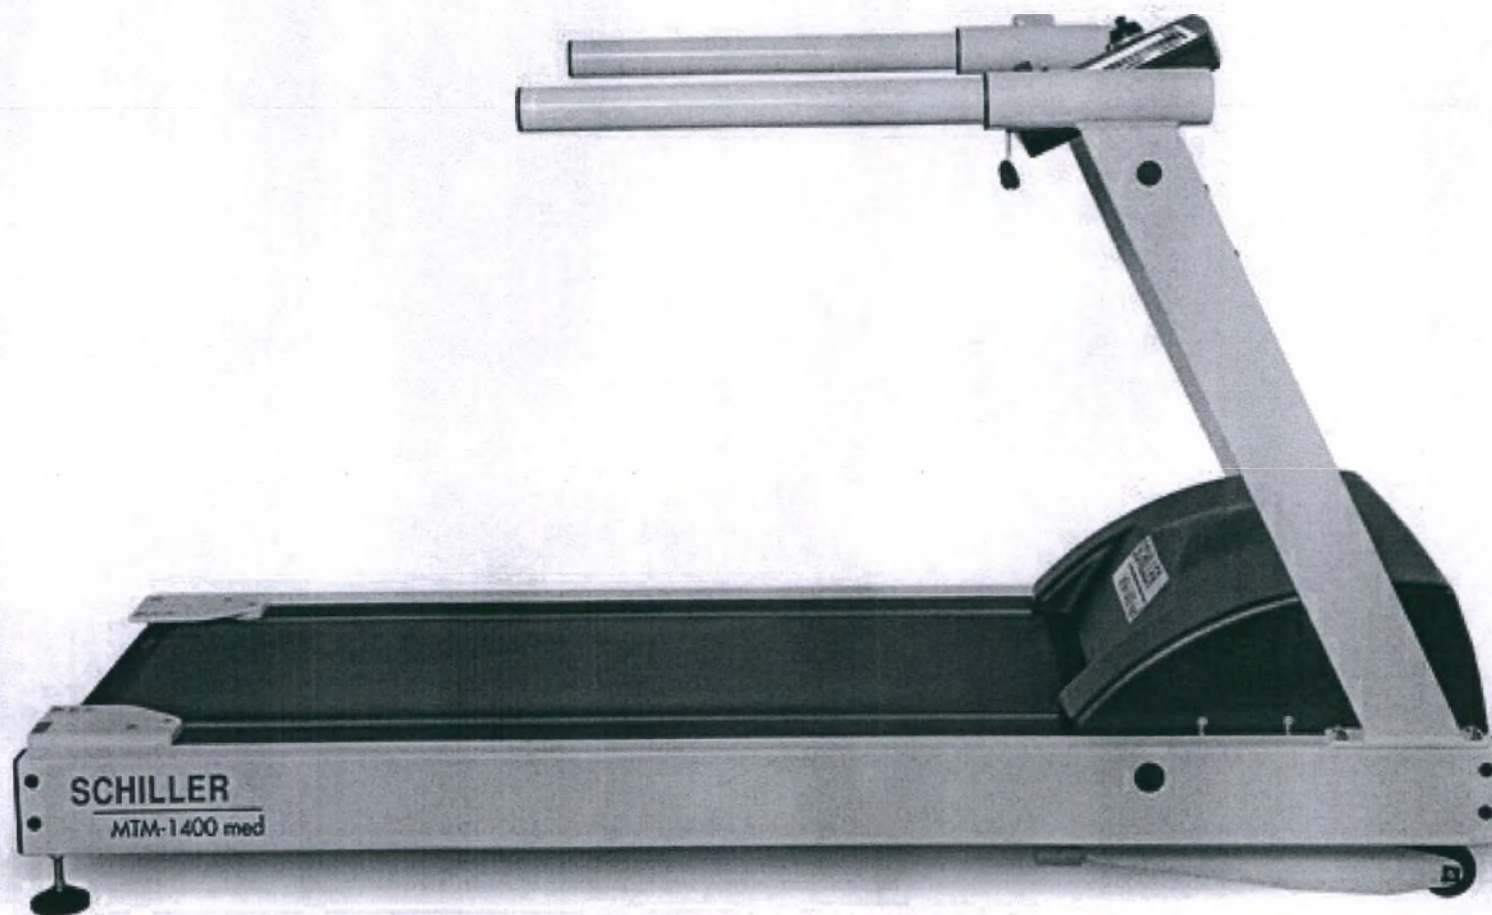


Беговая дорожка H/P/COSMOS pluto | SCHILLER MTM-1400 MED с поручнями: стандартными, длинными, многоуровневыми



Беговая дорожка: Н/Р/COSMOS, вариант исполнения MTM-1500 med, РУ №ФСЗ 2010/06043

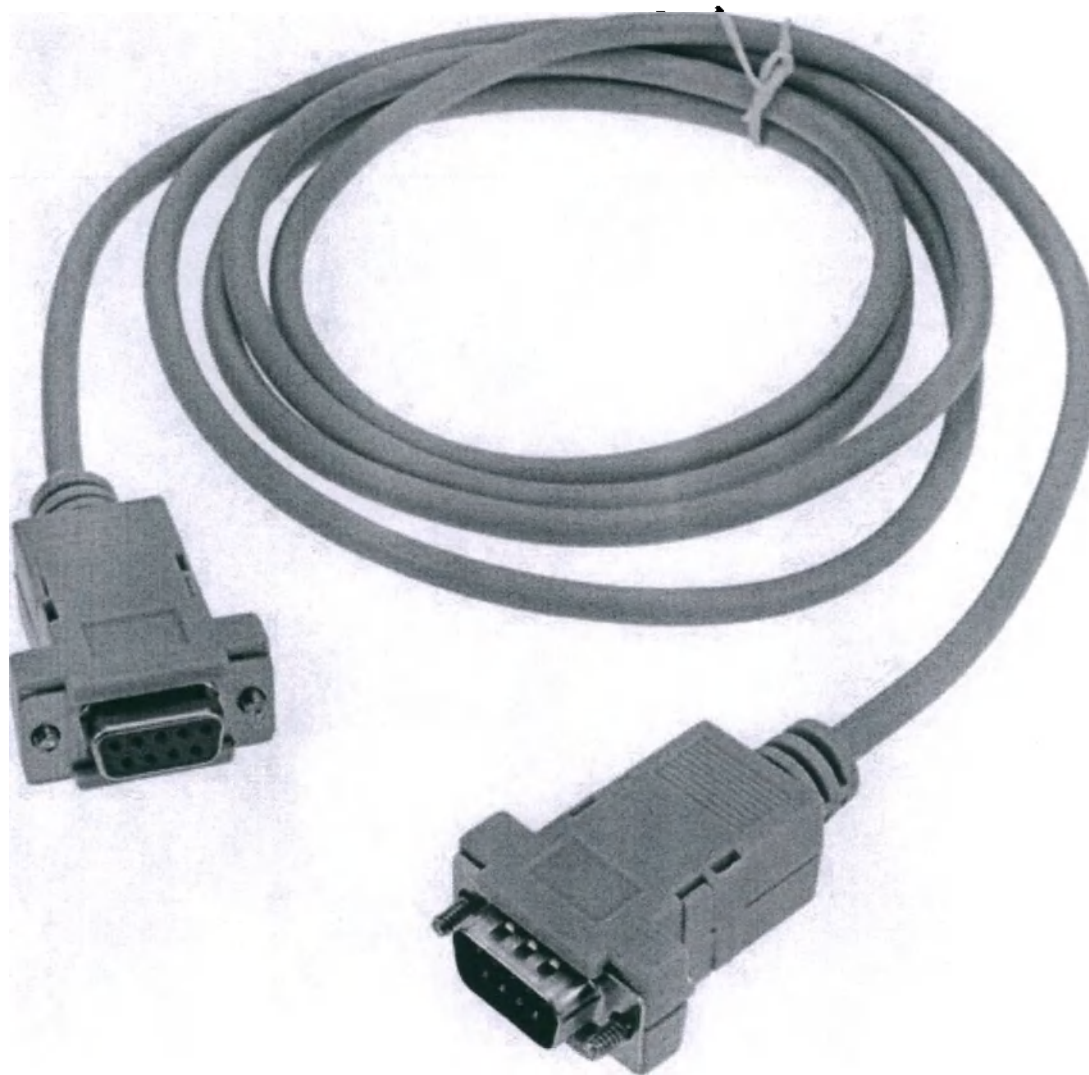


Кабель для беговой дорожки соединительный, РУ №ФСЗ 2010/06043

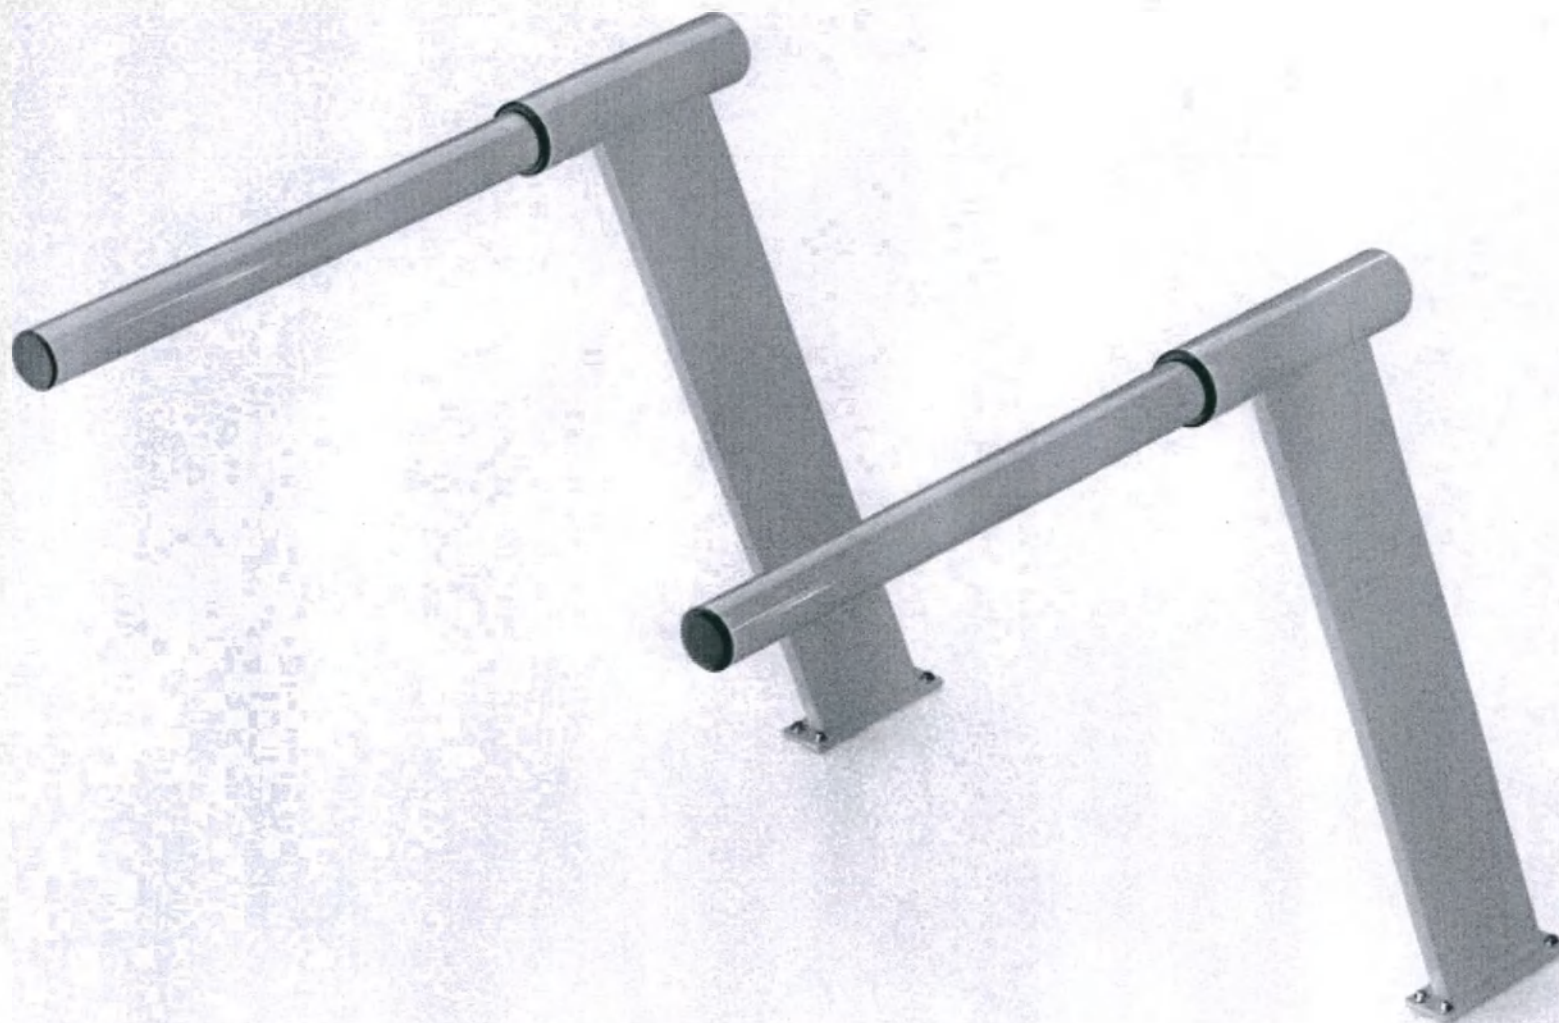


Поручень для беговой дорожки, РУ №ФС3 2010/06043



Арка для страховки пациента для беговой дорожки, РУ №ФСЗ 2010/06043

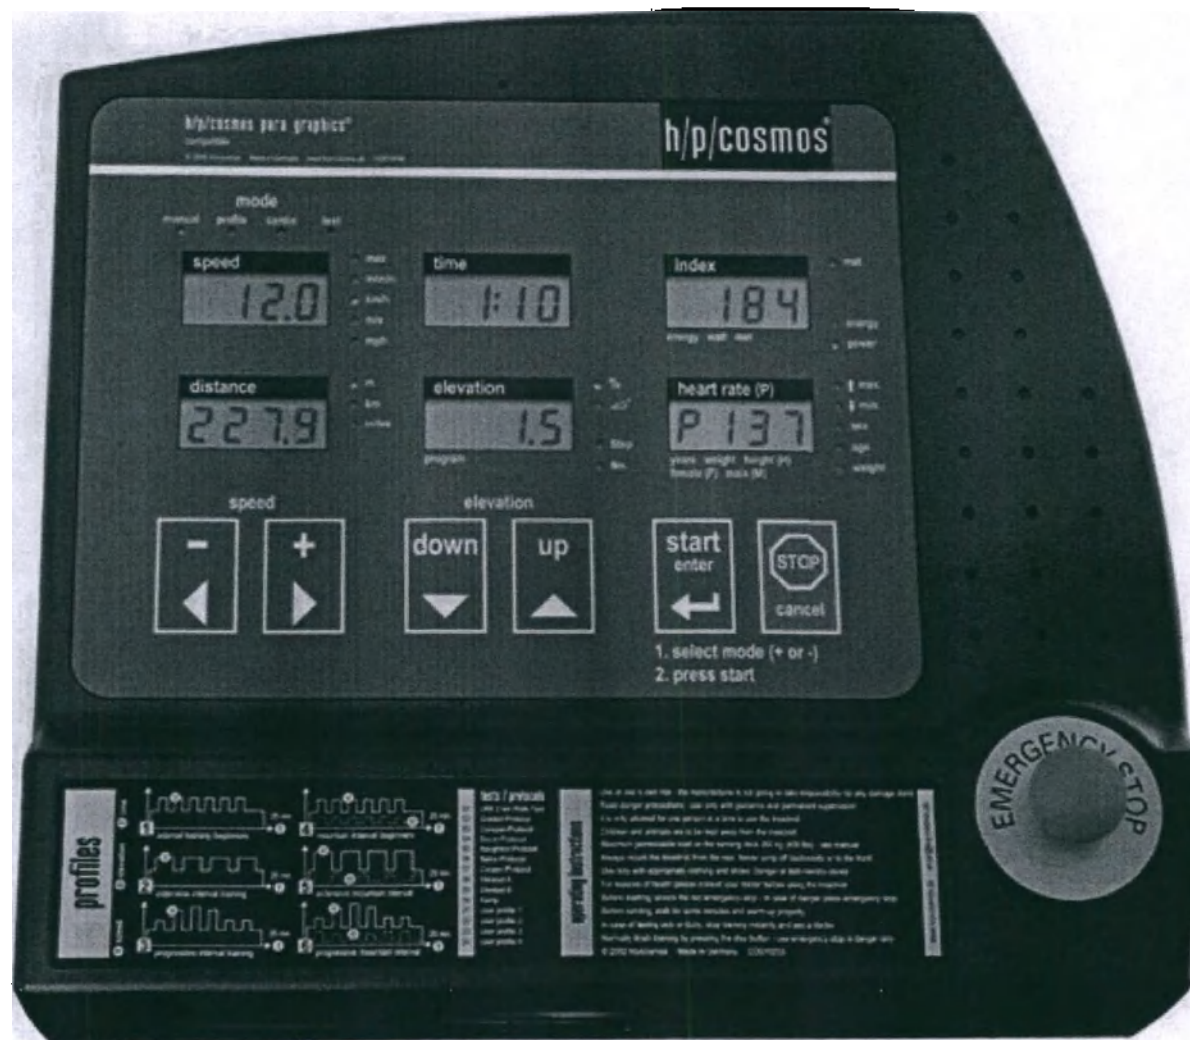


Контроллер управления для беговой дорожки, РУ №ФСЗ 2010/06043

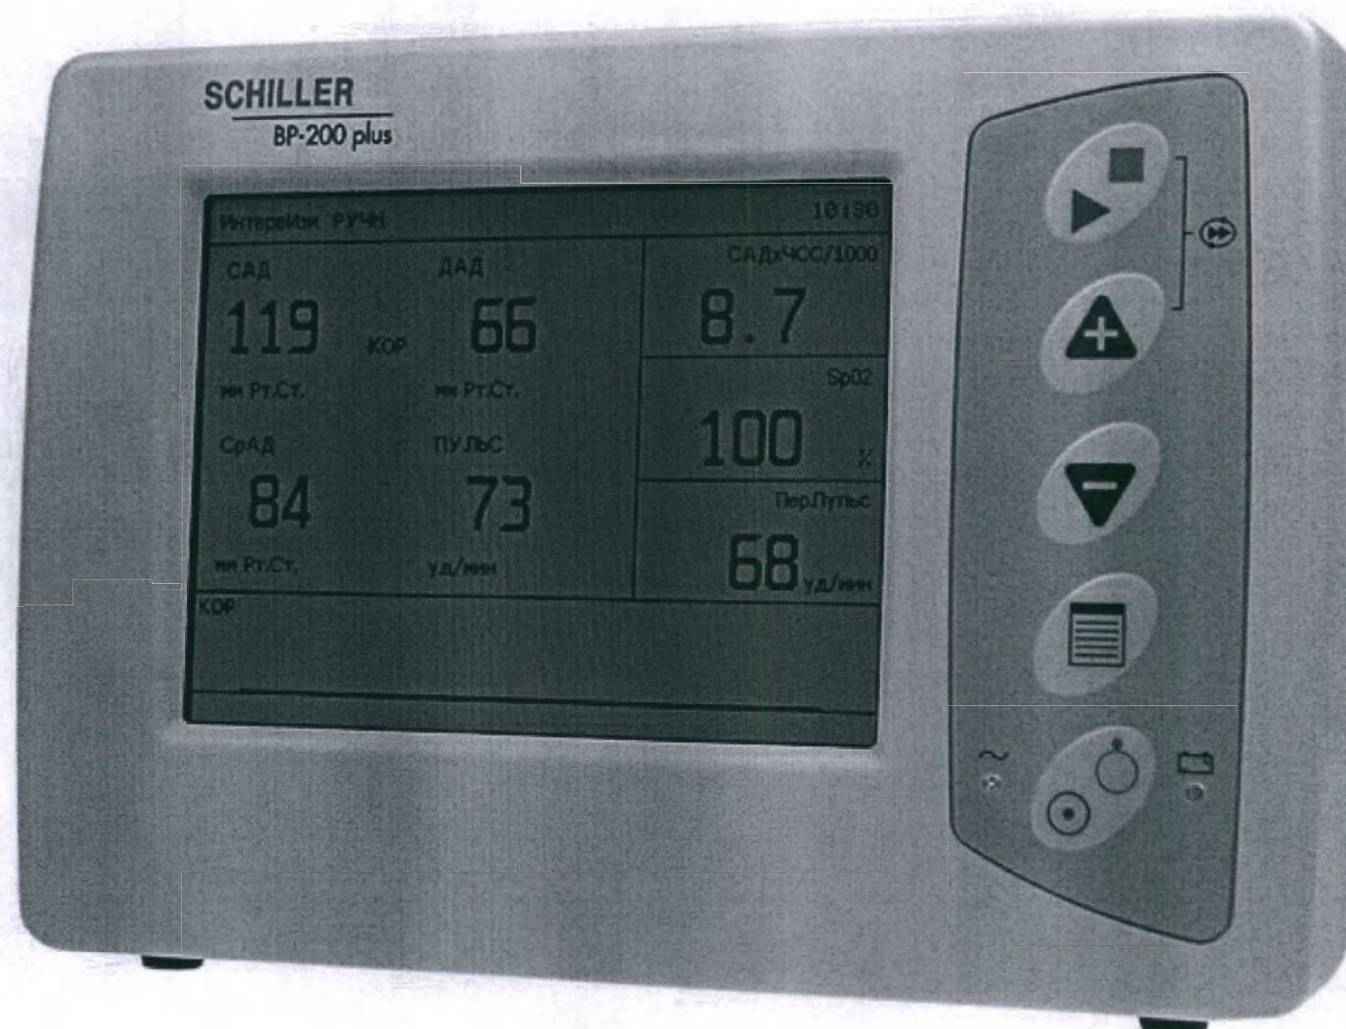


Регистратор АД: BP-200, мод.: plus, РУ №РЗН 2016/4341



Манжета для измерения НИАД: малая (S), средняя (M), большая (L), РУ №РЗН 2016/4341

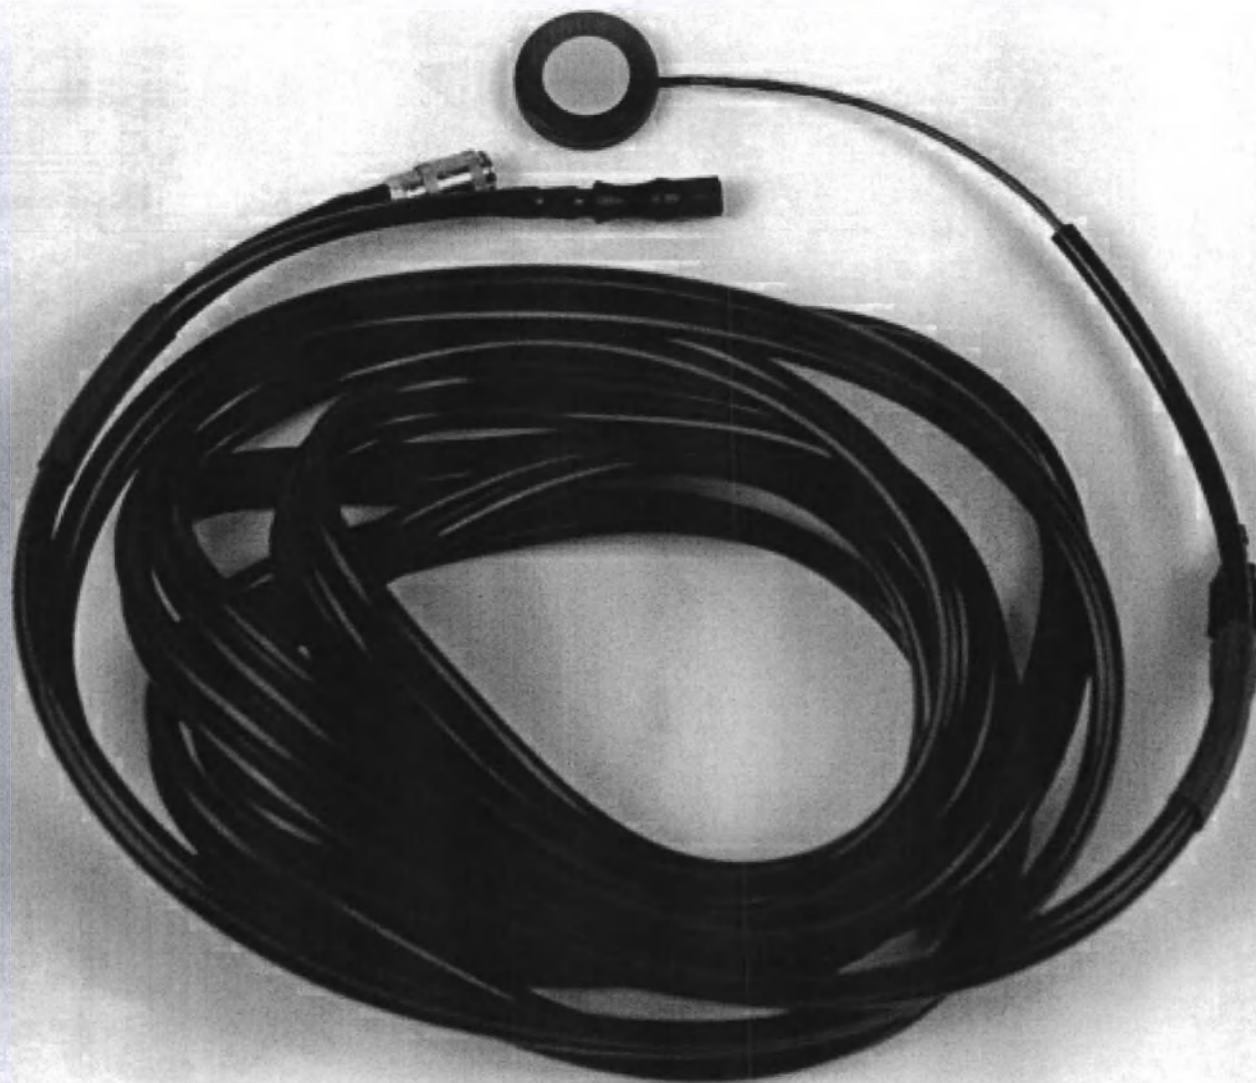


Микрофон с соединительной трубкой, РУ №РЗН 2016/4341

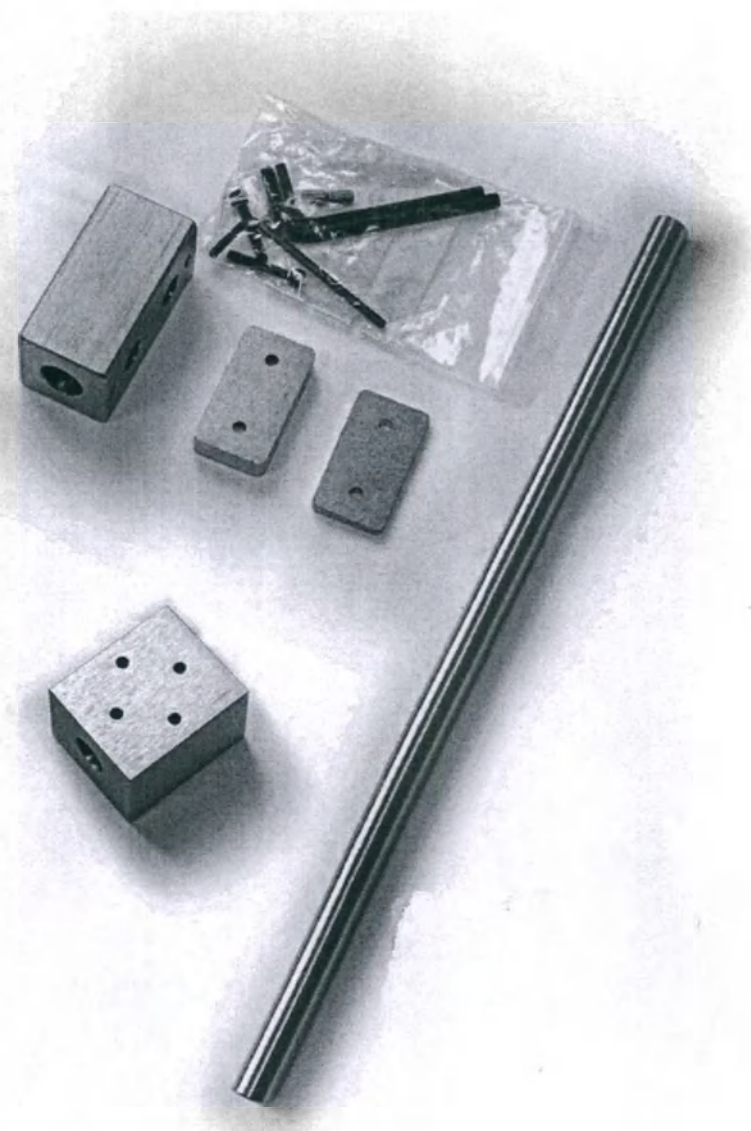


Крепление регистратора АД для тележки




Адаптер для устройства вакуумной аппликации электродов ЭКГ

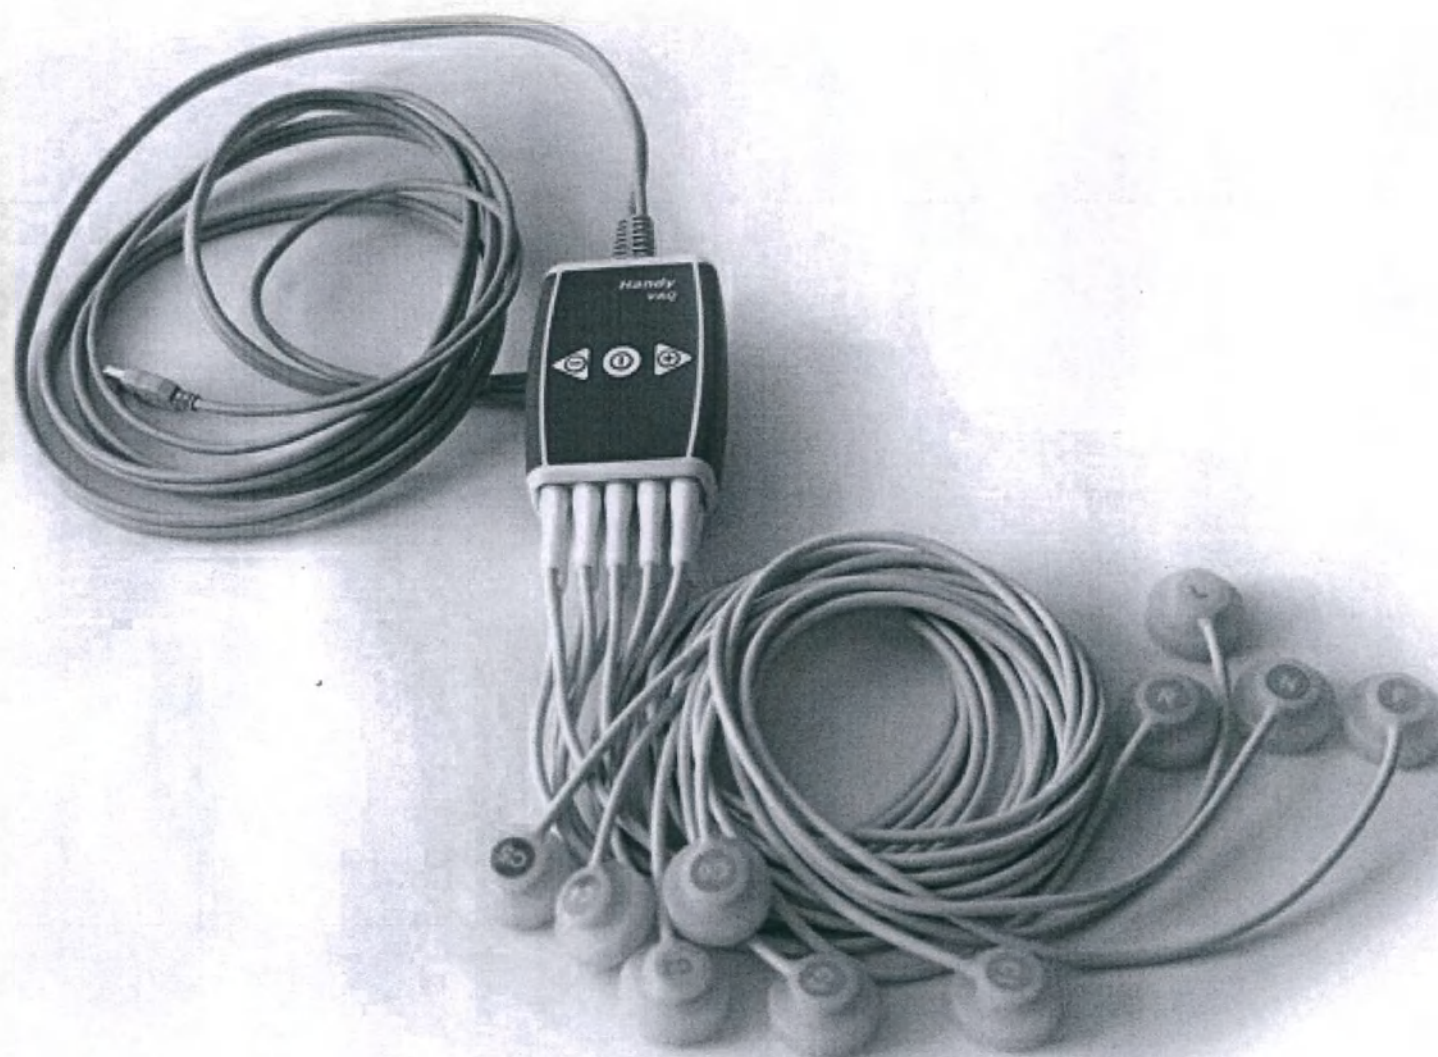


Устройство вакуумной аппликации электродов ЭКГ handy vaq со сменными отведениями

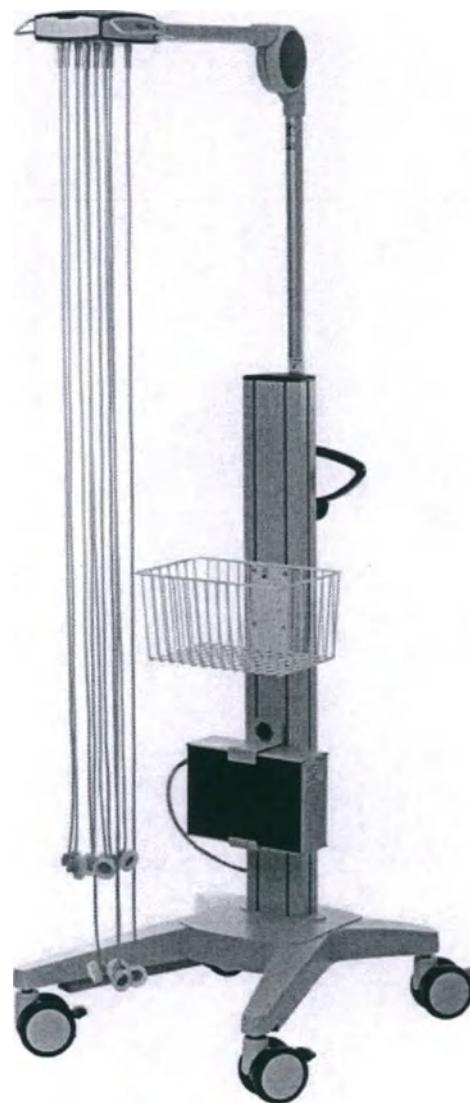


Устройство вакуумной аппликации электродов ЭКГ ergo vac со сменными отведениями, вариант исполнения: ergo vac

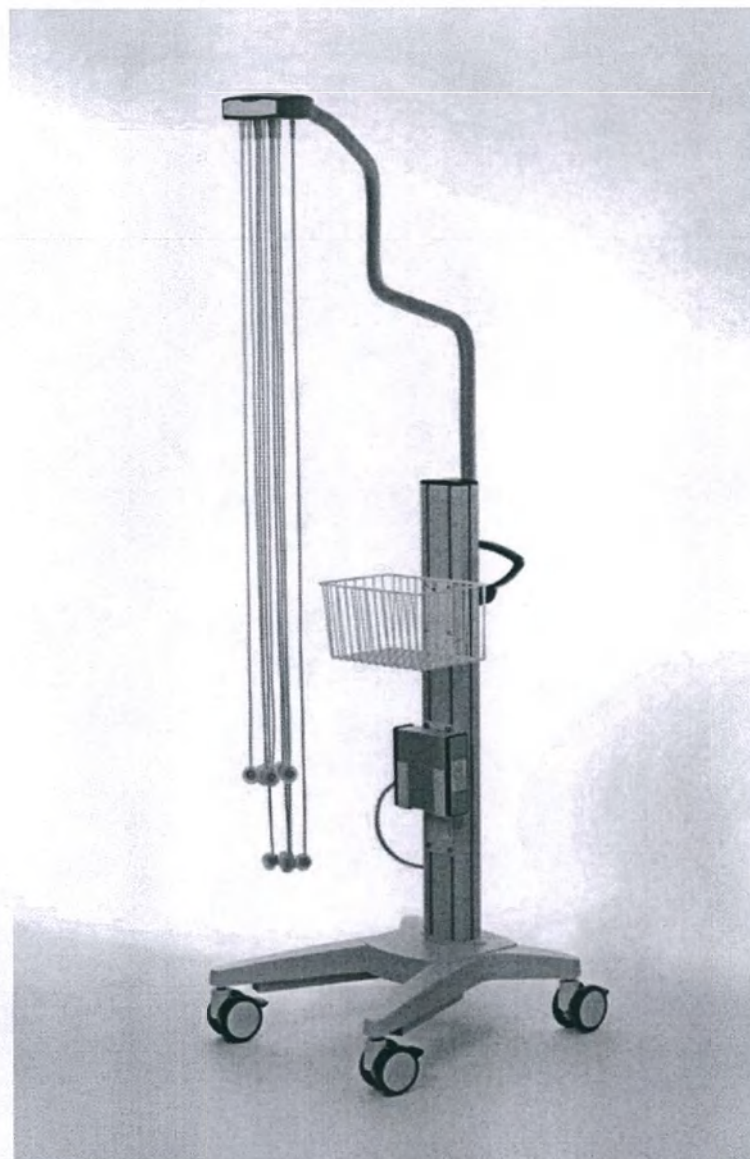


Устройство вакуумной аппликации электродов ЭКГ ergo vac со сменными отведениями, вариант исполнения: ergo vac LT

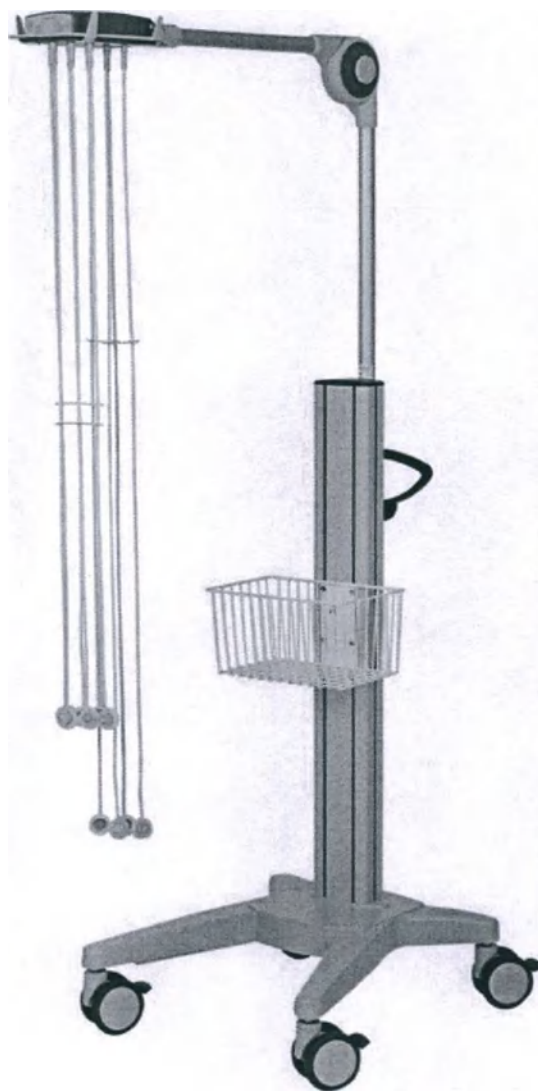

Устройство вакуумной аппликации электродов ЭКГ ergo vac со сменными отведениями, вариант исполнения: ergo vac compact

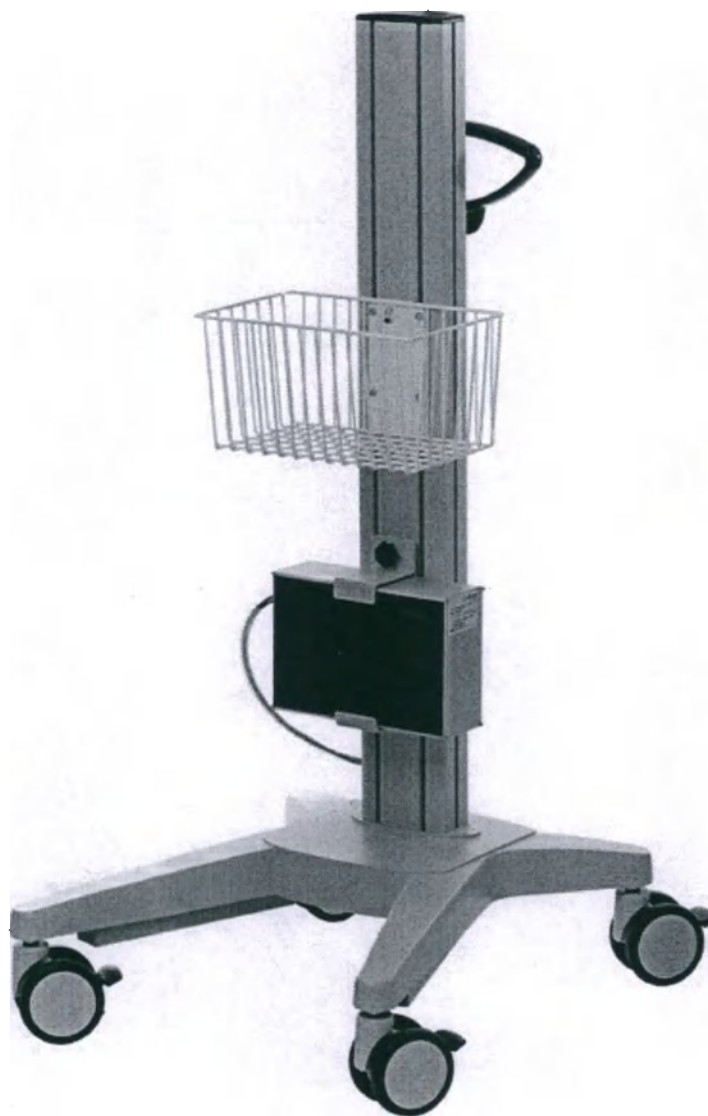


Стойка для устройства вакуумной аппликации электродов ЭКГ ergo vac

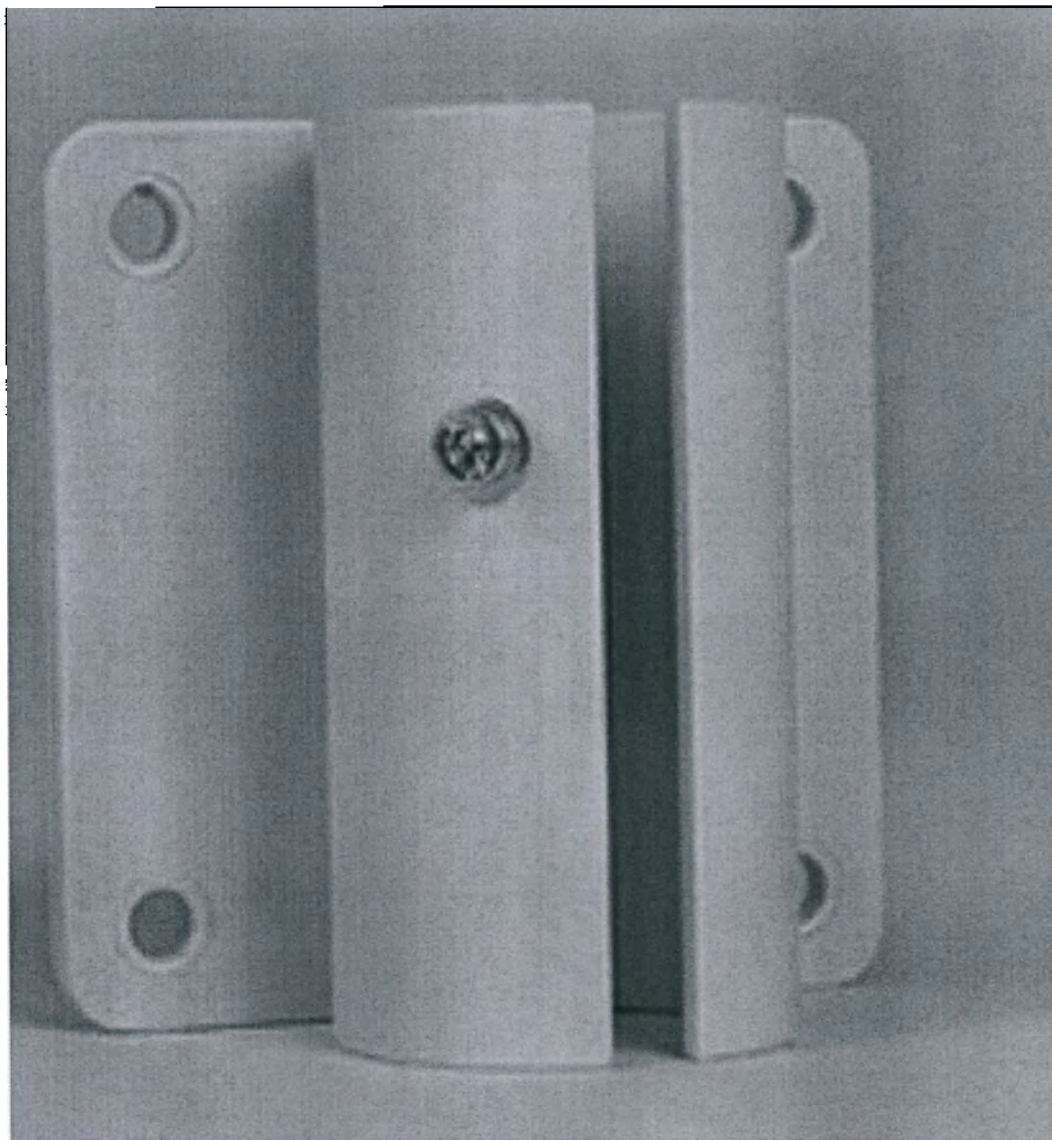

Держатель устройства вакуумной аппликации электродов ЭКГ для тележки



Датчик спирометрический SpiroScout SP plus

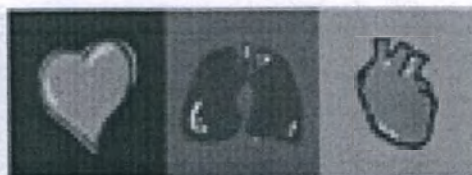

SCHILLER
SWITZERLAND

Сертификат на активацию

Серийный номер:


XXXX.XXXXXX


CARDIOVIT CS-104

Ключ активации:


XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

Ключ активации лицензии программного обеспечения спирометрии
(предоставляется на бумажном или электронном носителе или по электронной почте)

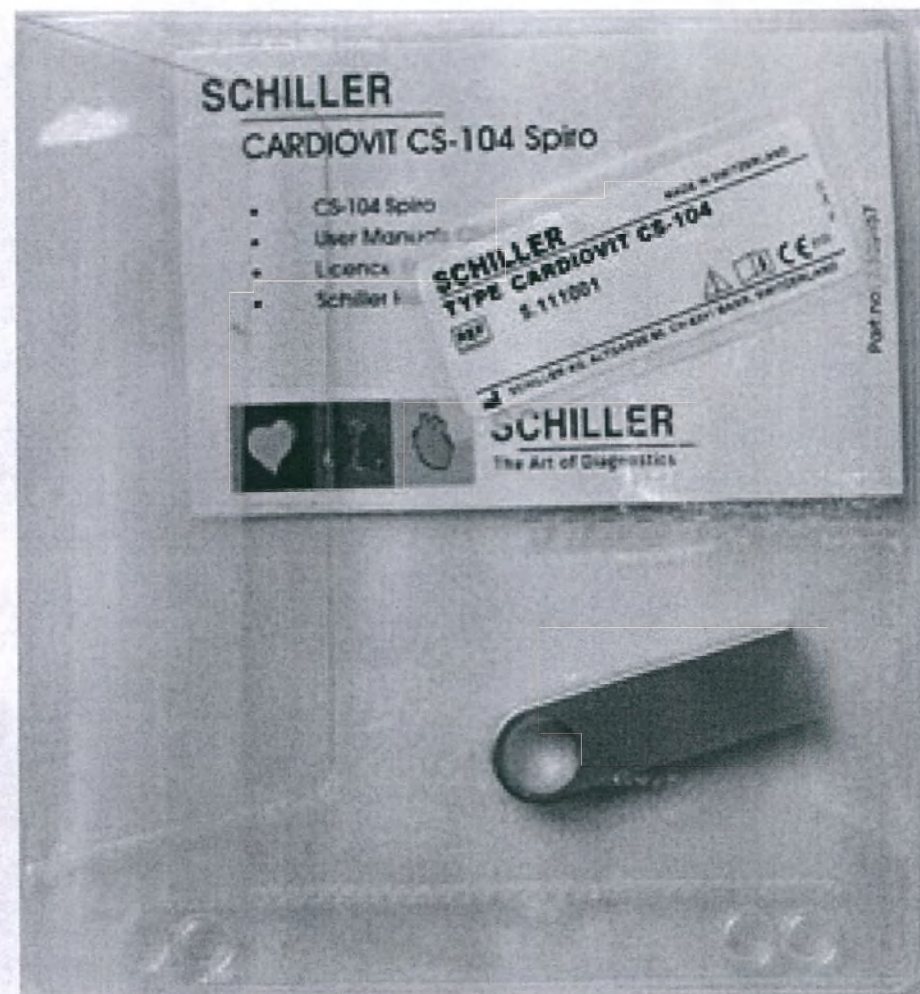

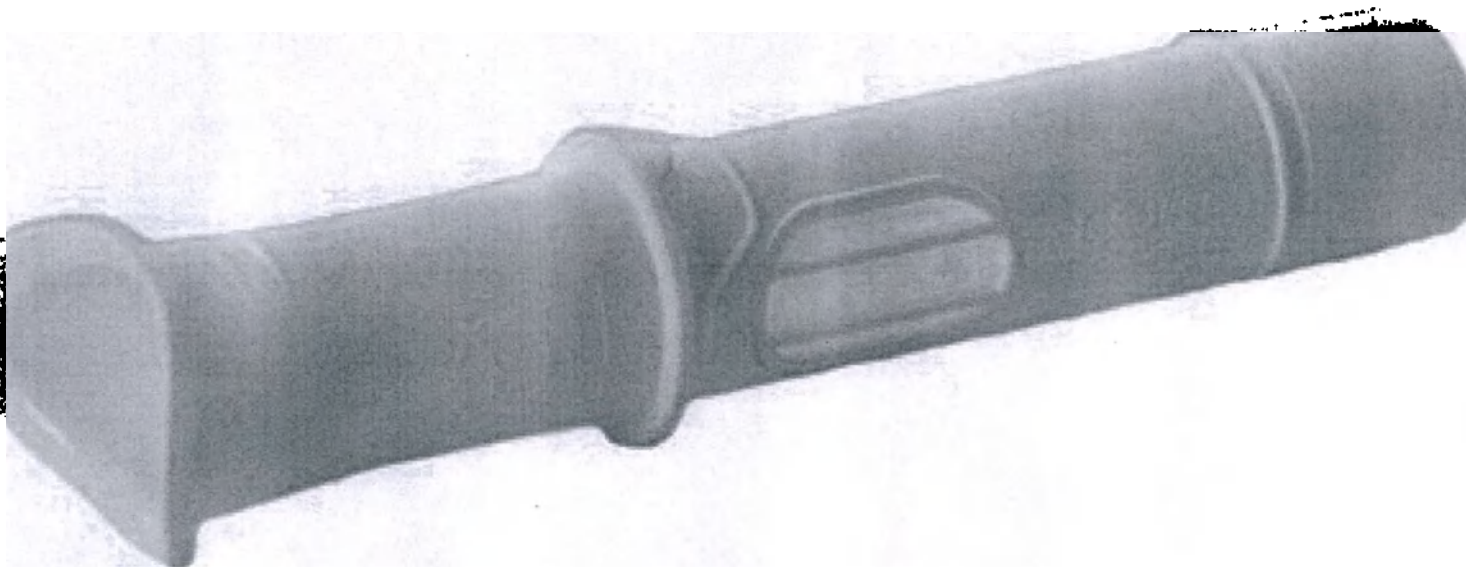

Дыхательная трубка одноразовая ScoutTube

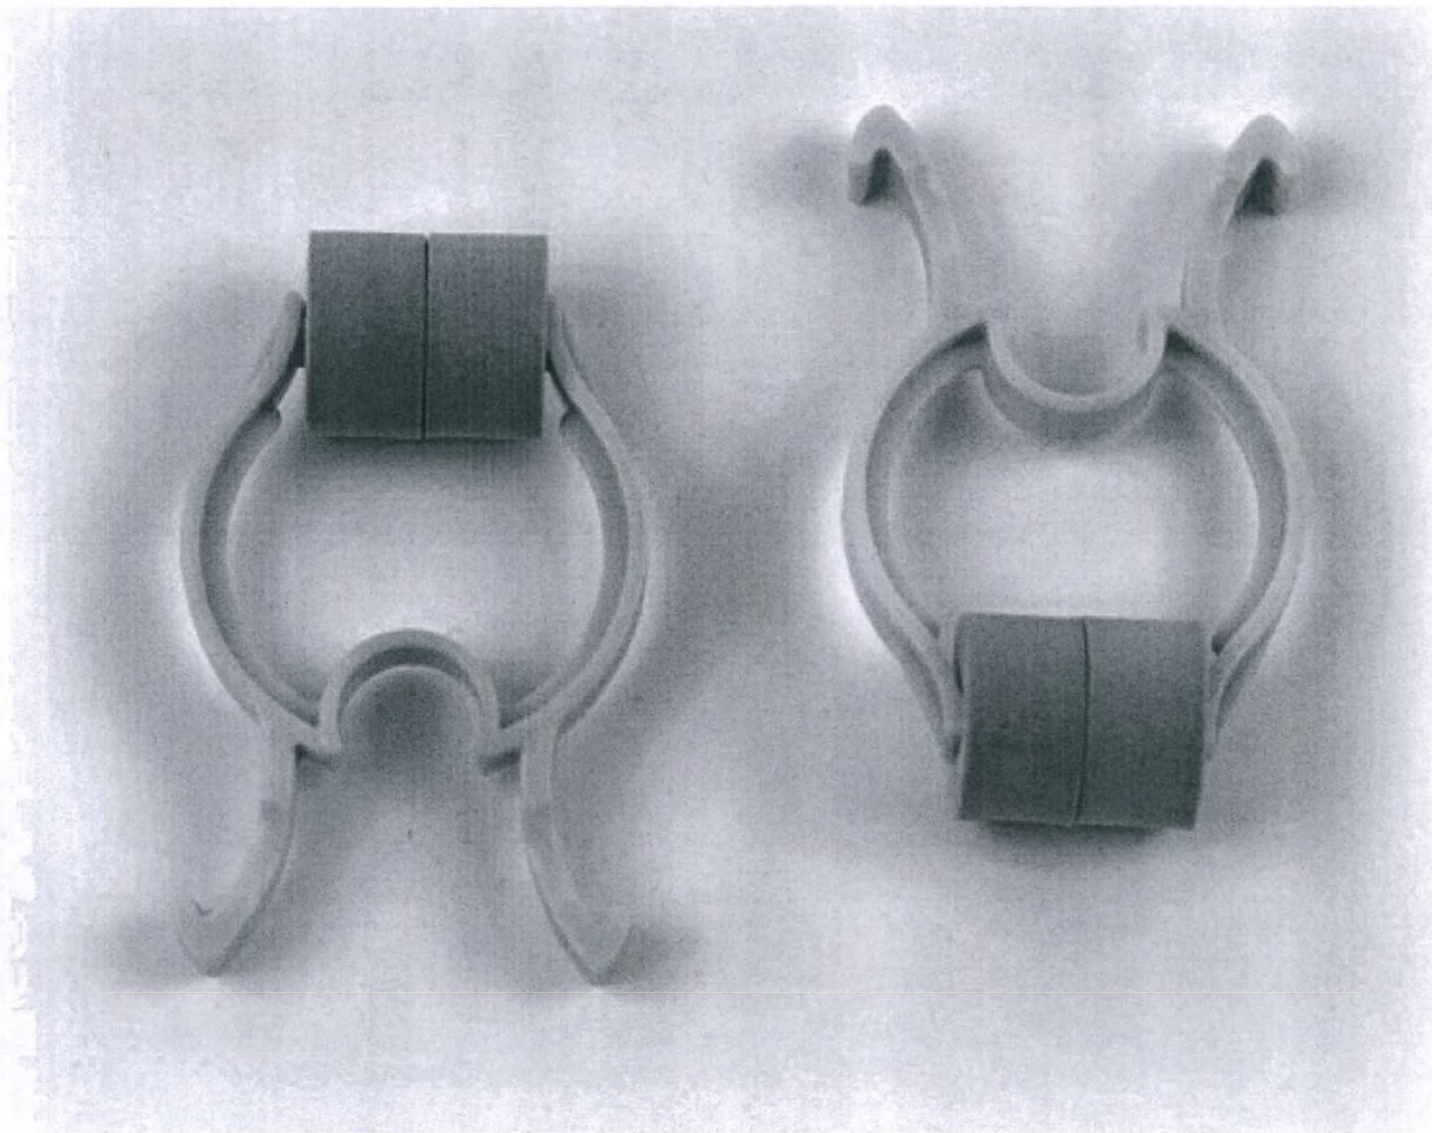


Зажим для носа



Калибровочный насос



Адаптер для калибровочного насоса

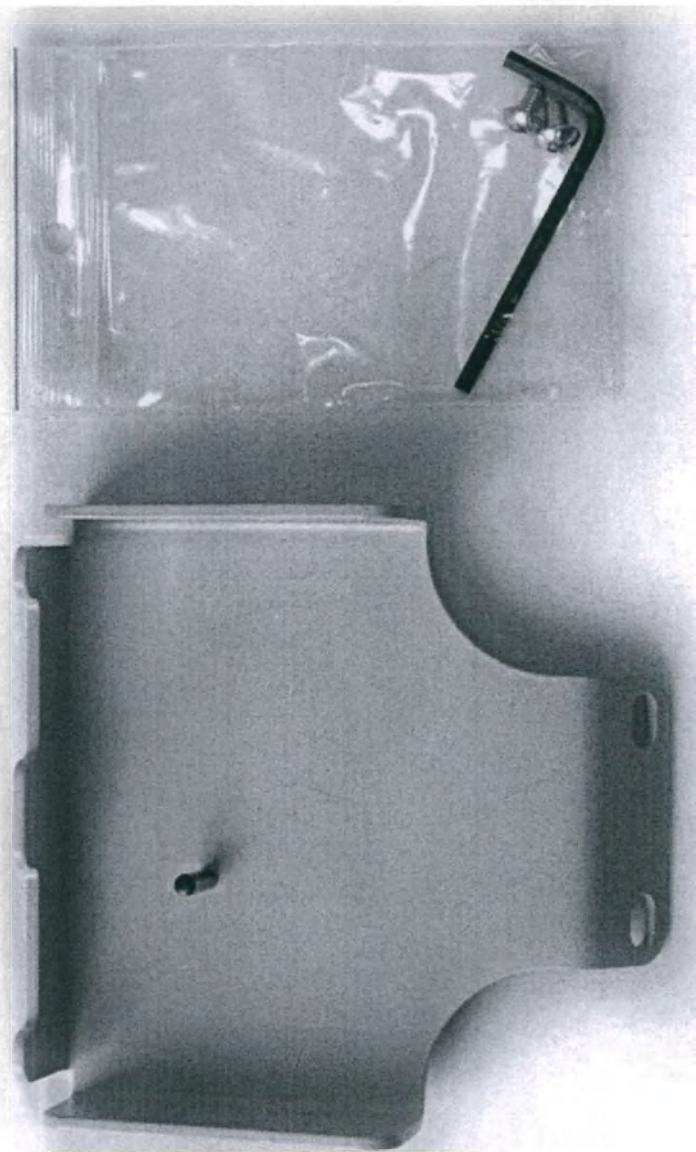

Держатель спирометрического датчика для тележки


Принадлежности



Чехол одноразовый



Сумка для аксессуаров

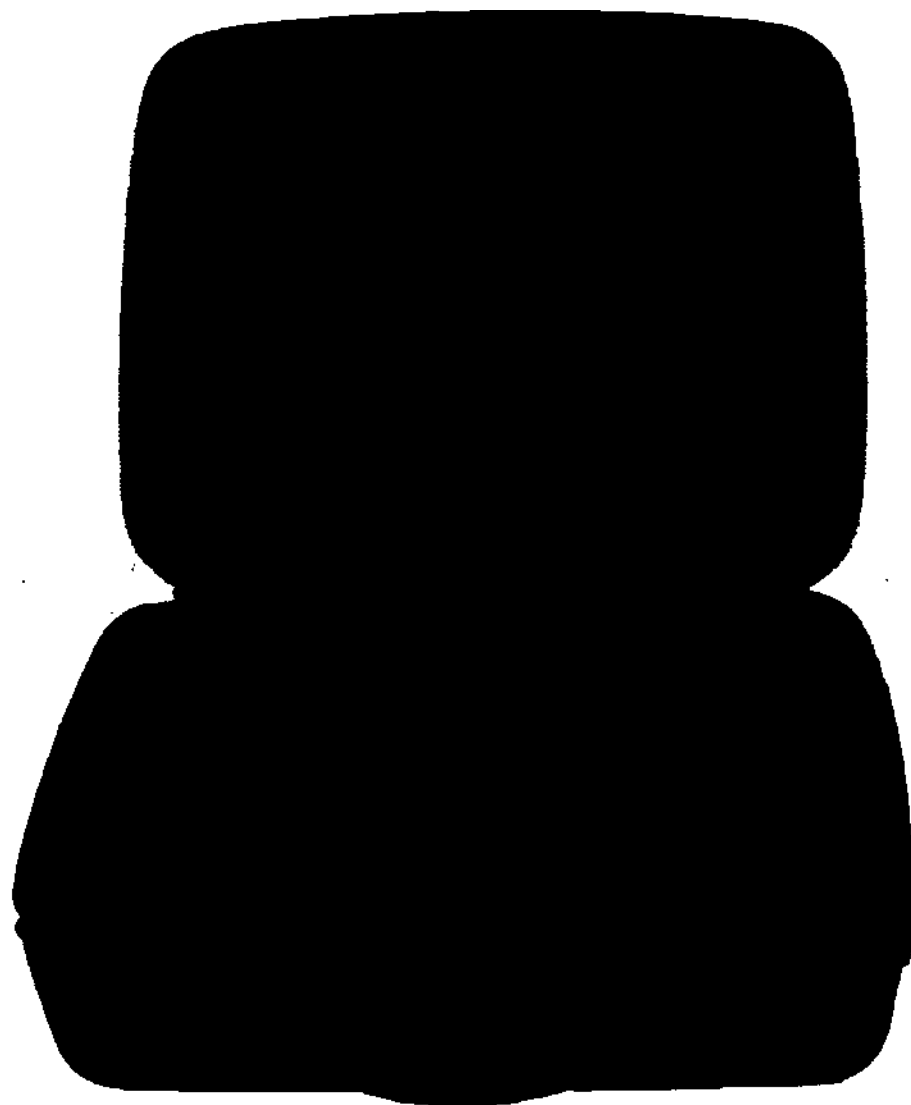

Сумка для переноски CARDIOVIT FT-1

Всего прошито и
скреплено печатью
83 листа (ов)

