

Фотографические изображения медицинского изделия  
**Аппарат ультразвуковой диагностический серии М с  
принадлежностями, варианты исполнения:  
М9, М9Т, М9СV, М8, М8GІ**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель по нормативным вопросам

ООО «Миндрей Медикал Рус»

*Сысоева* Сысоева Н.В.



2020 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Миндрей Медикал Рус»**

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5, антресоль 4, помещение I, ком.7, 11А

Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39

ИНН 7705815069 КПП 770201001

**Аппарат ультразвуковой диагностический серии М с принадлежностями,  
вариант исполнения М9**

**Модель: М9**

**Регистрационное удостоверение**

**№ РЗН**

**от**

**года**



Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. («Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал  
Электроникс Ко., Лтд.»), КНР

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057 Shenzhen, People's  
Republic of China

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «Миндрей Медикал Рус»

Адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5, антресоль 4, помещение I, ком.7, 11А


Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39

E-mail: [info.ru@mindray.com](mailto:info.ru@mindray.com)


Аппарат ультразвуковой диагностический серии М с принадлежностями, вариант исполнения: М9 (1. Основной блок (Main Unit) -1 шт.)




Аппарат ультразвуковой диагностический серии М с принадлежностями, вариант исполнения: М9Т (1. Основной блок (Main Unit) -1 шт.)

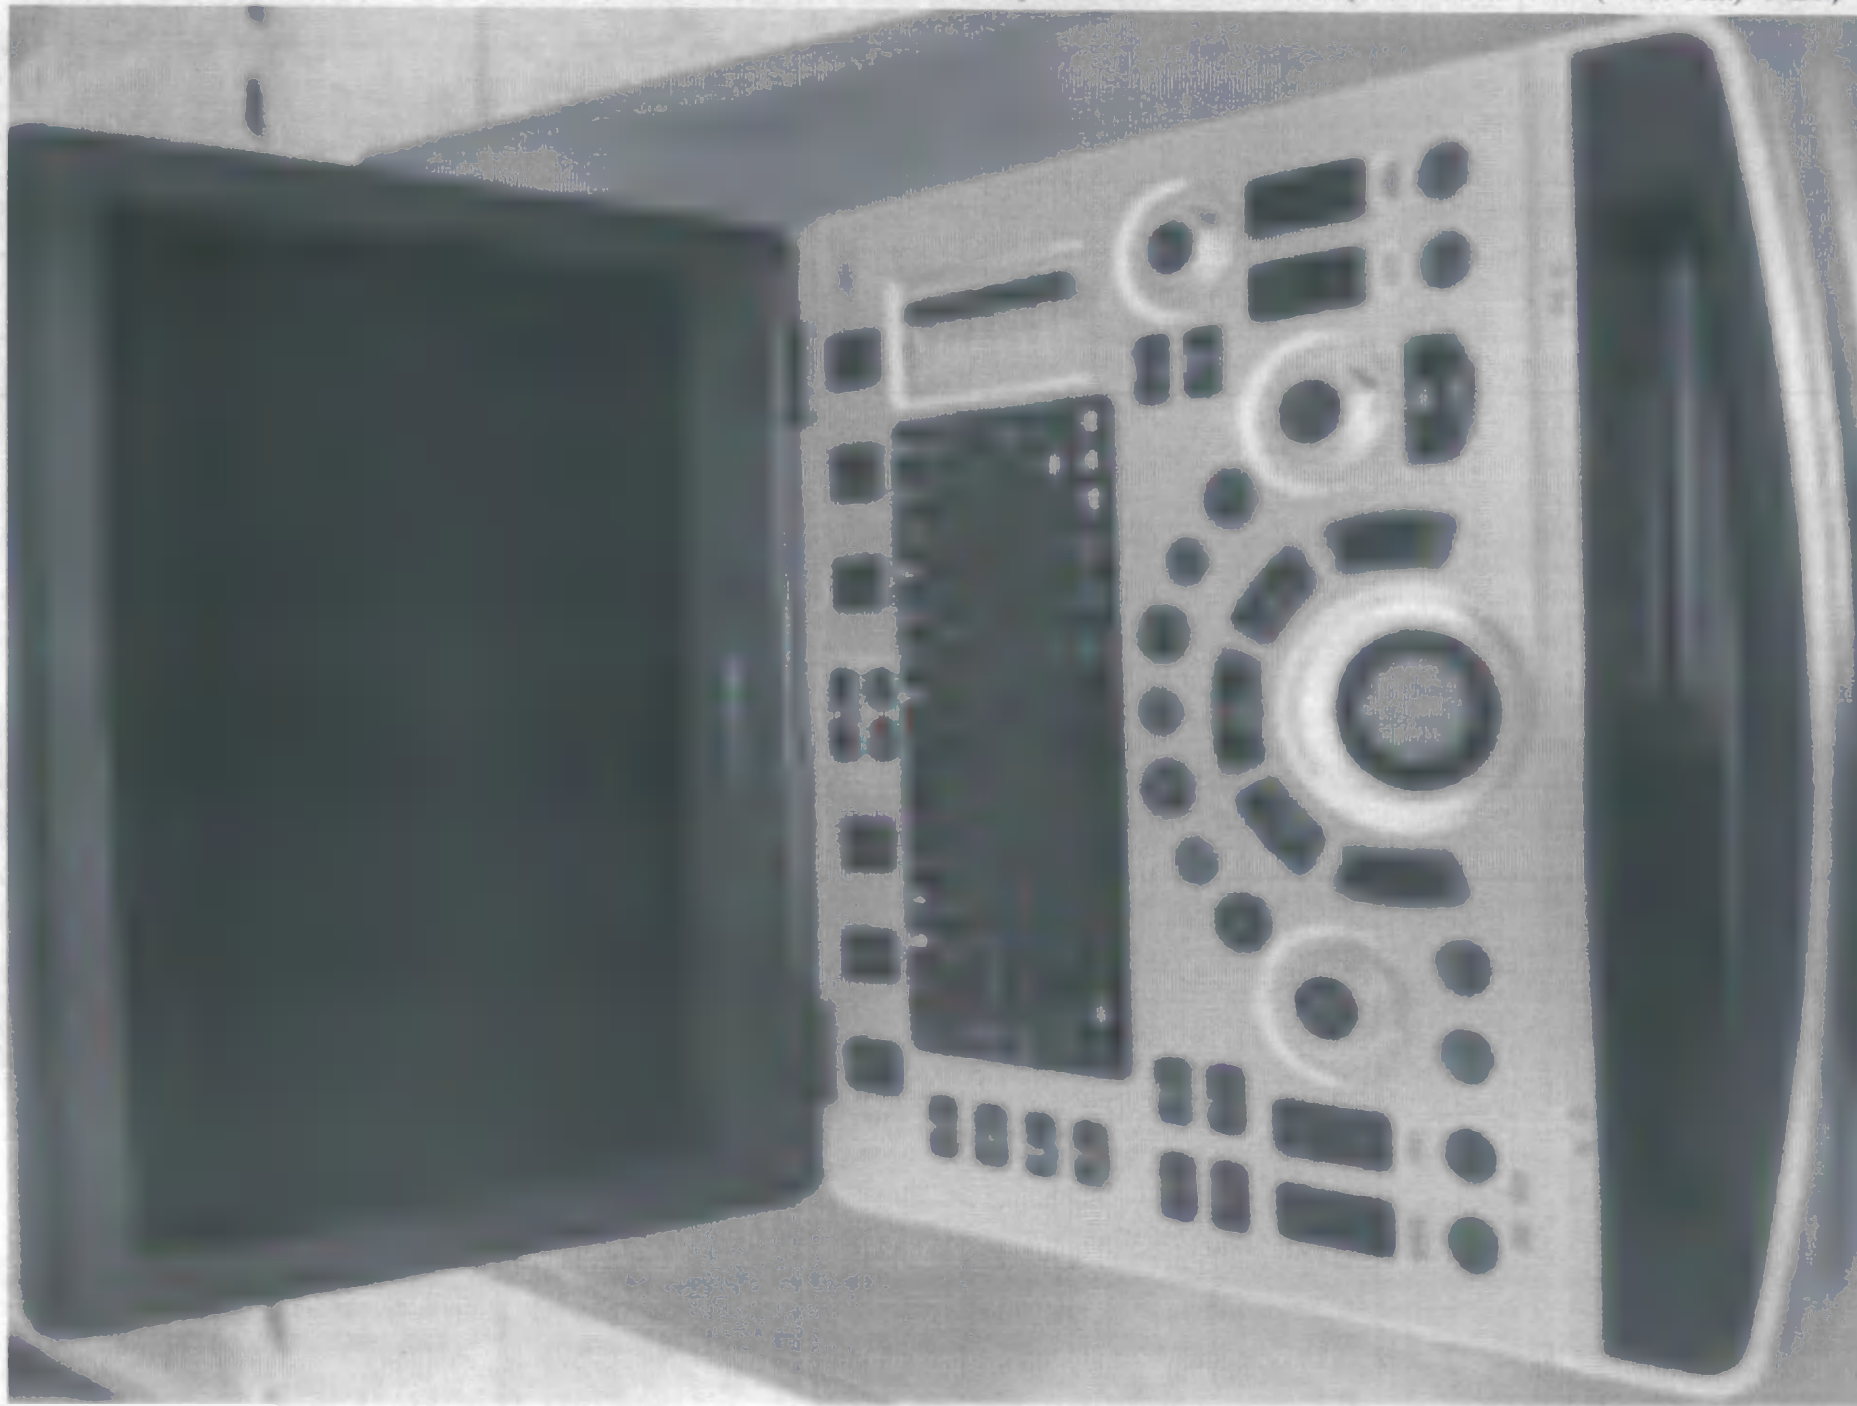


Аппарат ультразвуковой диагностический серии М с принадлежностями, вариант исполнения: М9СV (1. Основной блок (Main Unit) -1 шт.)

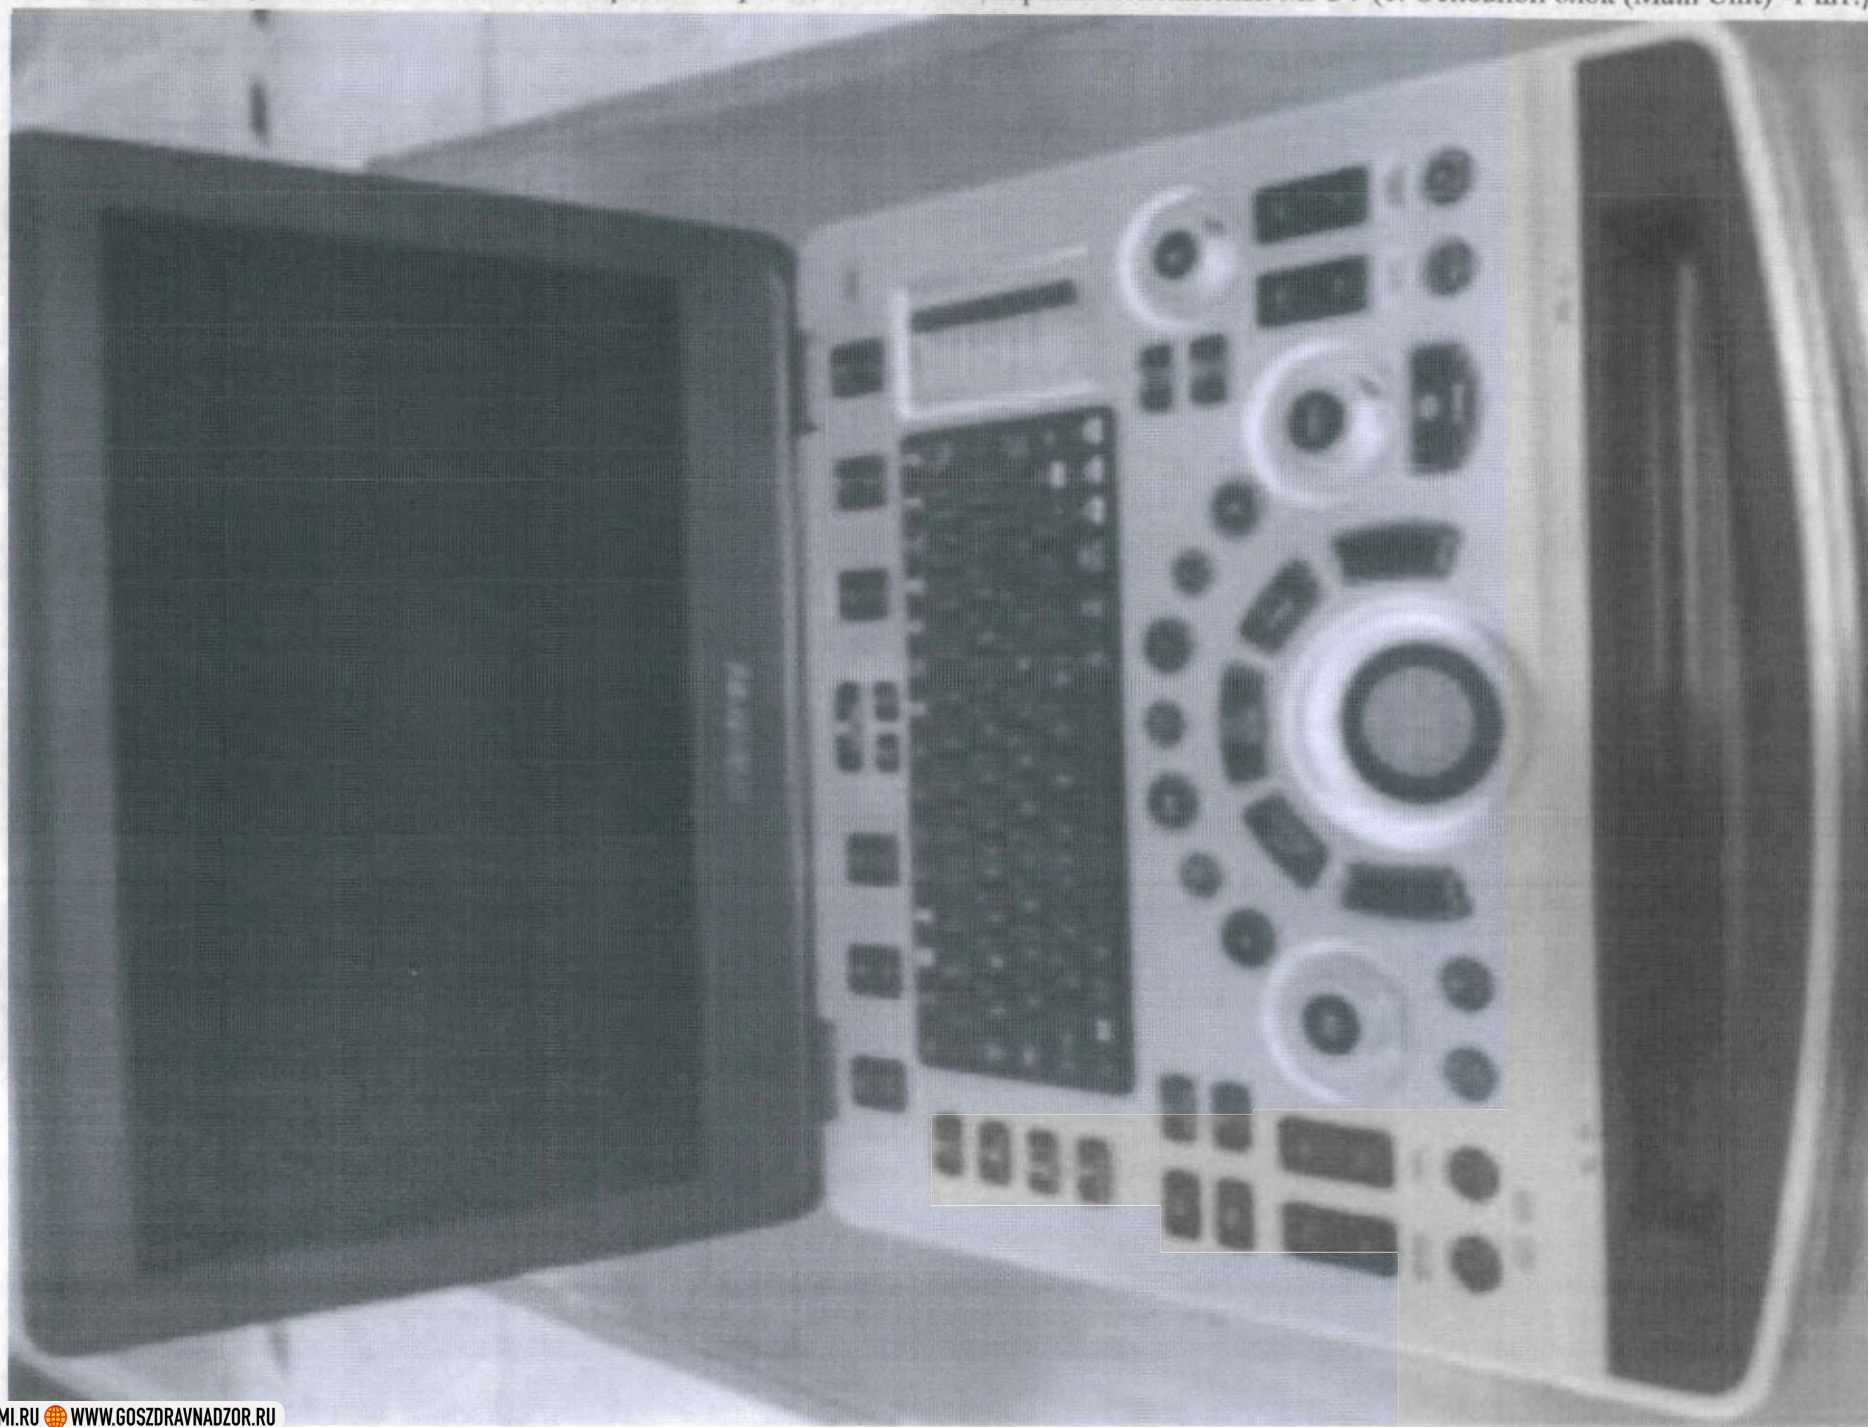


Аппарат ультразвуковой диагностический серии М с принадлежностями, вариант исполнения: М8 (1. Основной блок (Main Unit) -1 шт.)

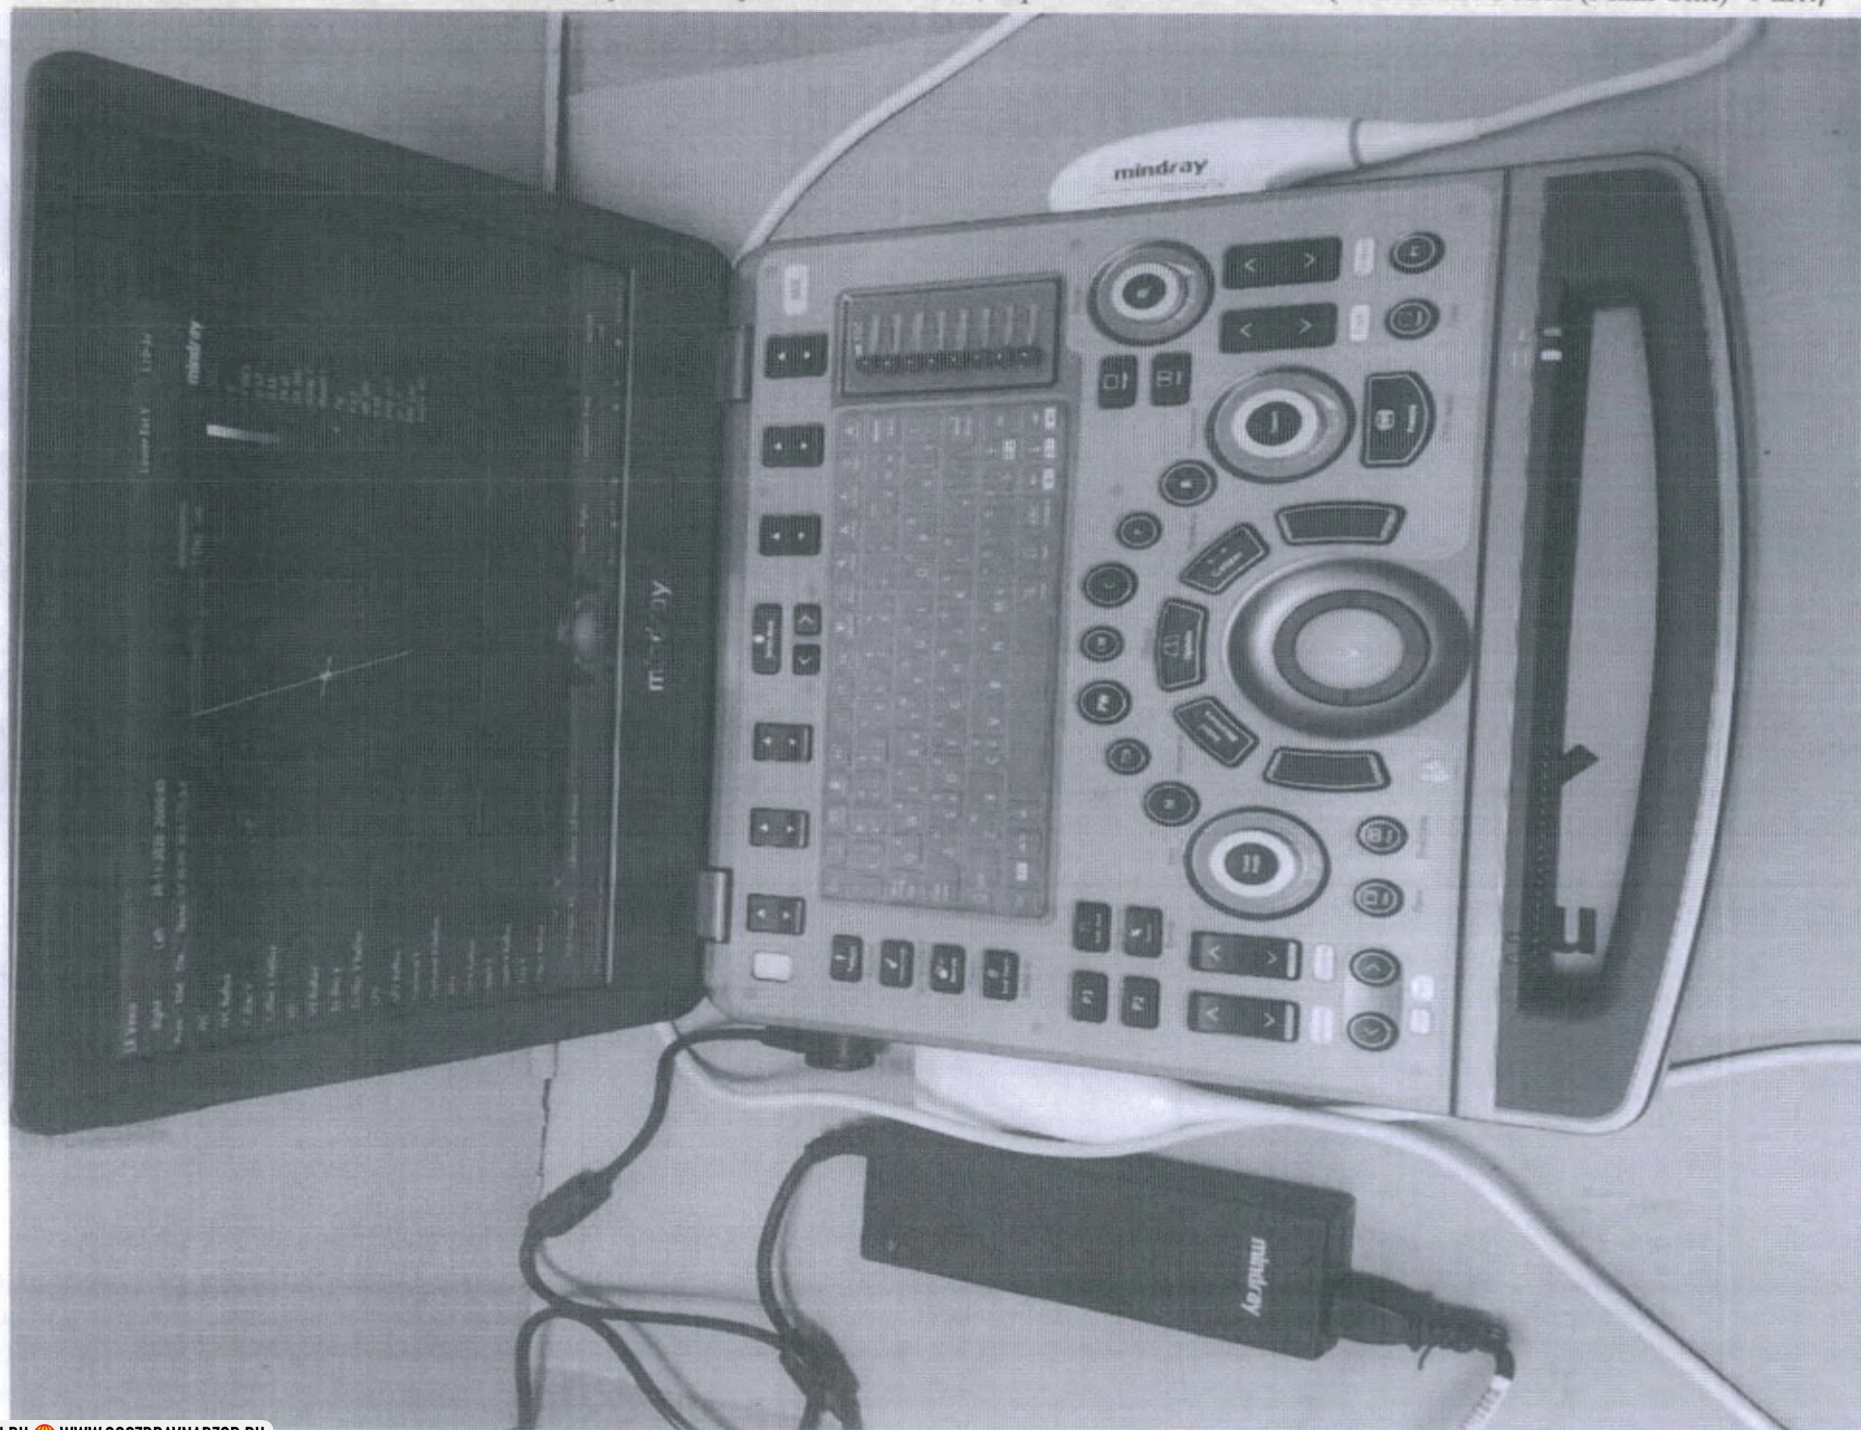


Аппарат ультразвуковой диагностический серии М с принадлежностями, вариант исполнения: М8Г1 (1. Основной блок (Main Unit) -1 шт.)

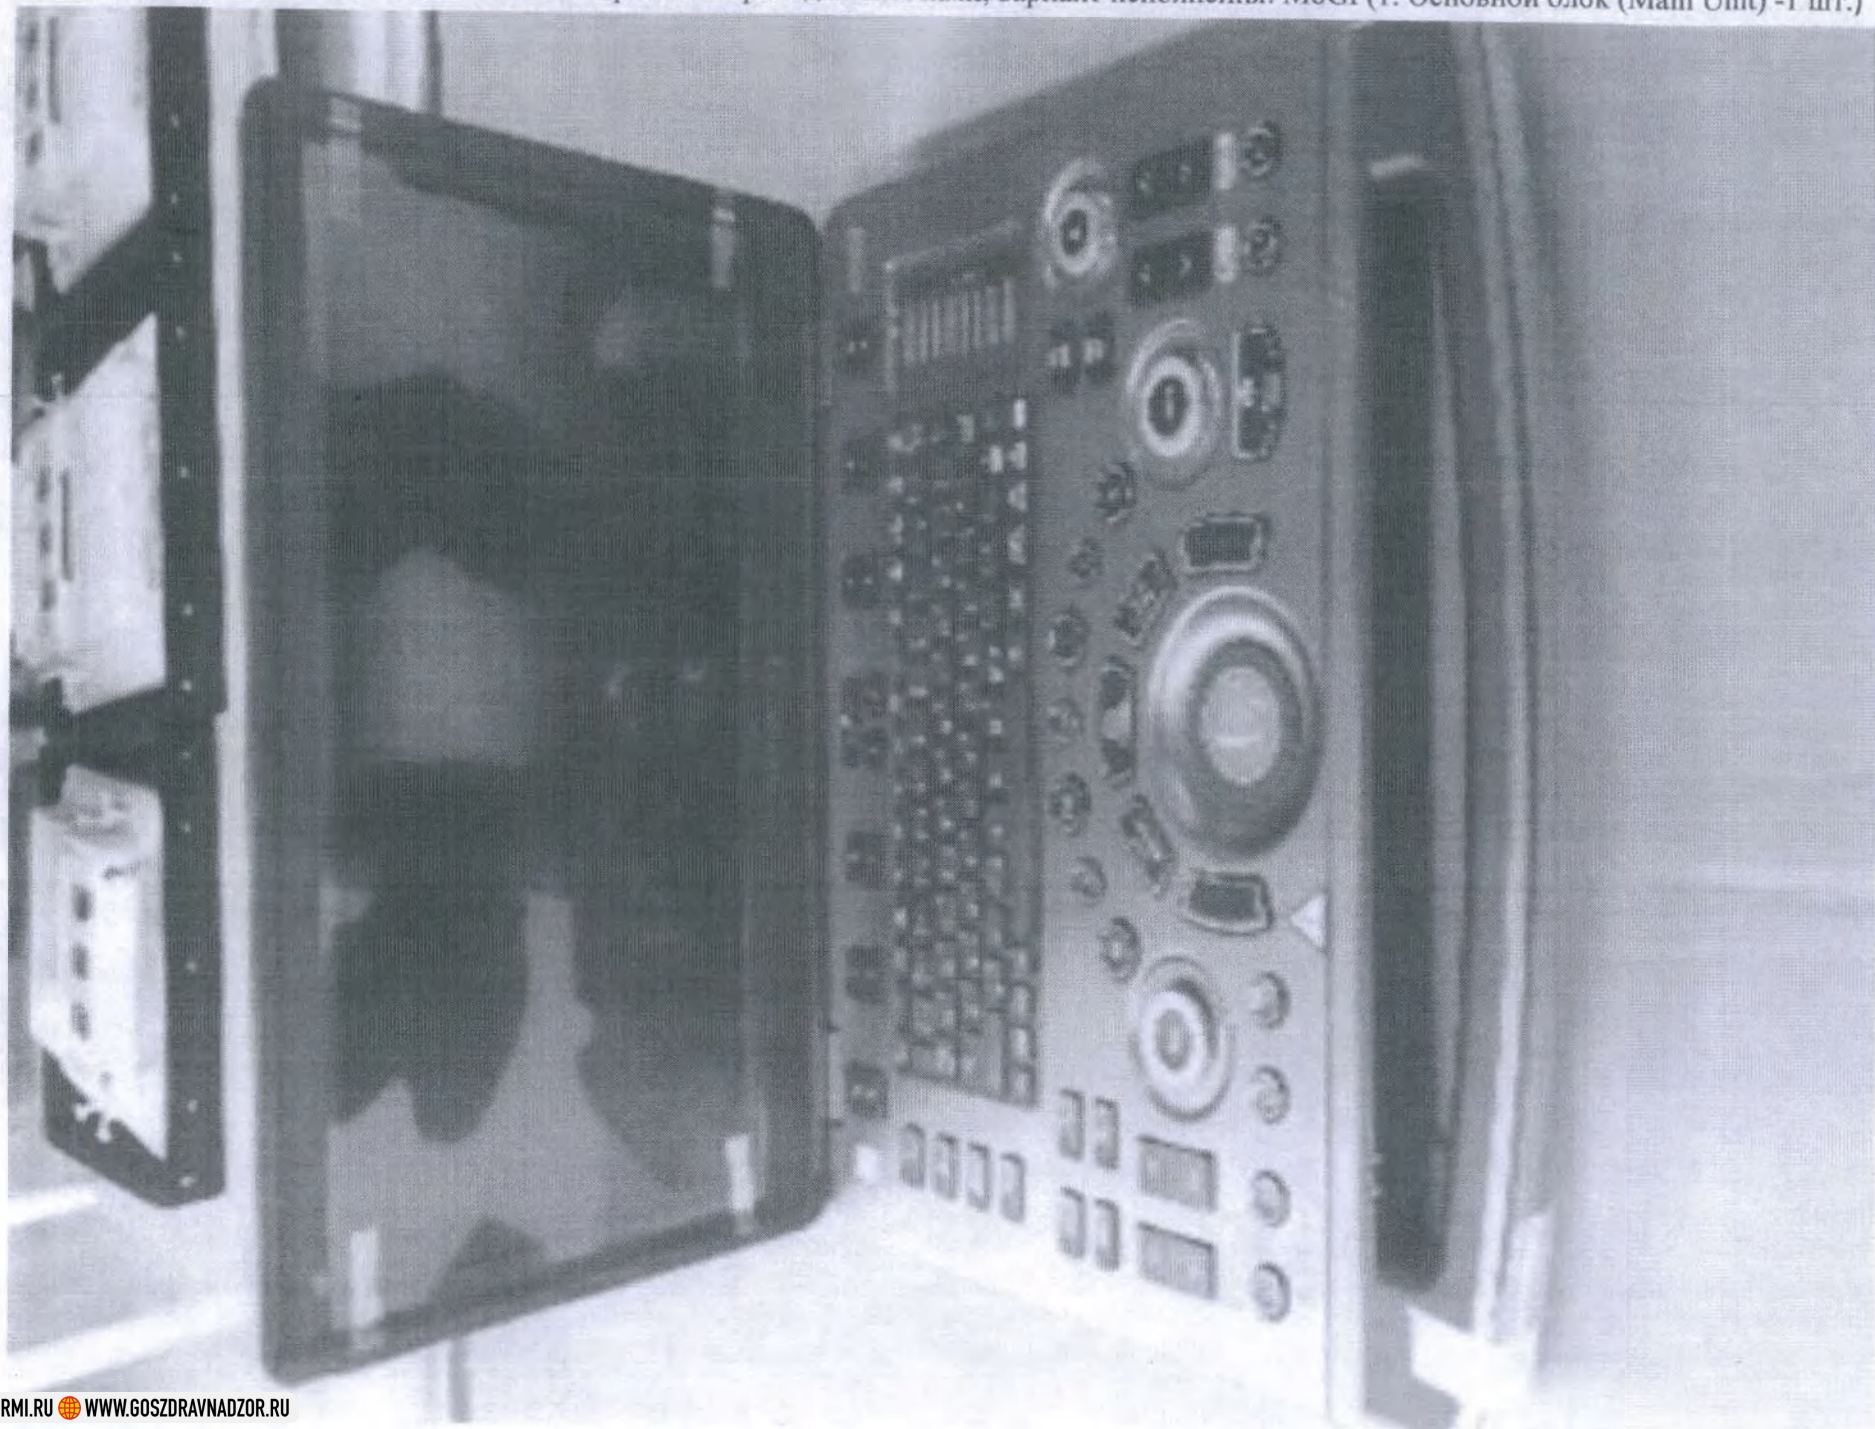

2. Кабель питания (Power cord) - 1 шт.

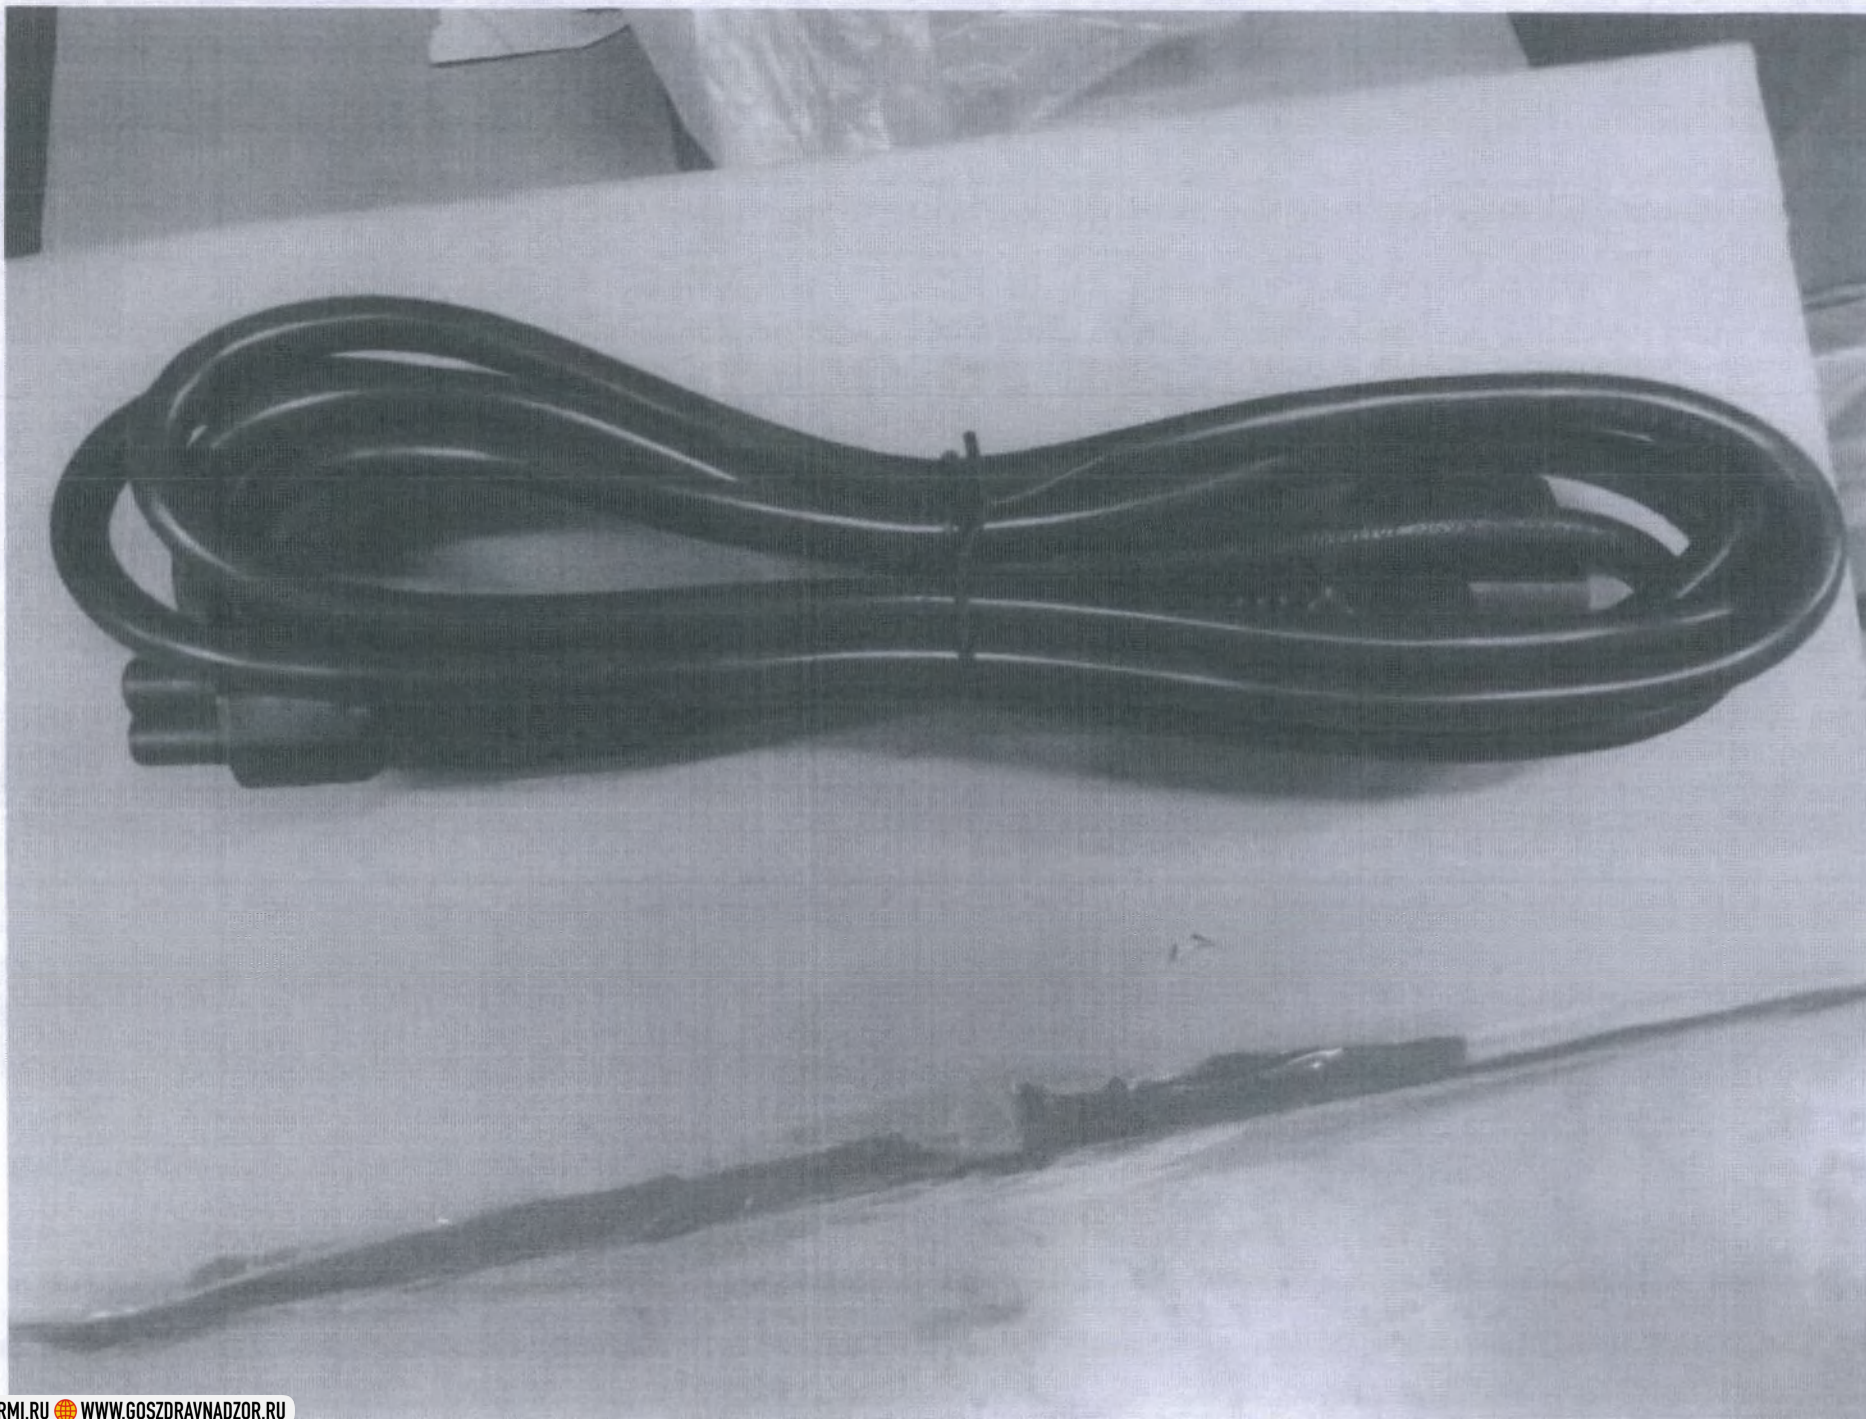

### 3. Встроенная батарея (Built-in battery) - 2 шт.

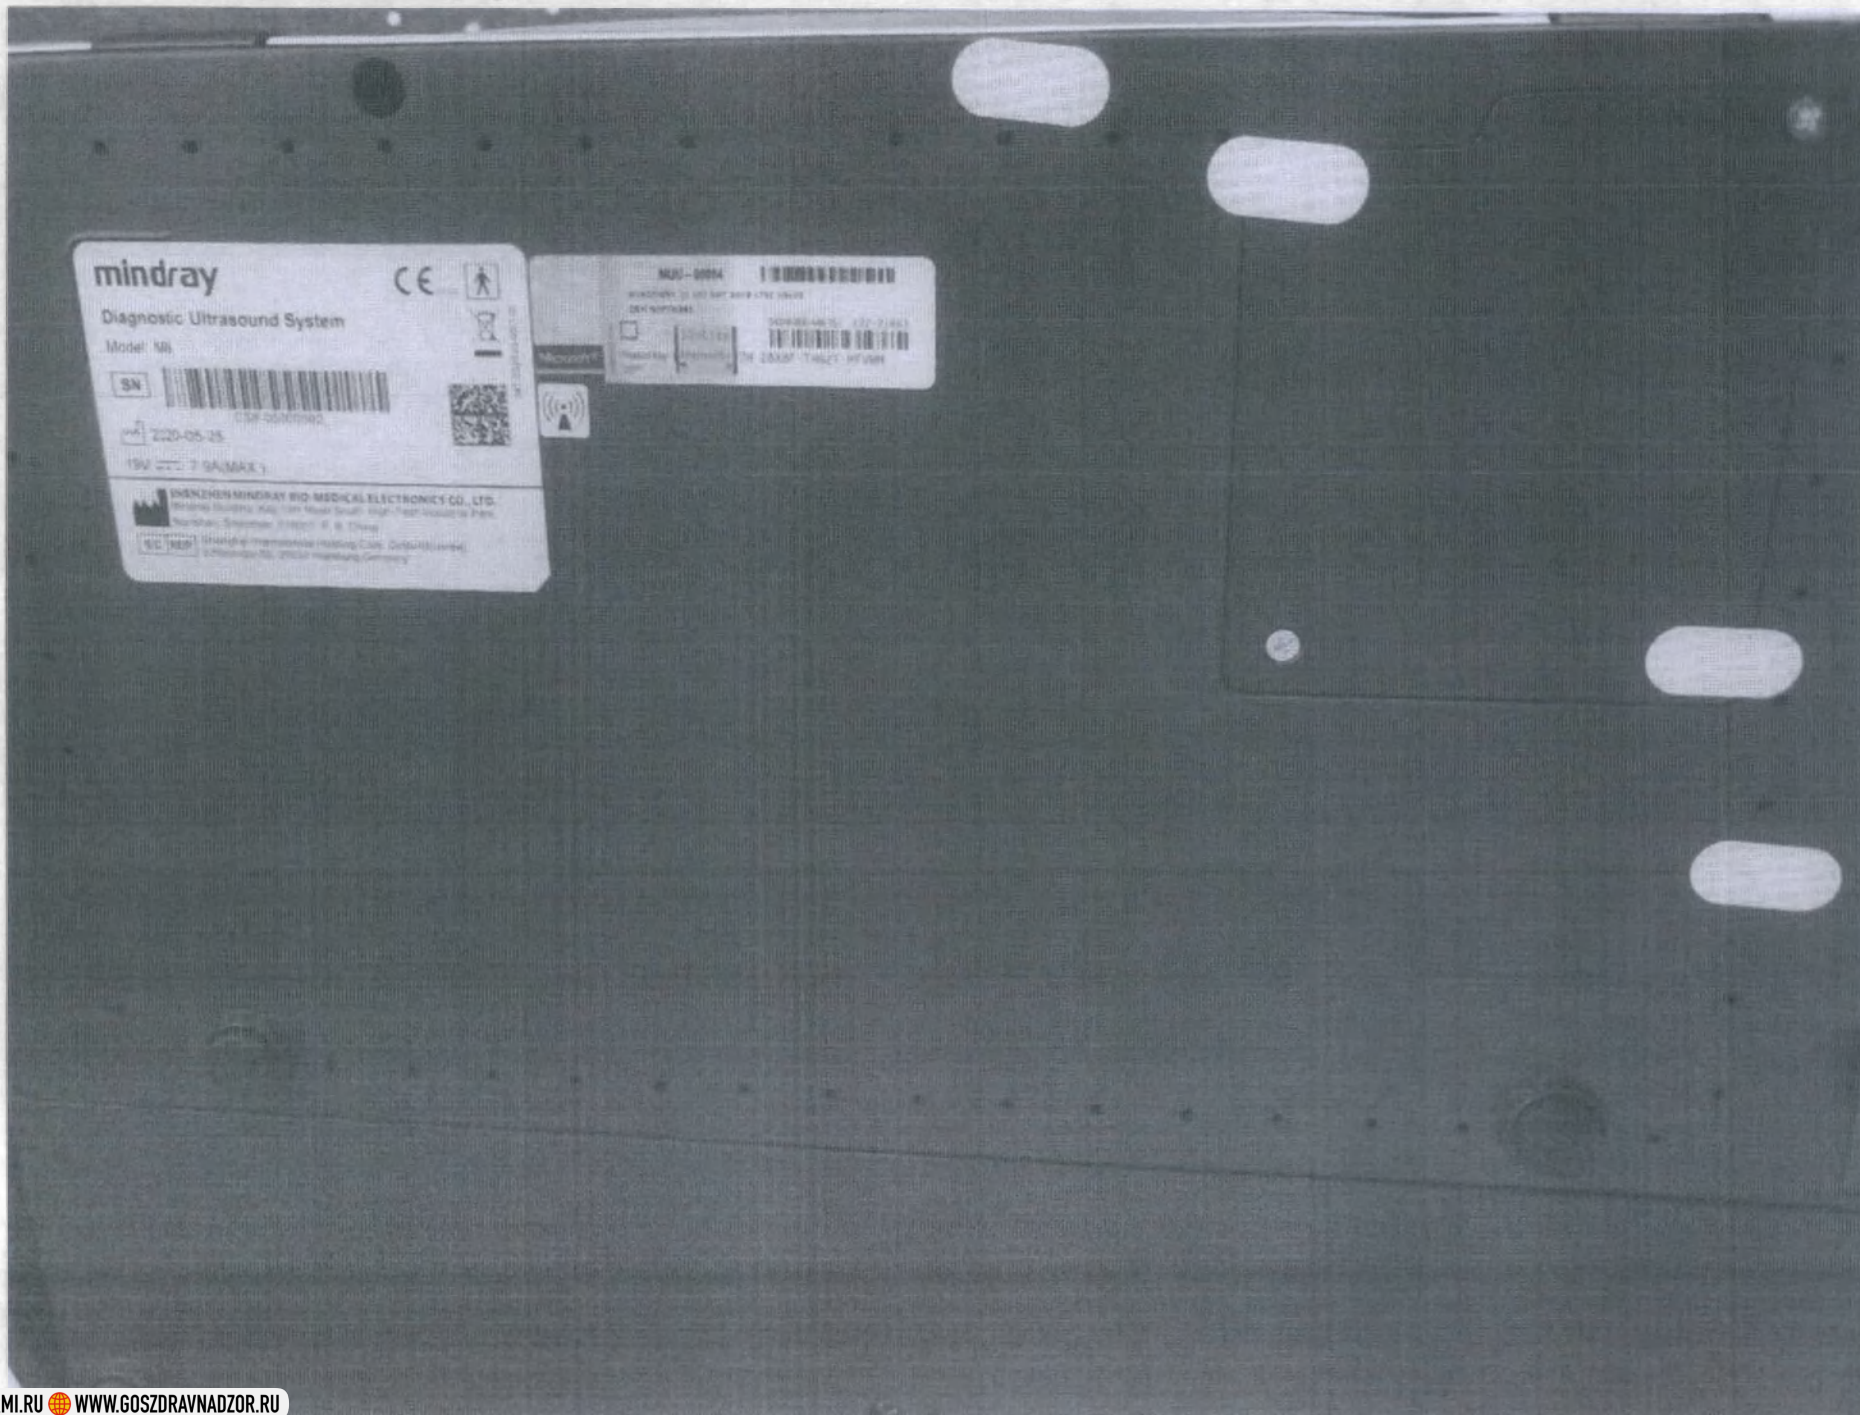

4. Адаптер переменного тока в постоянный (AC adapter), не более 2 шт.



5. Руководство по эксплуатации в печатном виде (User Manual print), не более 5 шт.


**Аппарат ультразвуковой  
диагностический серии М с  
принадлежностями, варианты  
исполнения: М9, М9Т, М9СV, М8, М8GІ**

**Руководство по эксплуатации**  
(Стандартные процедуры)


6. Колесная сумка для транспортировки аппарата (Wheeled Boarding Bag) - 1 шт.



7. Датчики ультразвуковые: - конвексный C5-1s (Convex array ultrasound probe: C5-1s), не более 5 шт.(при необходимости).

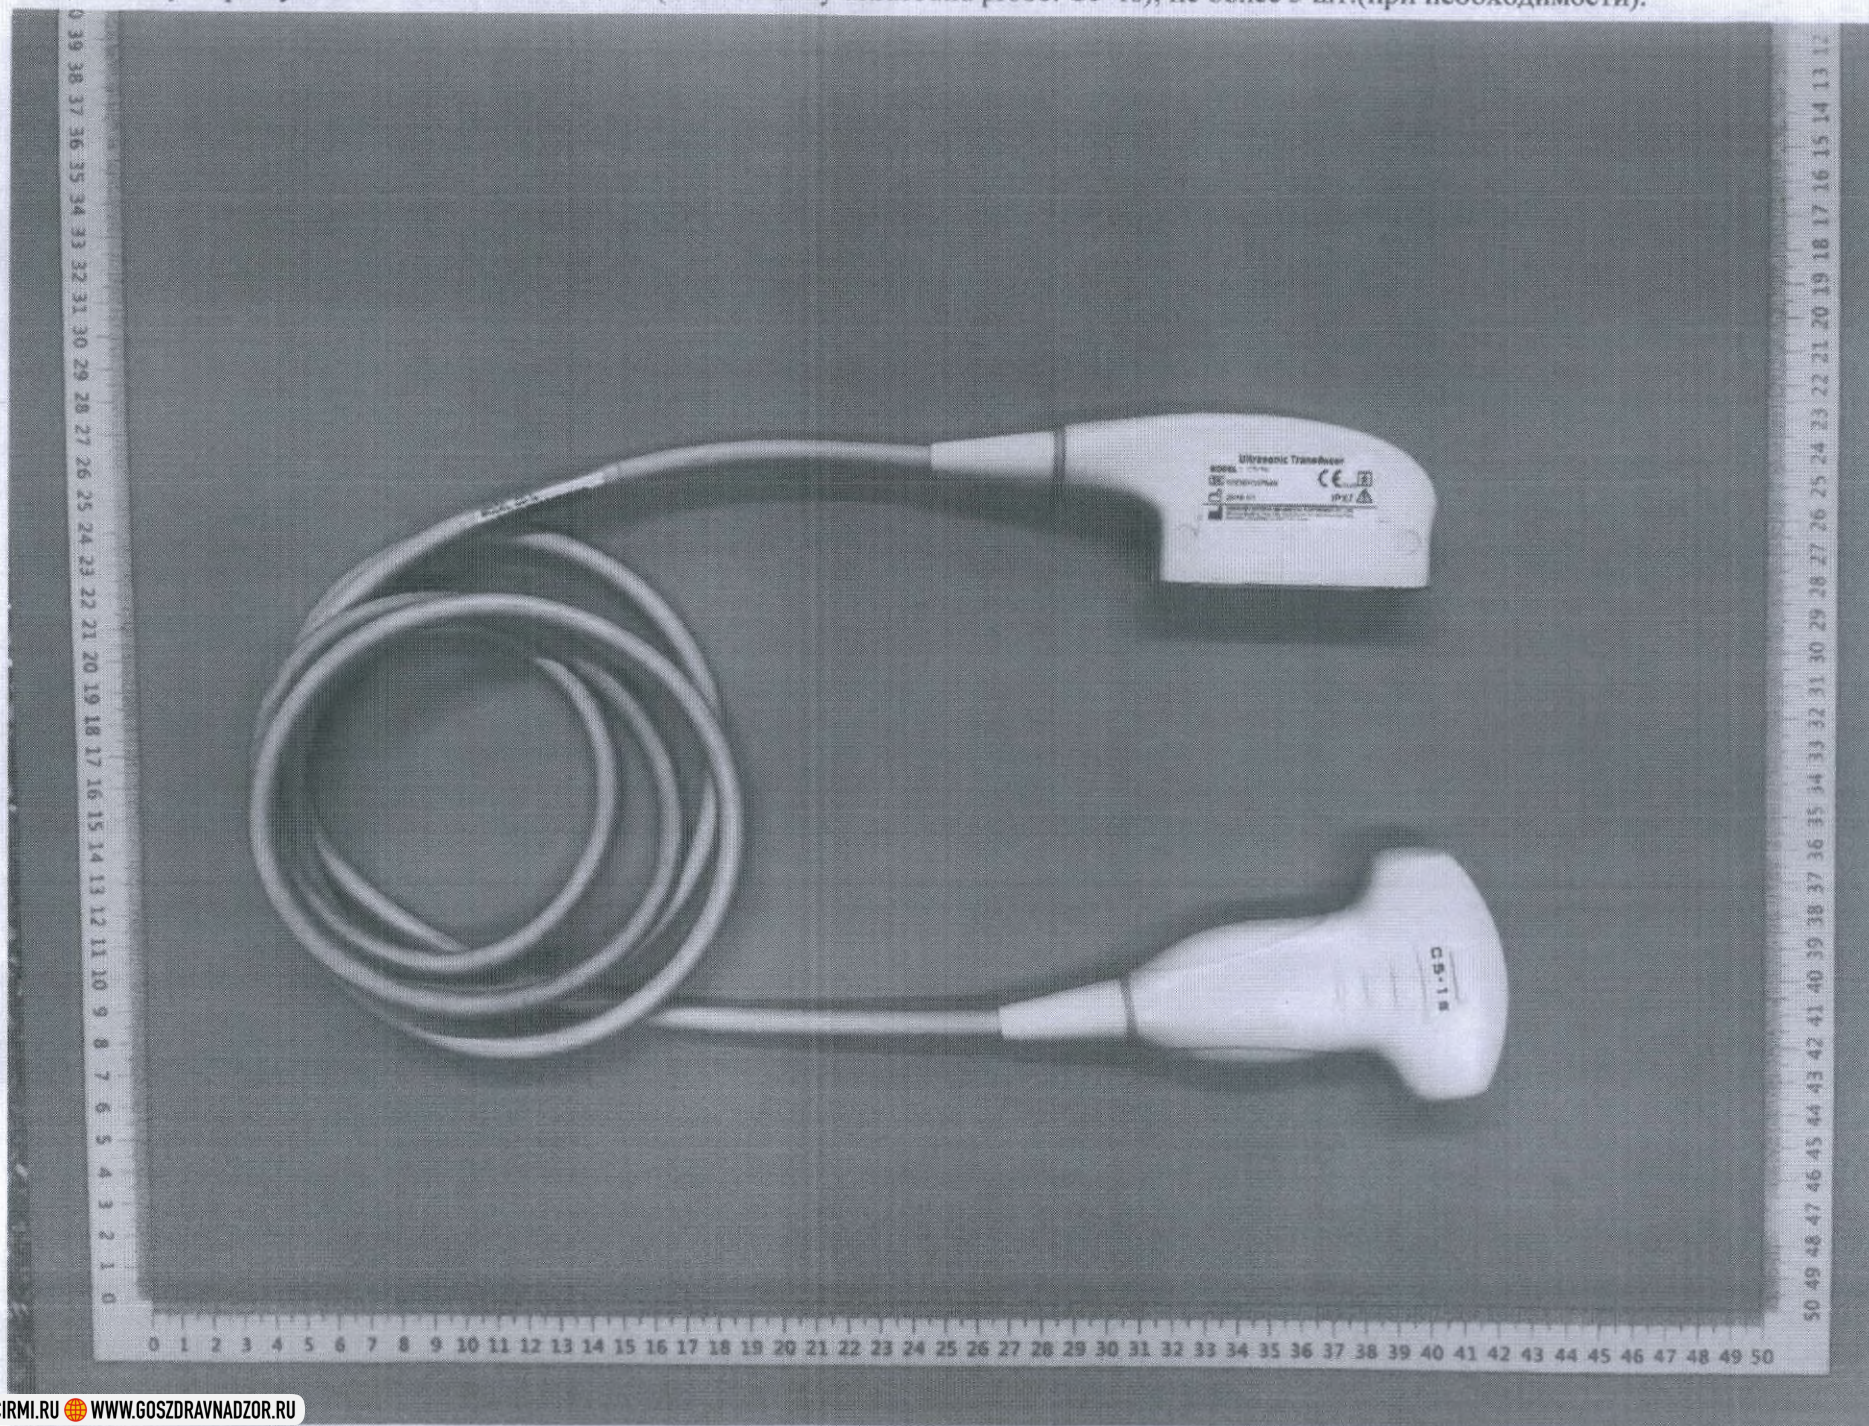


- конвексный C6-2Gs (Convex array ultrasound probe: C6-2Gs), не более 5 шт.(при необходимости).

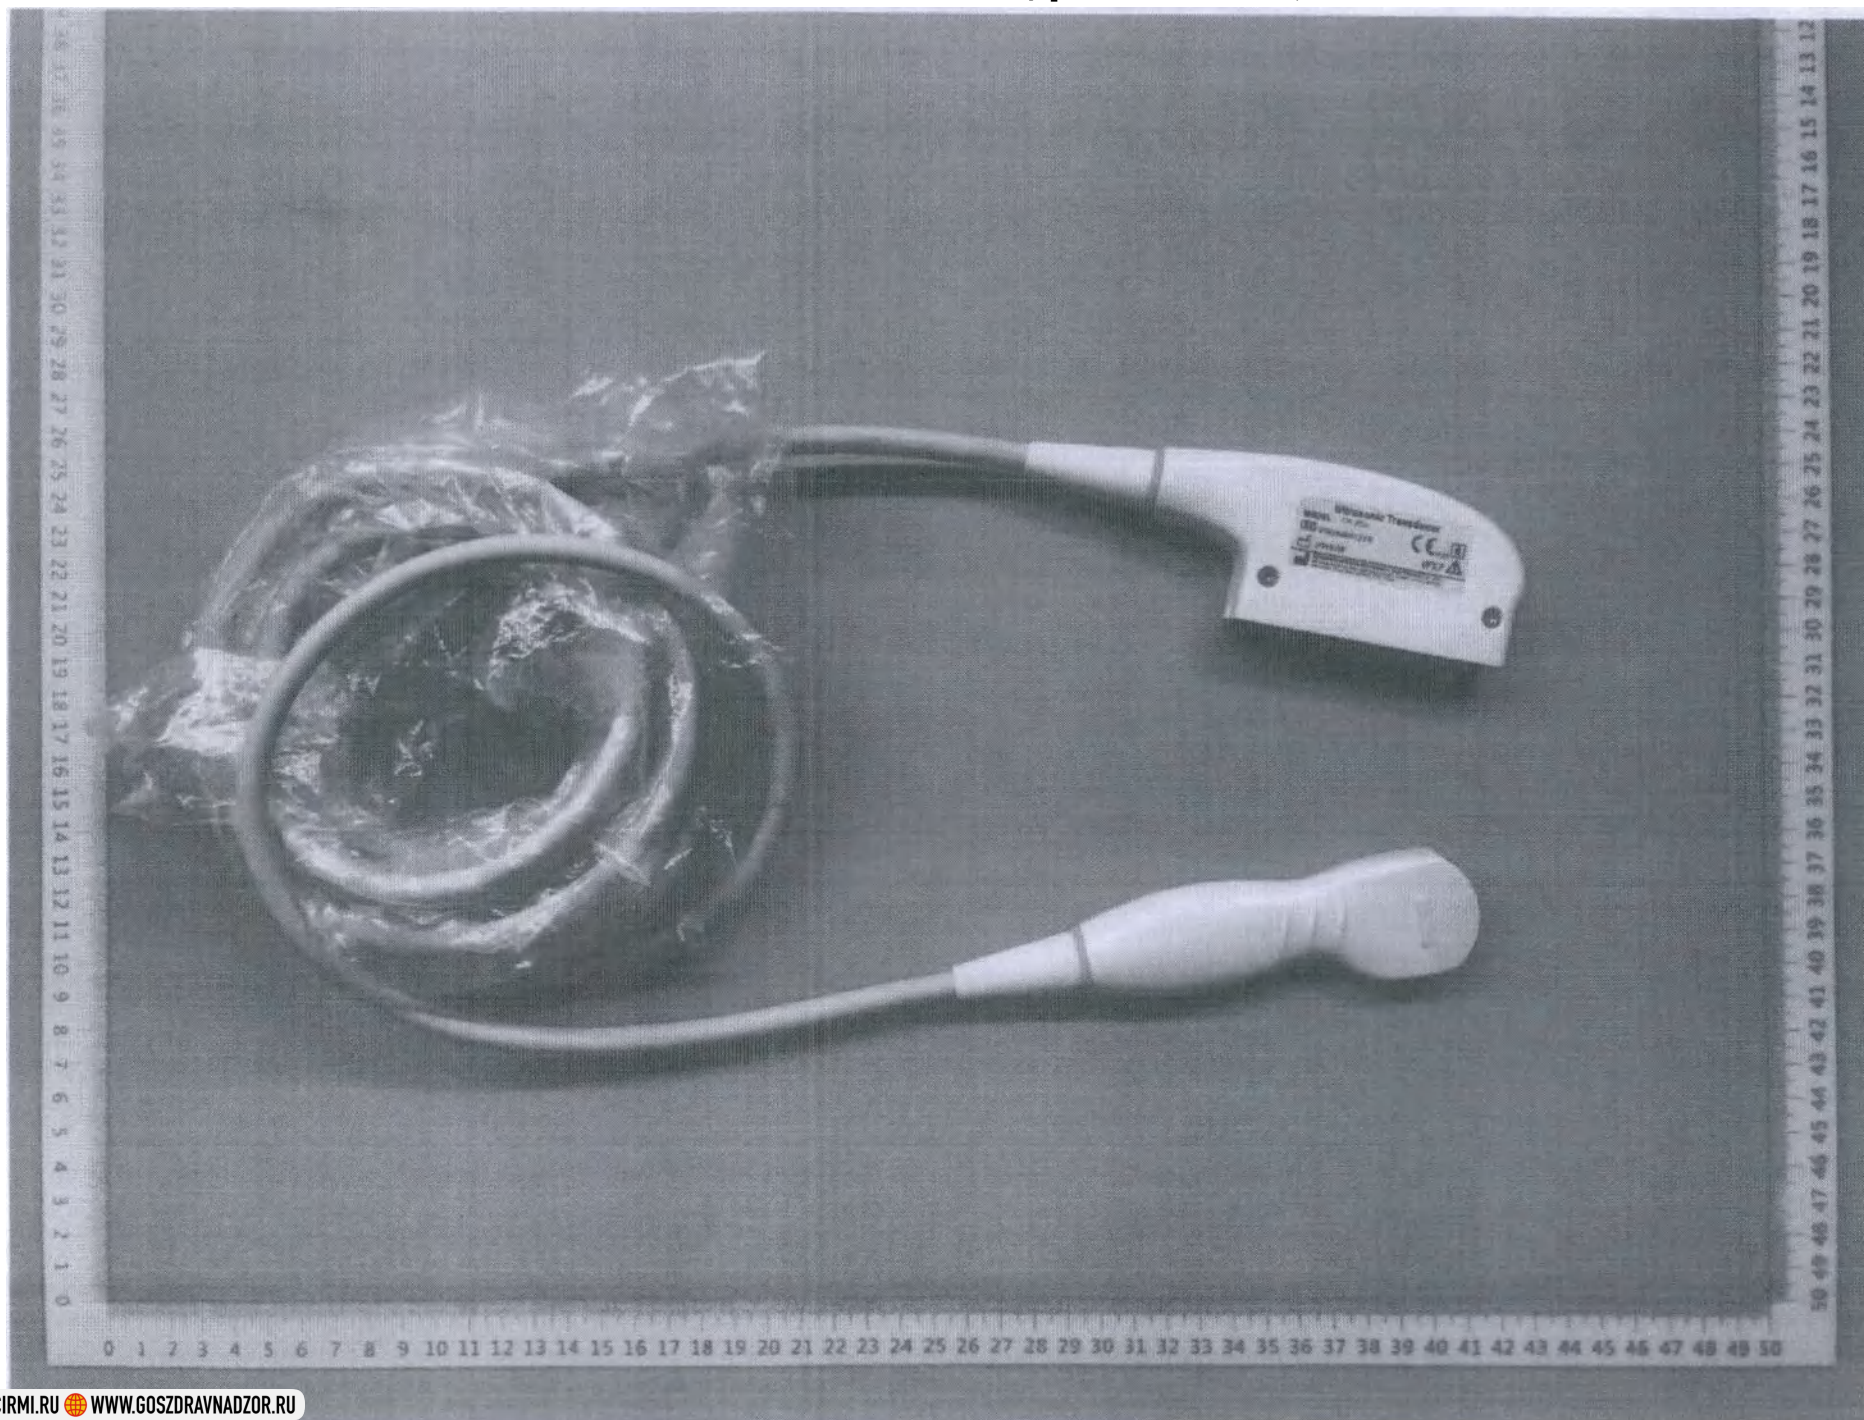

- микроконвексный C11-3s (Micro-convex array ultrasound probe: C11-3s), не более 5 шт.(при необходимости).




- линейный: L10-3s (Linear array ultrasound probe: L10-3s), не более 5 шт.(при необходимости).

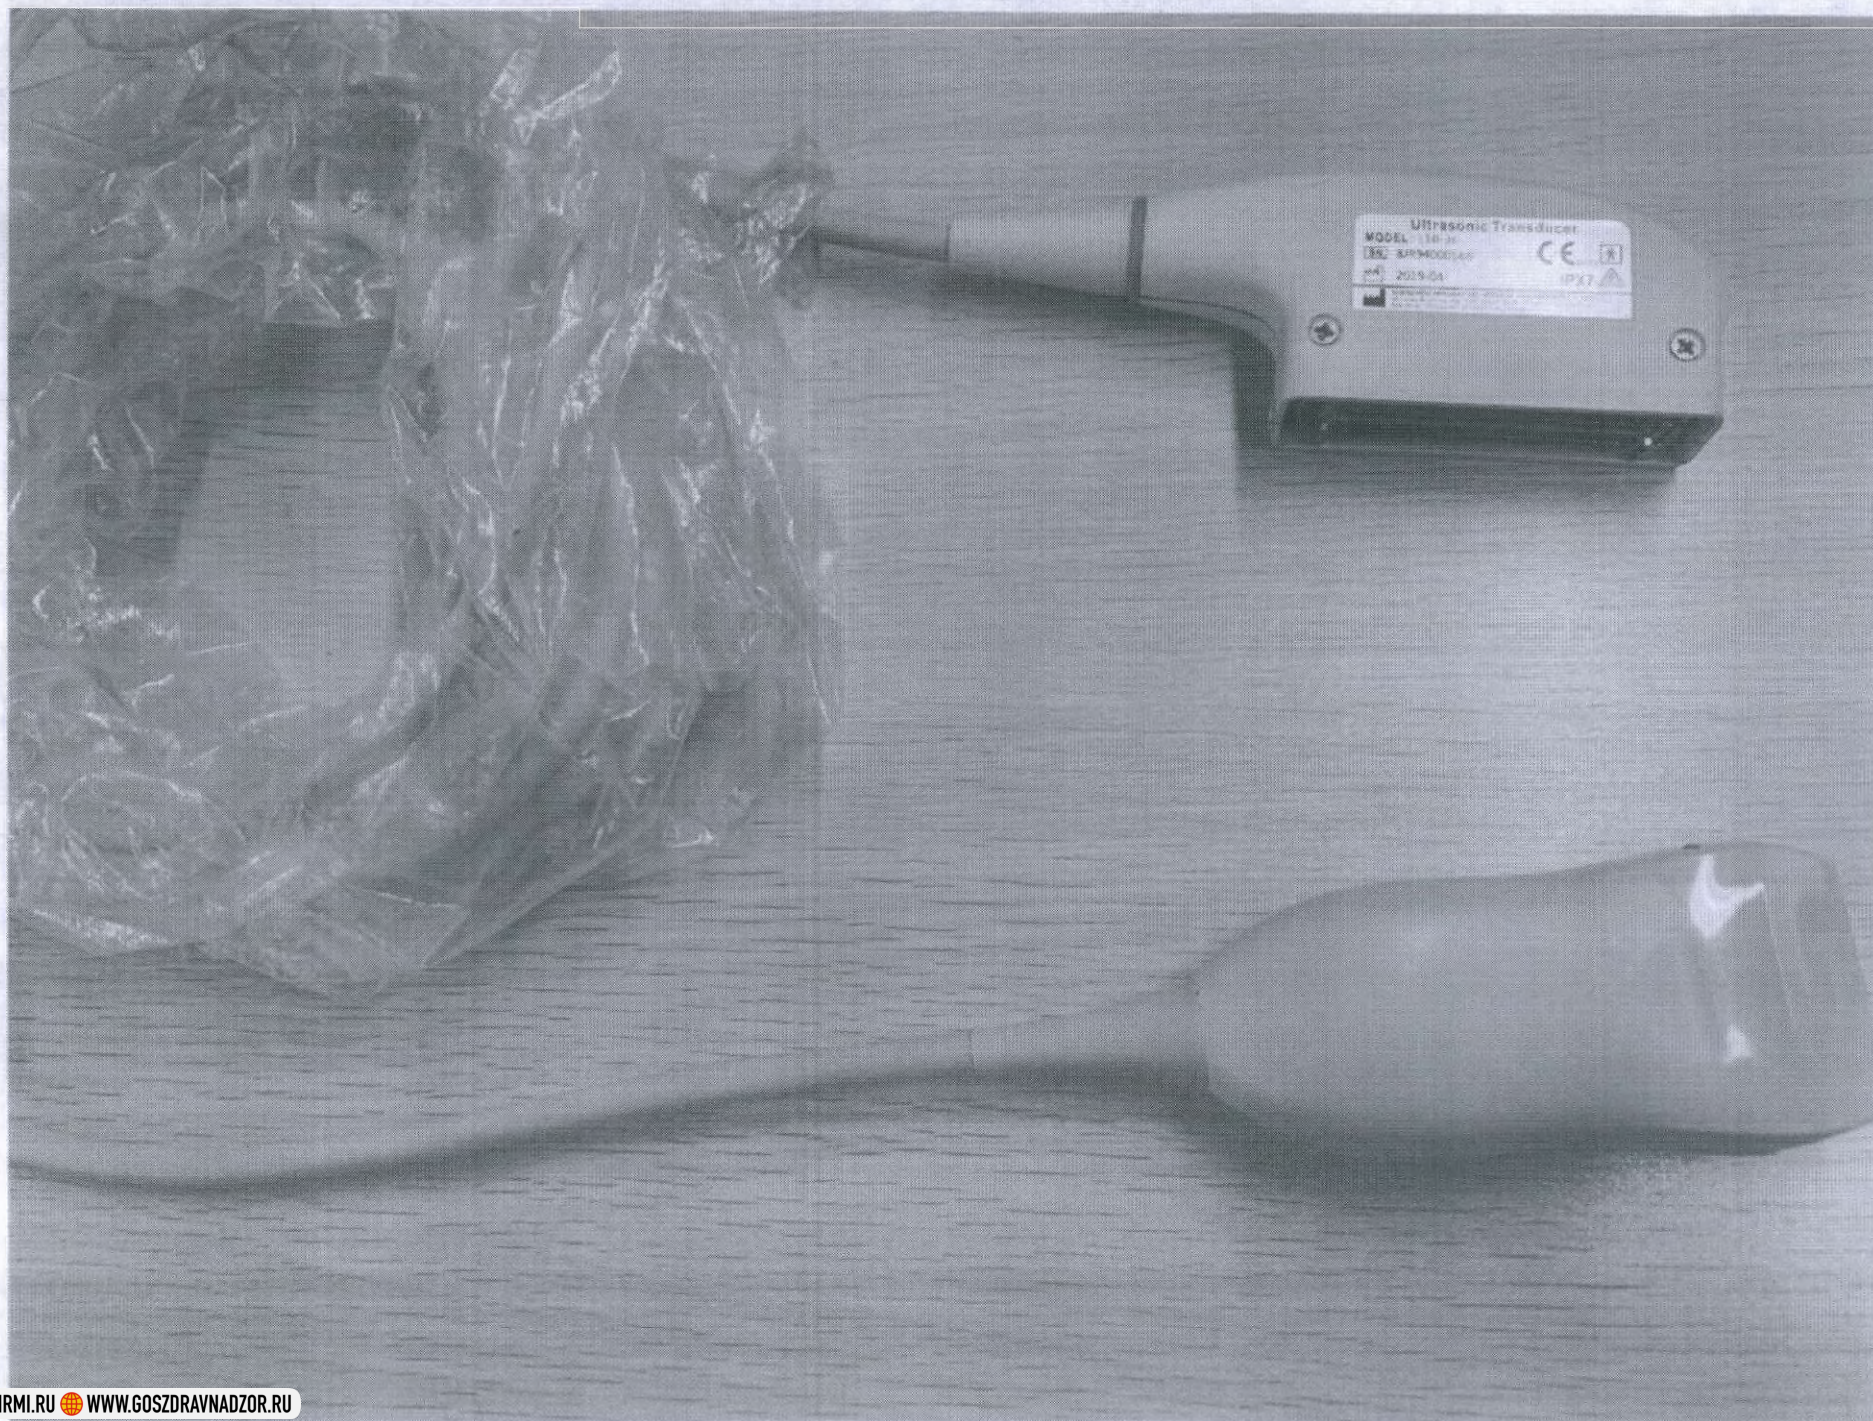


- линейный: L12-4s (Linear array ultrasound probe: L12-4s), не более 5 шт.(при необходимости).




- линейный: L14-6Ns (Linear array ultrasound probe: L14-6Ns), не более 5 шт.(при необходимости).

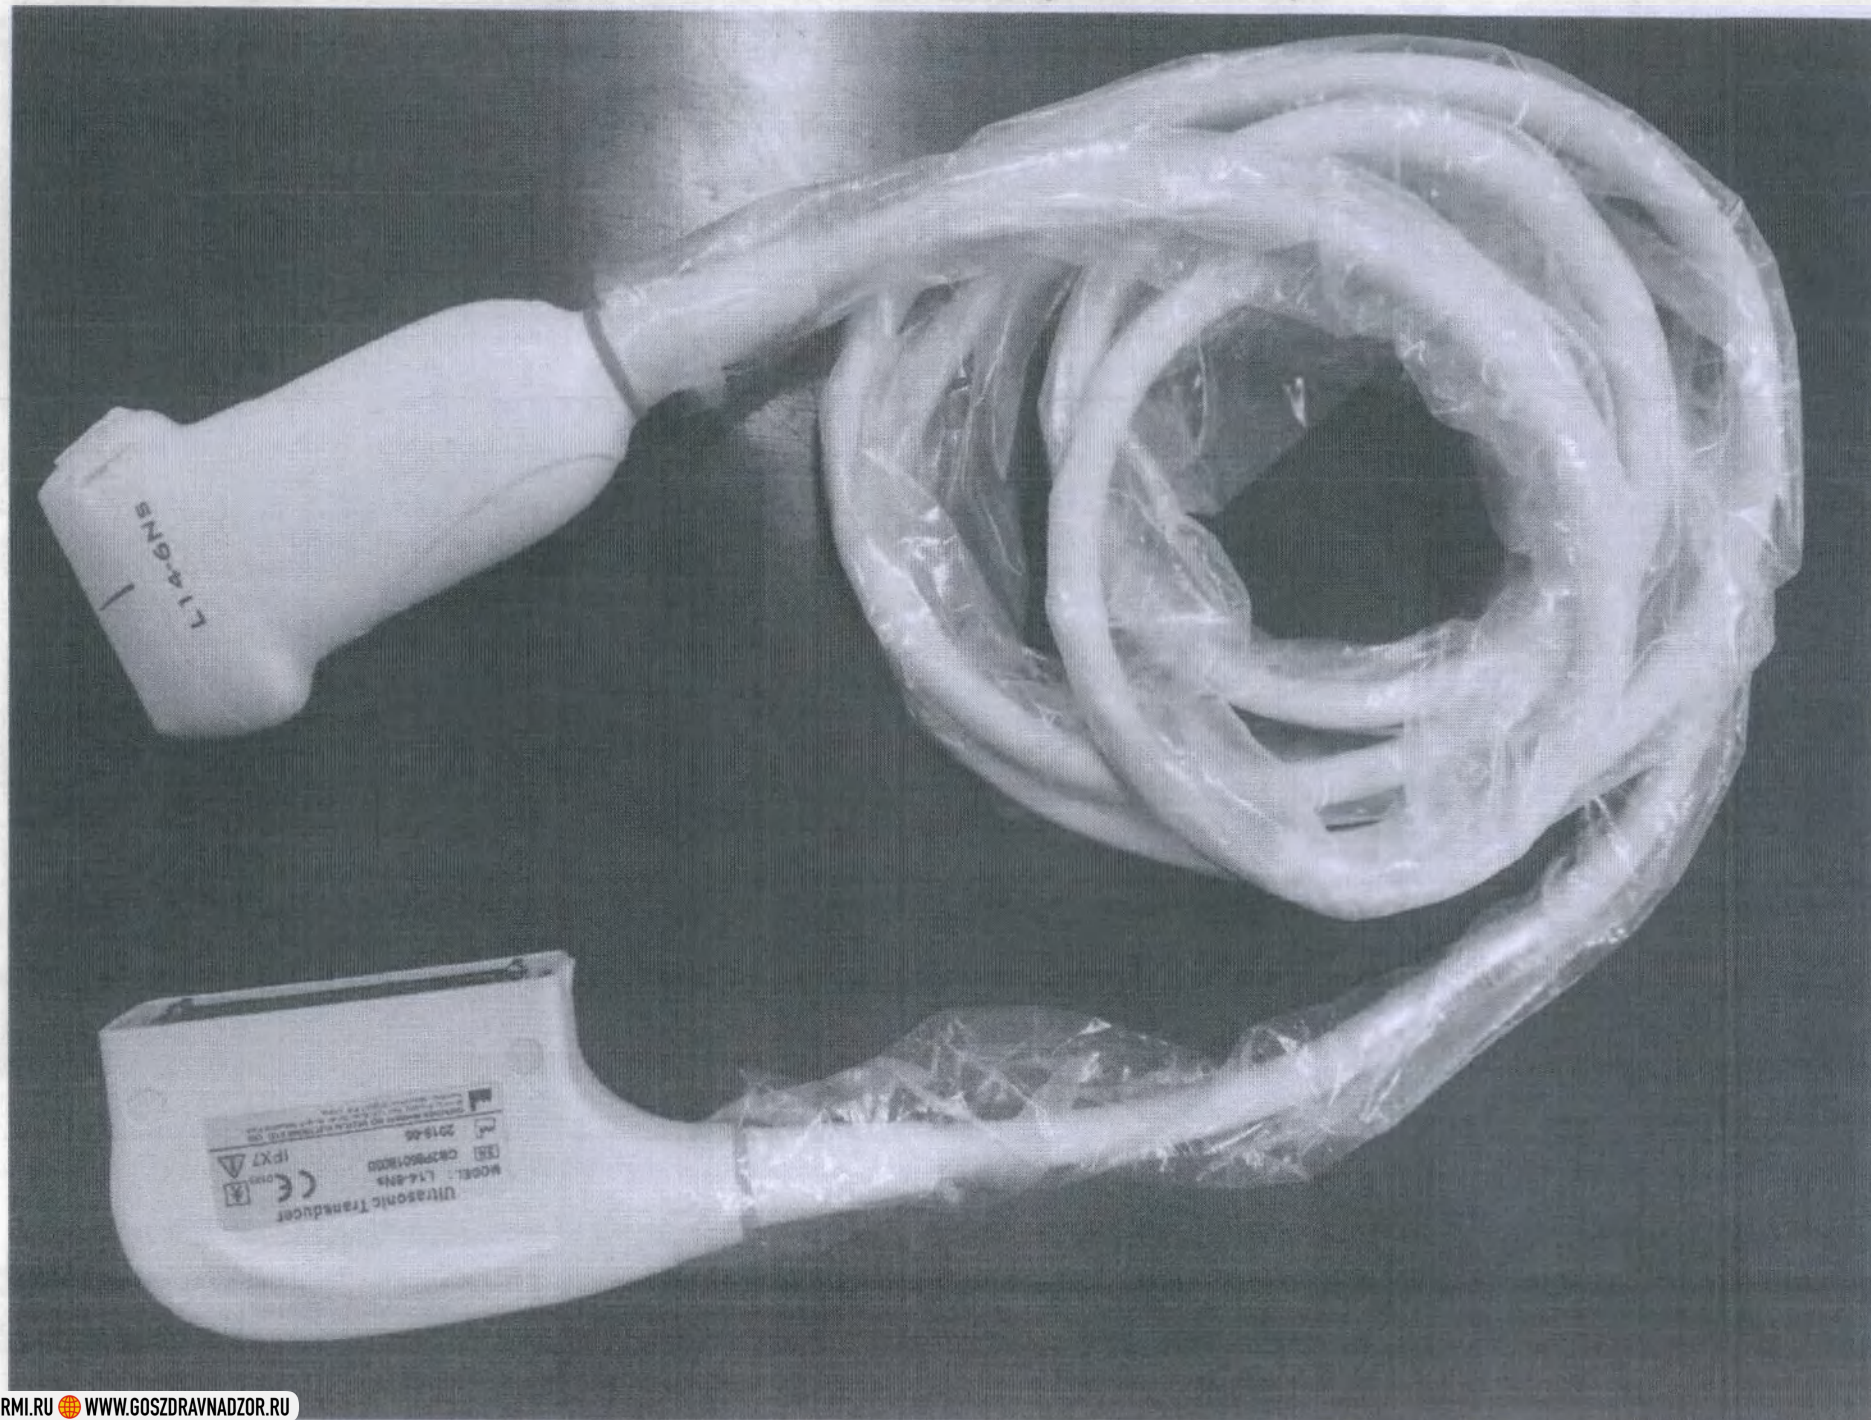

- линейный: LM14-6s (Linear array ultrasound probe: LM14-6s), не более 5 шт.(при необходимости).

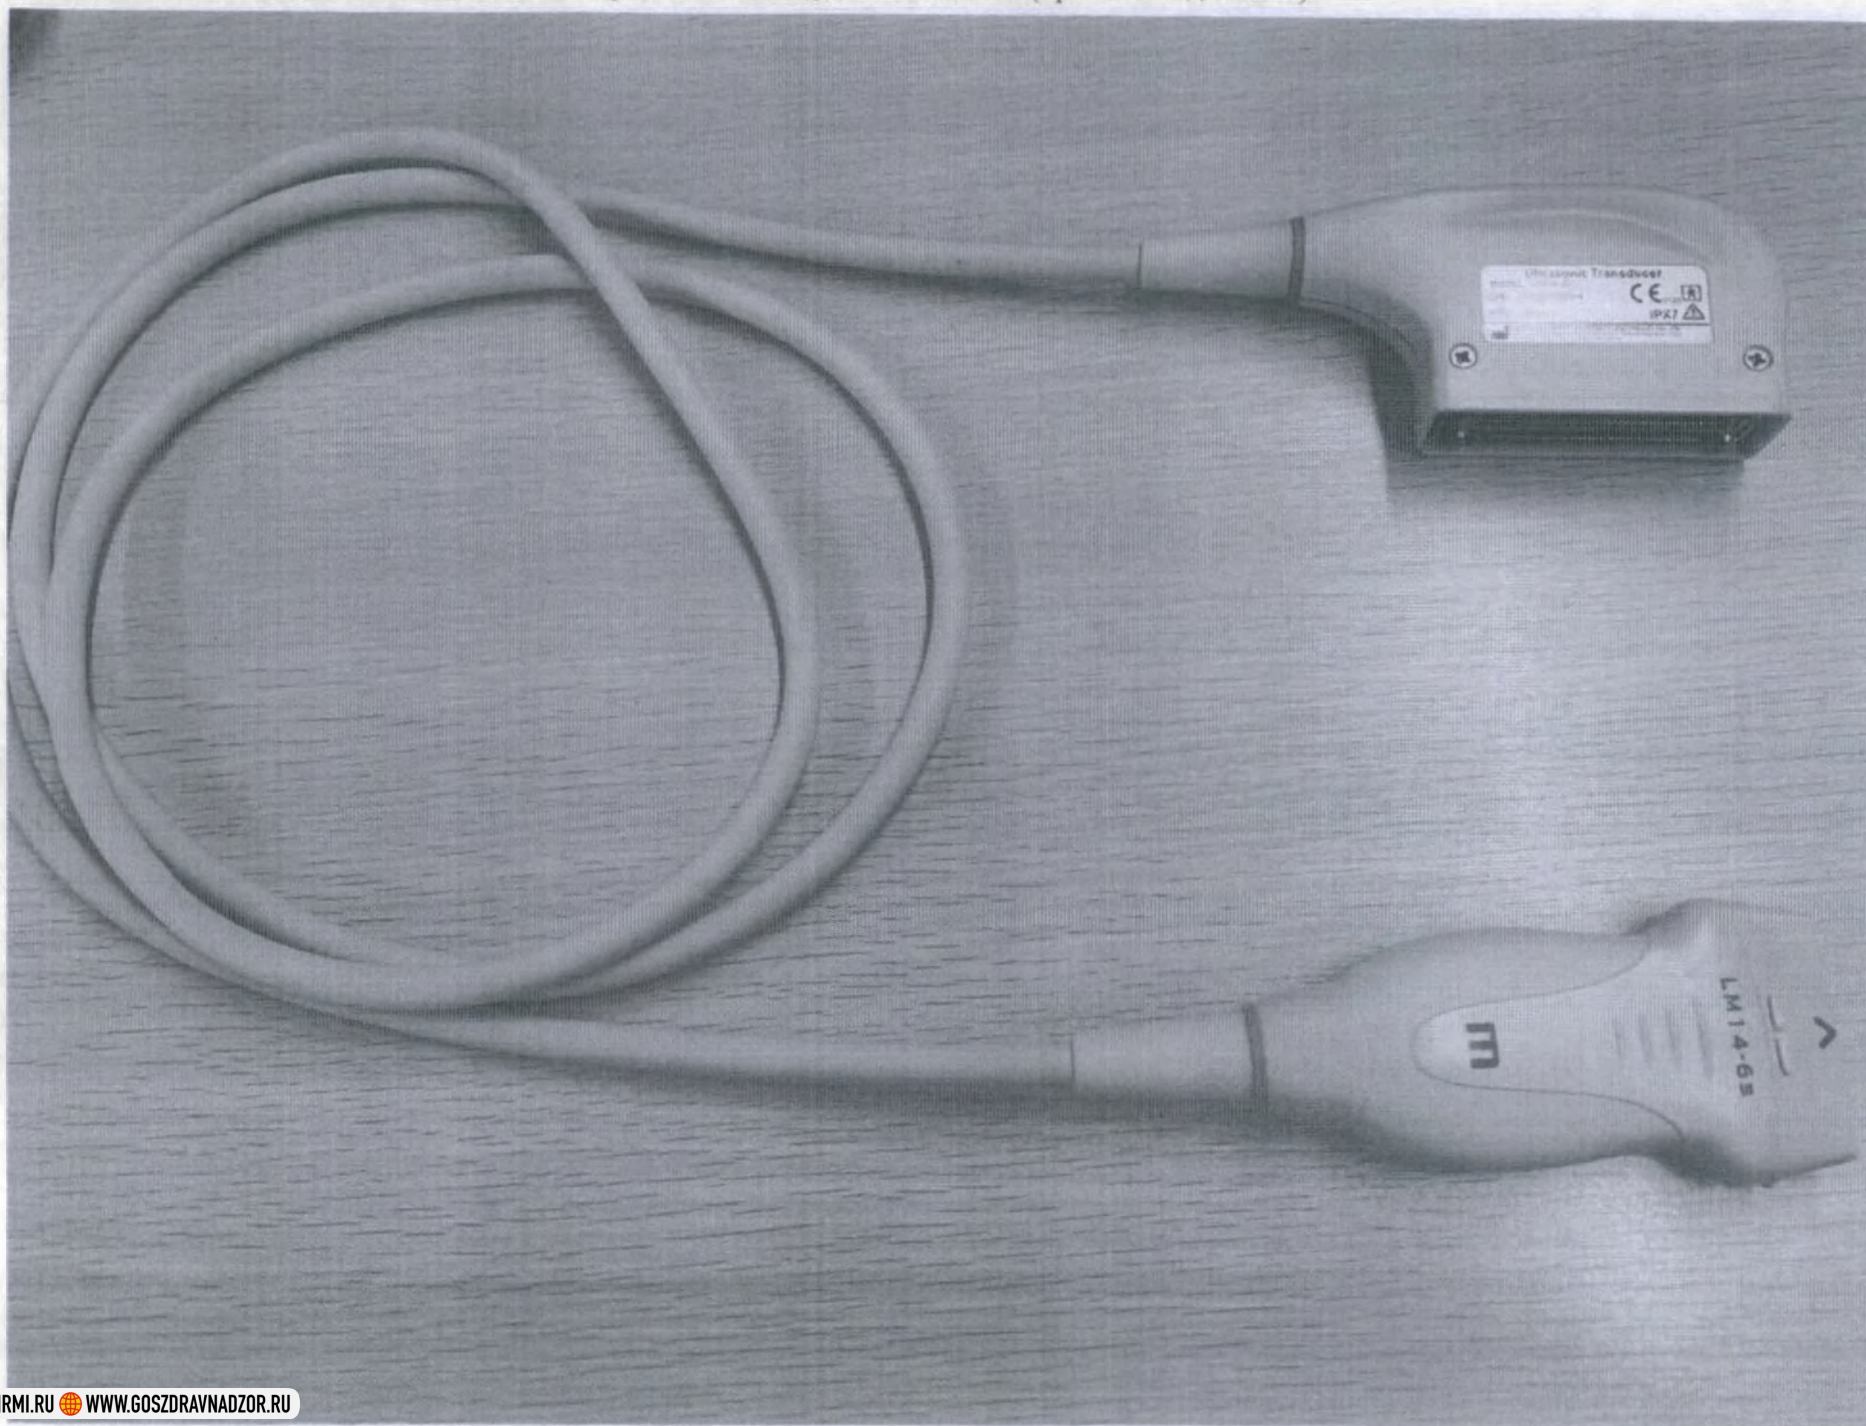


- линейный: L14-6Ws (Linear array ultrasound probe: L14-6Ws), не более 5 шт.(при необходимости).

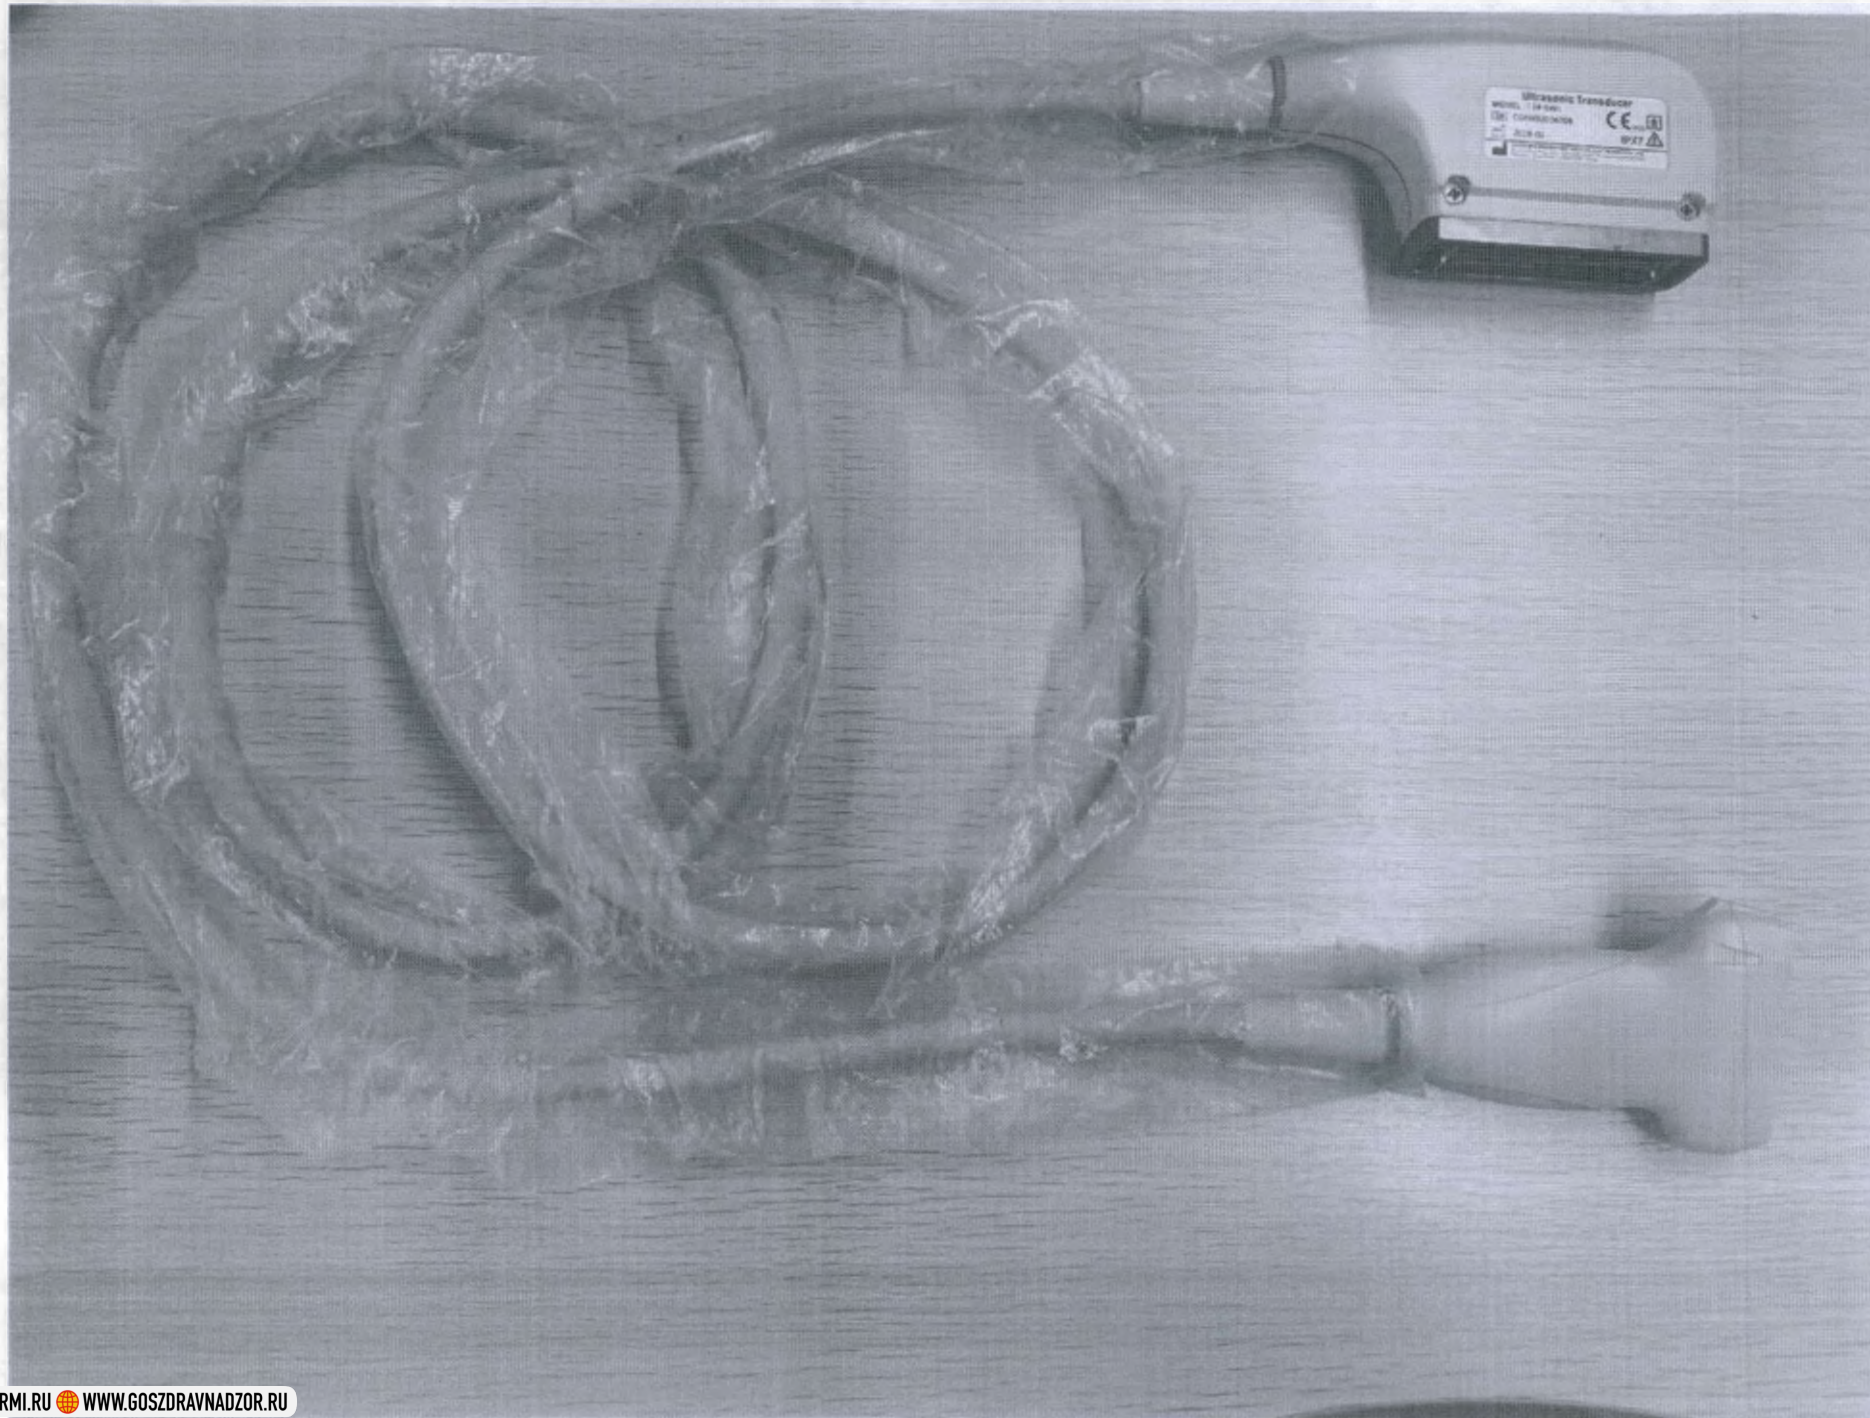


- линейный: L20-5s (Linear array ultrasound probe: L20-5s), не более 5 шт.(при необходимости).




- интраоперационный L16-4Hs (Intra-operative linear array transducer: L16-4Hs), не более 5 шт.(при необходимости).

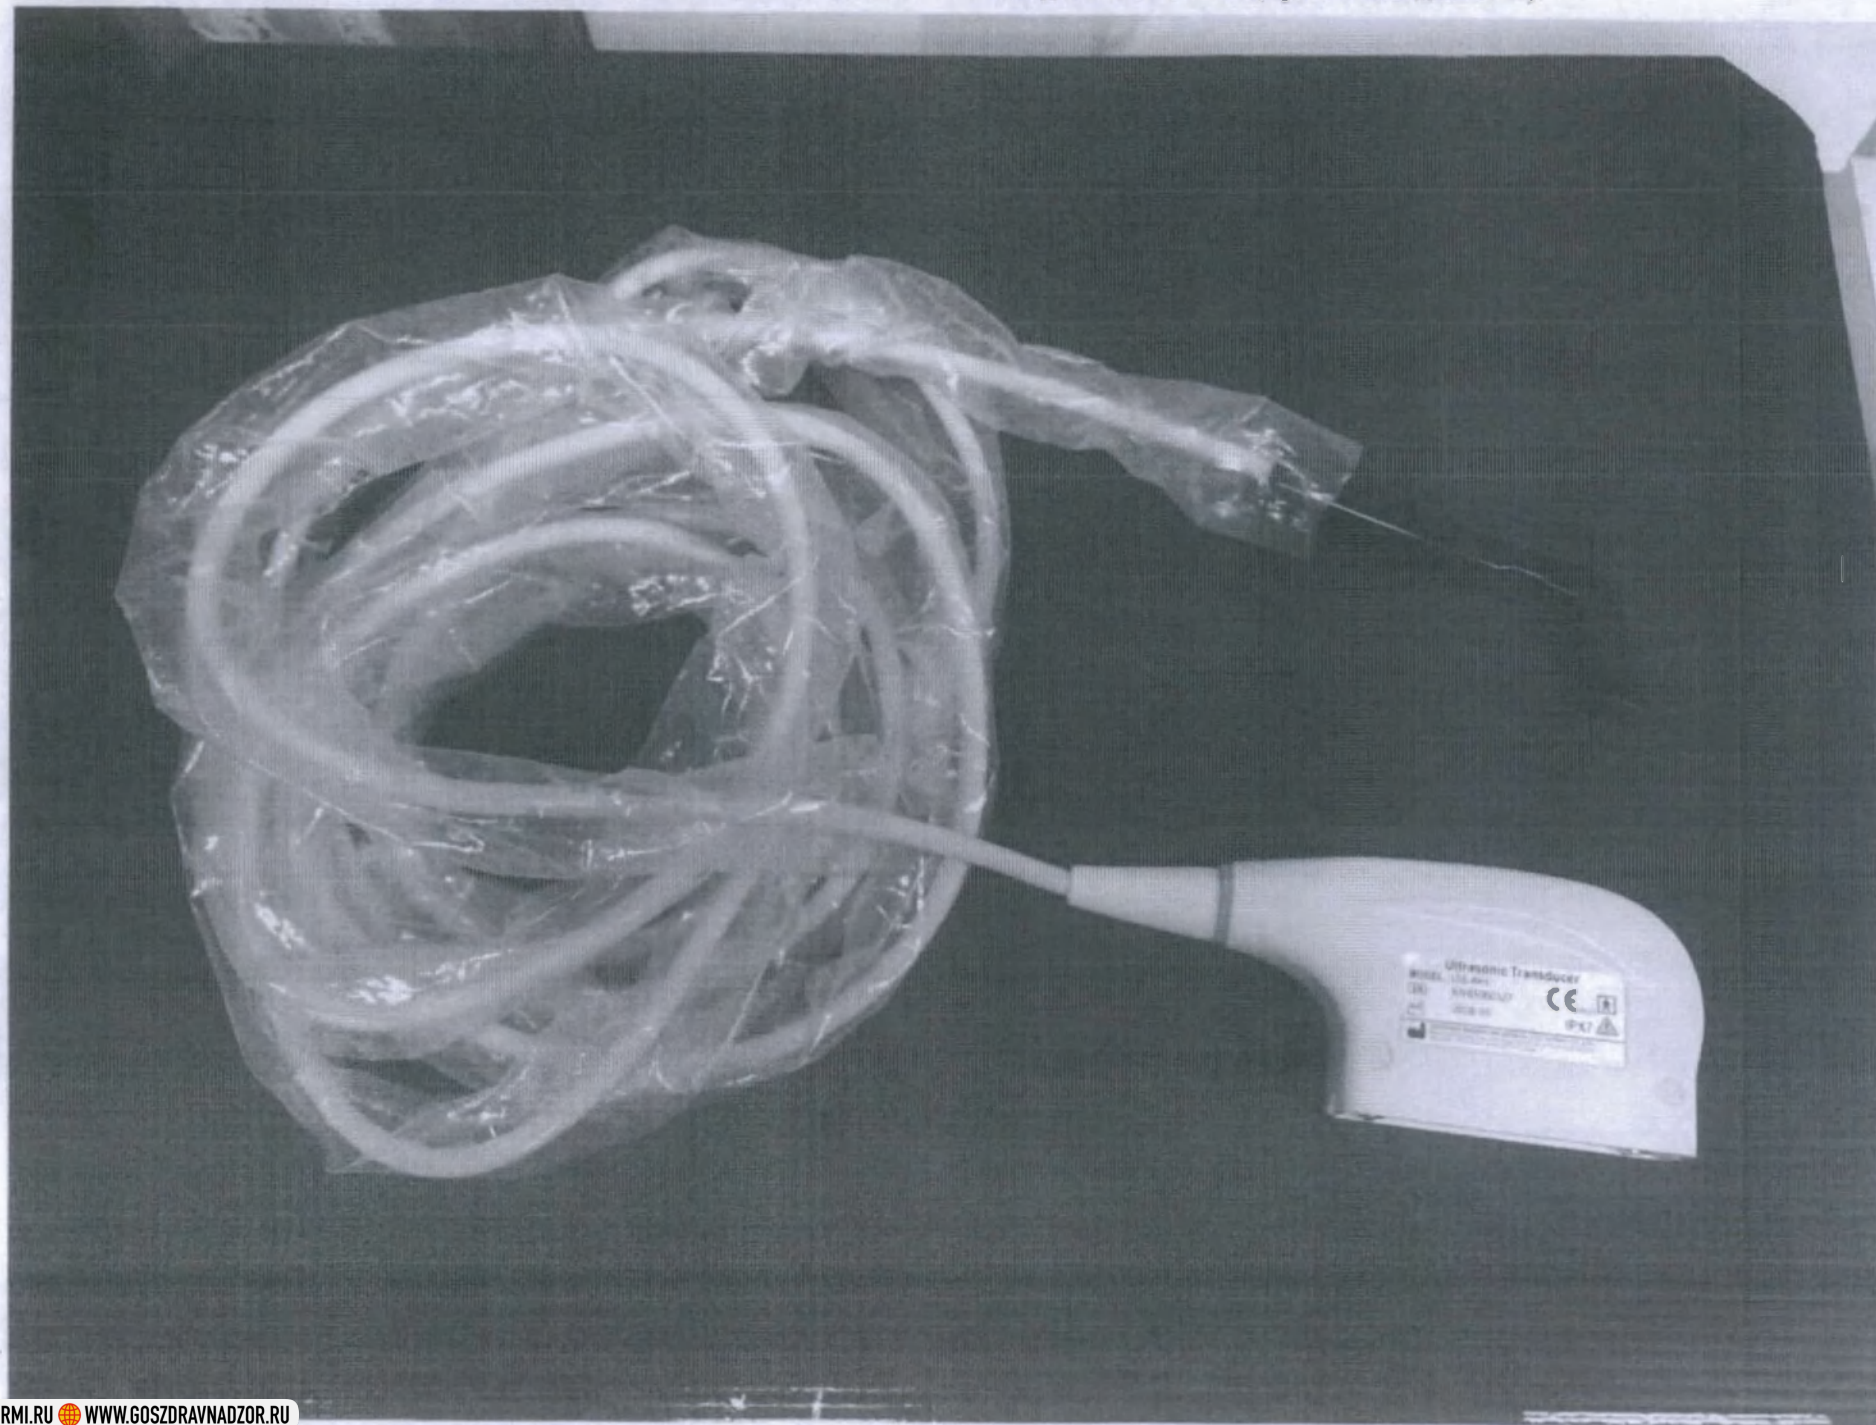

- внутрисполостной V11-3Ws (Endocavity ultrasound probe: V11-3Ws), не более 5 шт.(при необходимости).

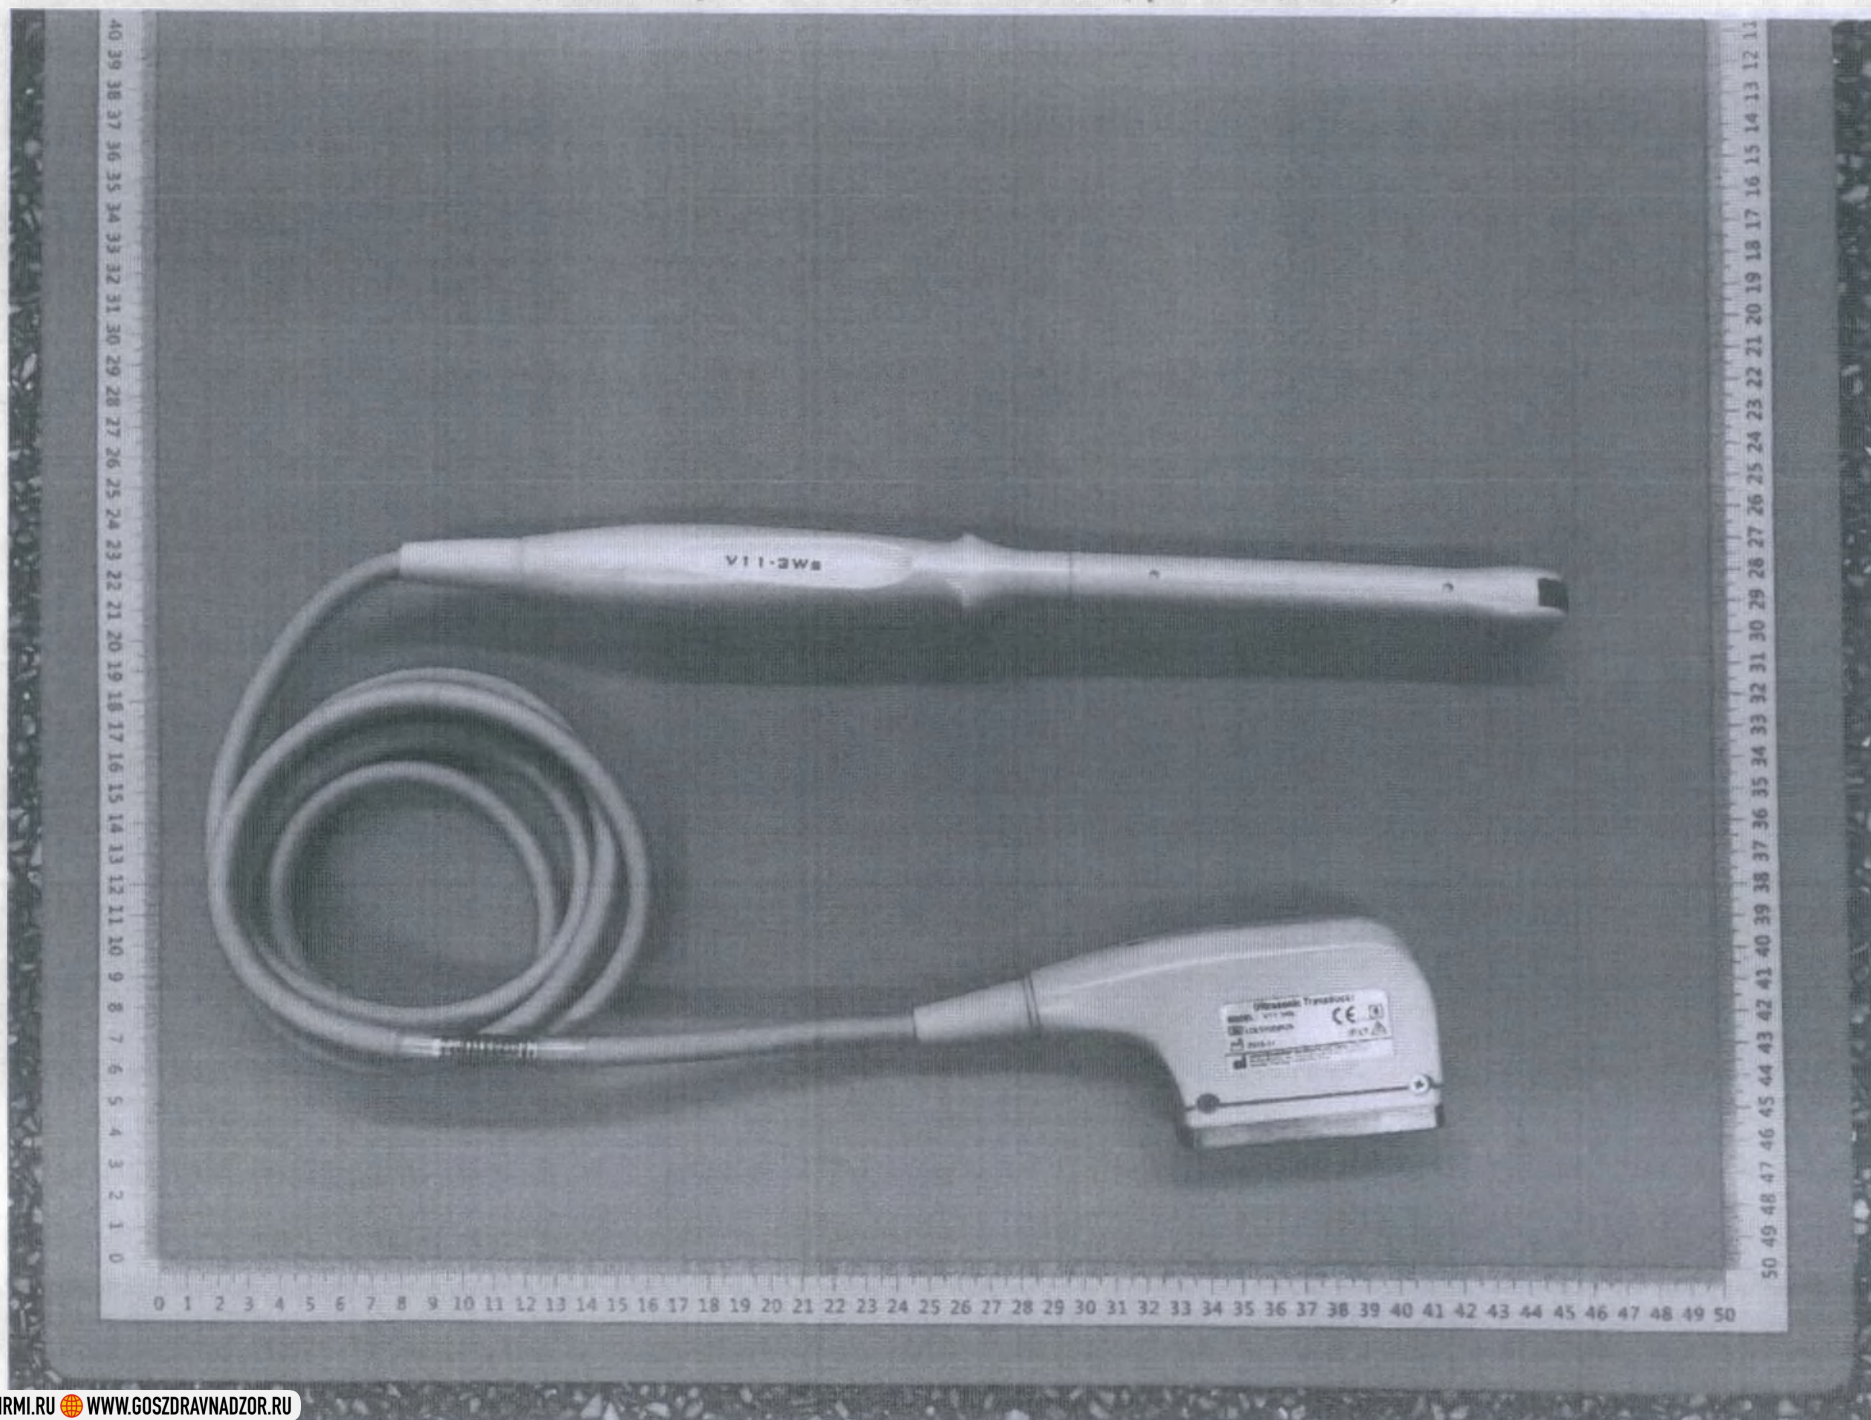


- объемный внутрисполостной DE11-3s (Endocavity Volume ultra-sound probe: DE11-3s), не более 5 шт.(при необходимости).

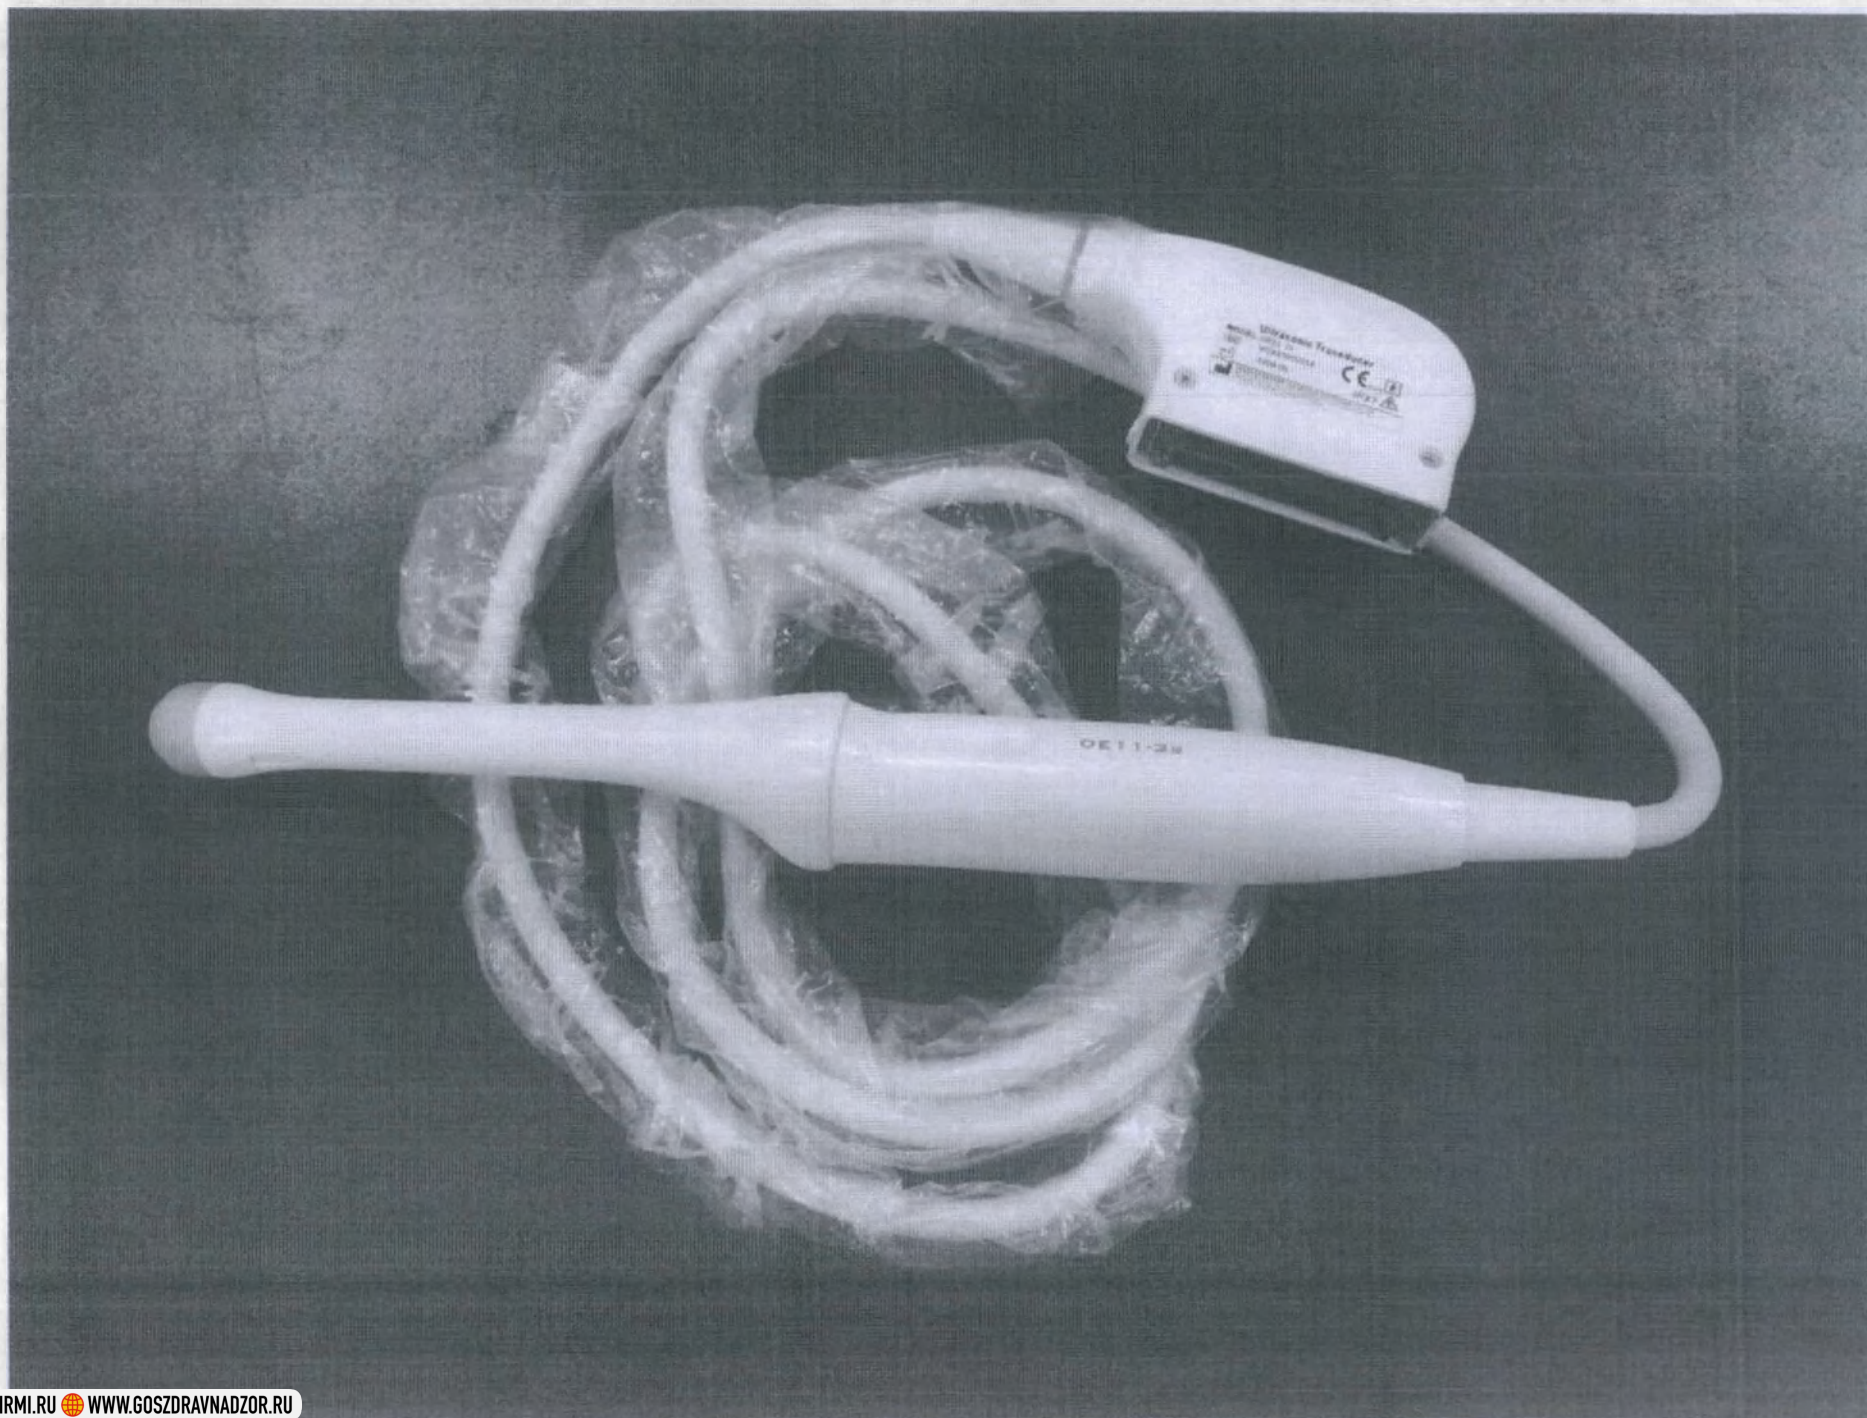


- объемный D7-2s (Volume ultrasound probe: D7-2s), не более 5 шт.(при необходимости).




- фазированный SP5-1s (Phased array ultrasound probe: SP5-1s), не более 5 шт.(при необходимости).

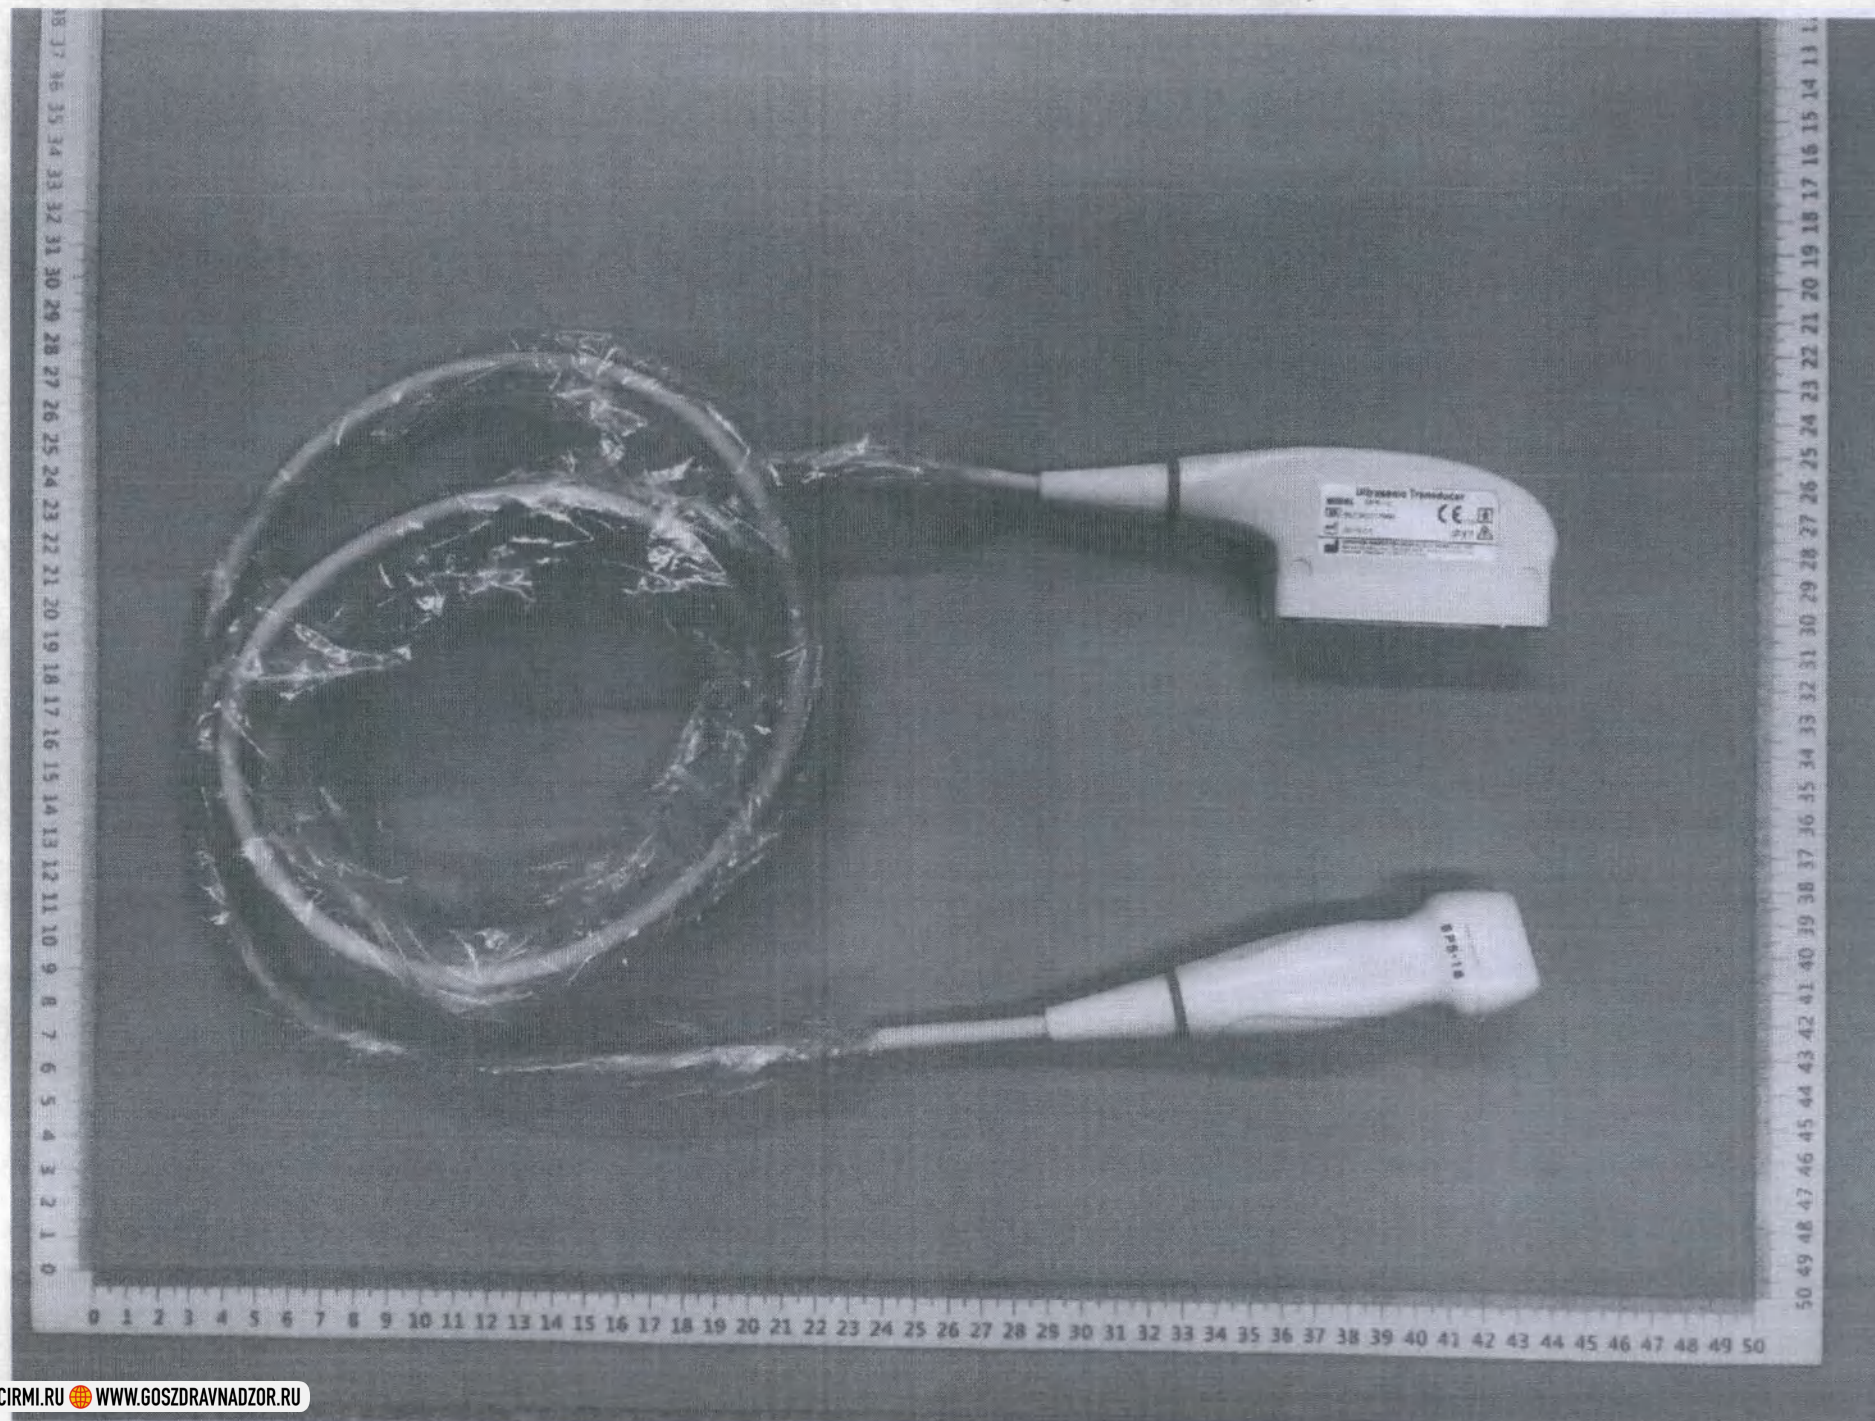


- фазированный P10-4s (Phased array ultrasound probe: P10-4s), не более 5 шт.(при необходимости).

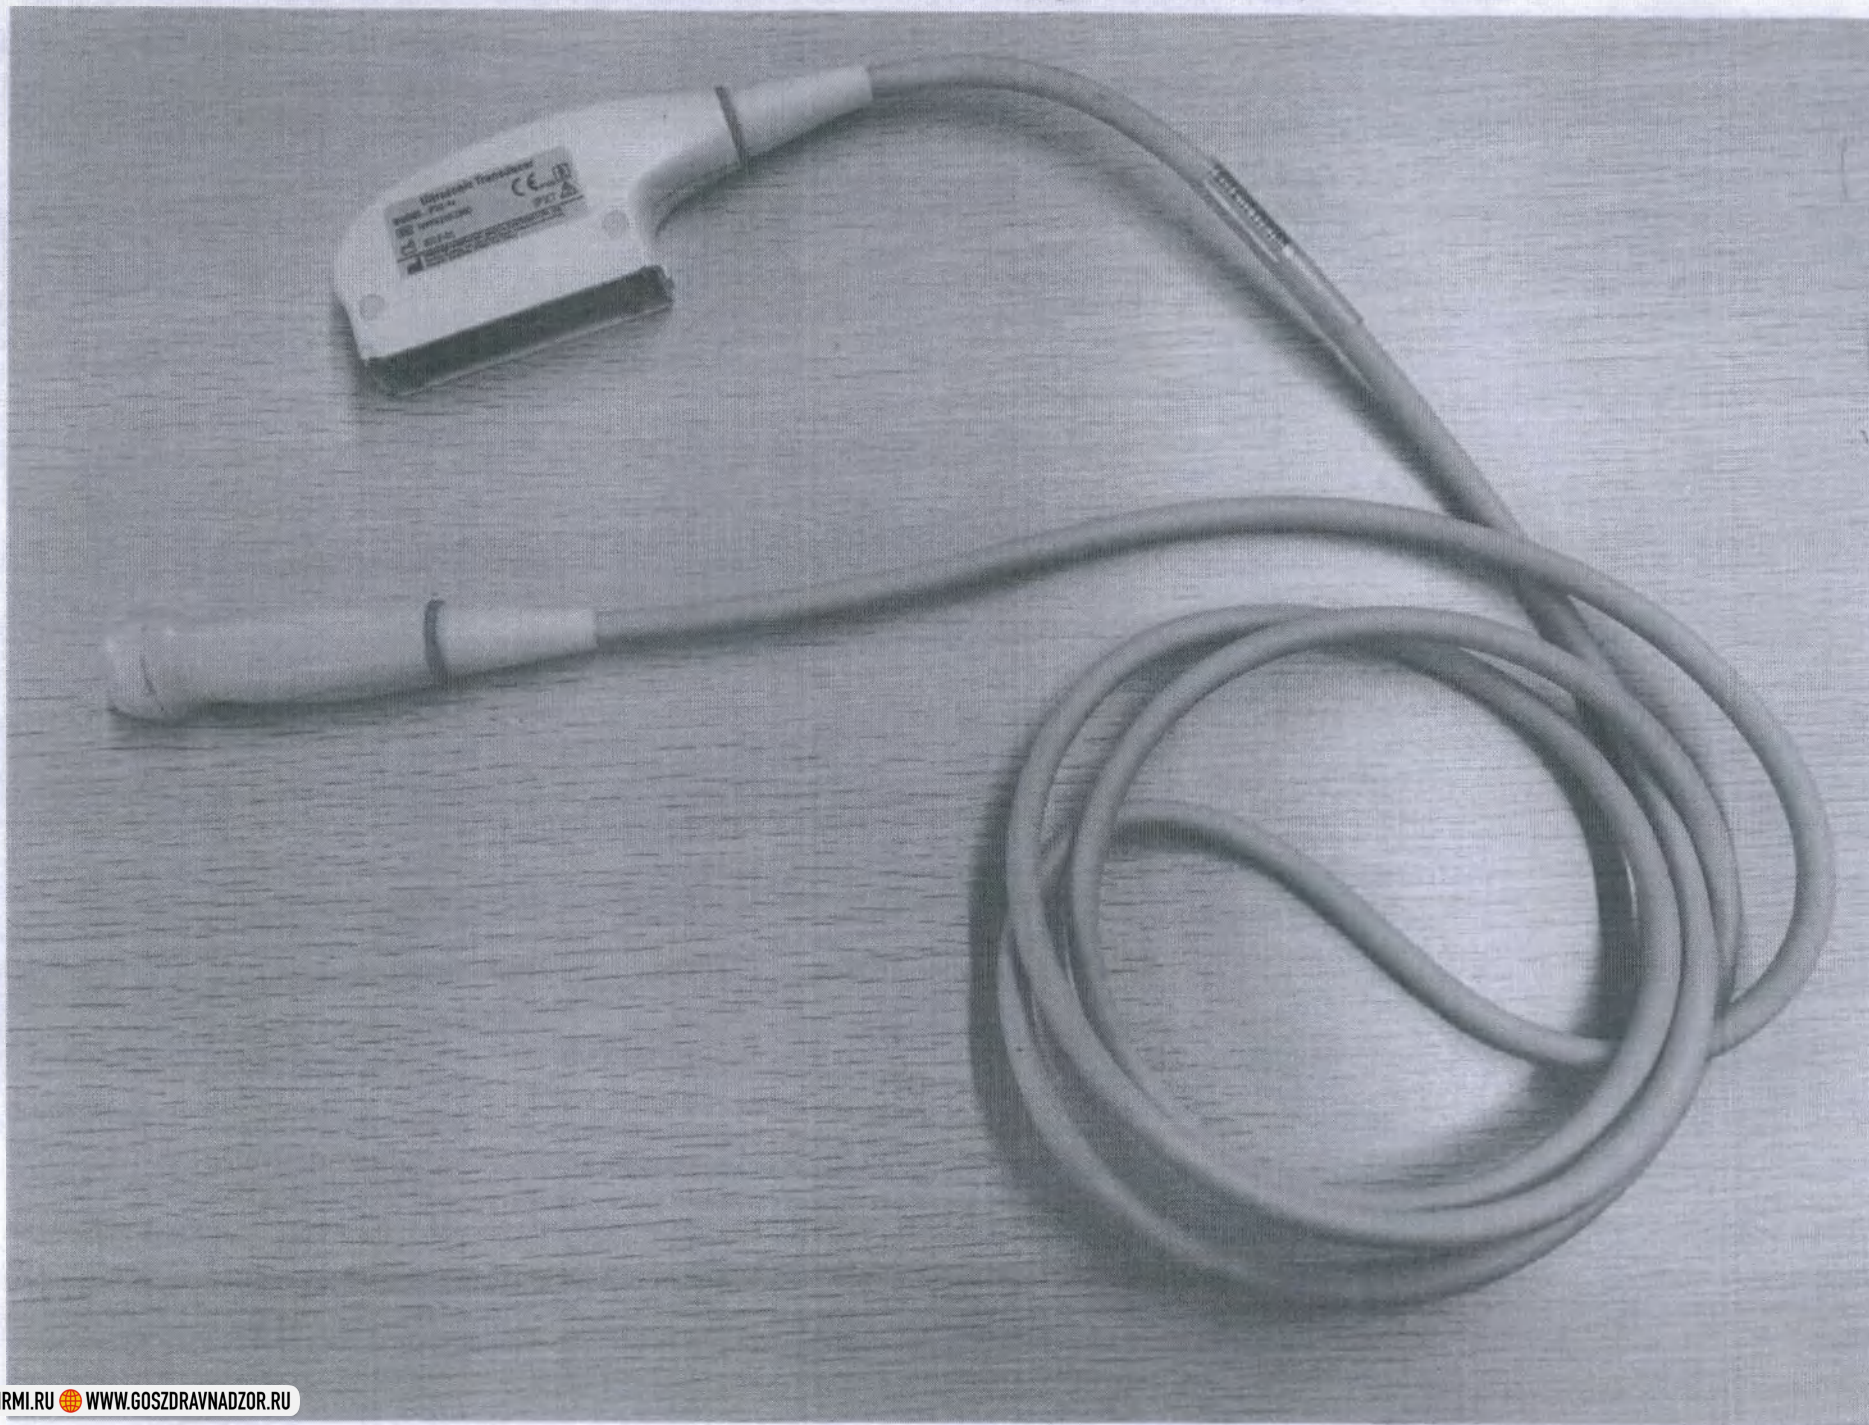


- фазированный P7-3s (Phased array ultrasound probe: P7-3s), не более 5 шт.(при необходимости).

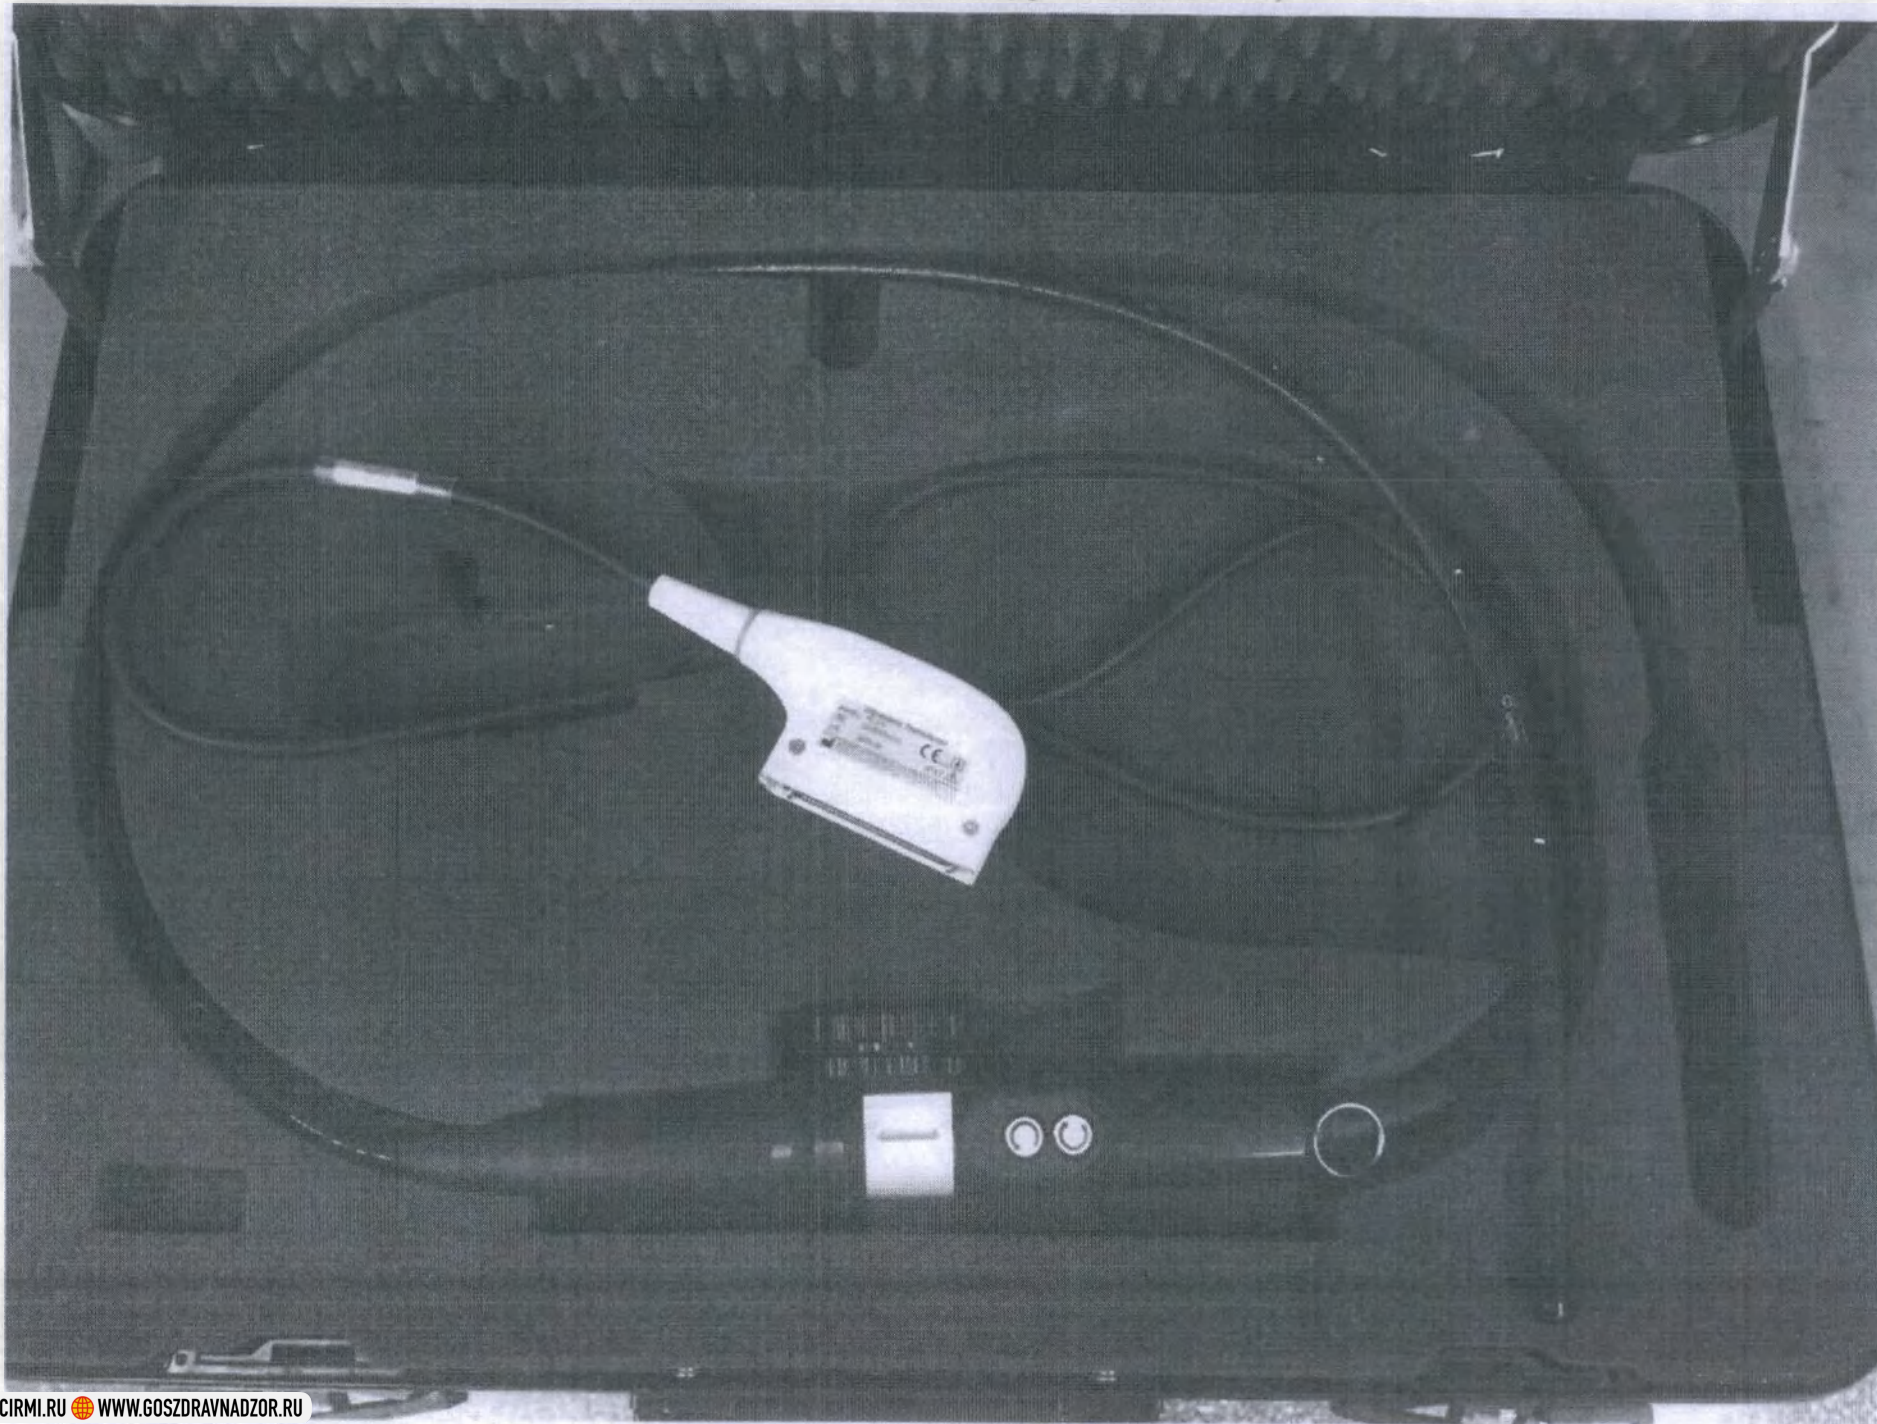


- фазированный P4-2s (Phased array ultrasound probe: P4-2s), не более 5 шт.(при необходимости).

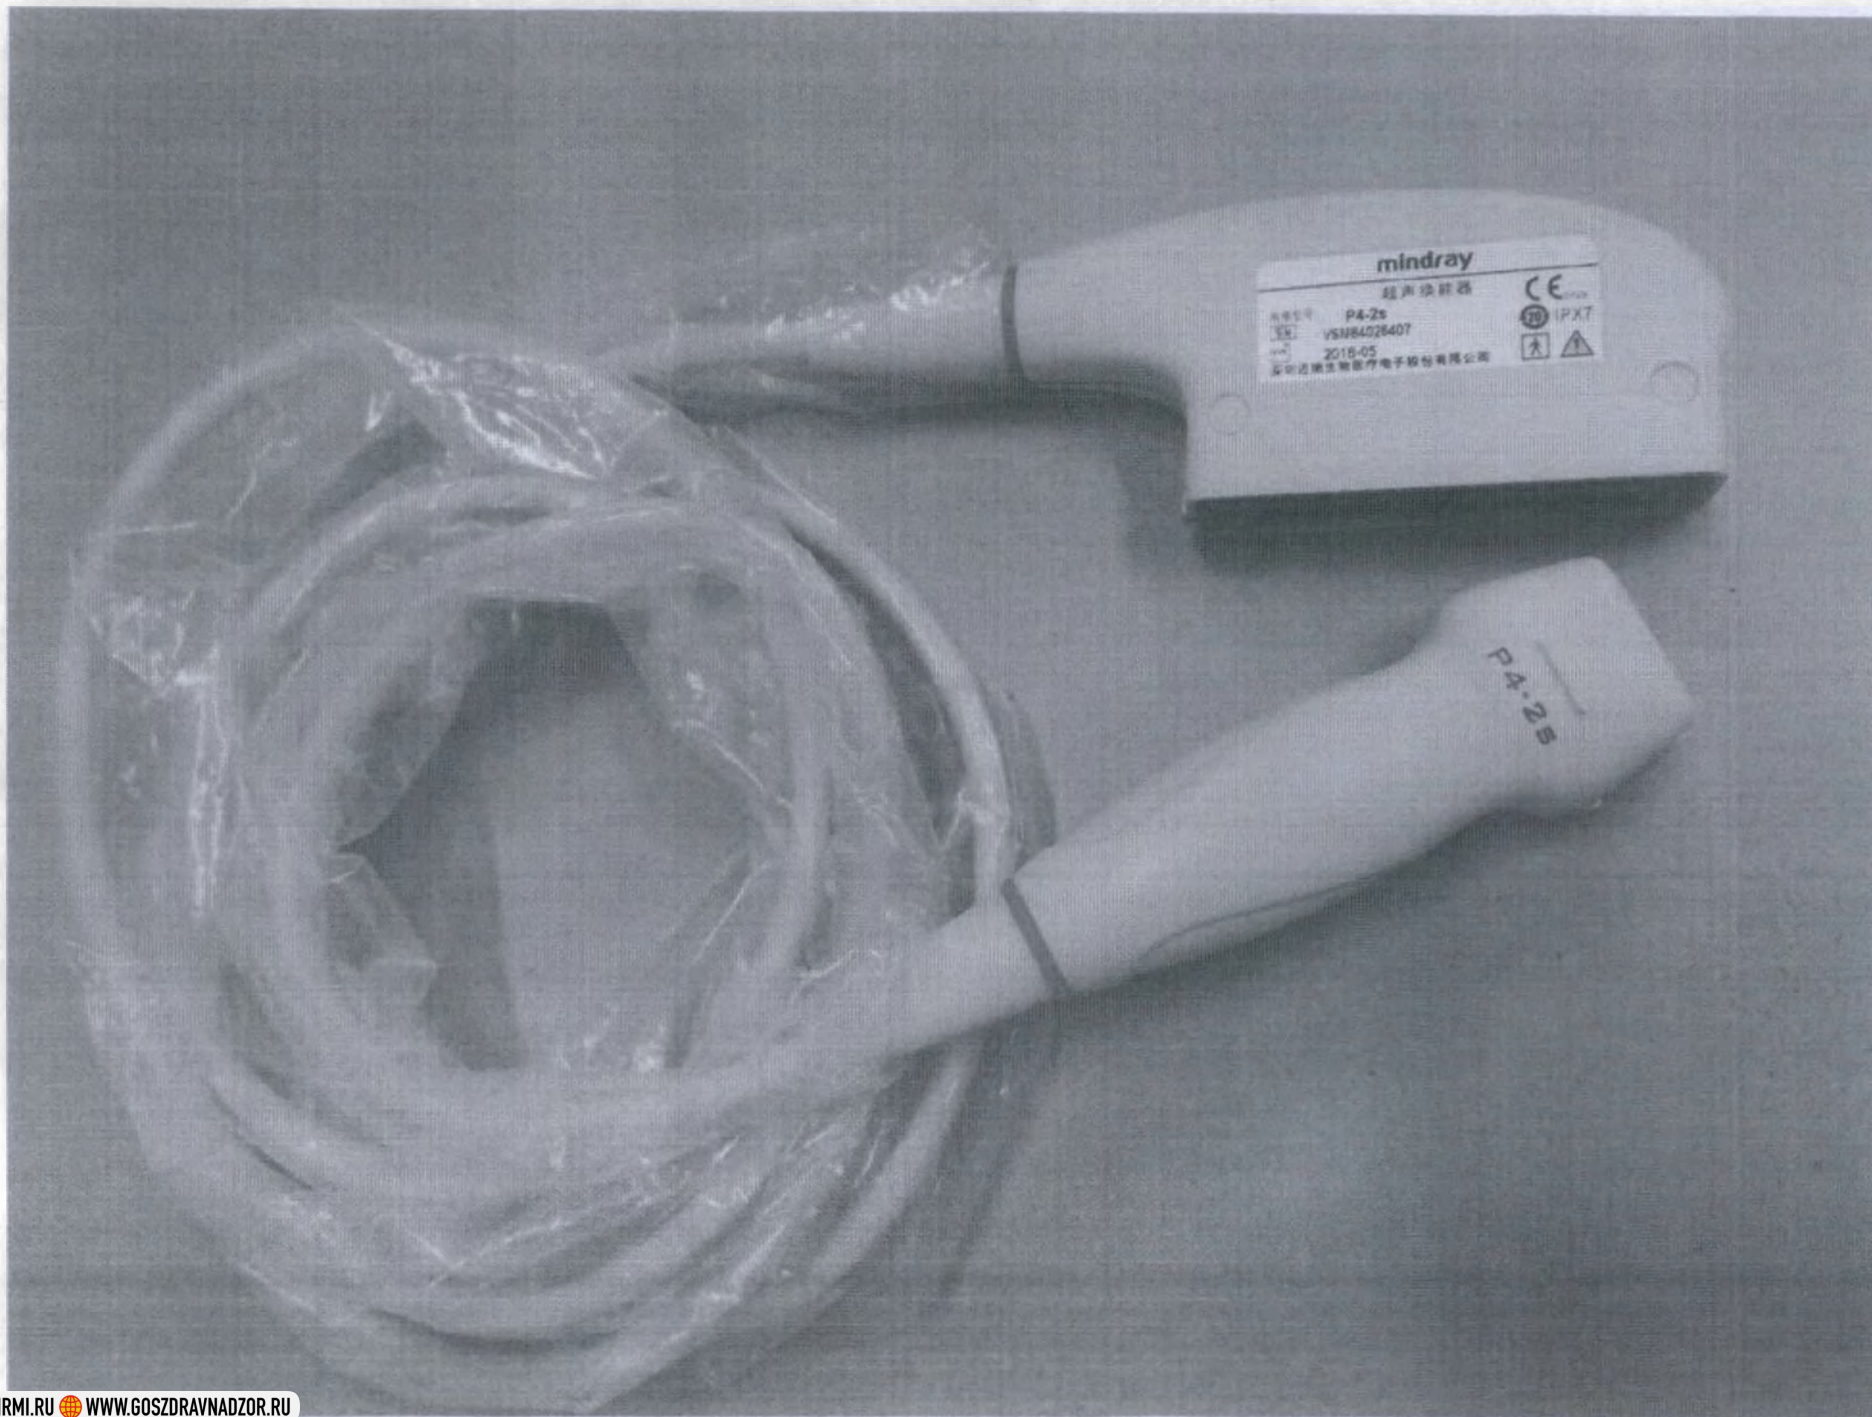


- секторный фазированный Р7-3Ts (Transesophageal ultrasound probe: P7-3Ts), не более 5 шт.(при необходимости).

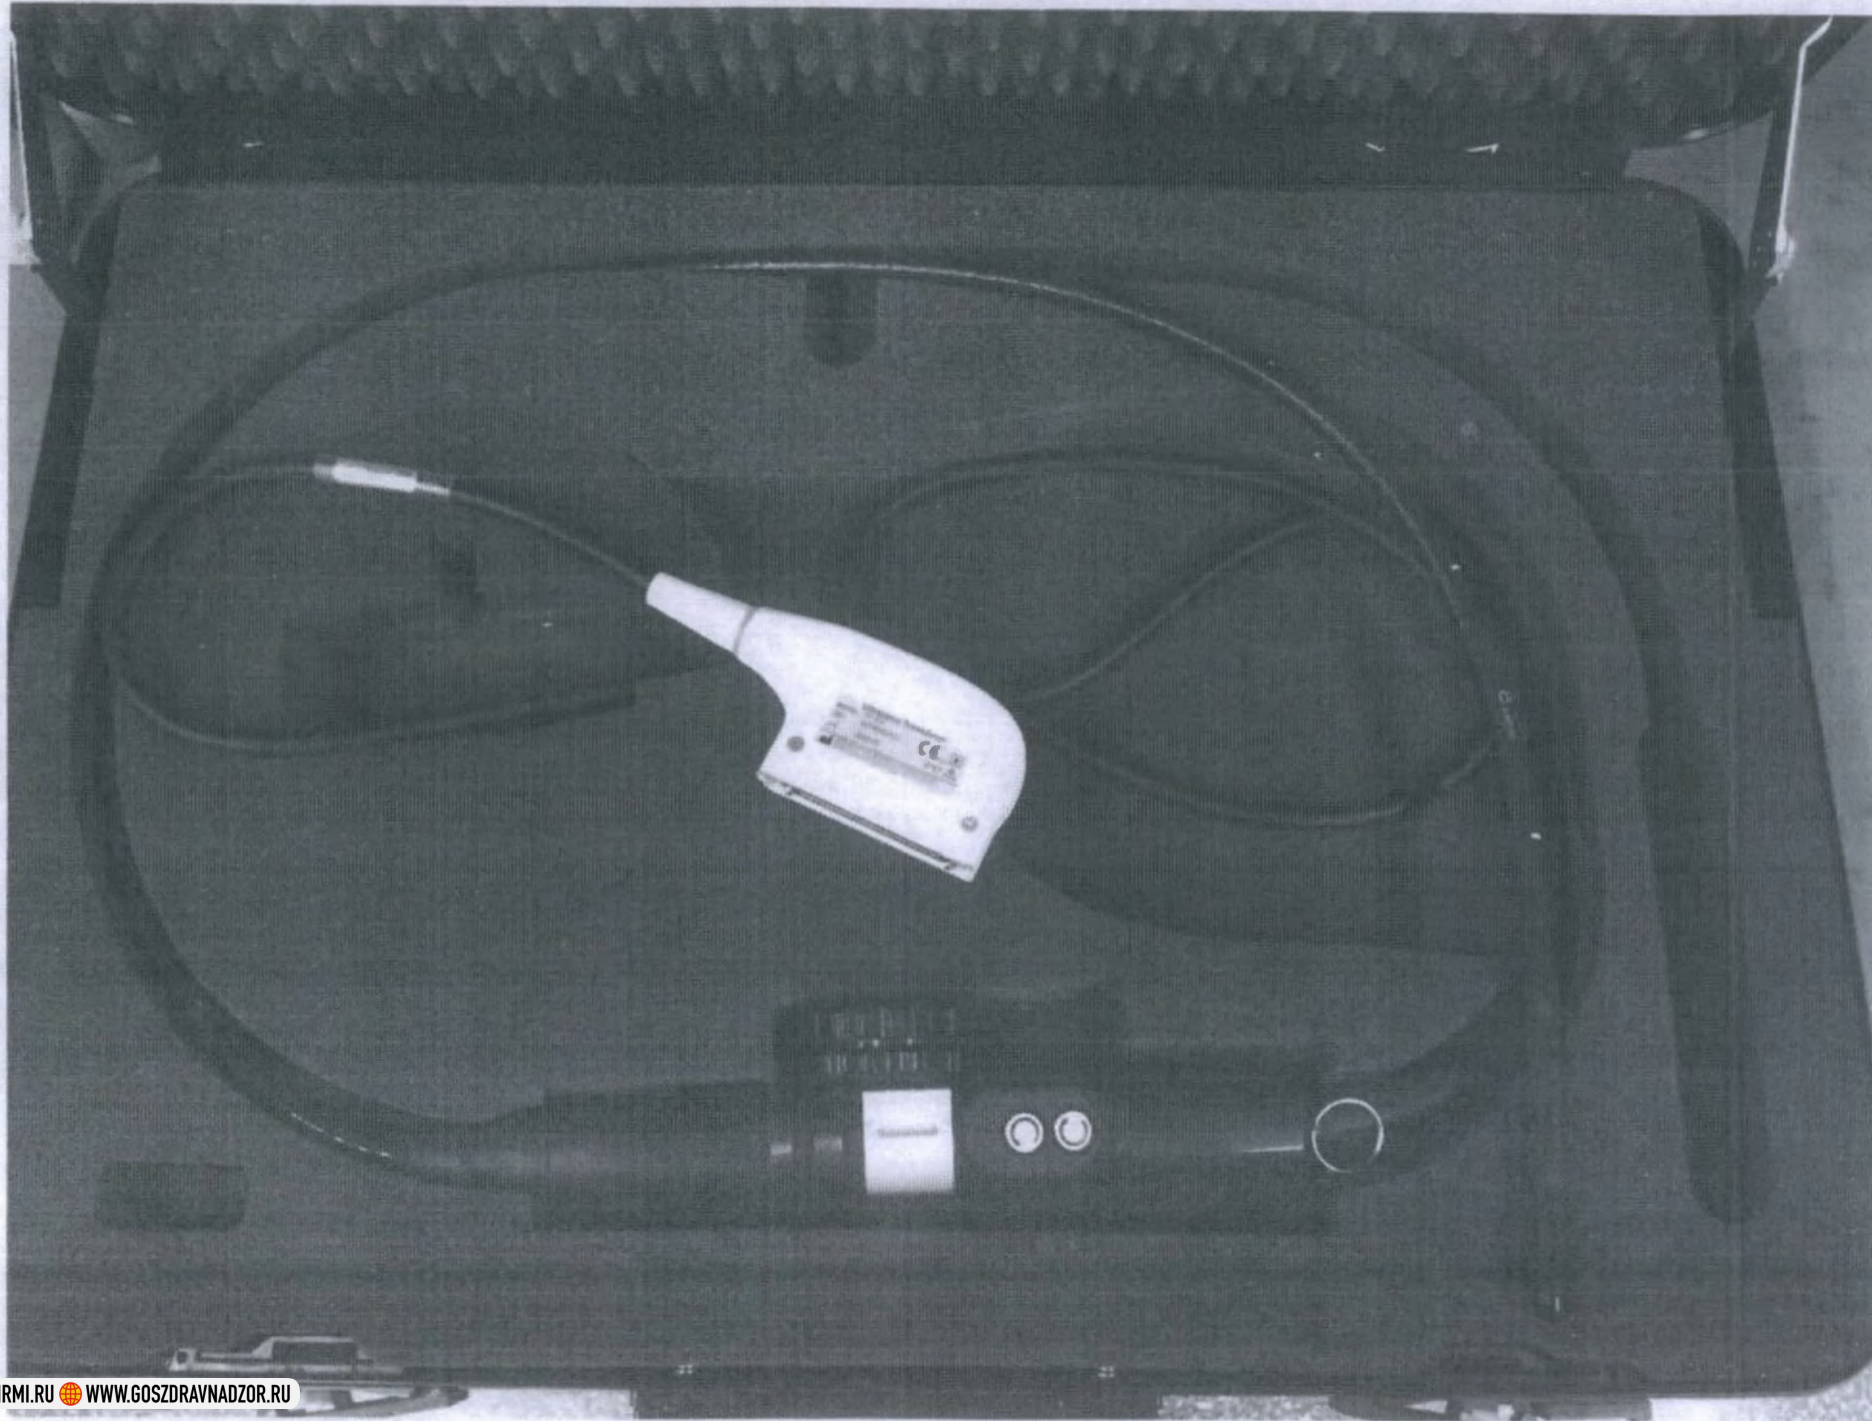

- карандашный CW5s (Pencil probe: CW5s), не более 2 шт. (при необходимости).

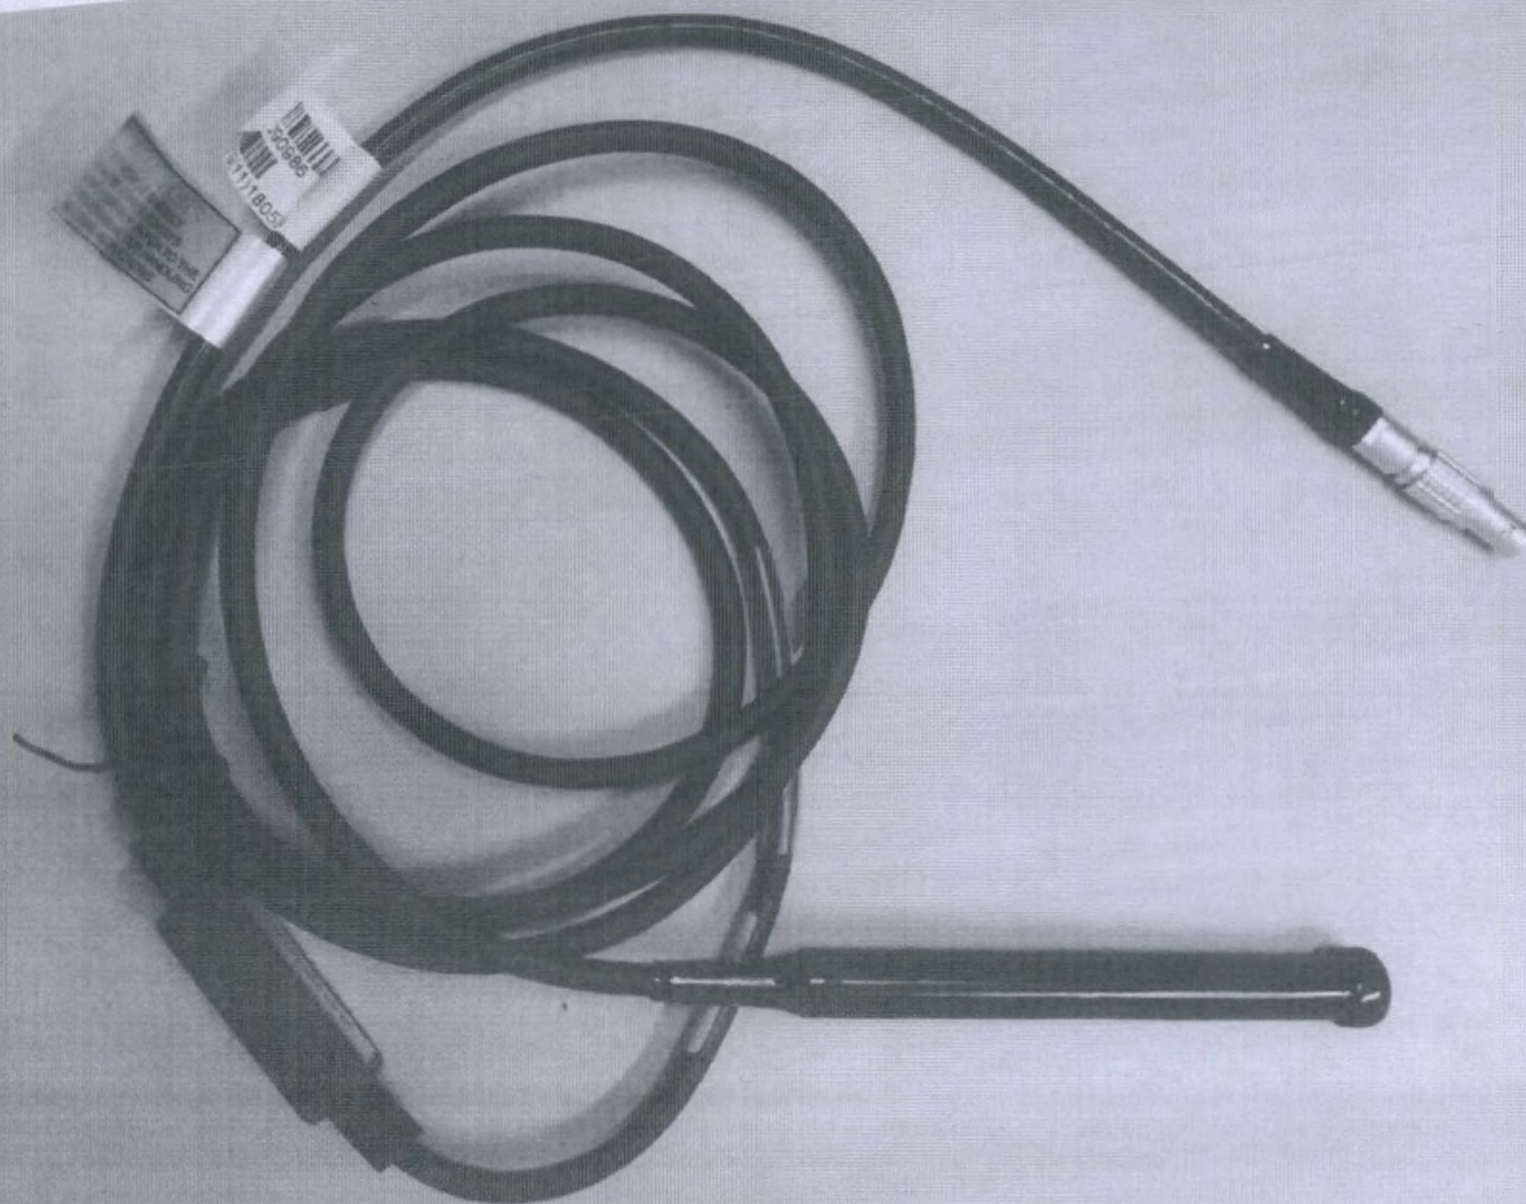

- карандашный CW2s (Pencil probe: CW2s), не более 2 шт.(при необходимости).

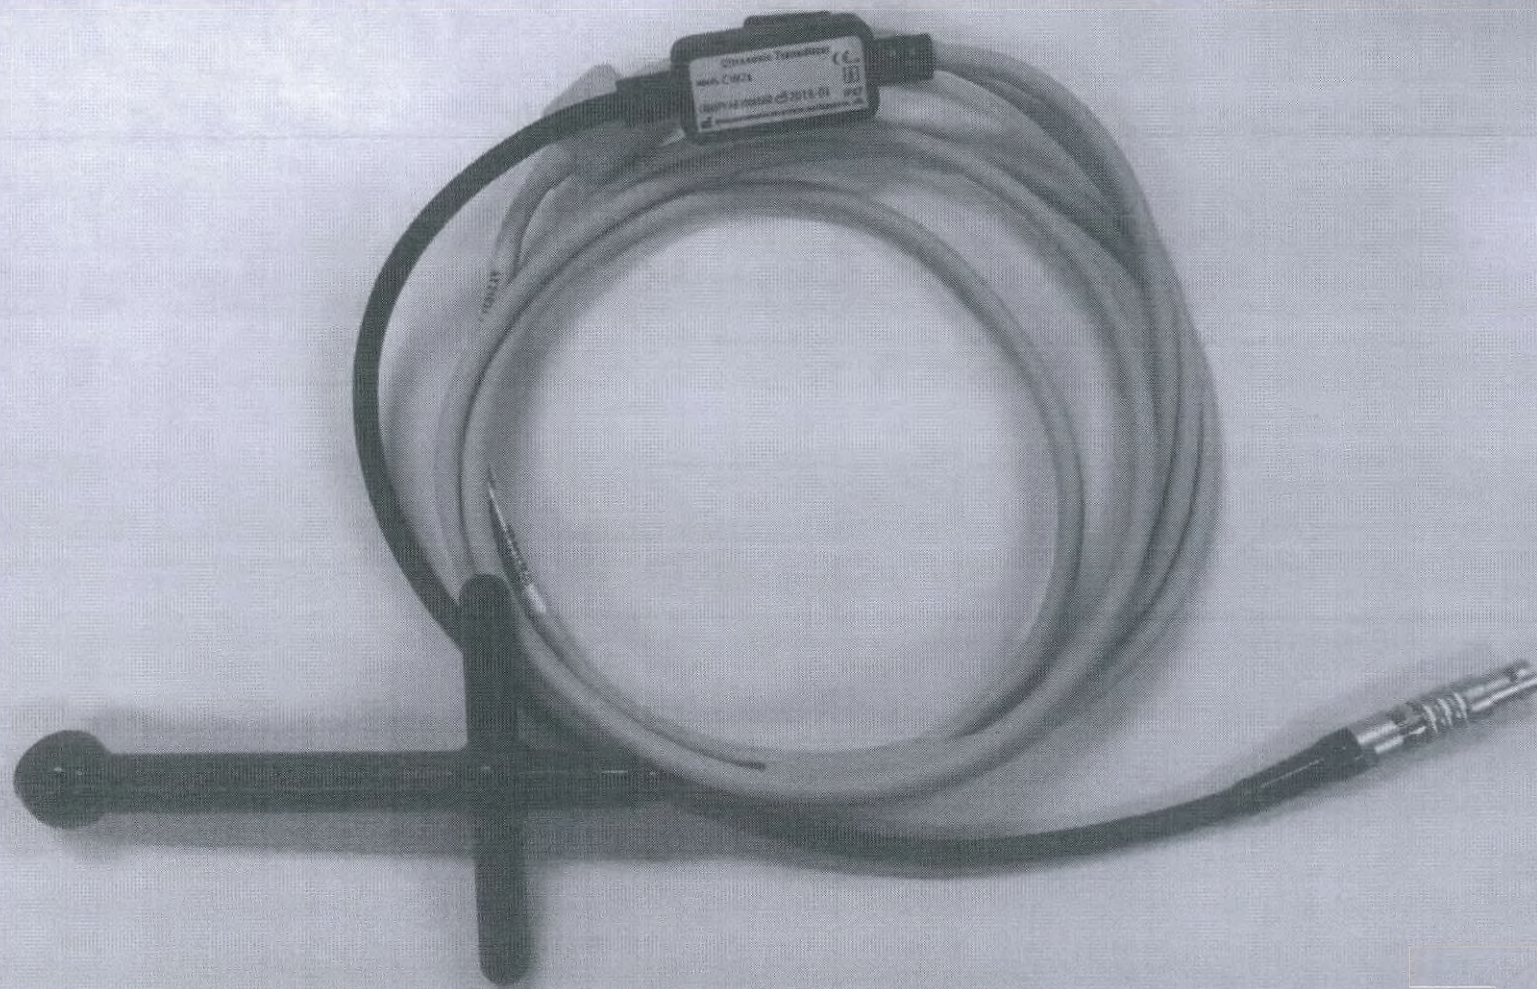


8. Модуль: - приема ЭКГ сигналов с кабелем ЭКГ (Physio Module (includes ECG with cords)), не более 2 шт. (при необходимости).




- постоянно-волнового доплера (CW module) (при необходимости).




- объемного сканирования в реальном времени (4D module) (при необходимости).

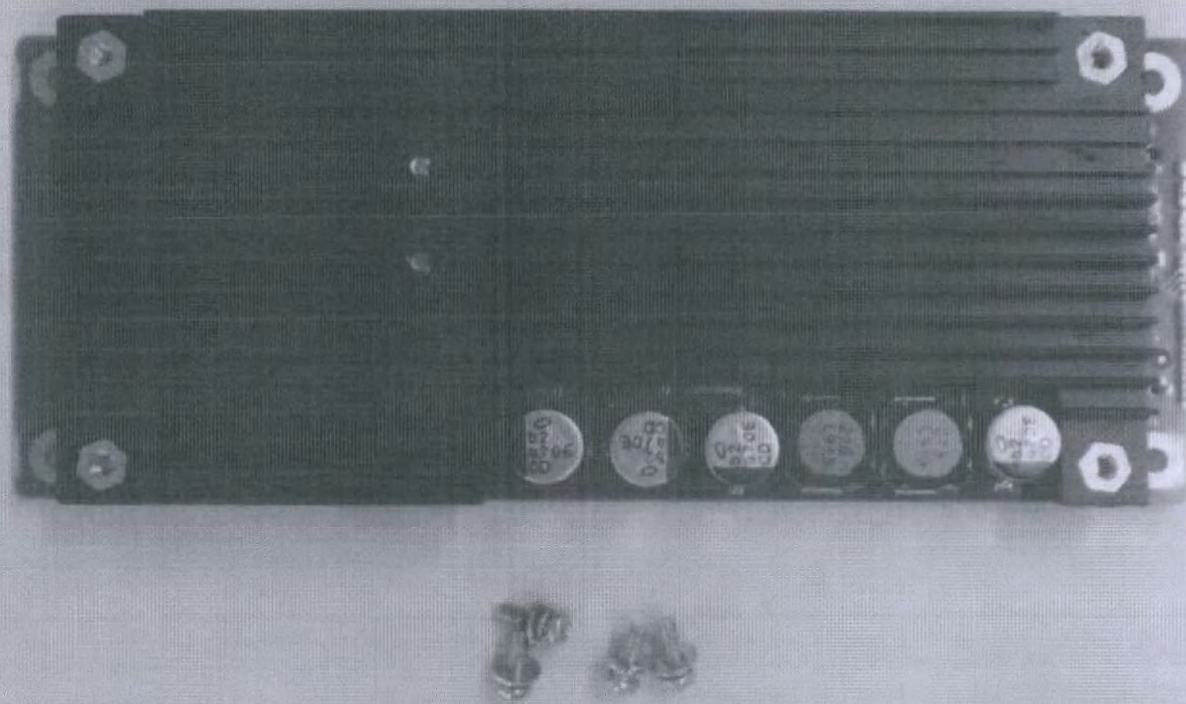


- физиологических сигналов (Physiology module) (при необходимости).

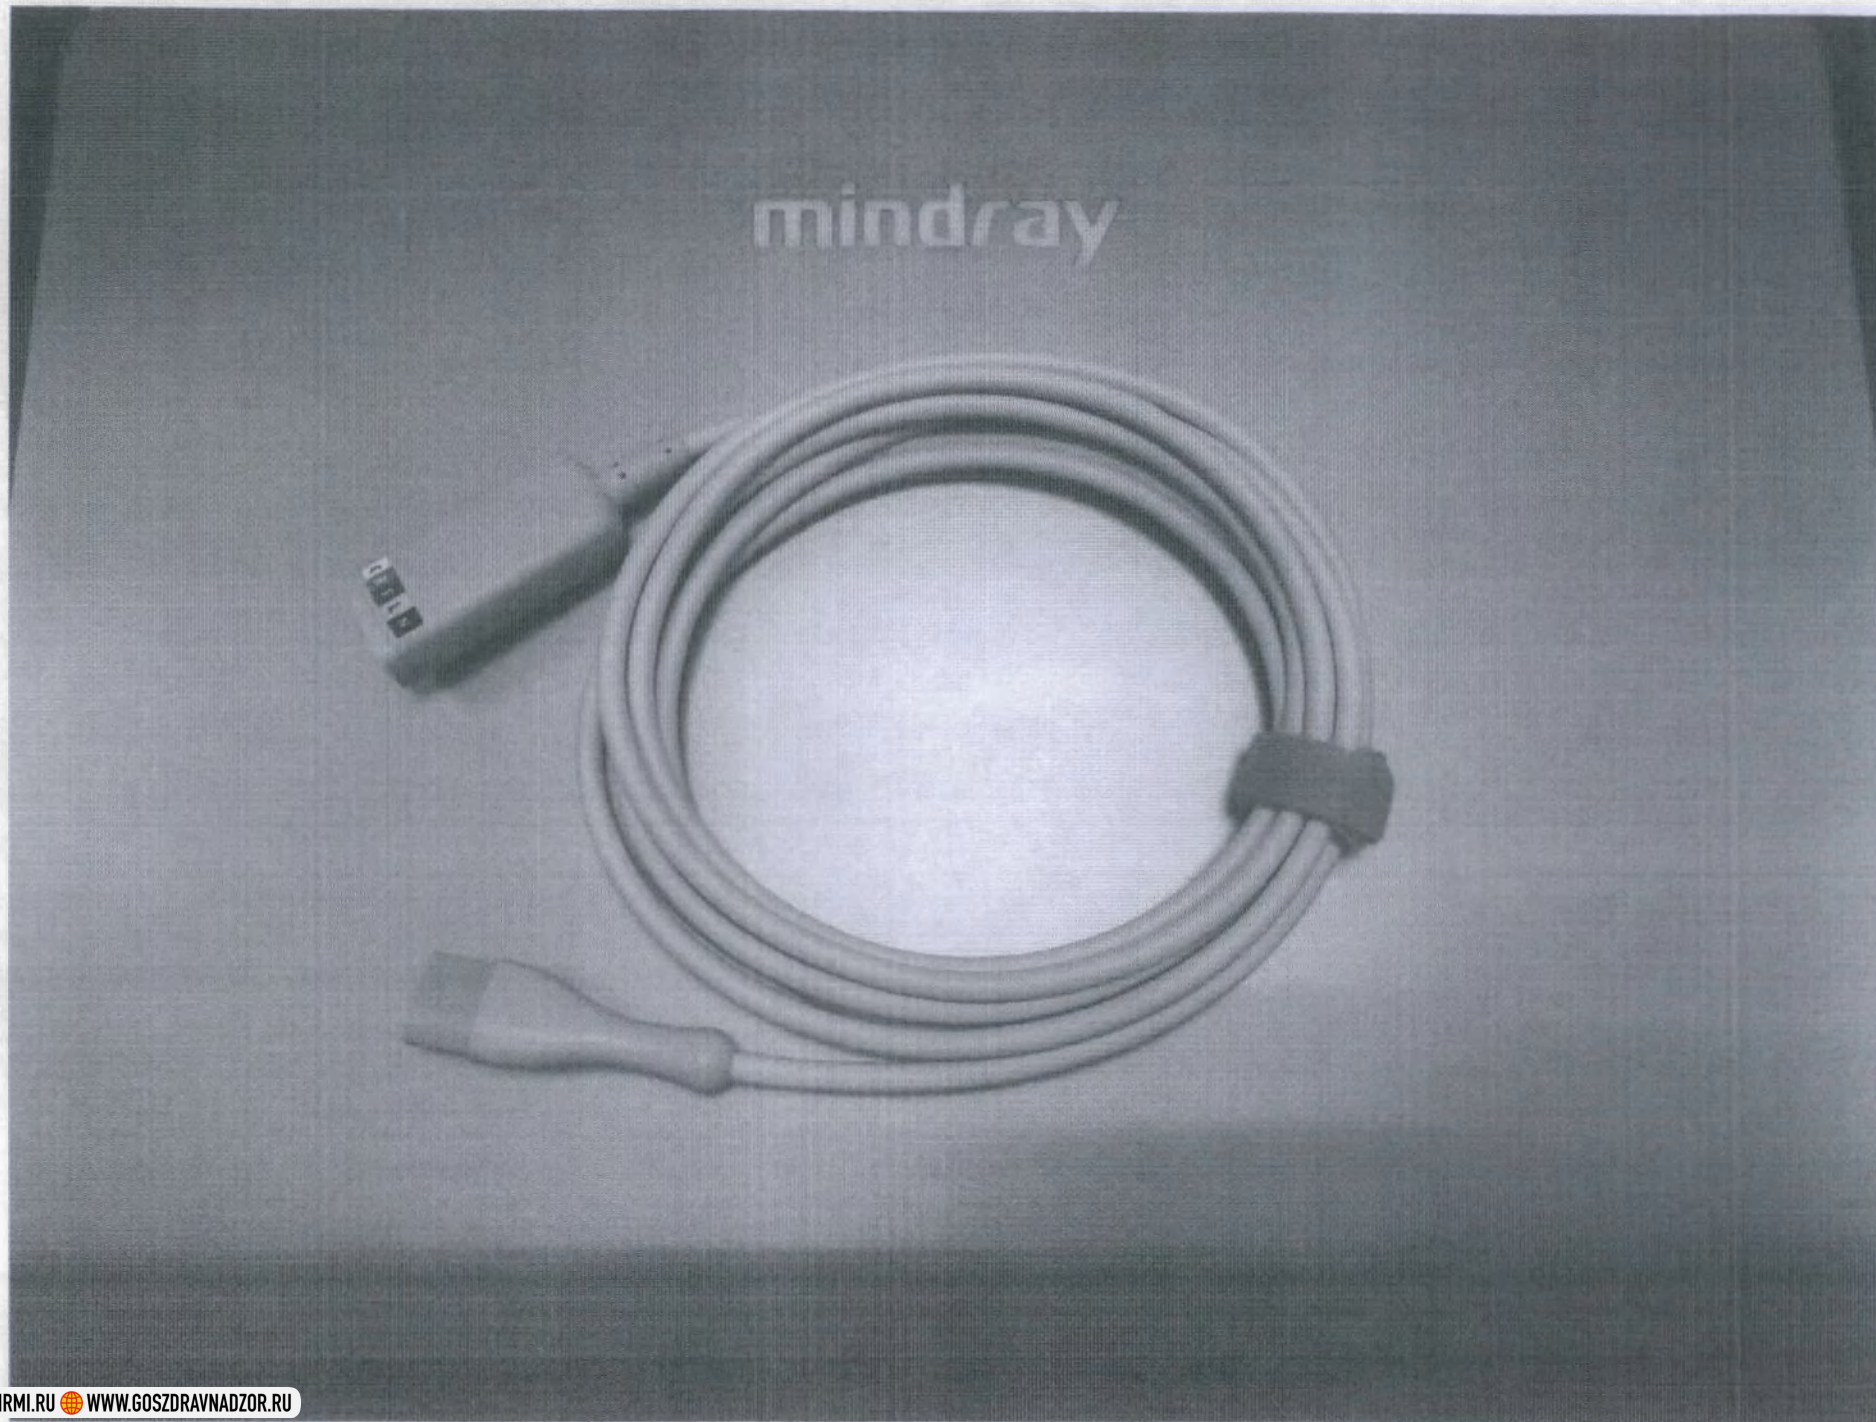

- физиологических сигналов (Physiology module) (при необходимости).

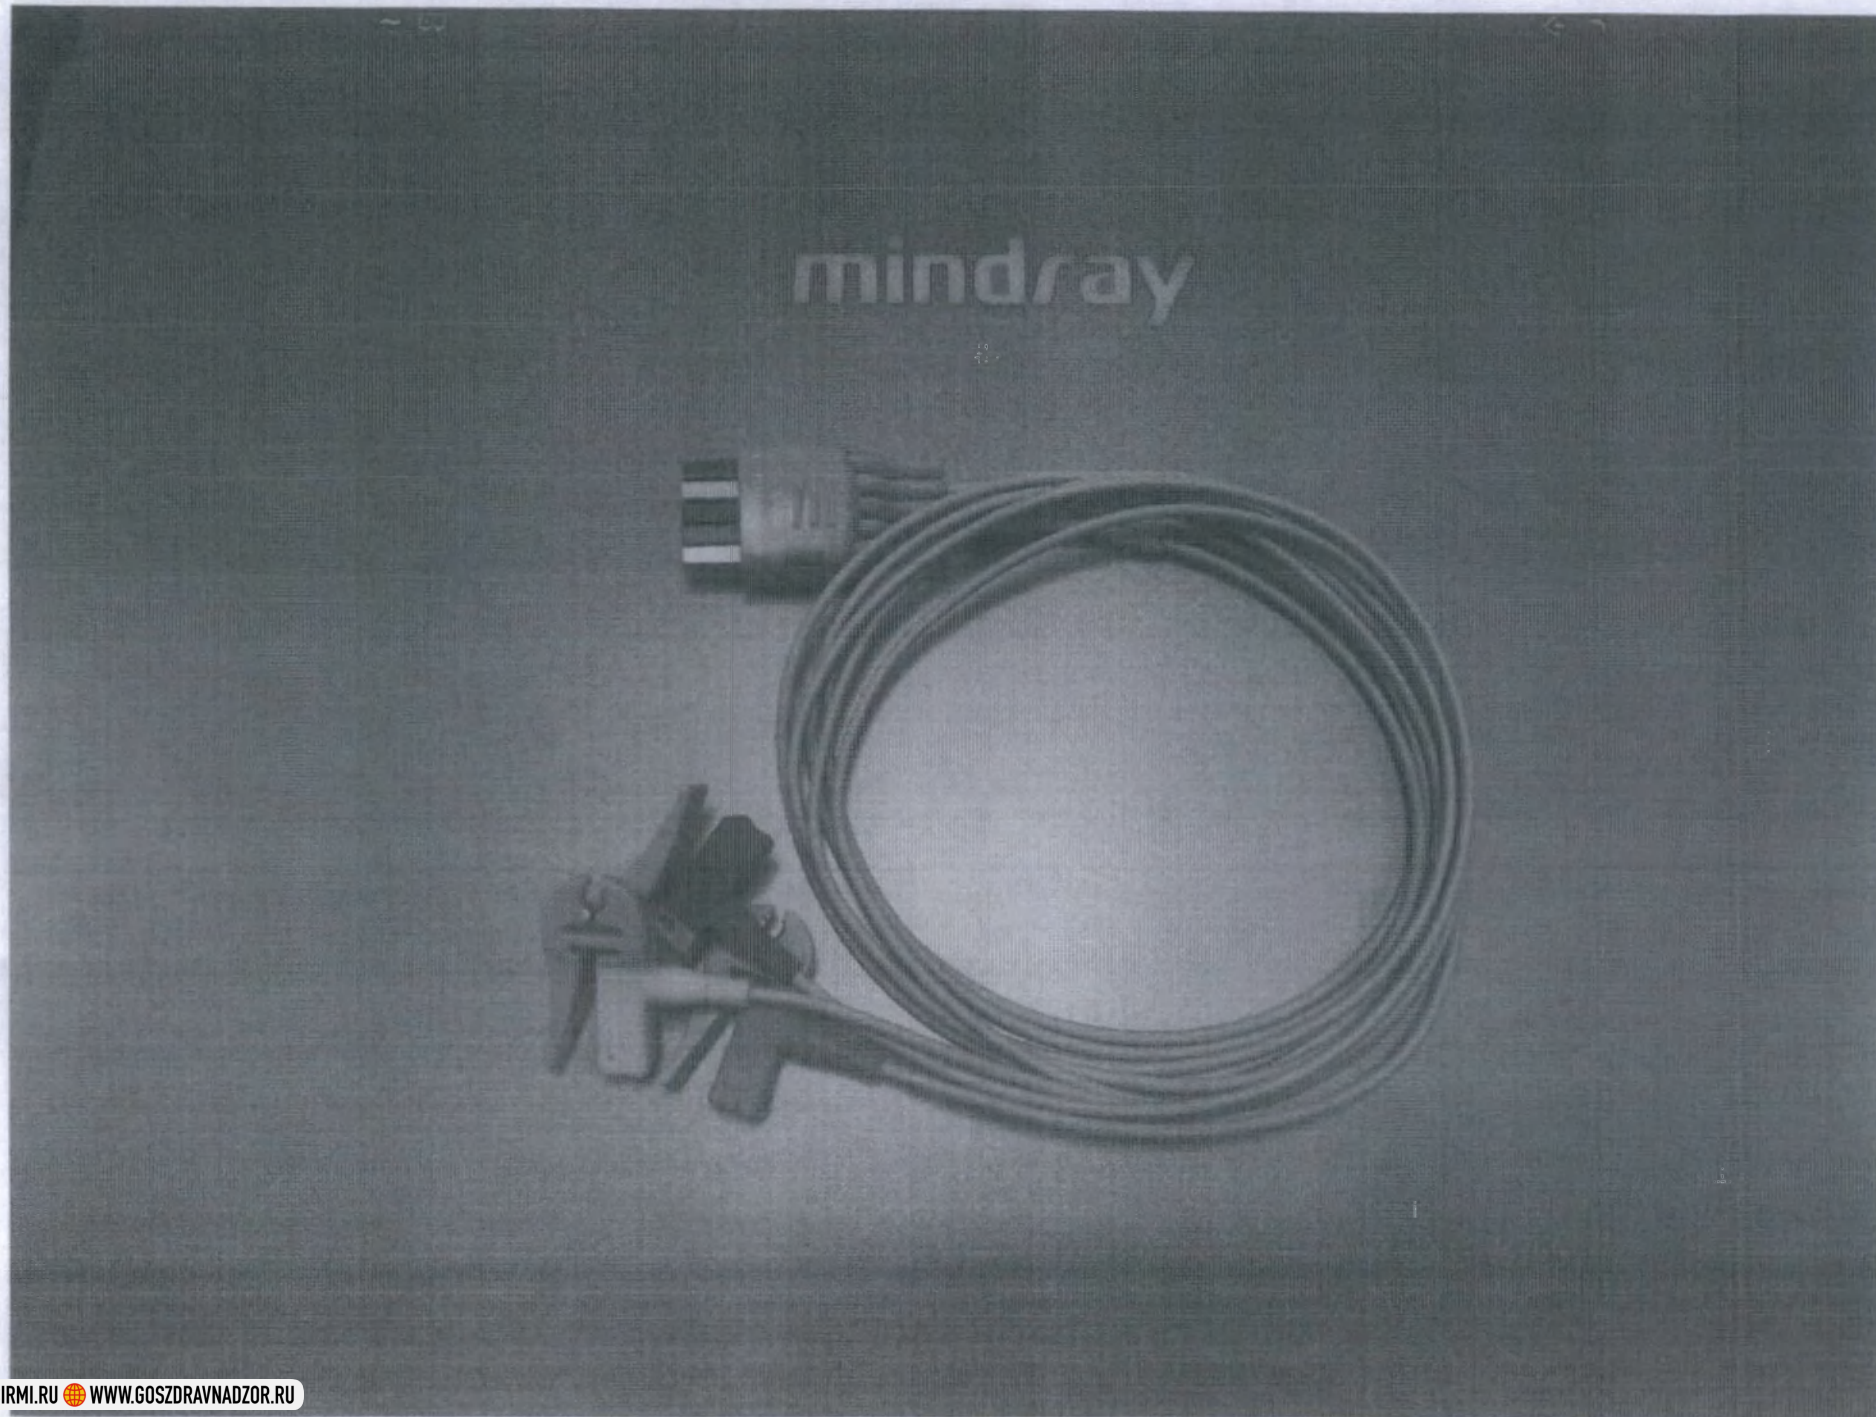

- физиологических сигналов (Physiology module) (при необходимости).

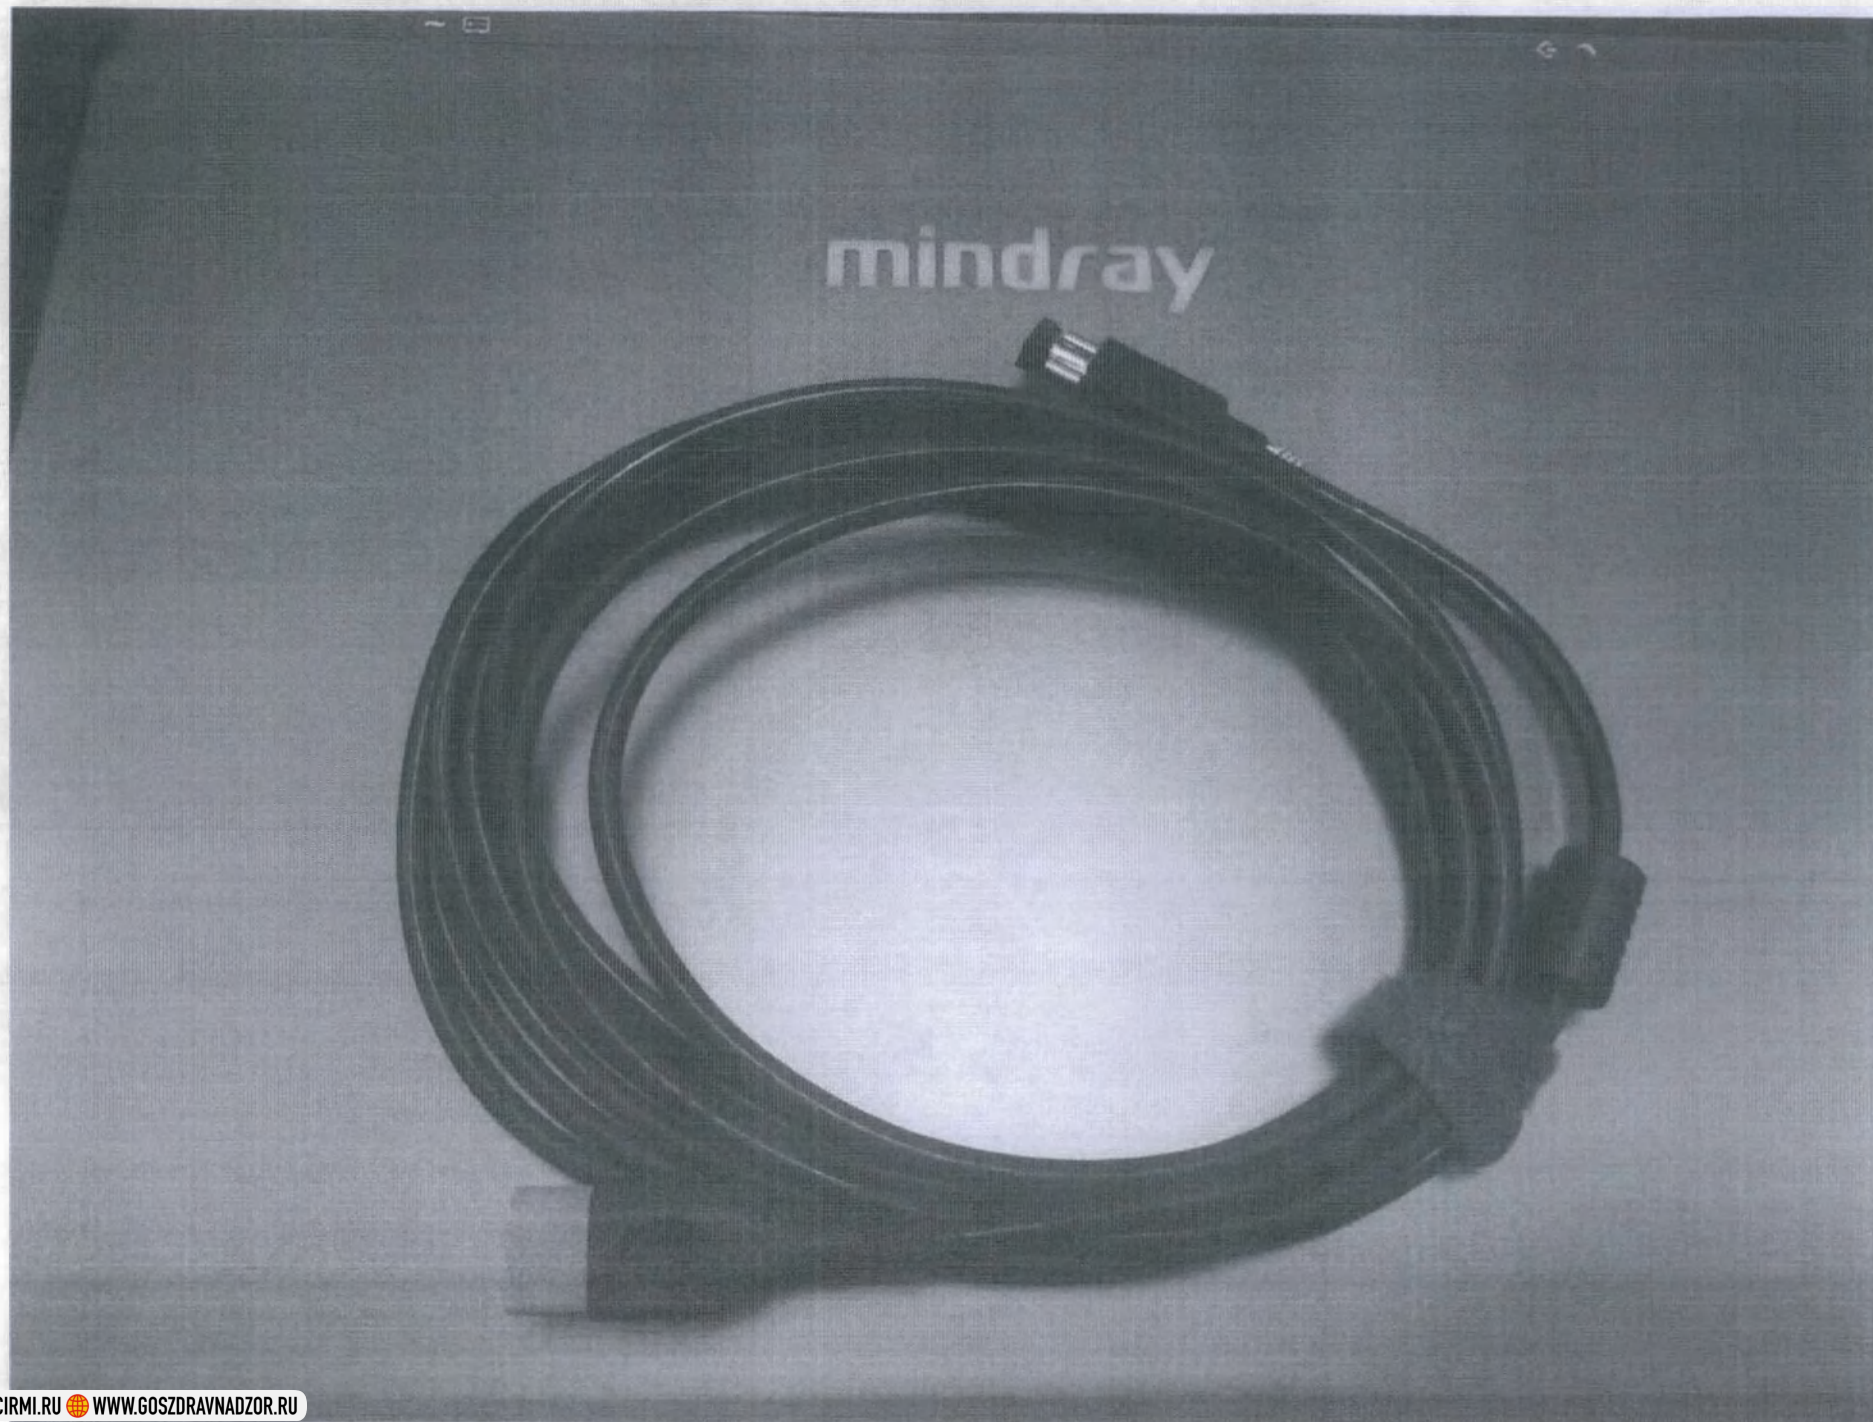



9. Насадки биопсийные (Biopsy bracket): - NGB-004, не более 10 шт.(при необходимости).




- NGB-007, не более 10 шт.(при необходимости).


41



- NGB-007, не более 10 шт.(при необходимости).

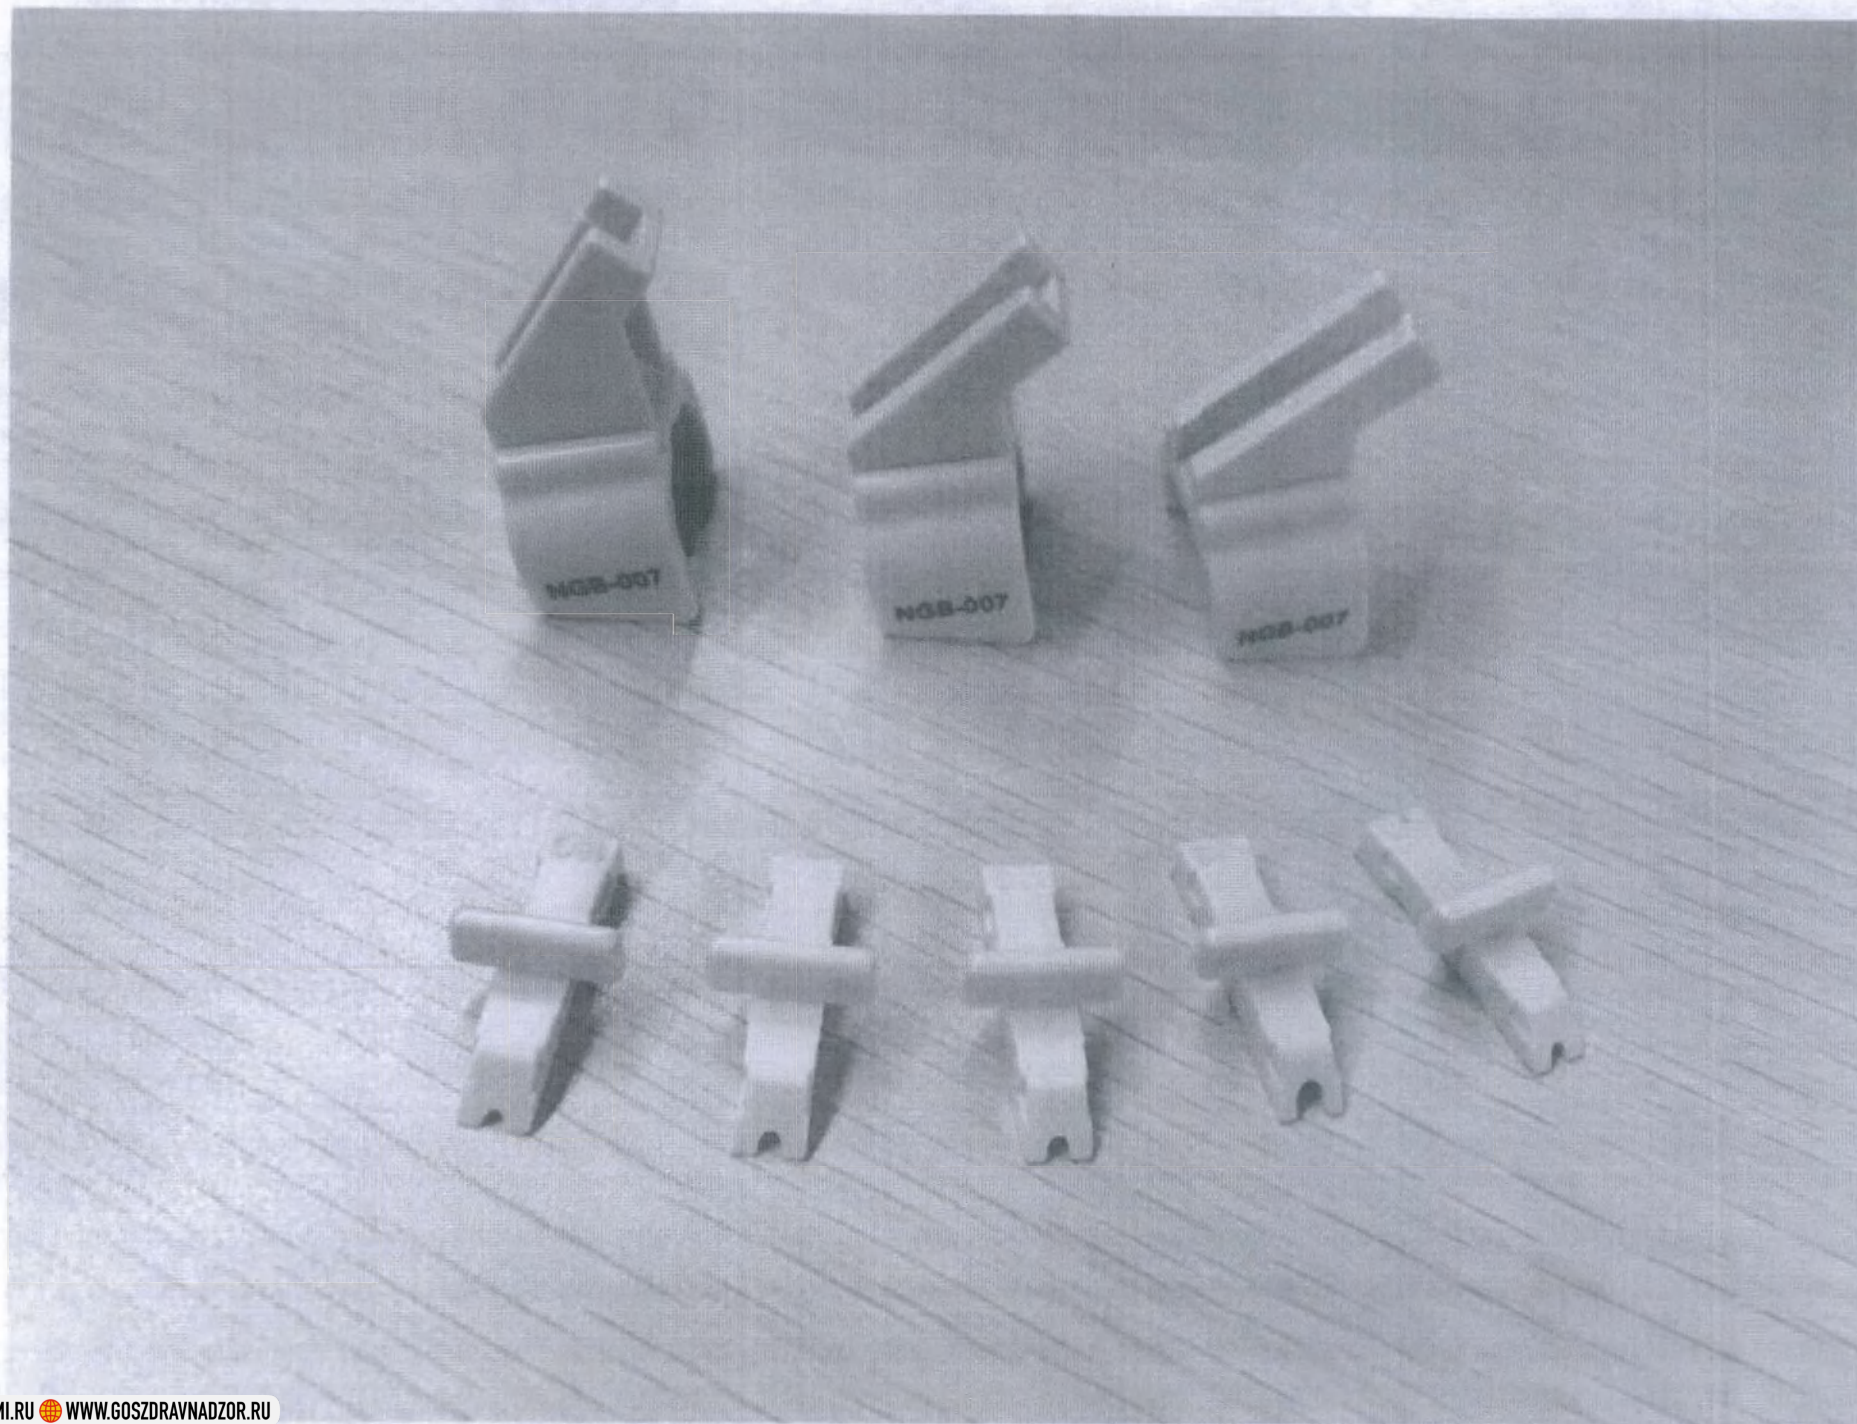


- NGB-022, не более 10 шт.(при необходимости).

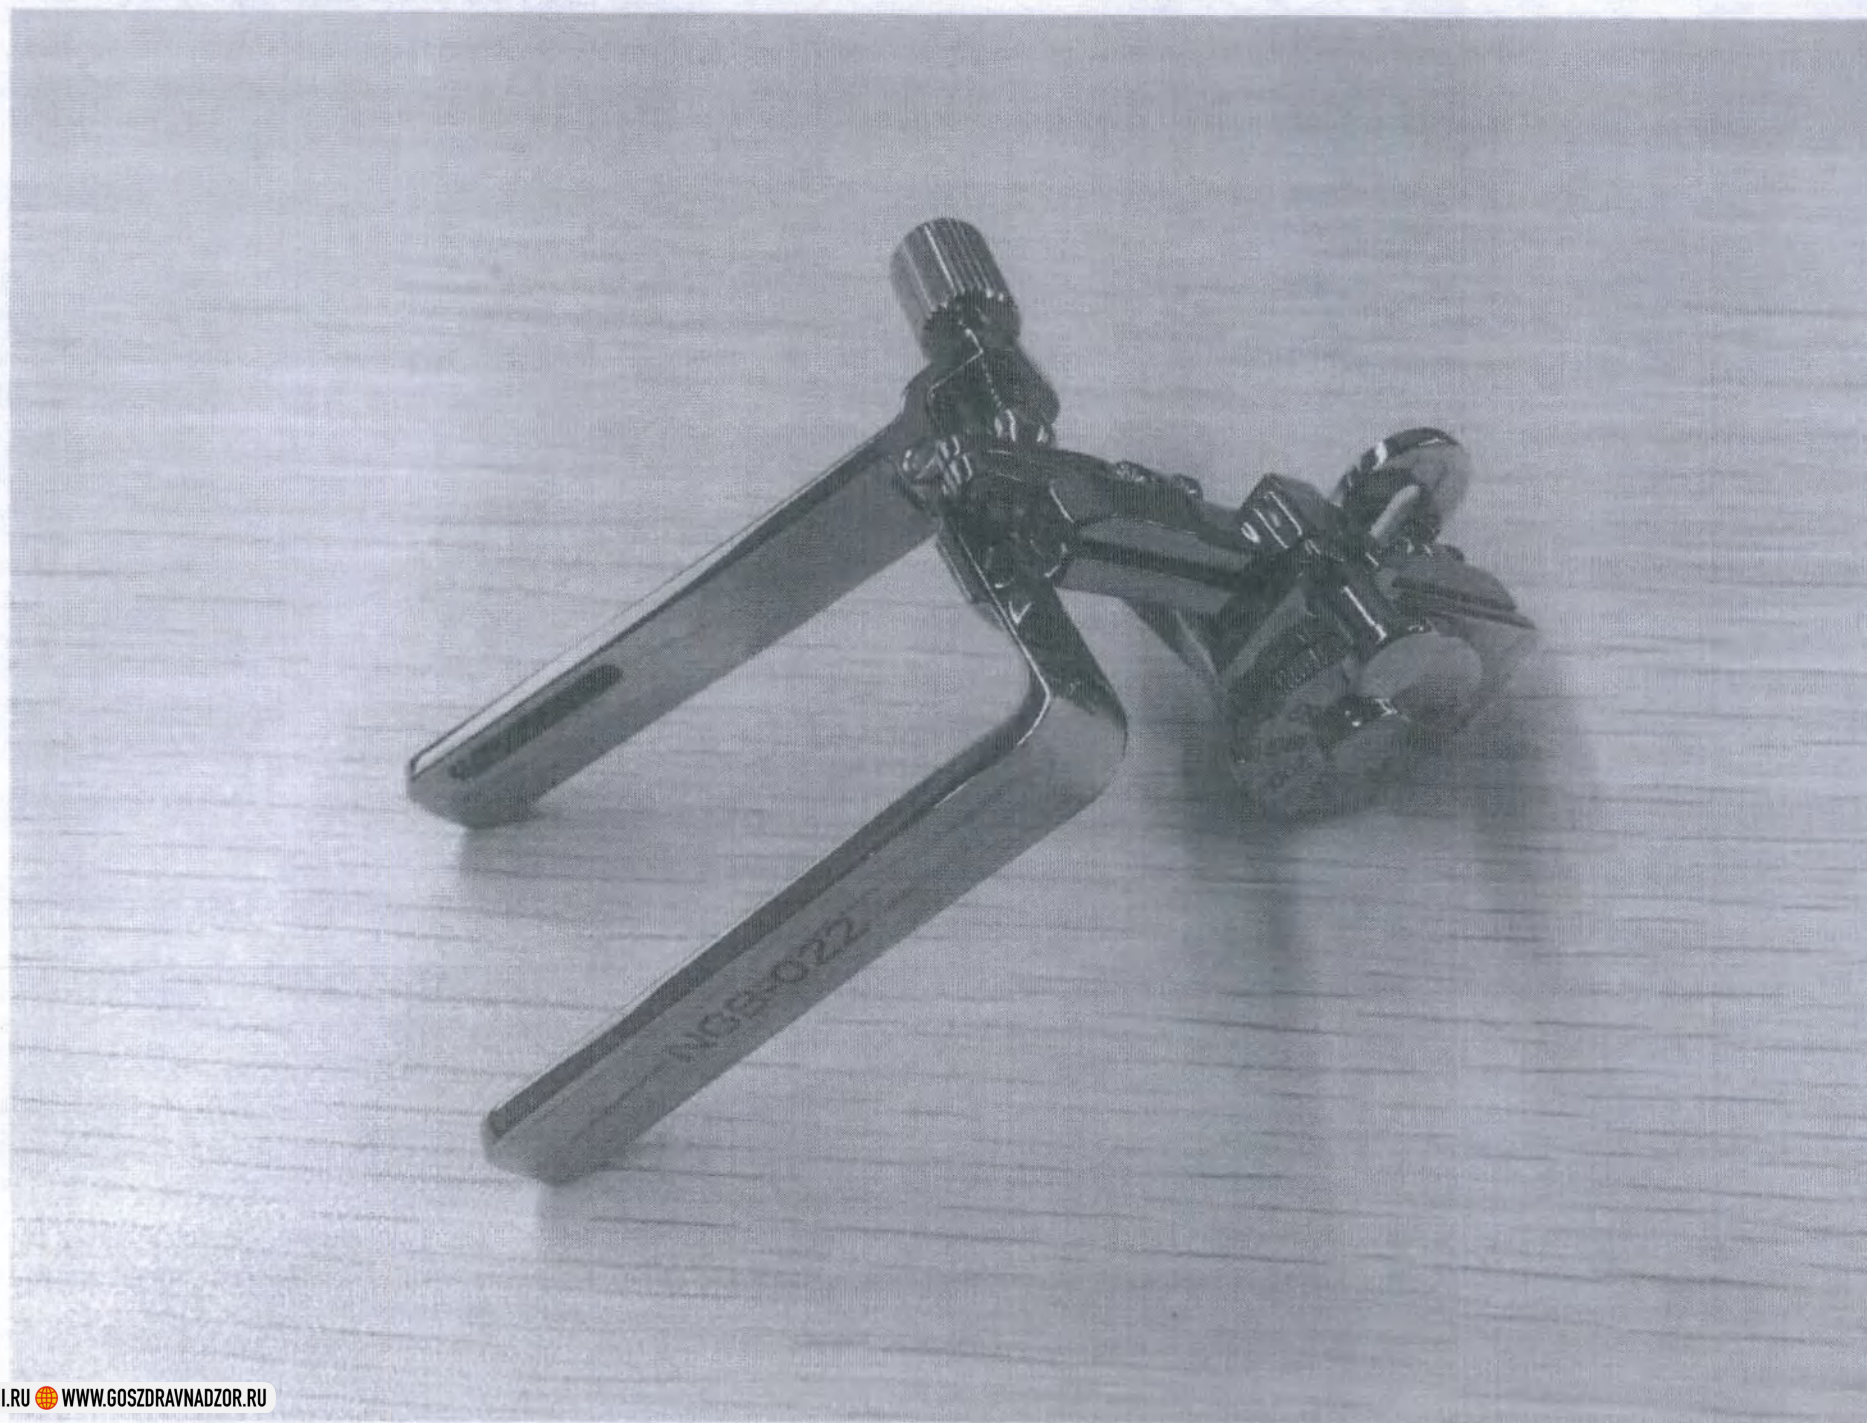


- NGB-011, не более 10 шт.(при необходимости).



- NGB-018, не более 10 шт.(при необходимости).

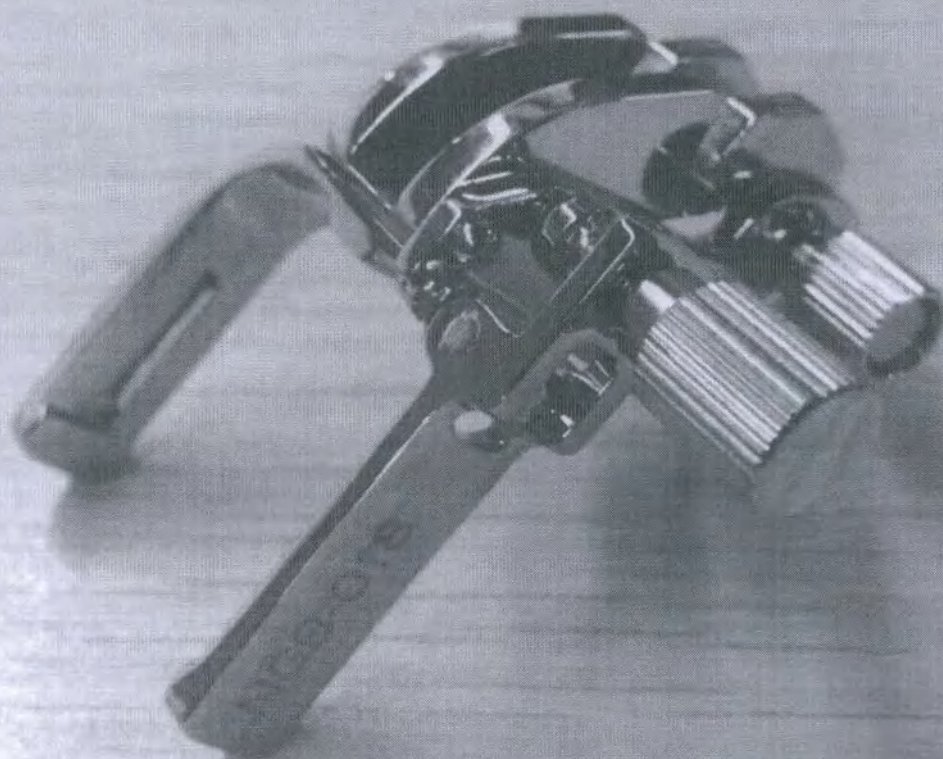


- NGB-023, не более 10 шт.(при необходимости).

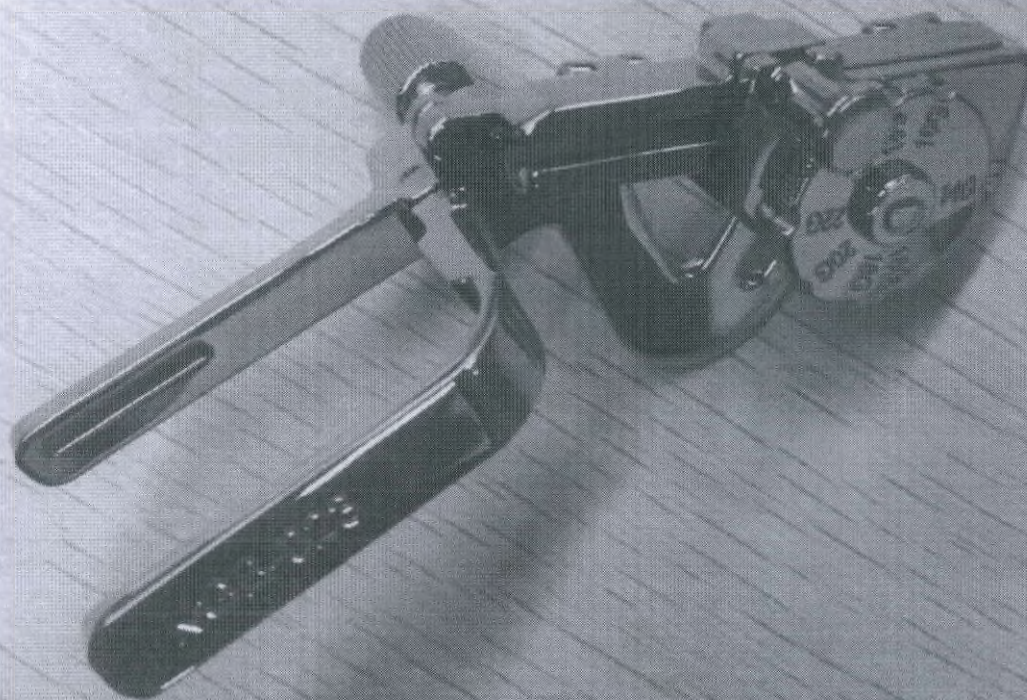


- NGB-024, не более 10 шт.(при необходимости).




10. Программное обеспечение с пакетом измерений и вычислений: - для абдоминальных исследований. (Abdomen/General Package) (при необходимости).

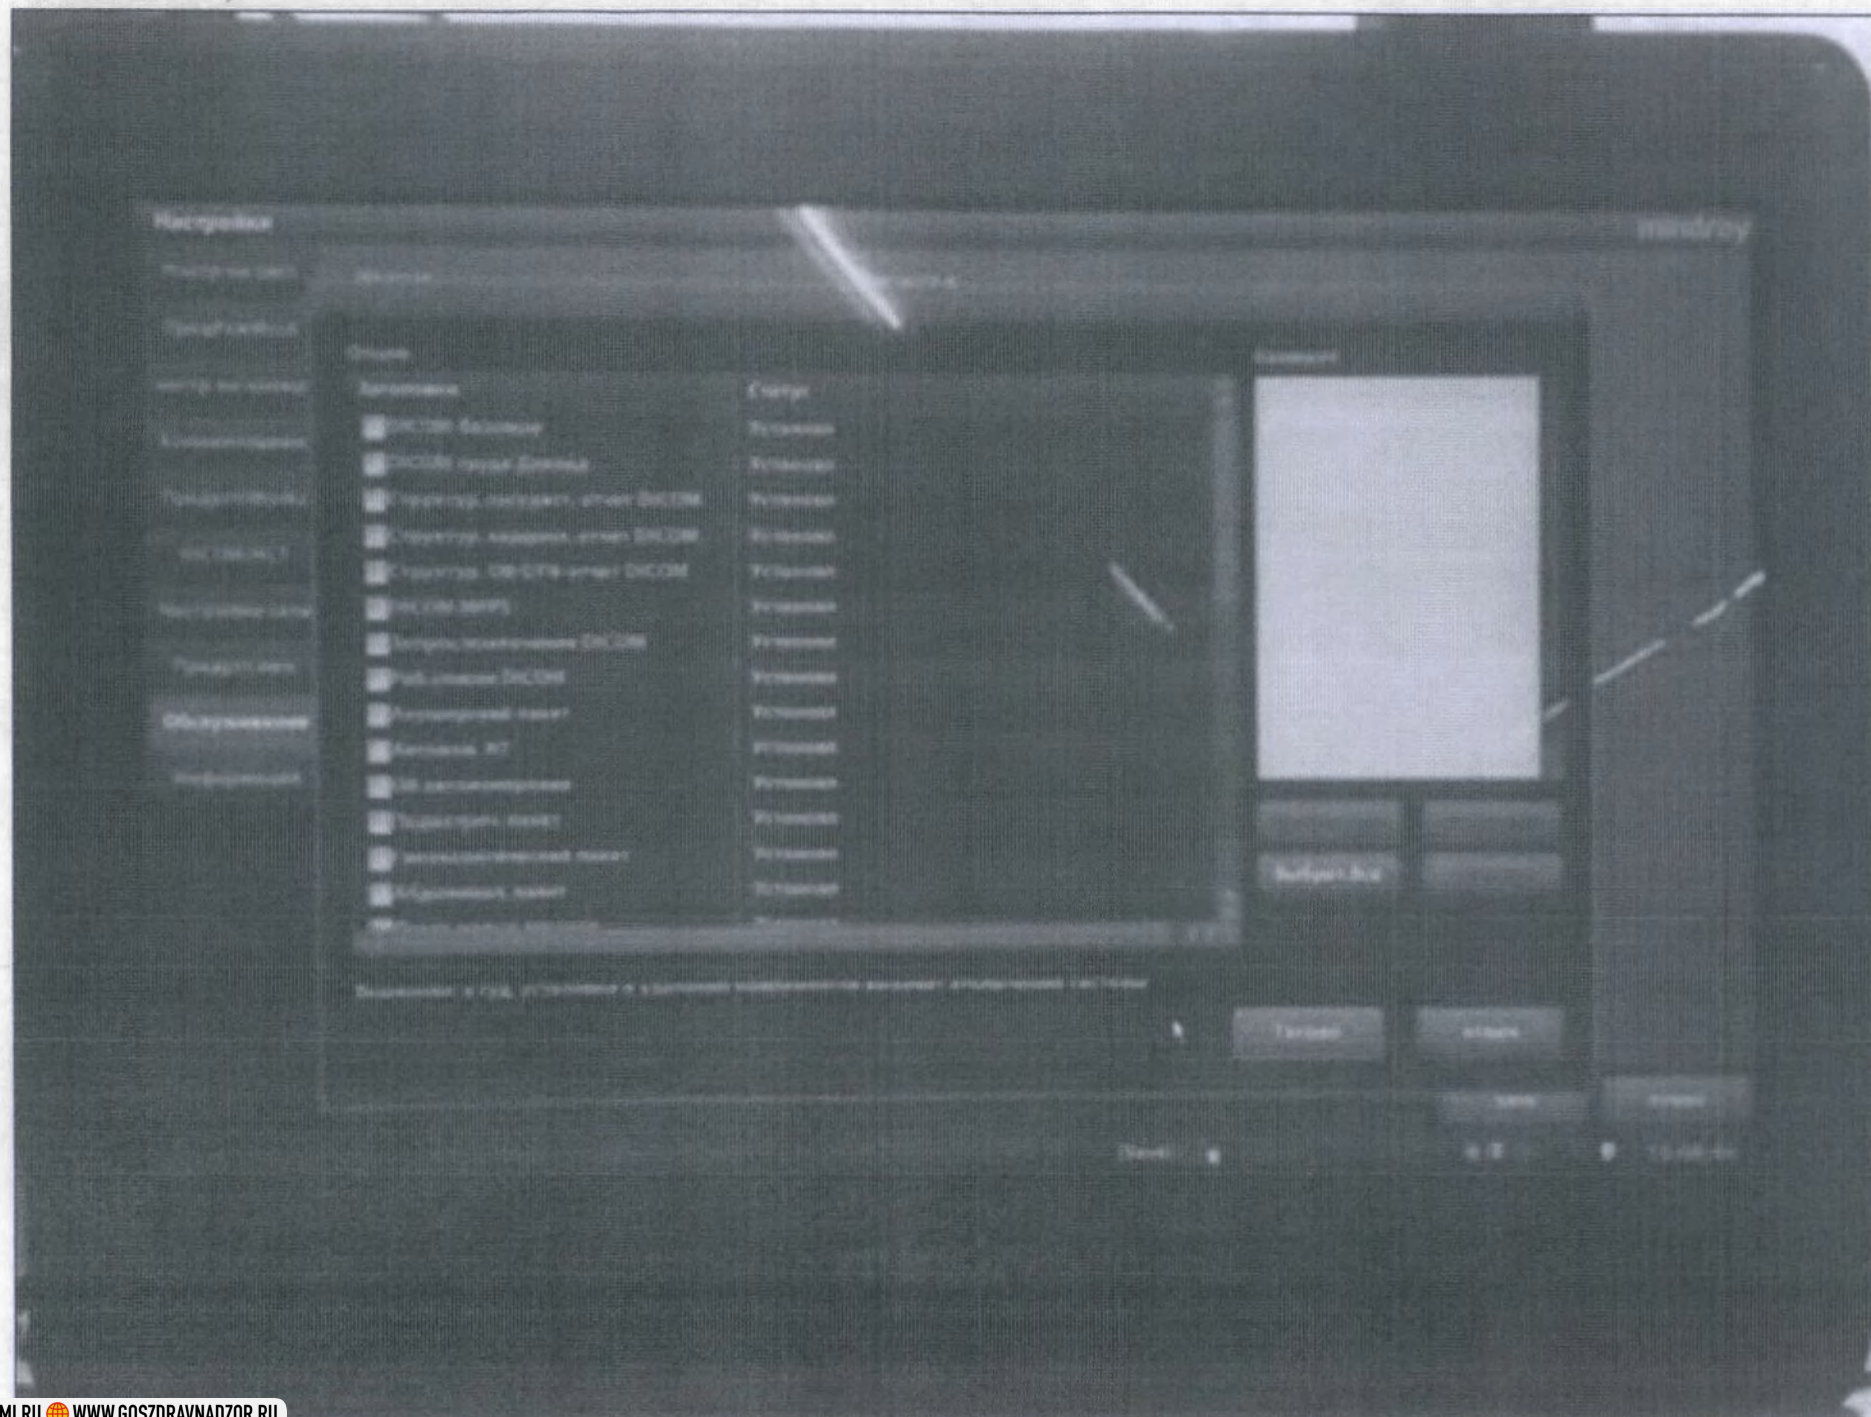


- для акушерства (Obstetrics package) (при необходимости).

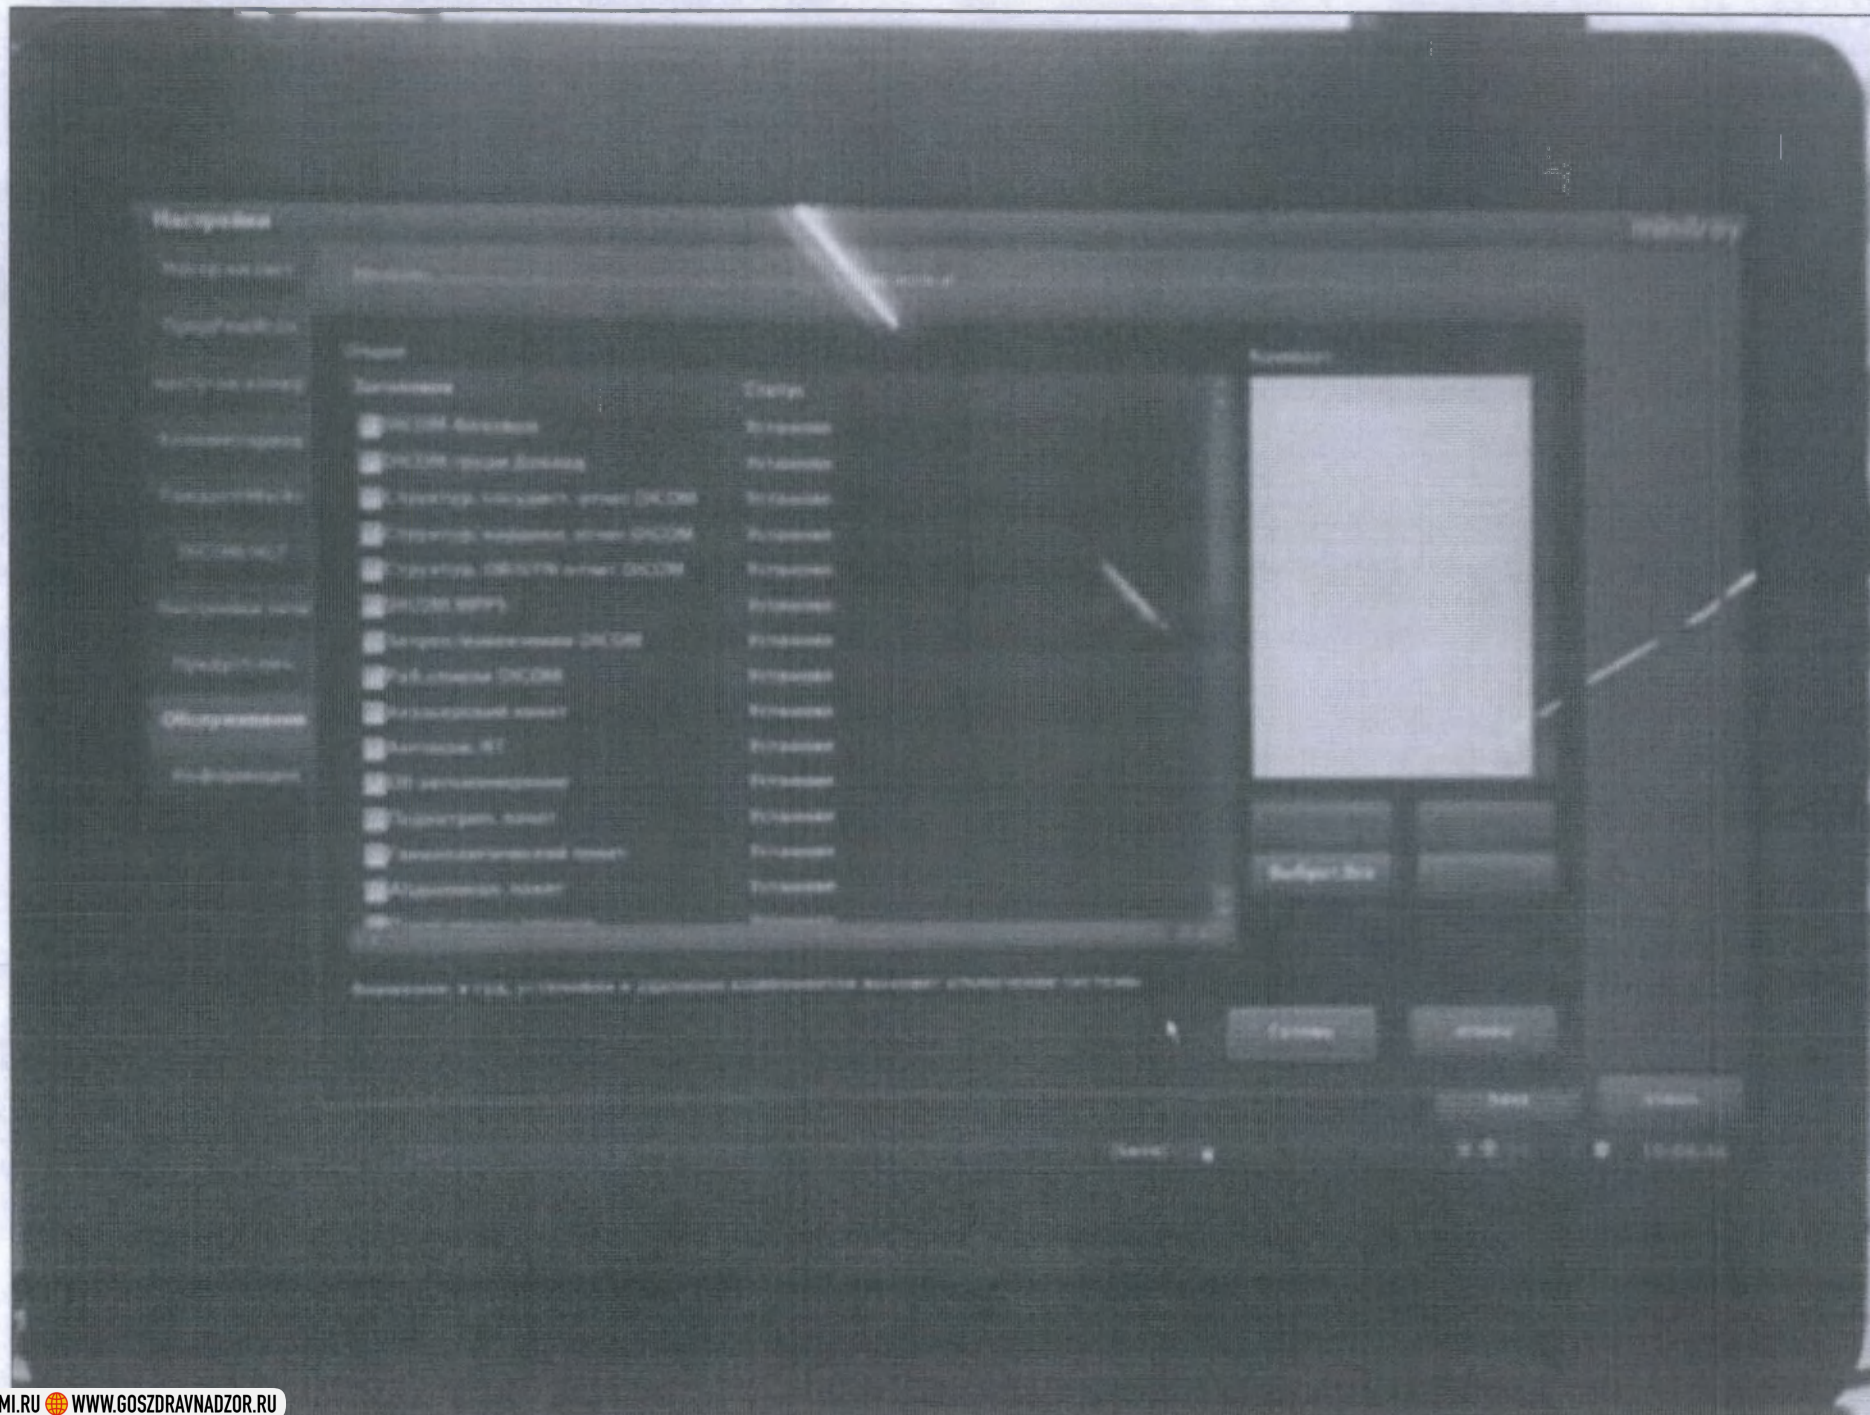

- для гинекологии (Gynecology package) (при необходимости).

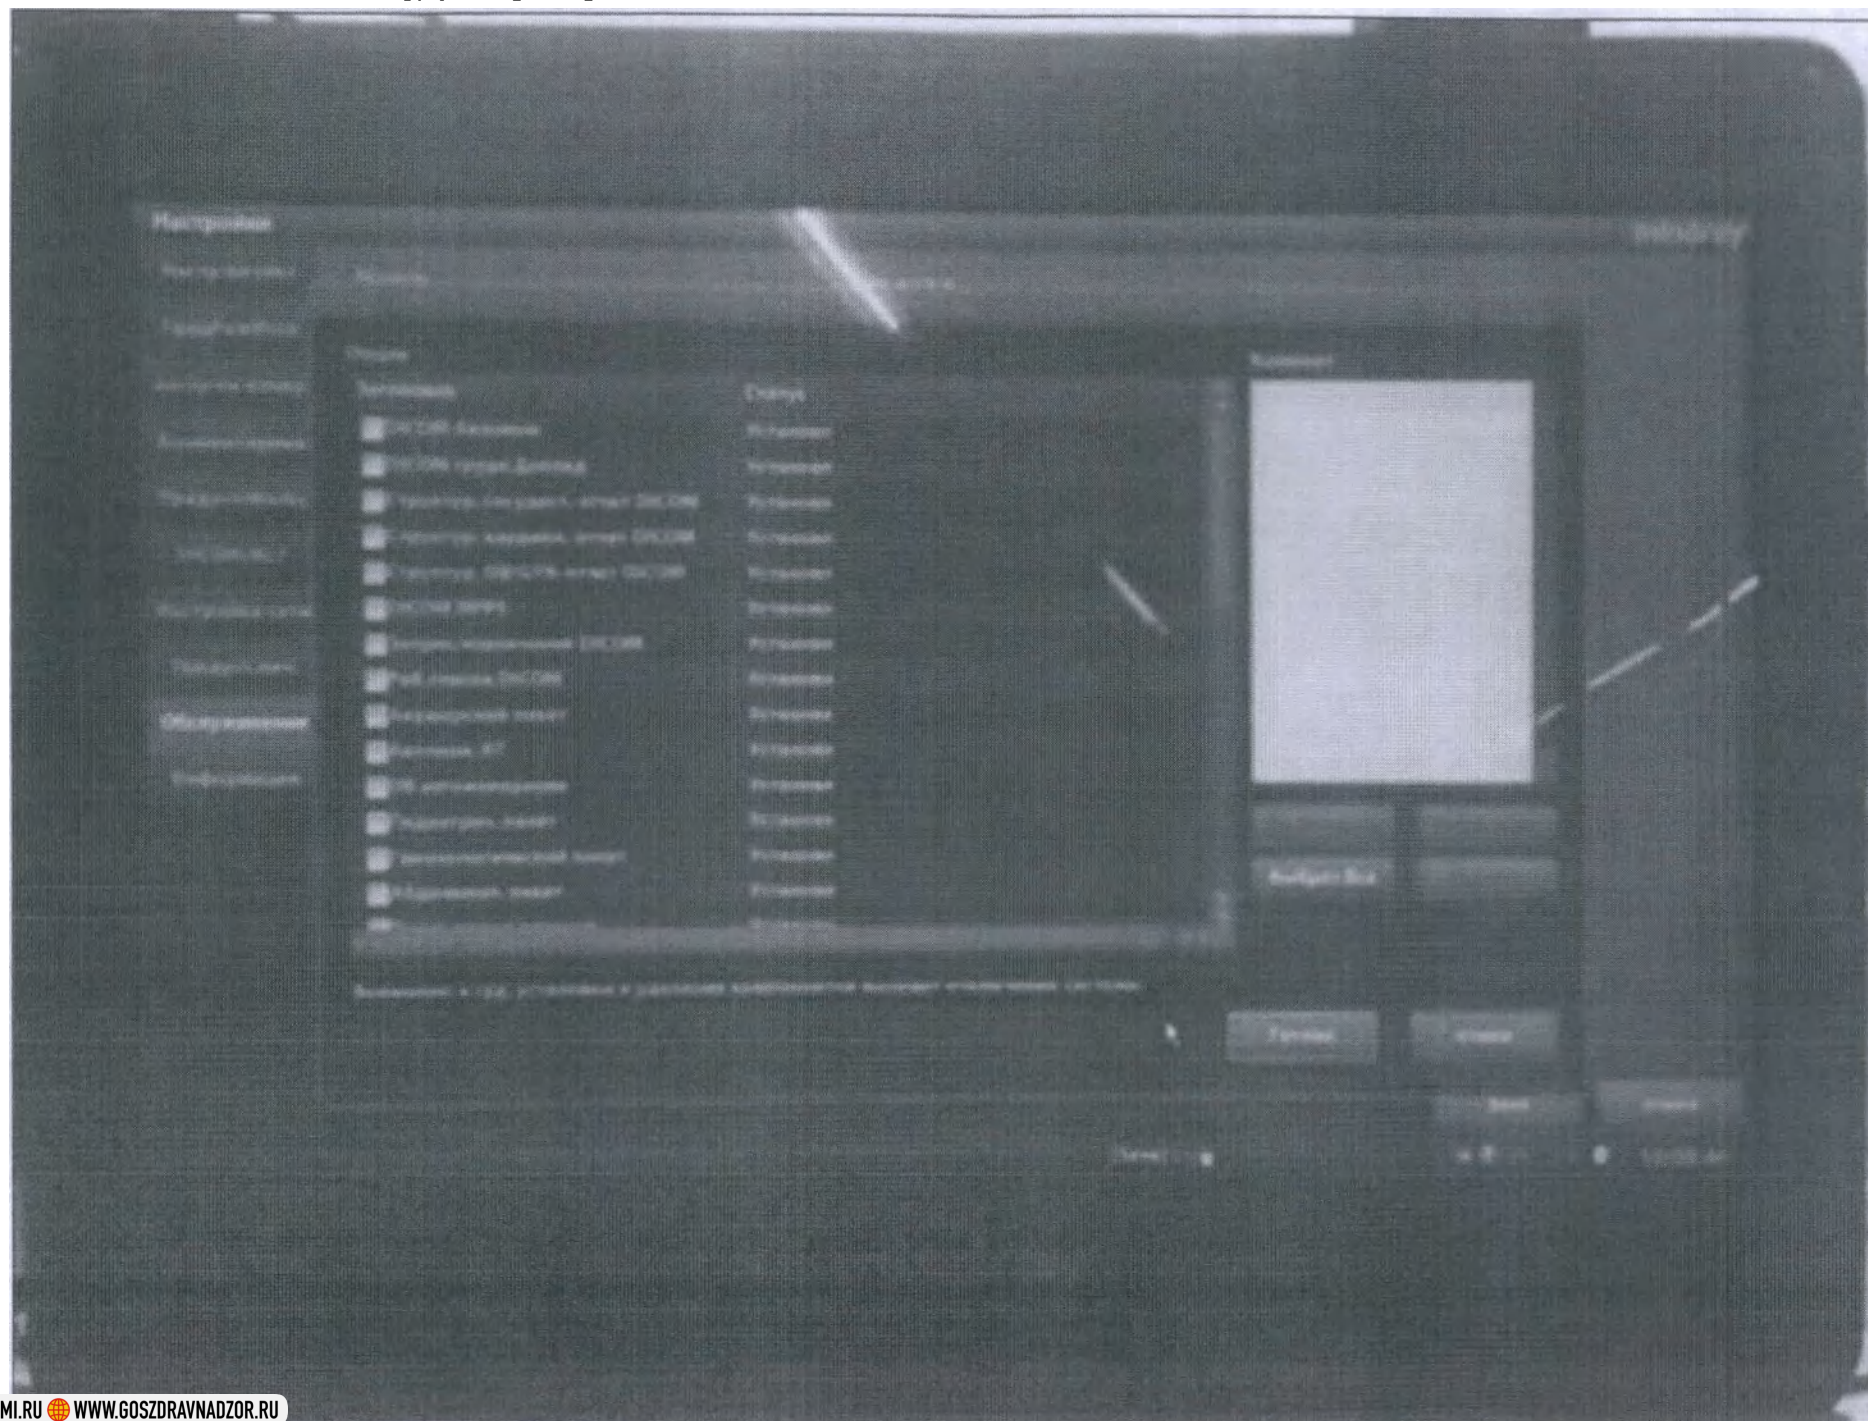

- для урологии (Urology package) (при необходимости).

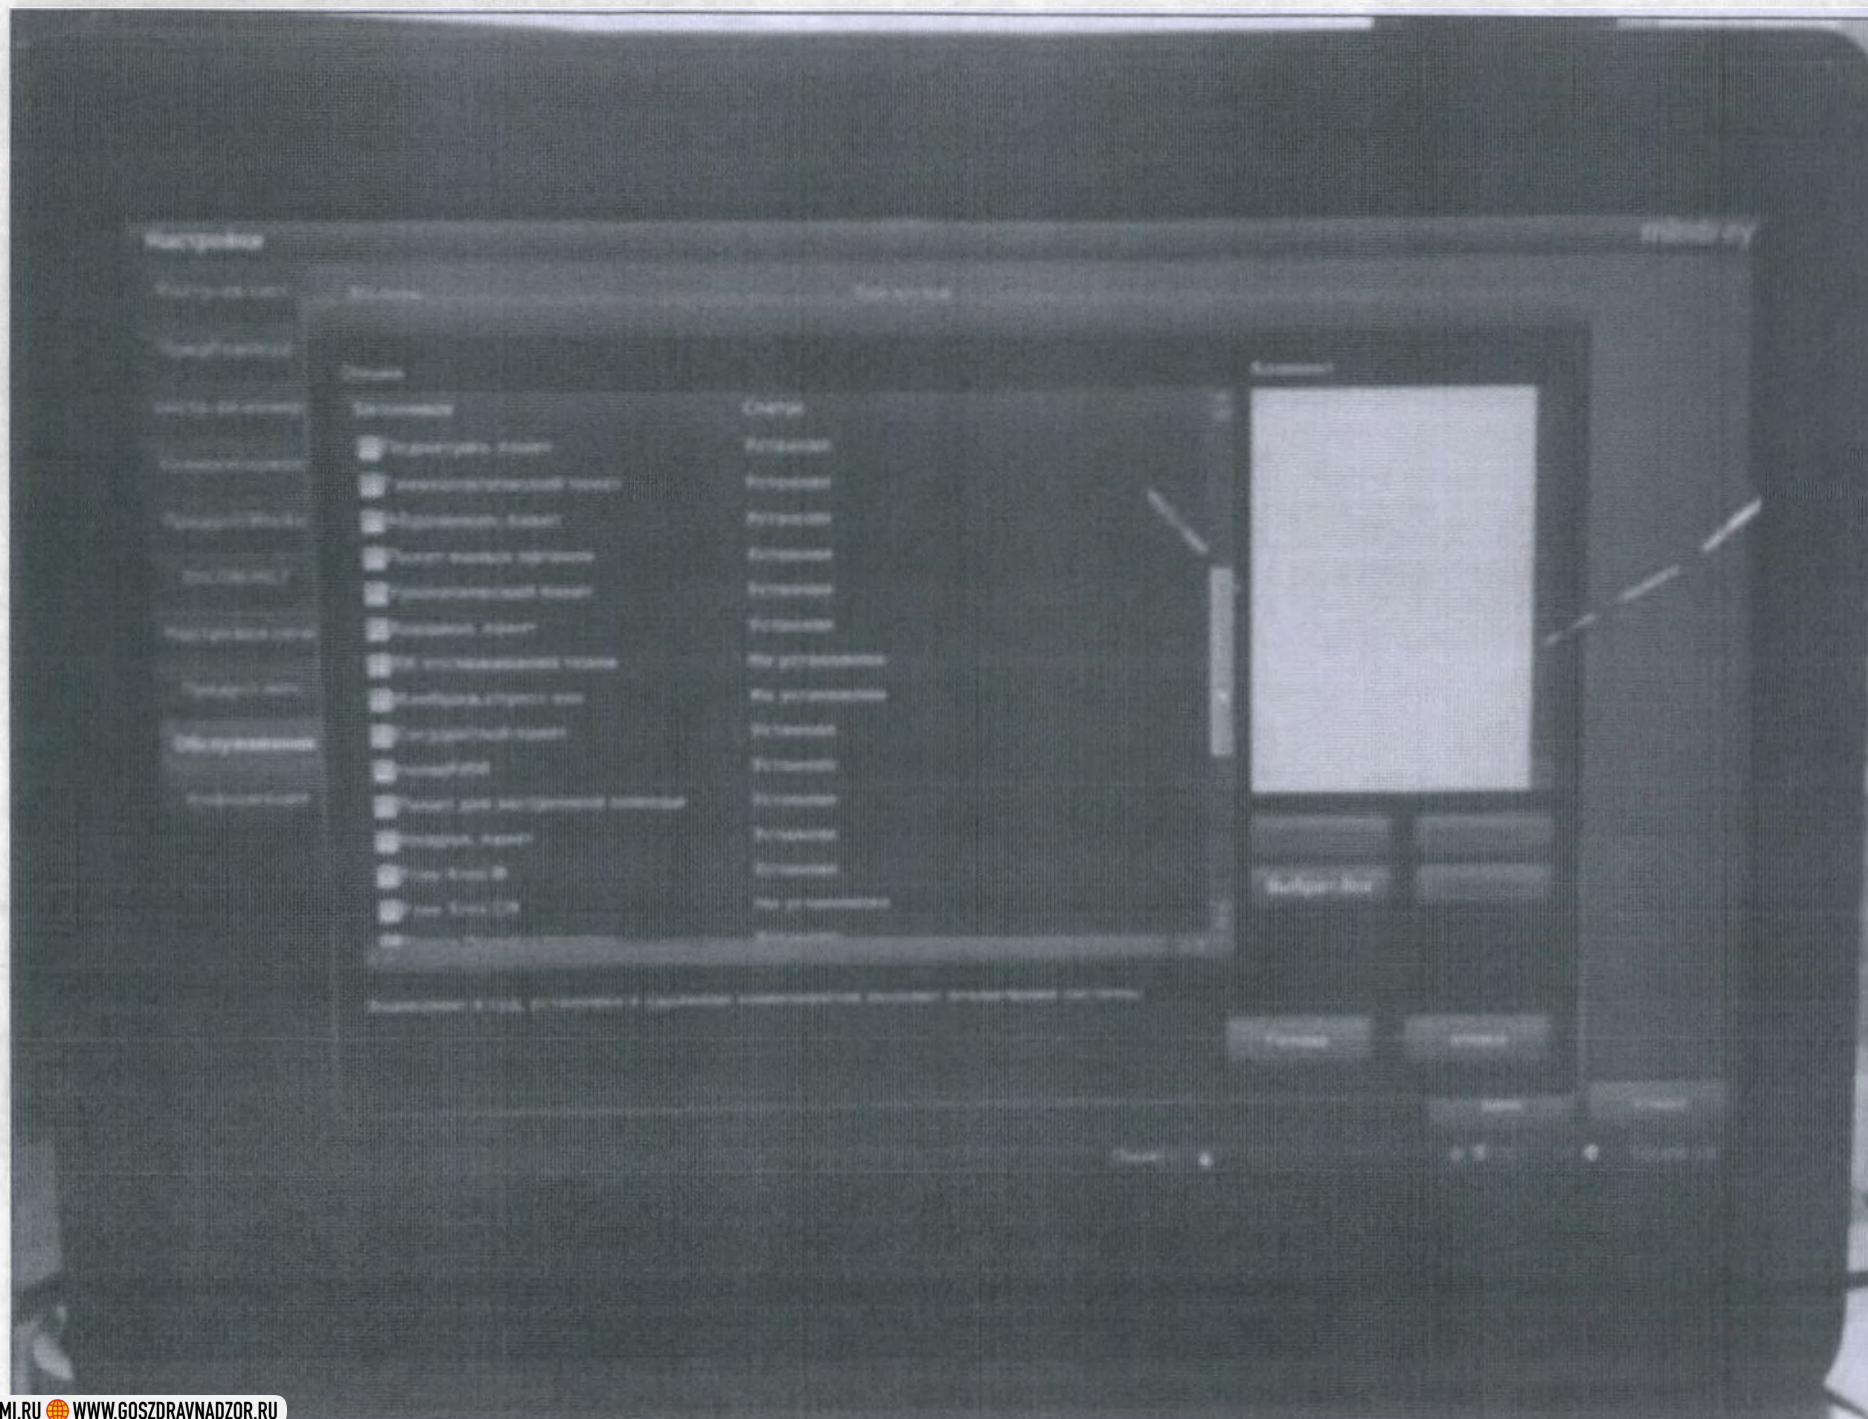





- для кардиологии (Cardiology Package) (при необходимости).




- для ангиологии (Vascular Package ) (при необходимости).

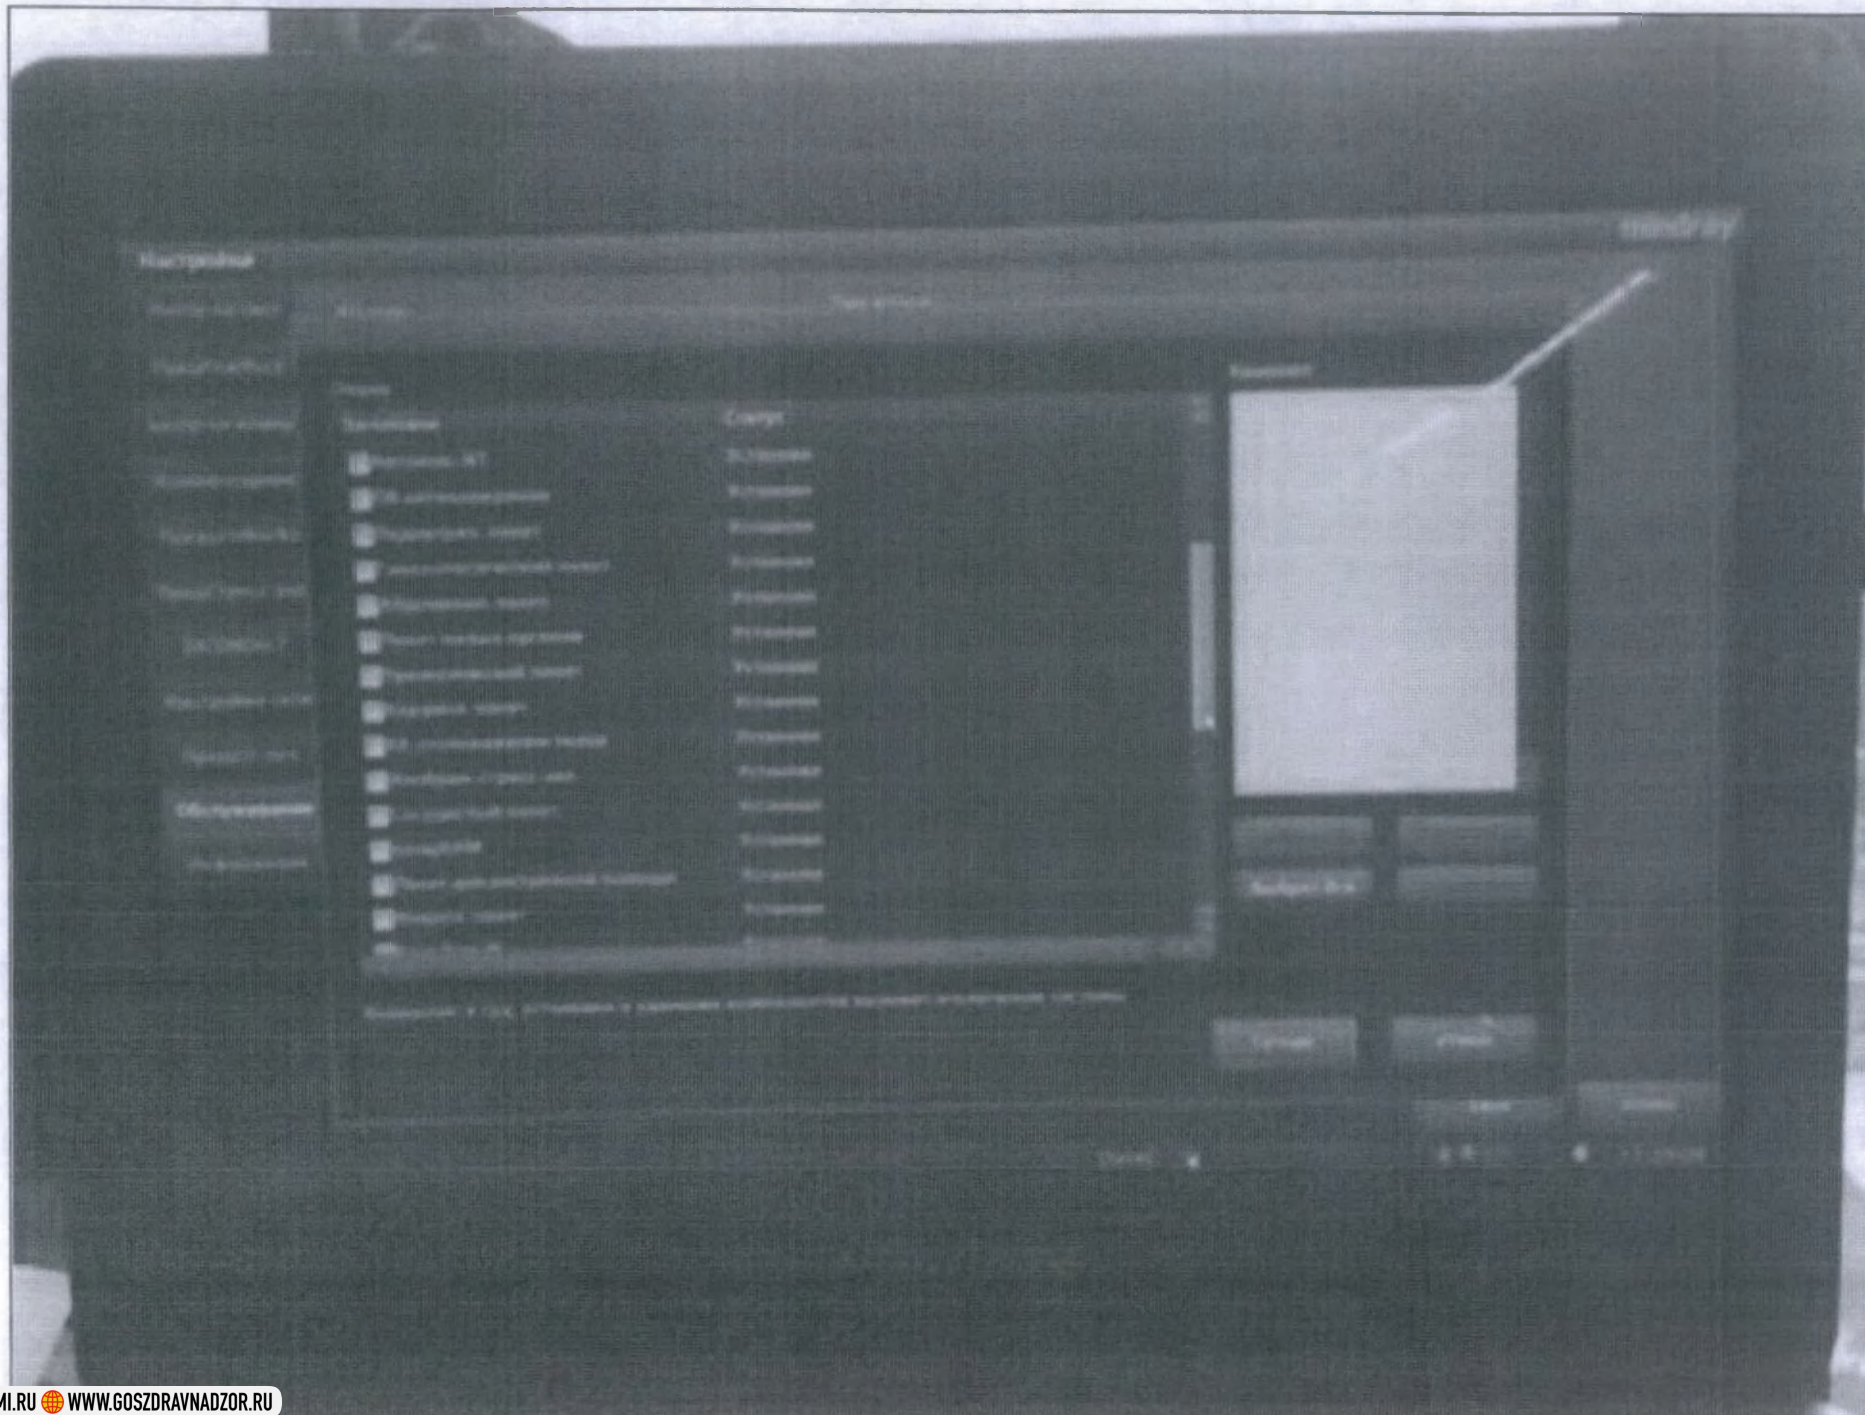


- для исследований малых органов (Small Parts Package ) (при необходимости).

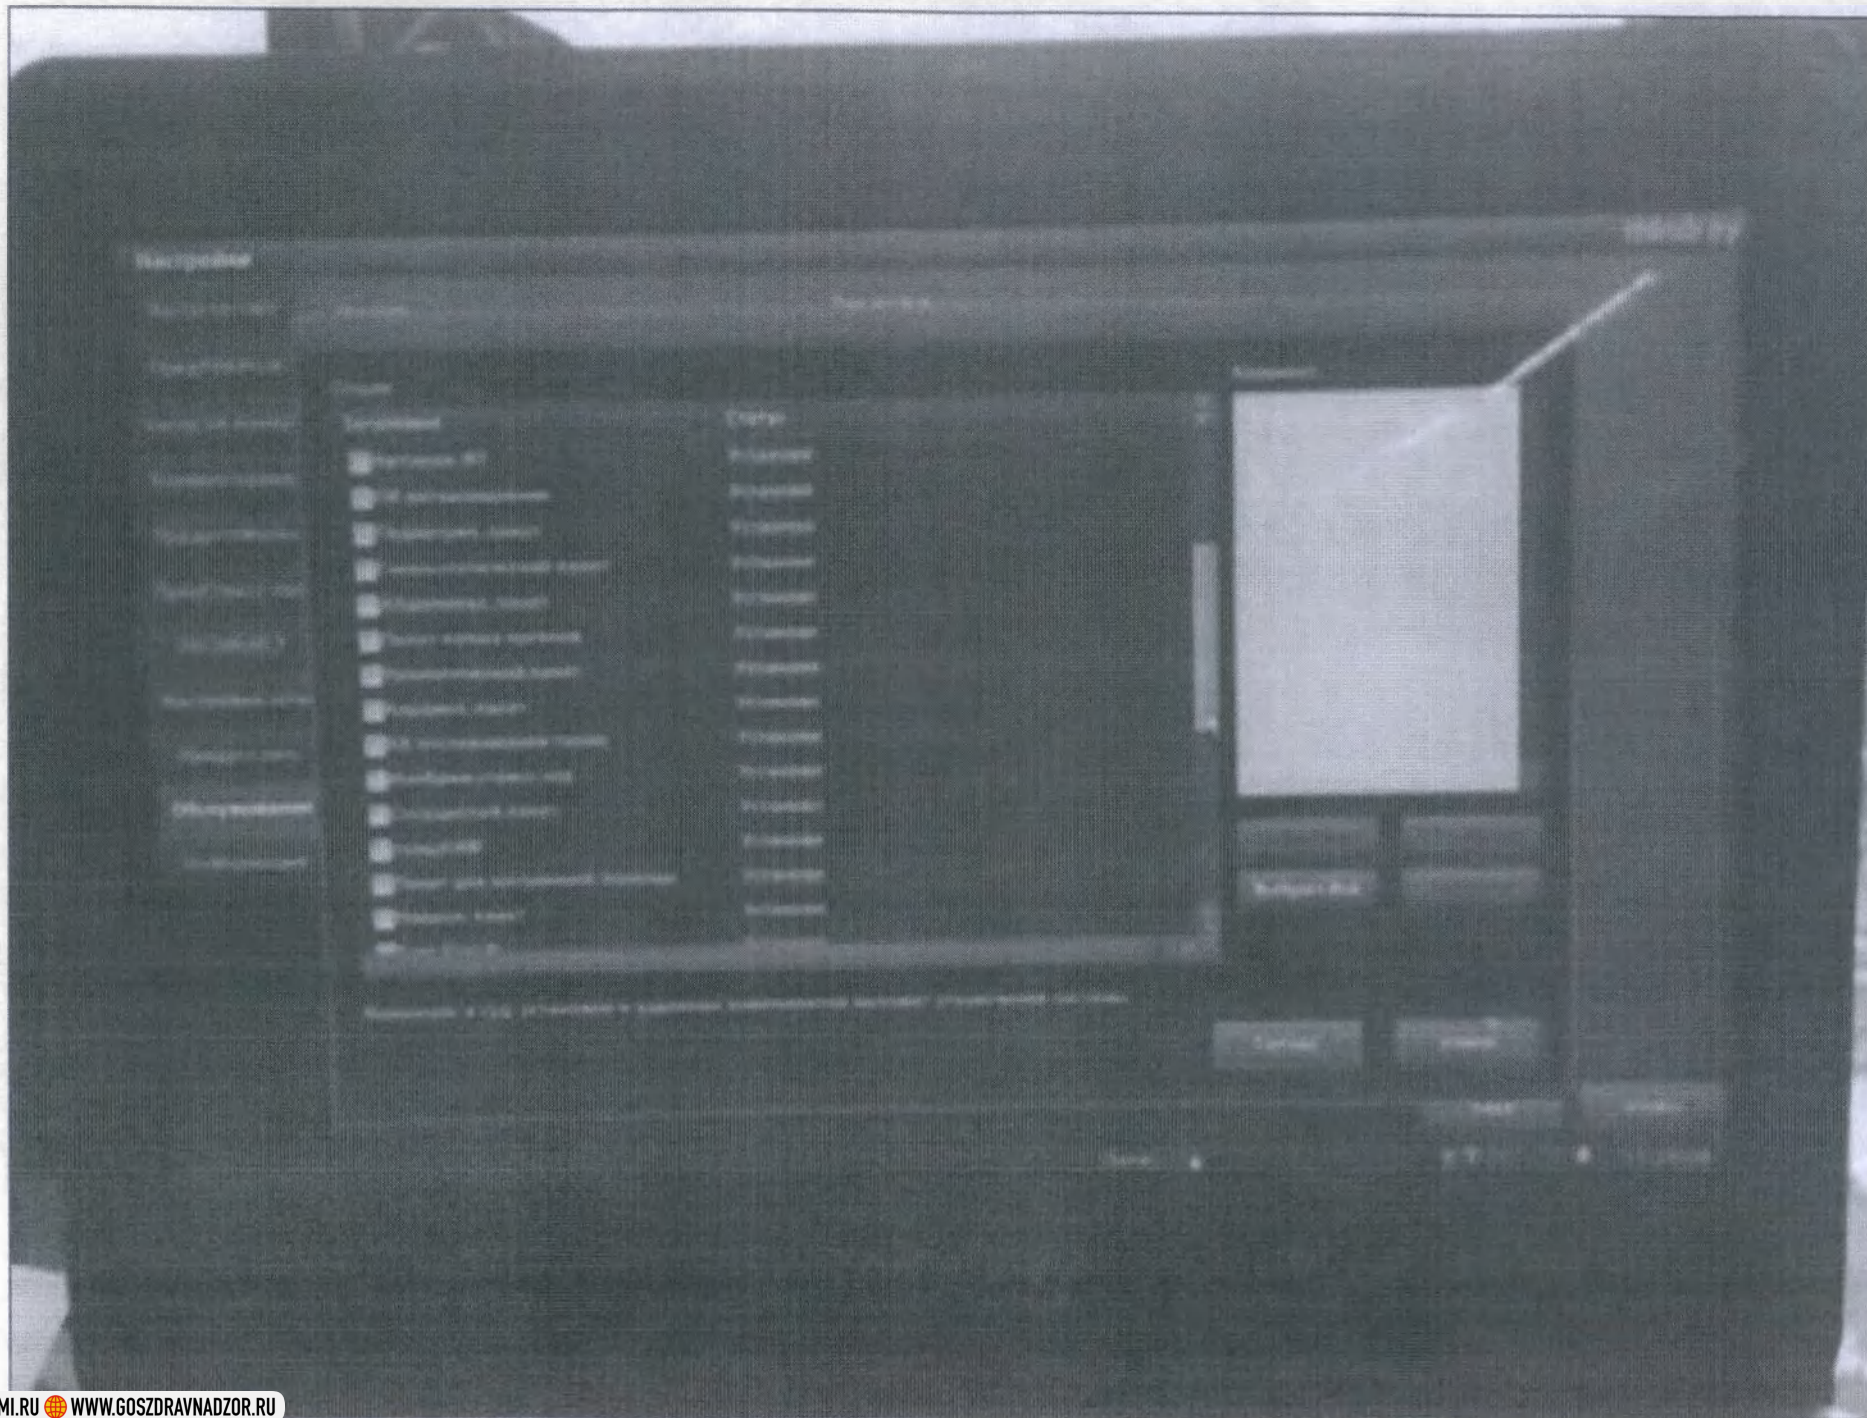


- для ургентной медицины (Emergency&Critical Package ) (при необходимости).

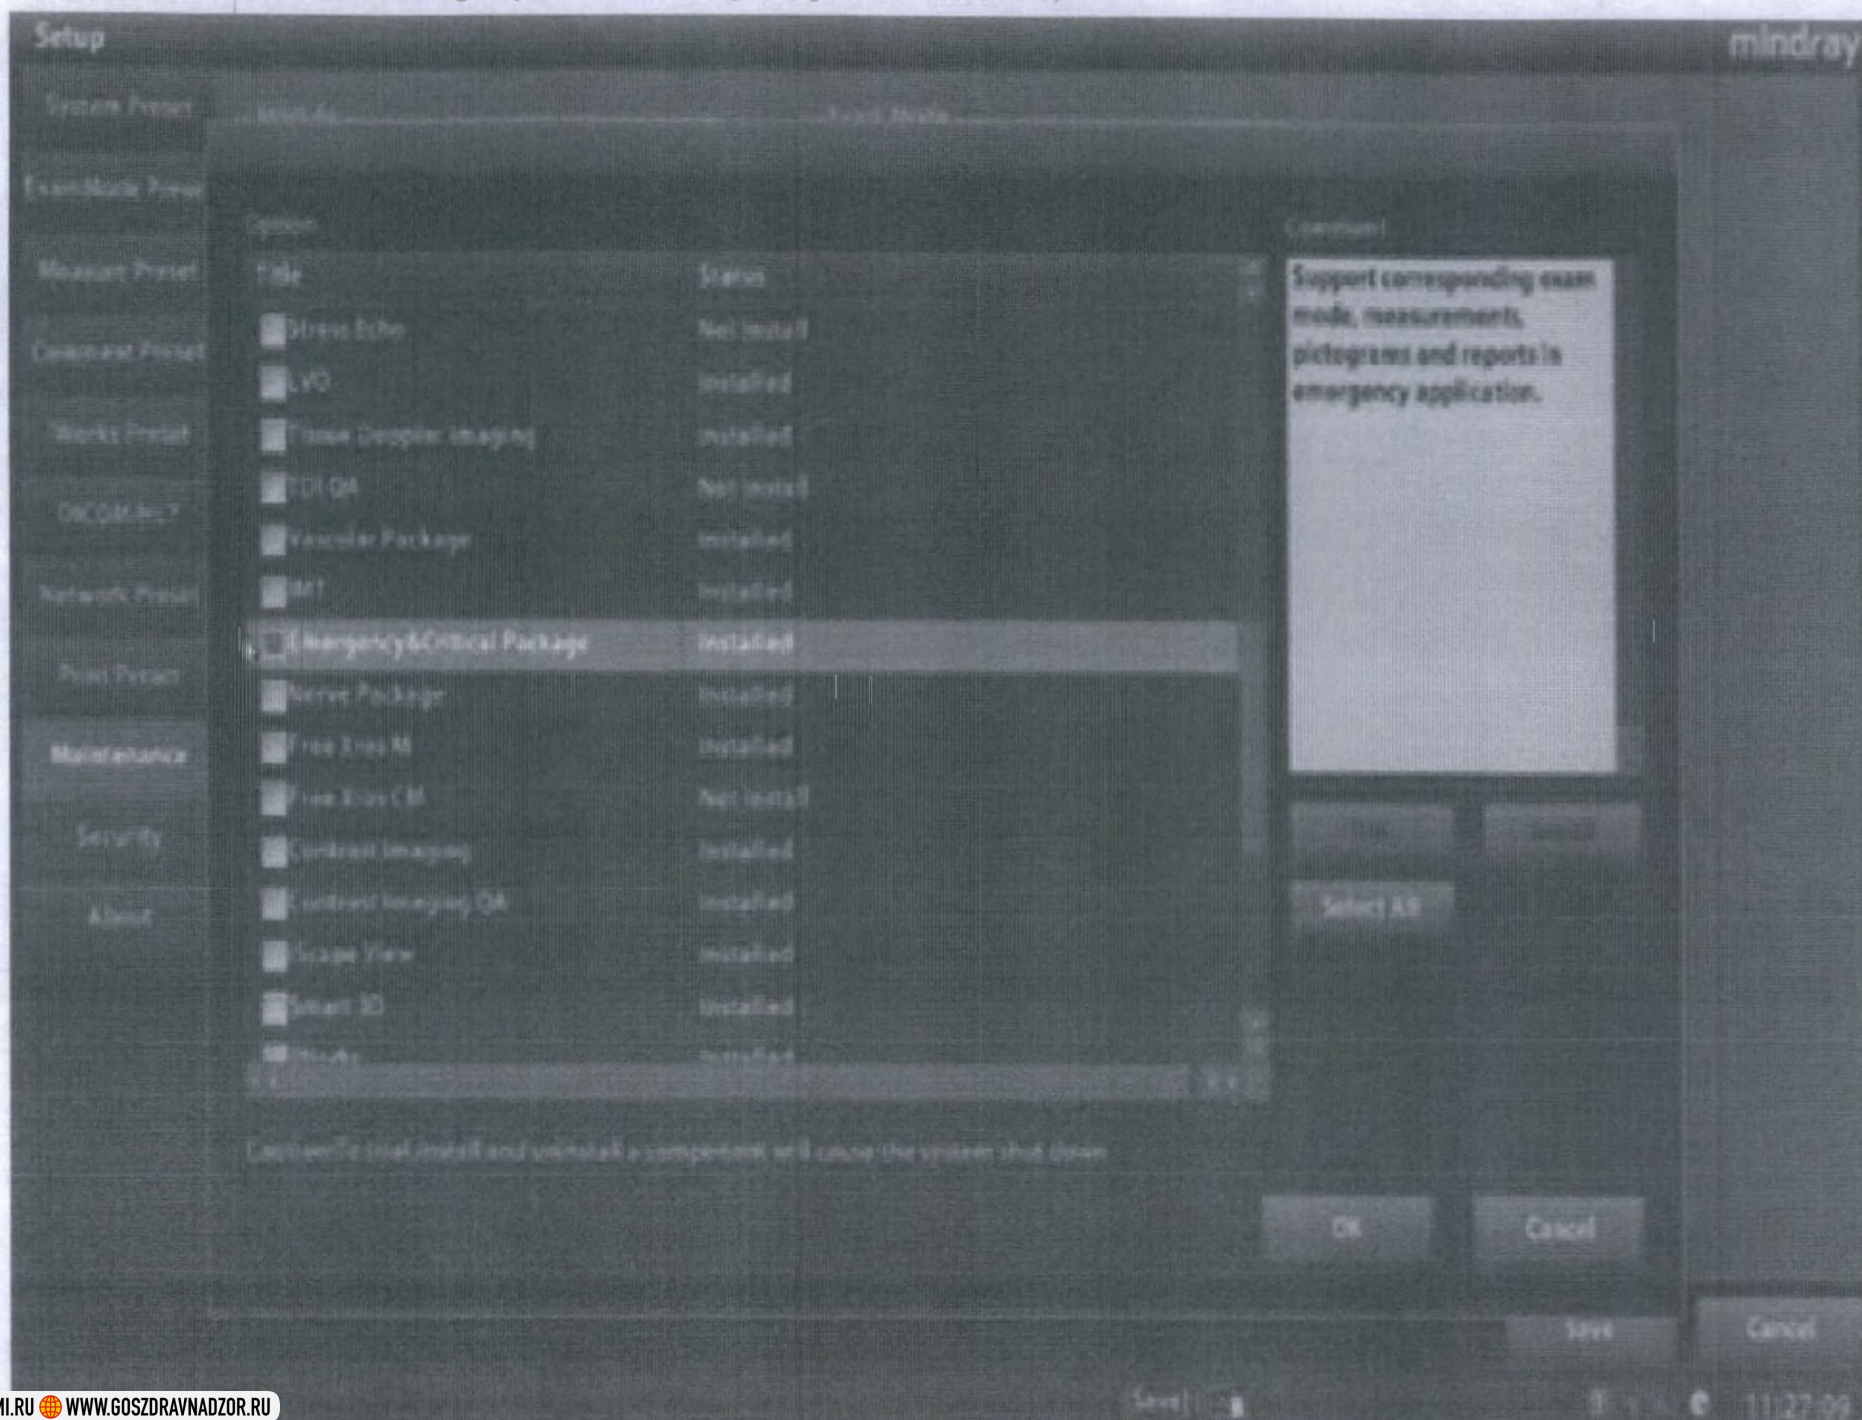


- для регионарной анестезии (Nerve package) (при необходимости).

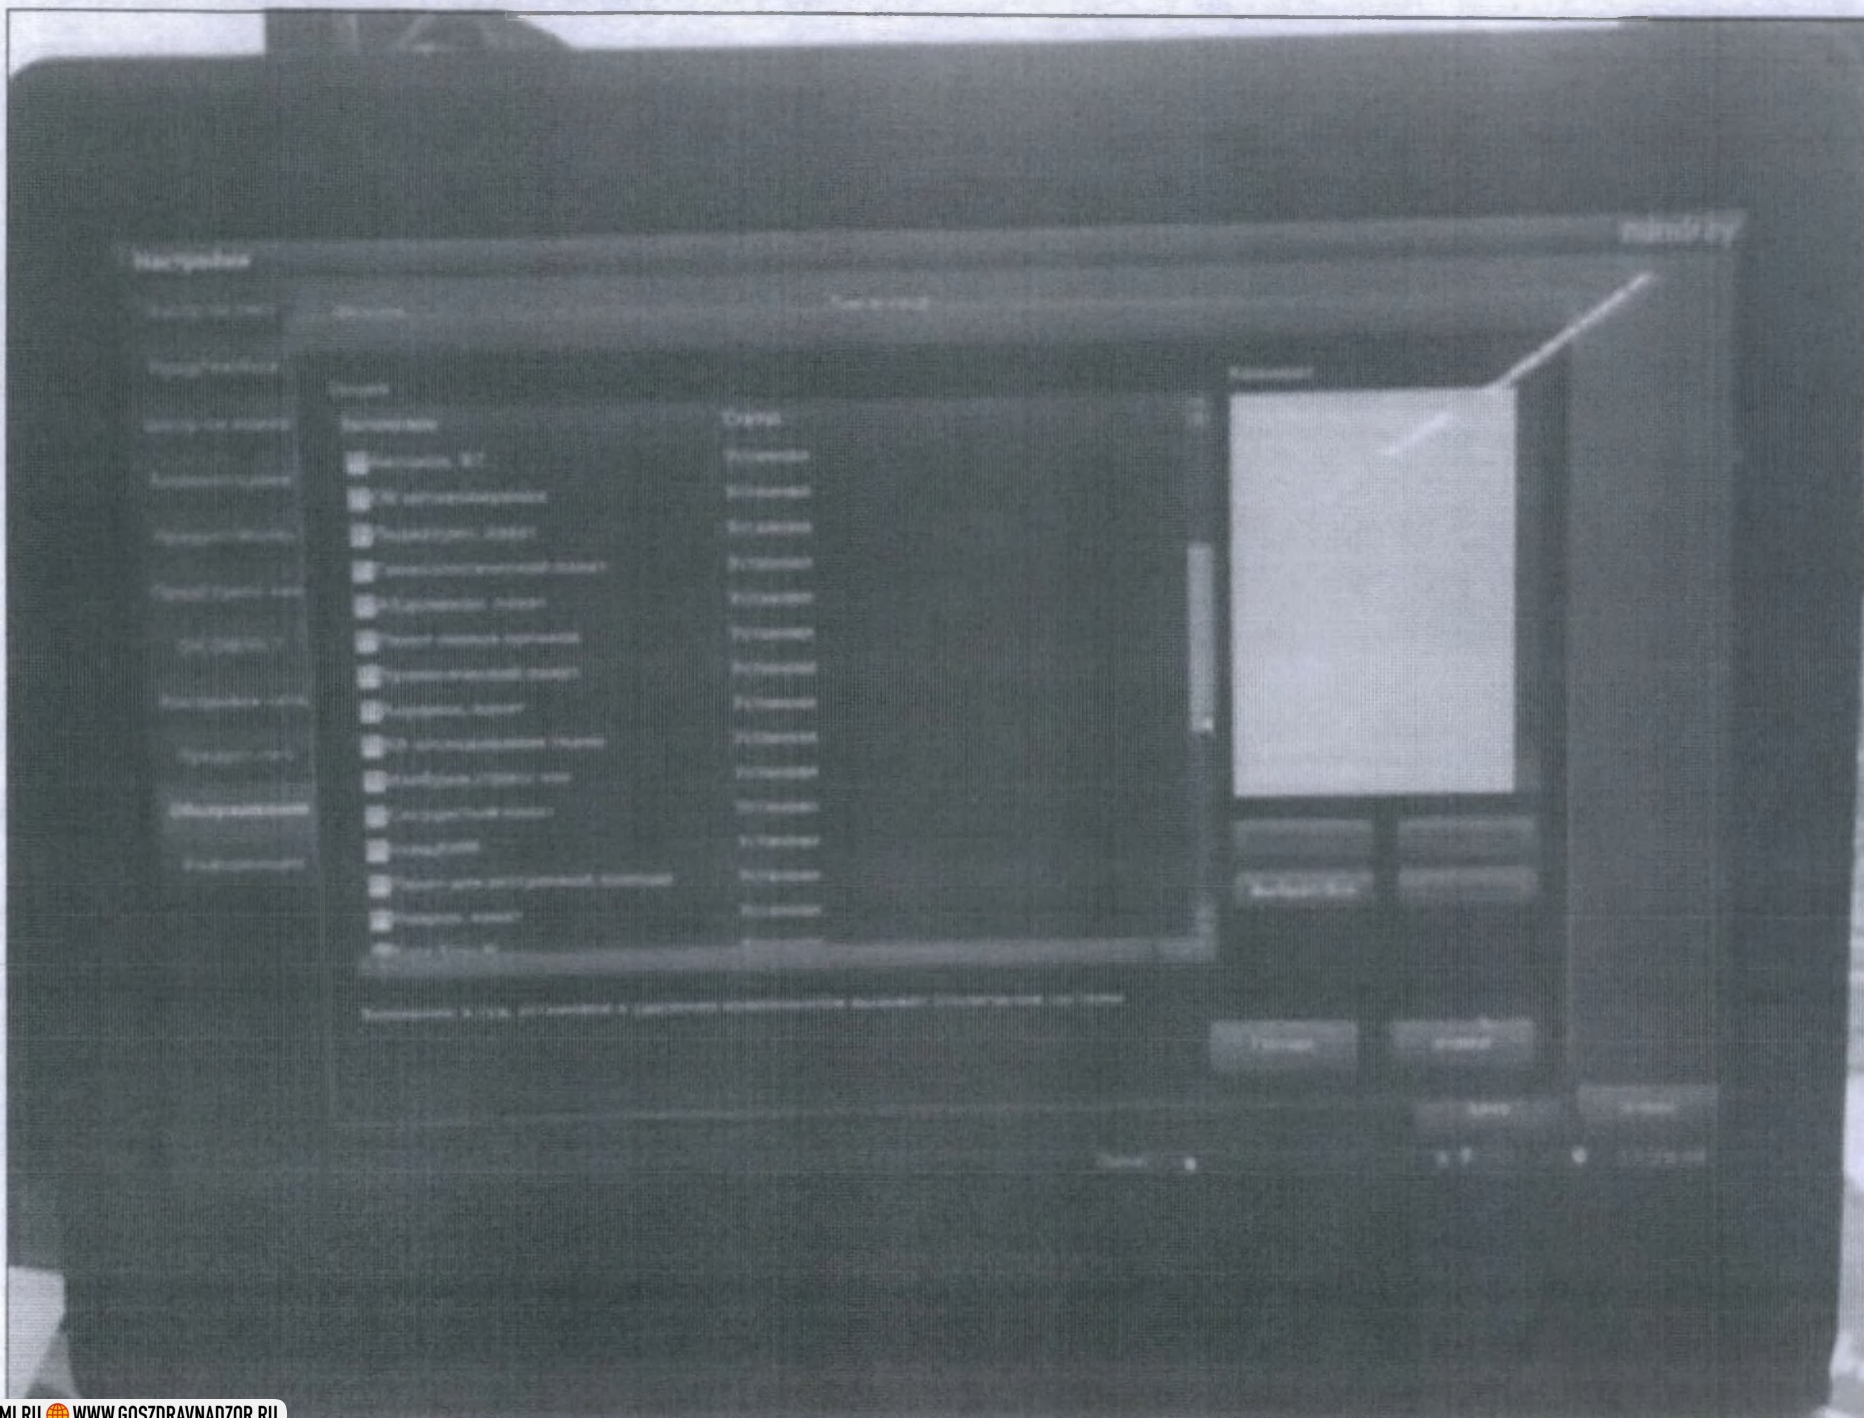


11. Программное обеспечение: - для интеграции в больничную сеть DICOM, не более 8 шт.(при необходимости).

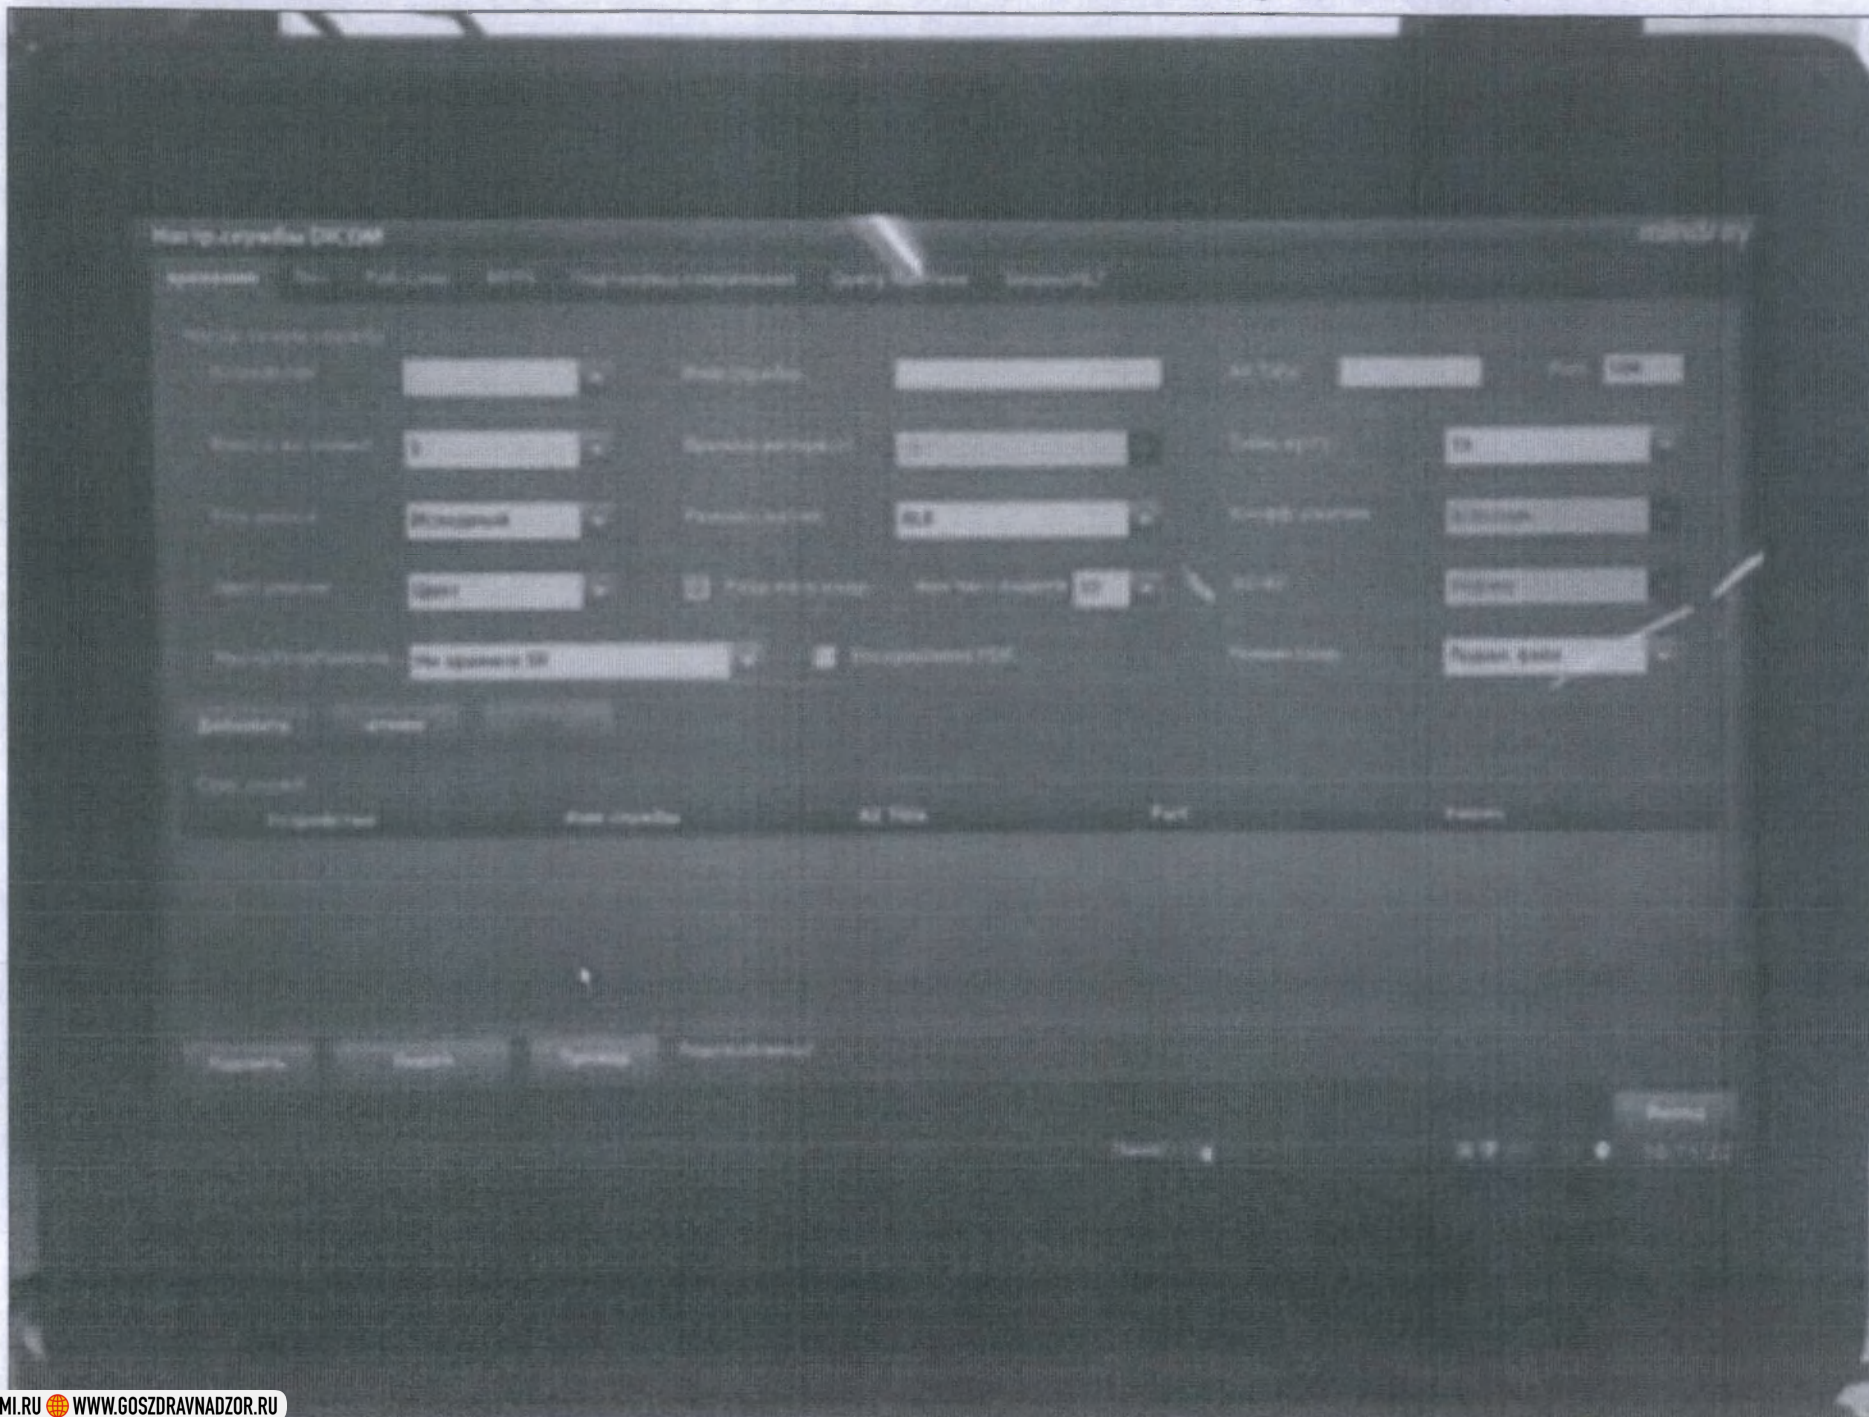


- режима панорамного сканирования (iScape) (при необходимости).

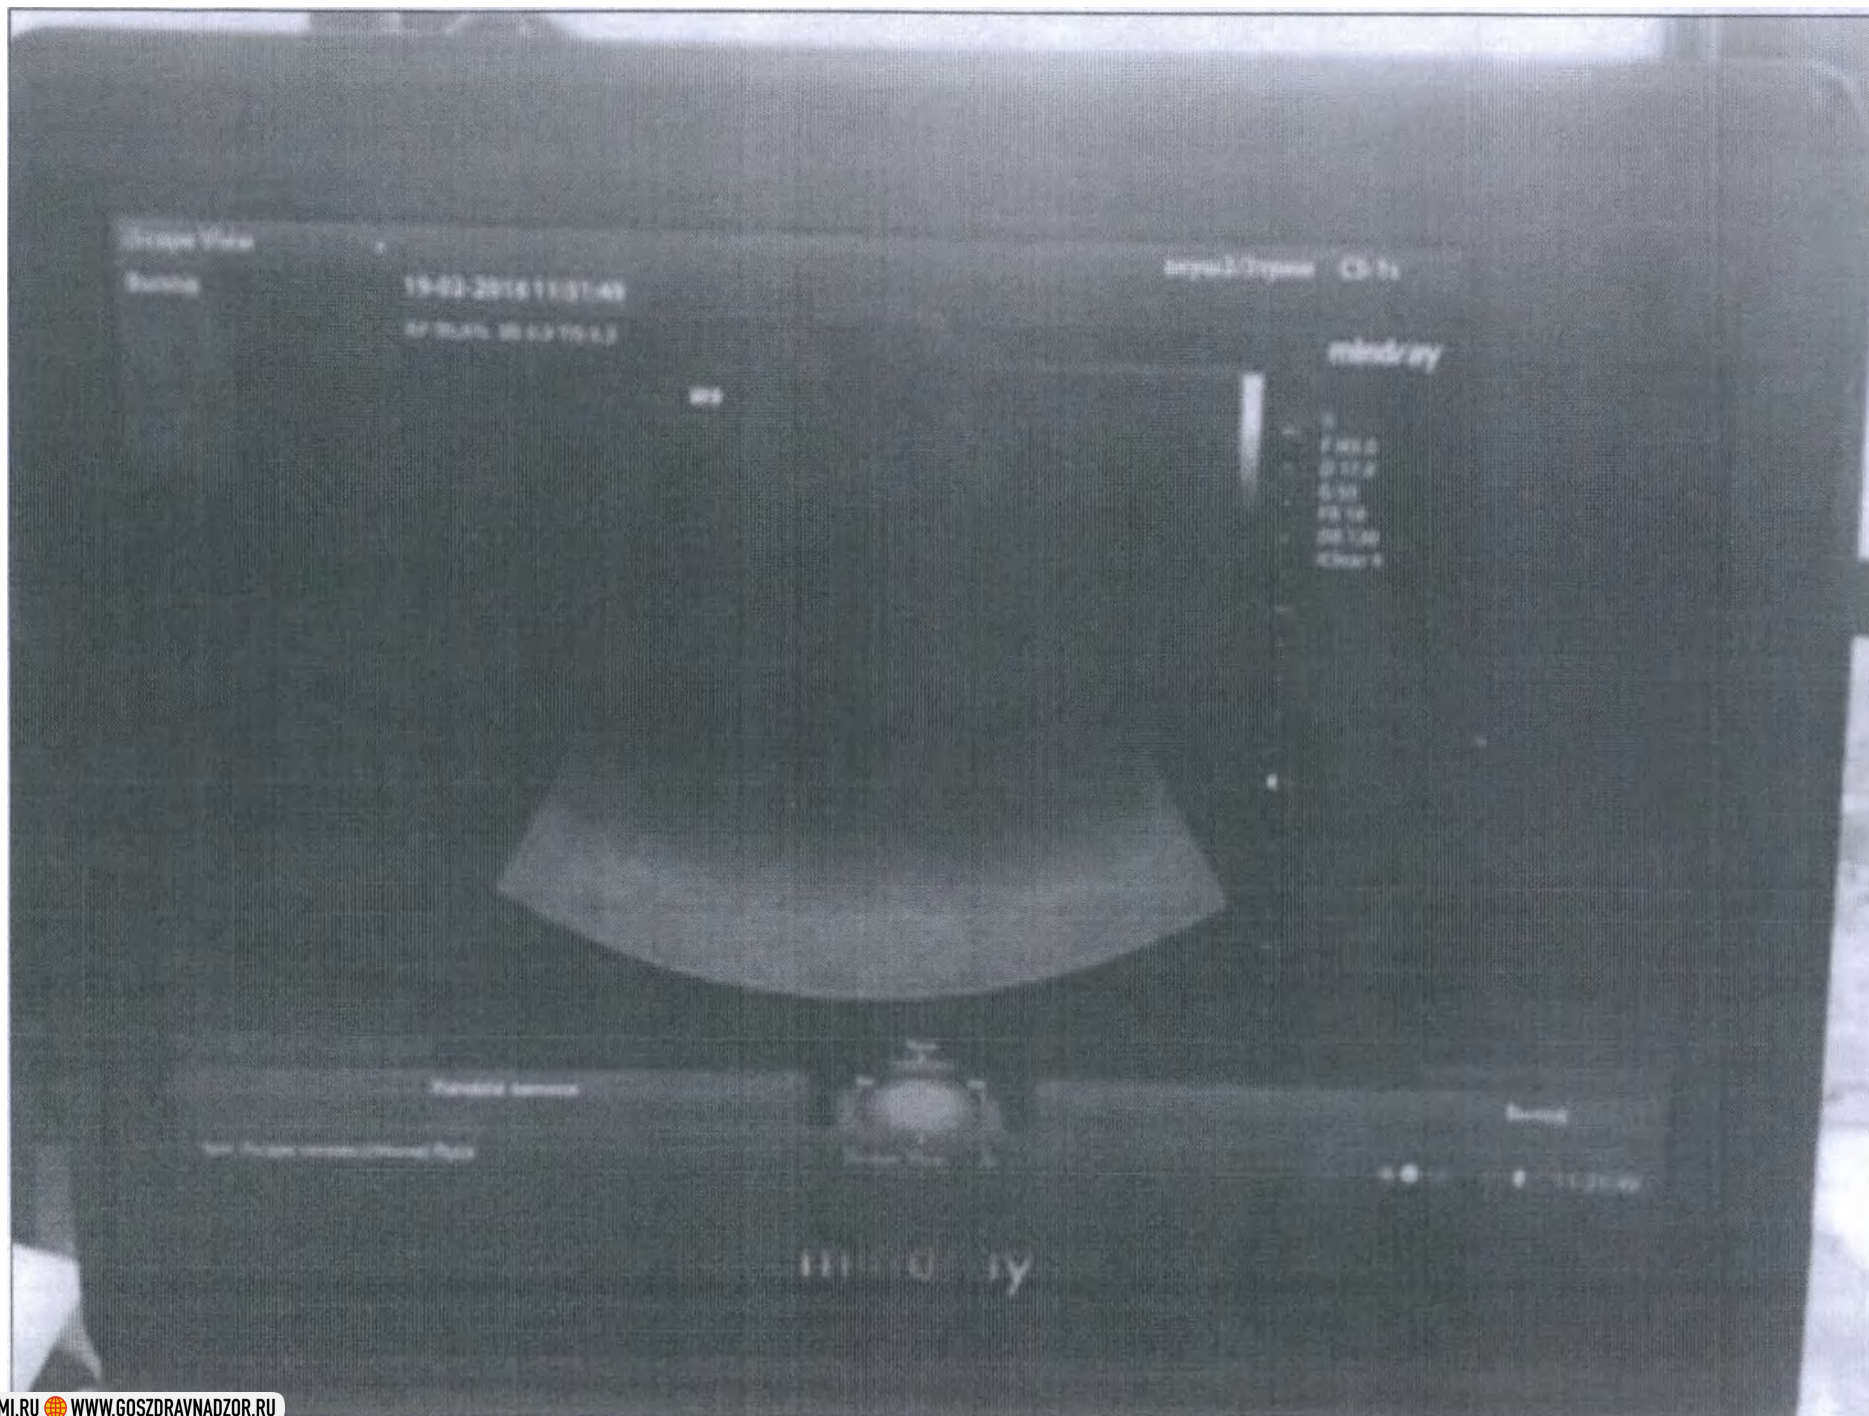


- анатомического М-режима (Free Xros M) (при необходимости).

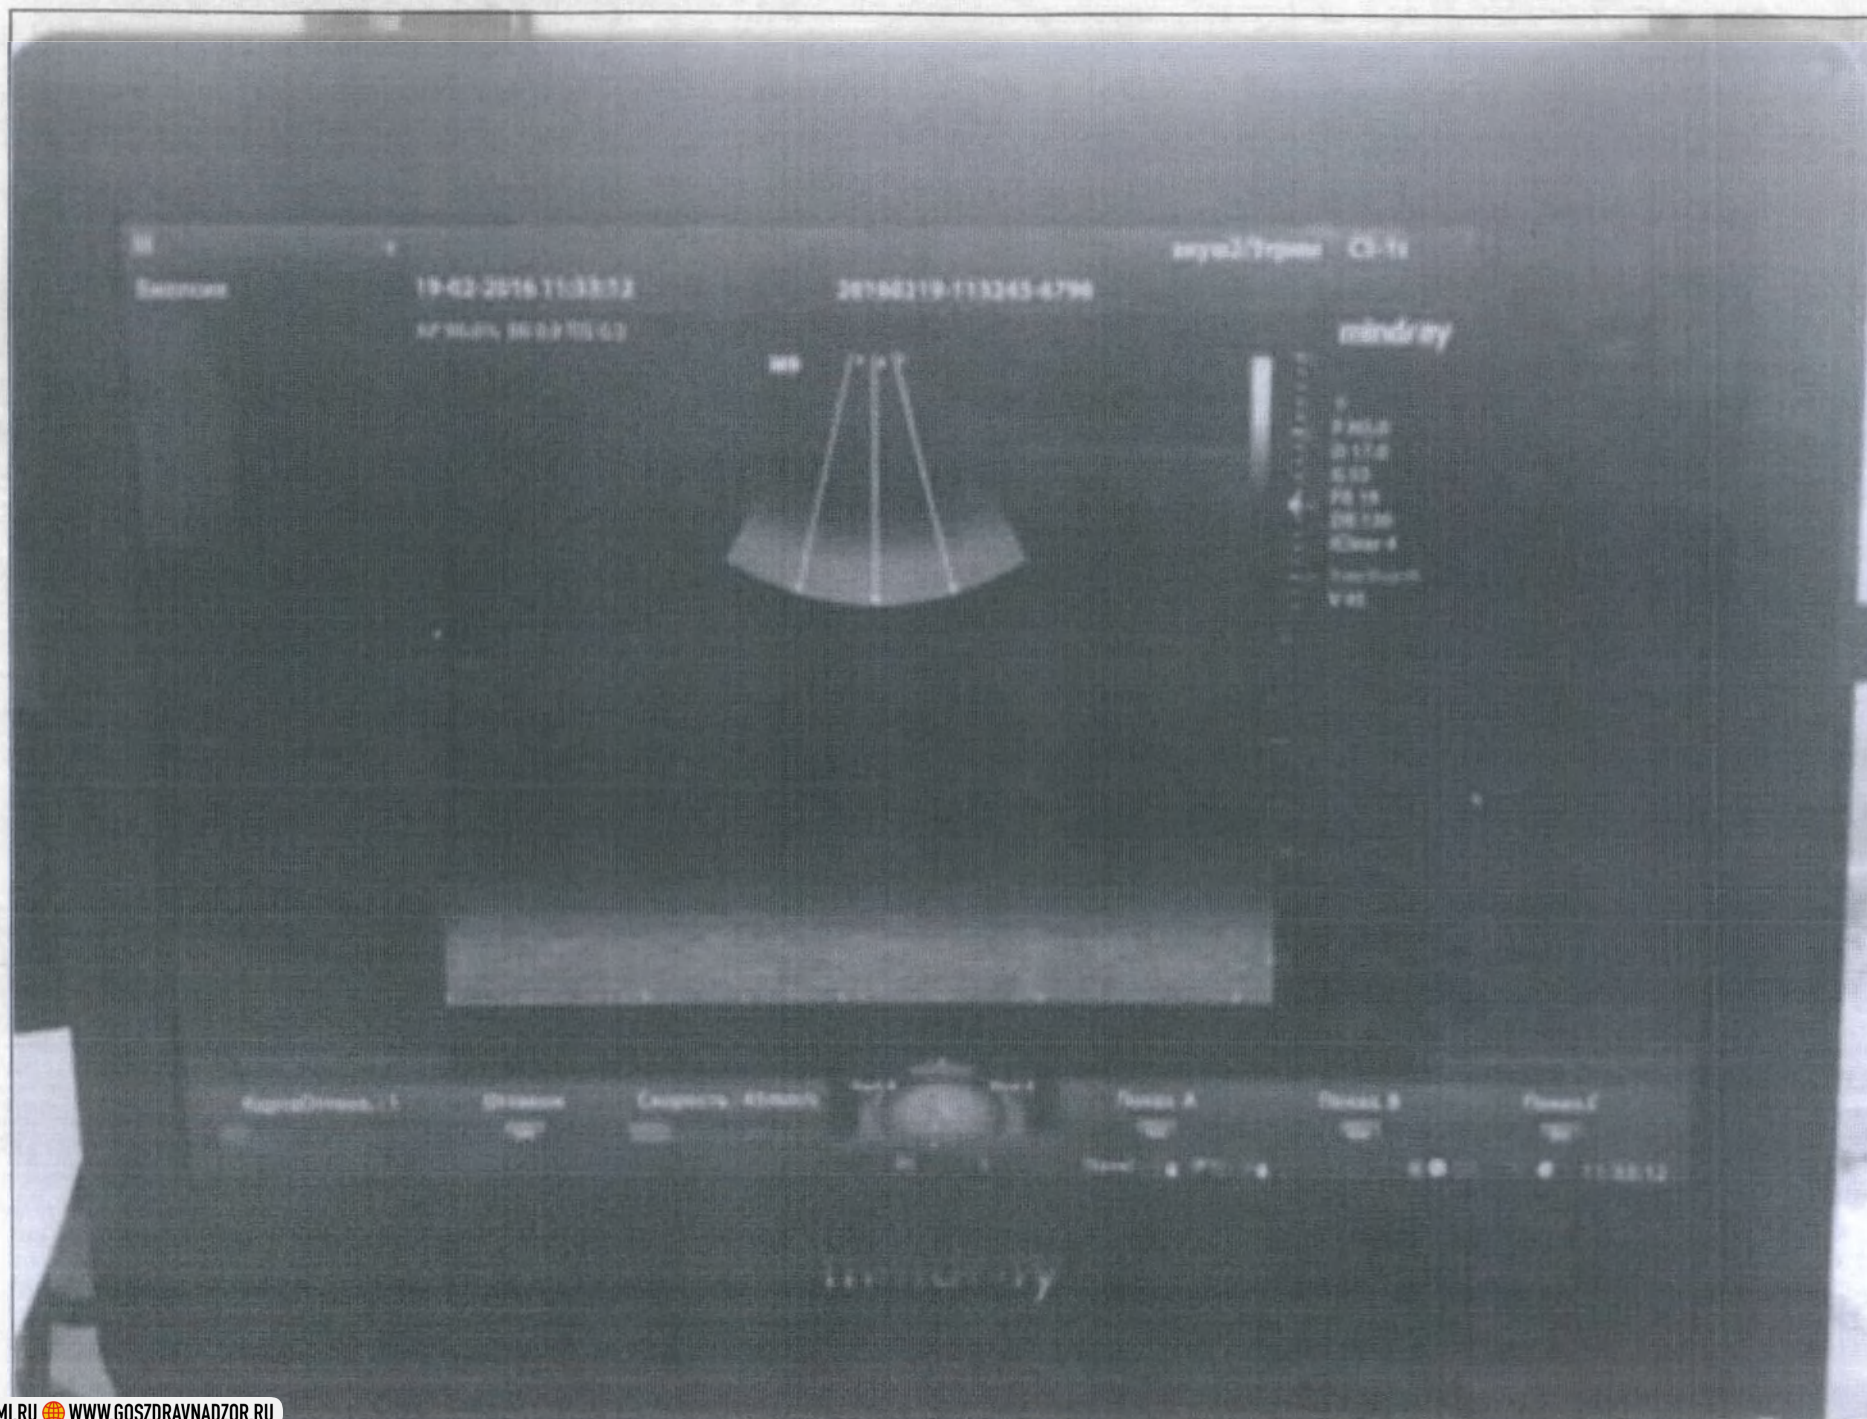

- для криволинейного анатомического М-режима (Free Xros CM) (при необходимости).

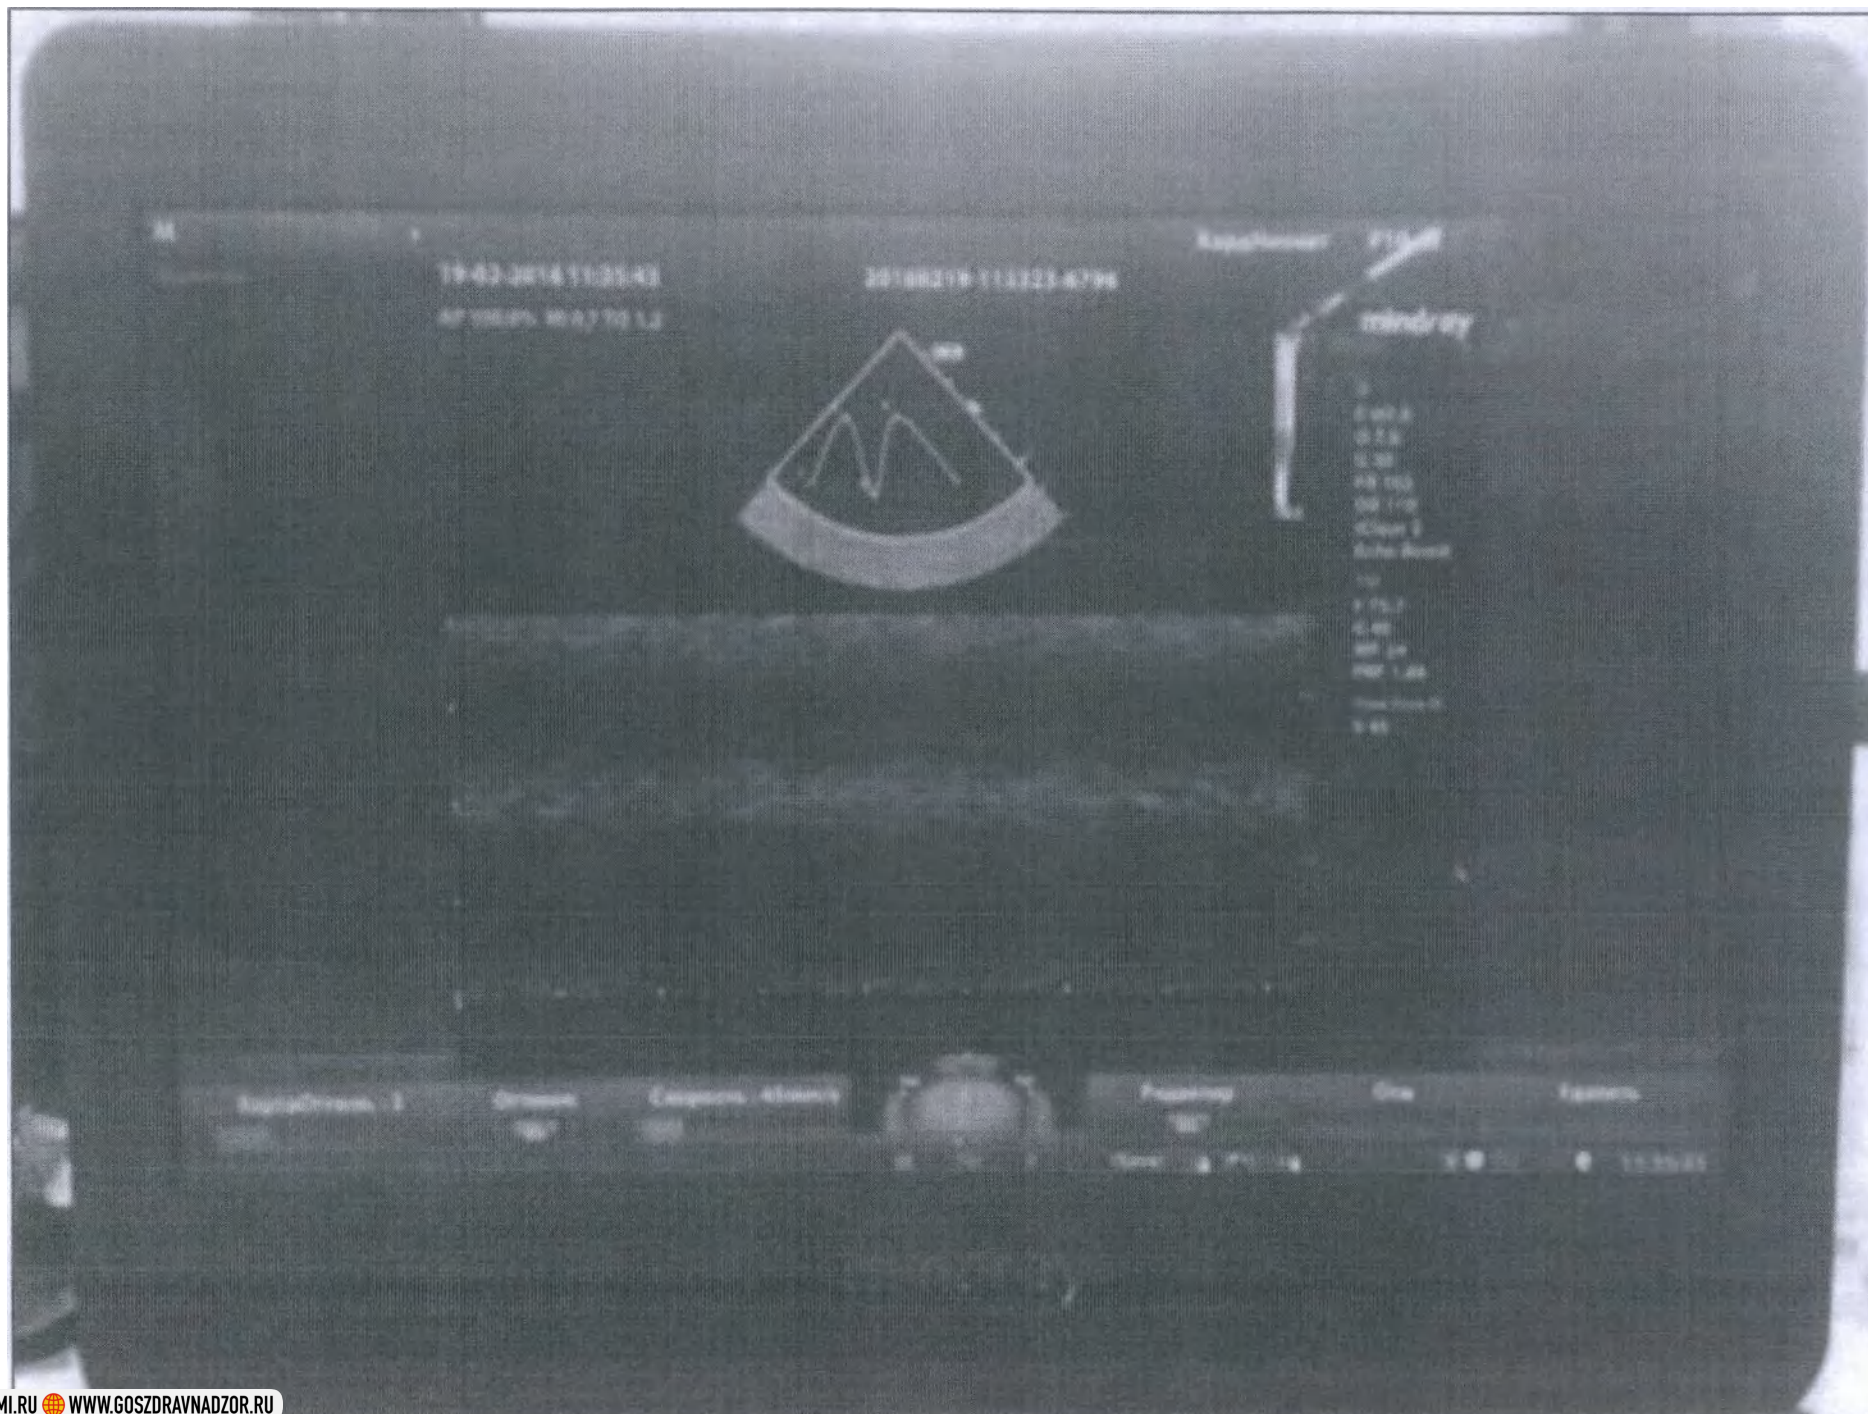


- для автоматического измерения комплекса интима-медиа (ИМТ) (при необходимости).

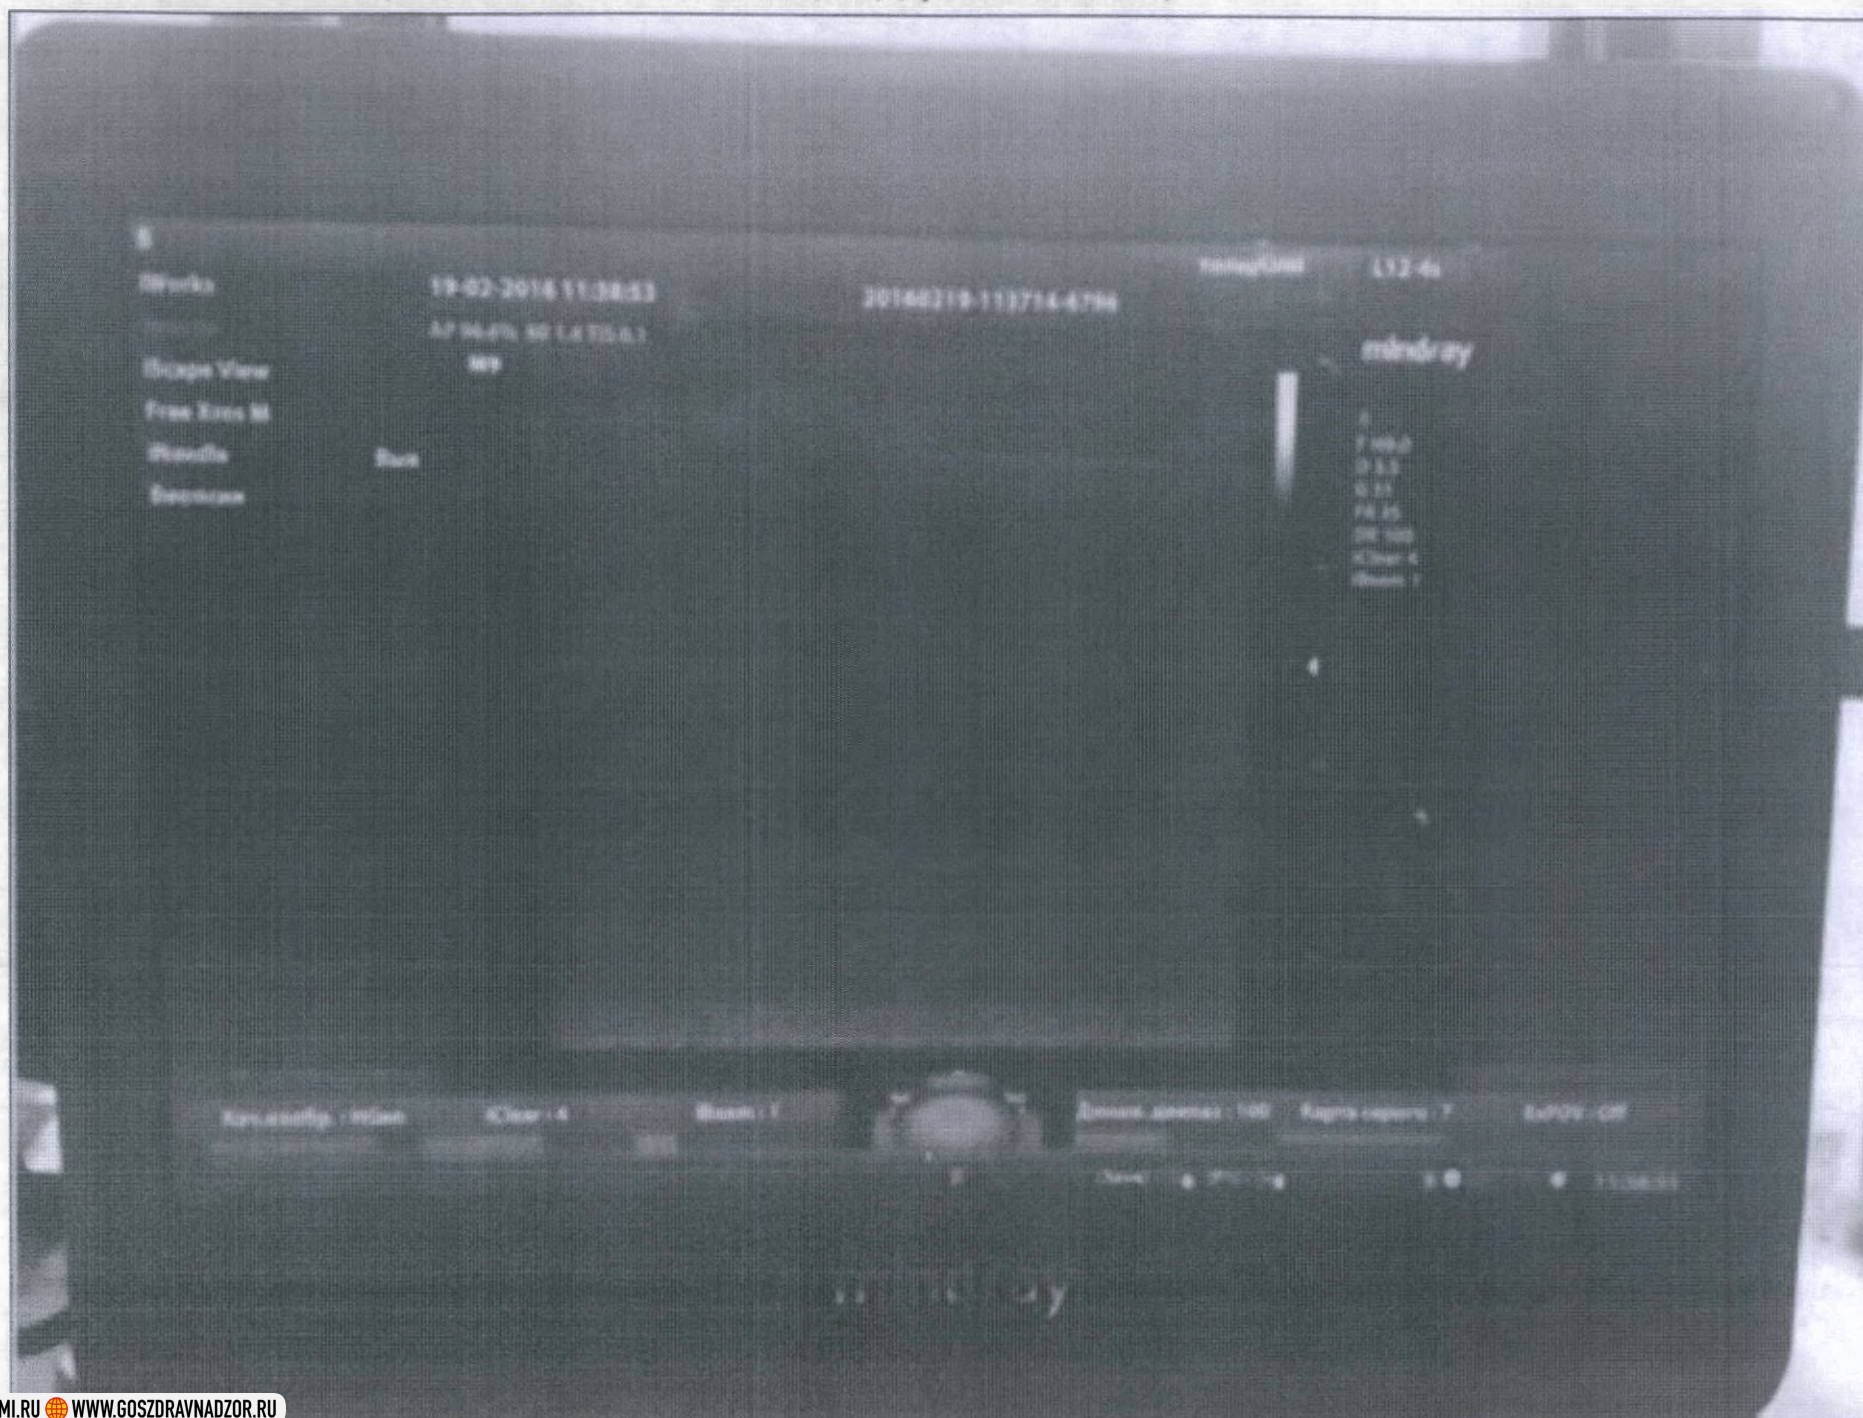





- режима эластографии с программой анализа (Elastography) (при необходимости).

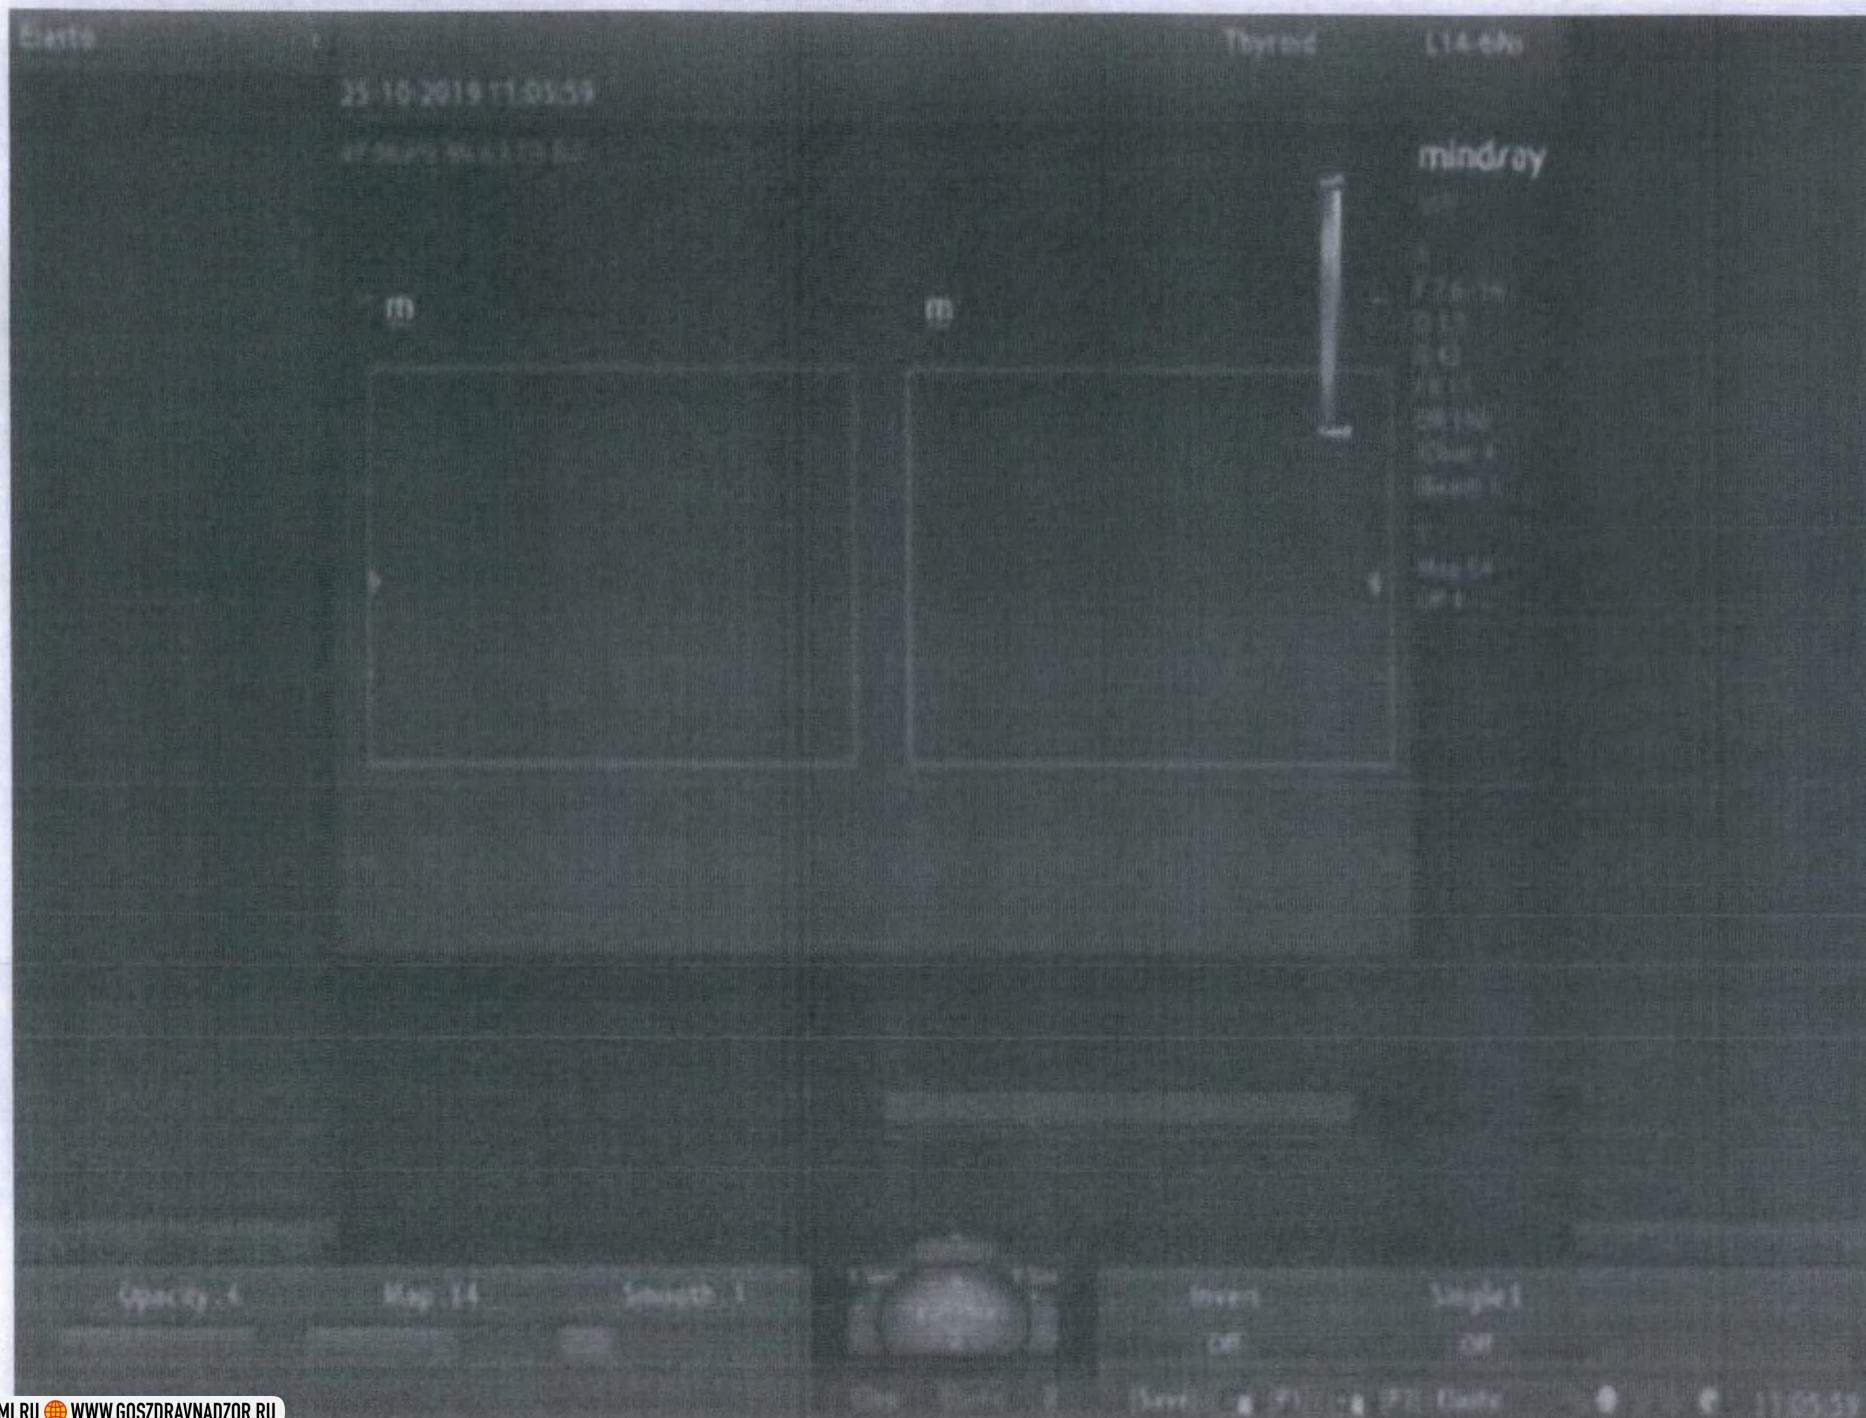


- автоматизированных рабочих протоколов (iWorks) (при необходимости).

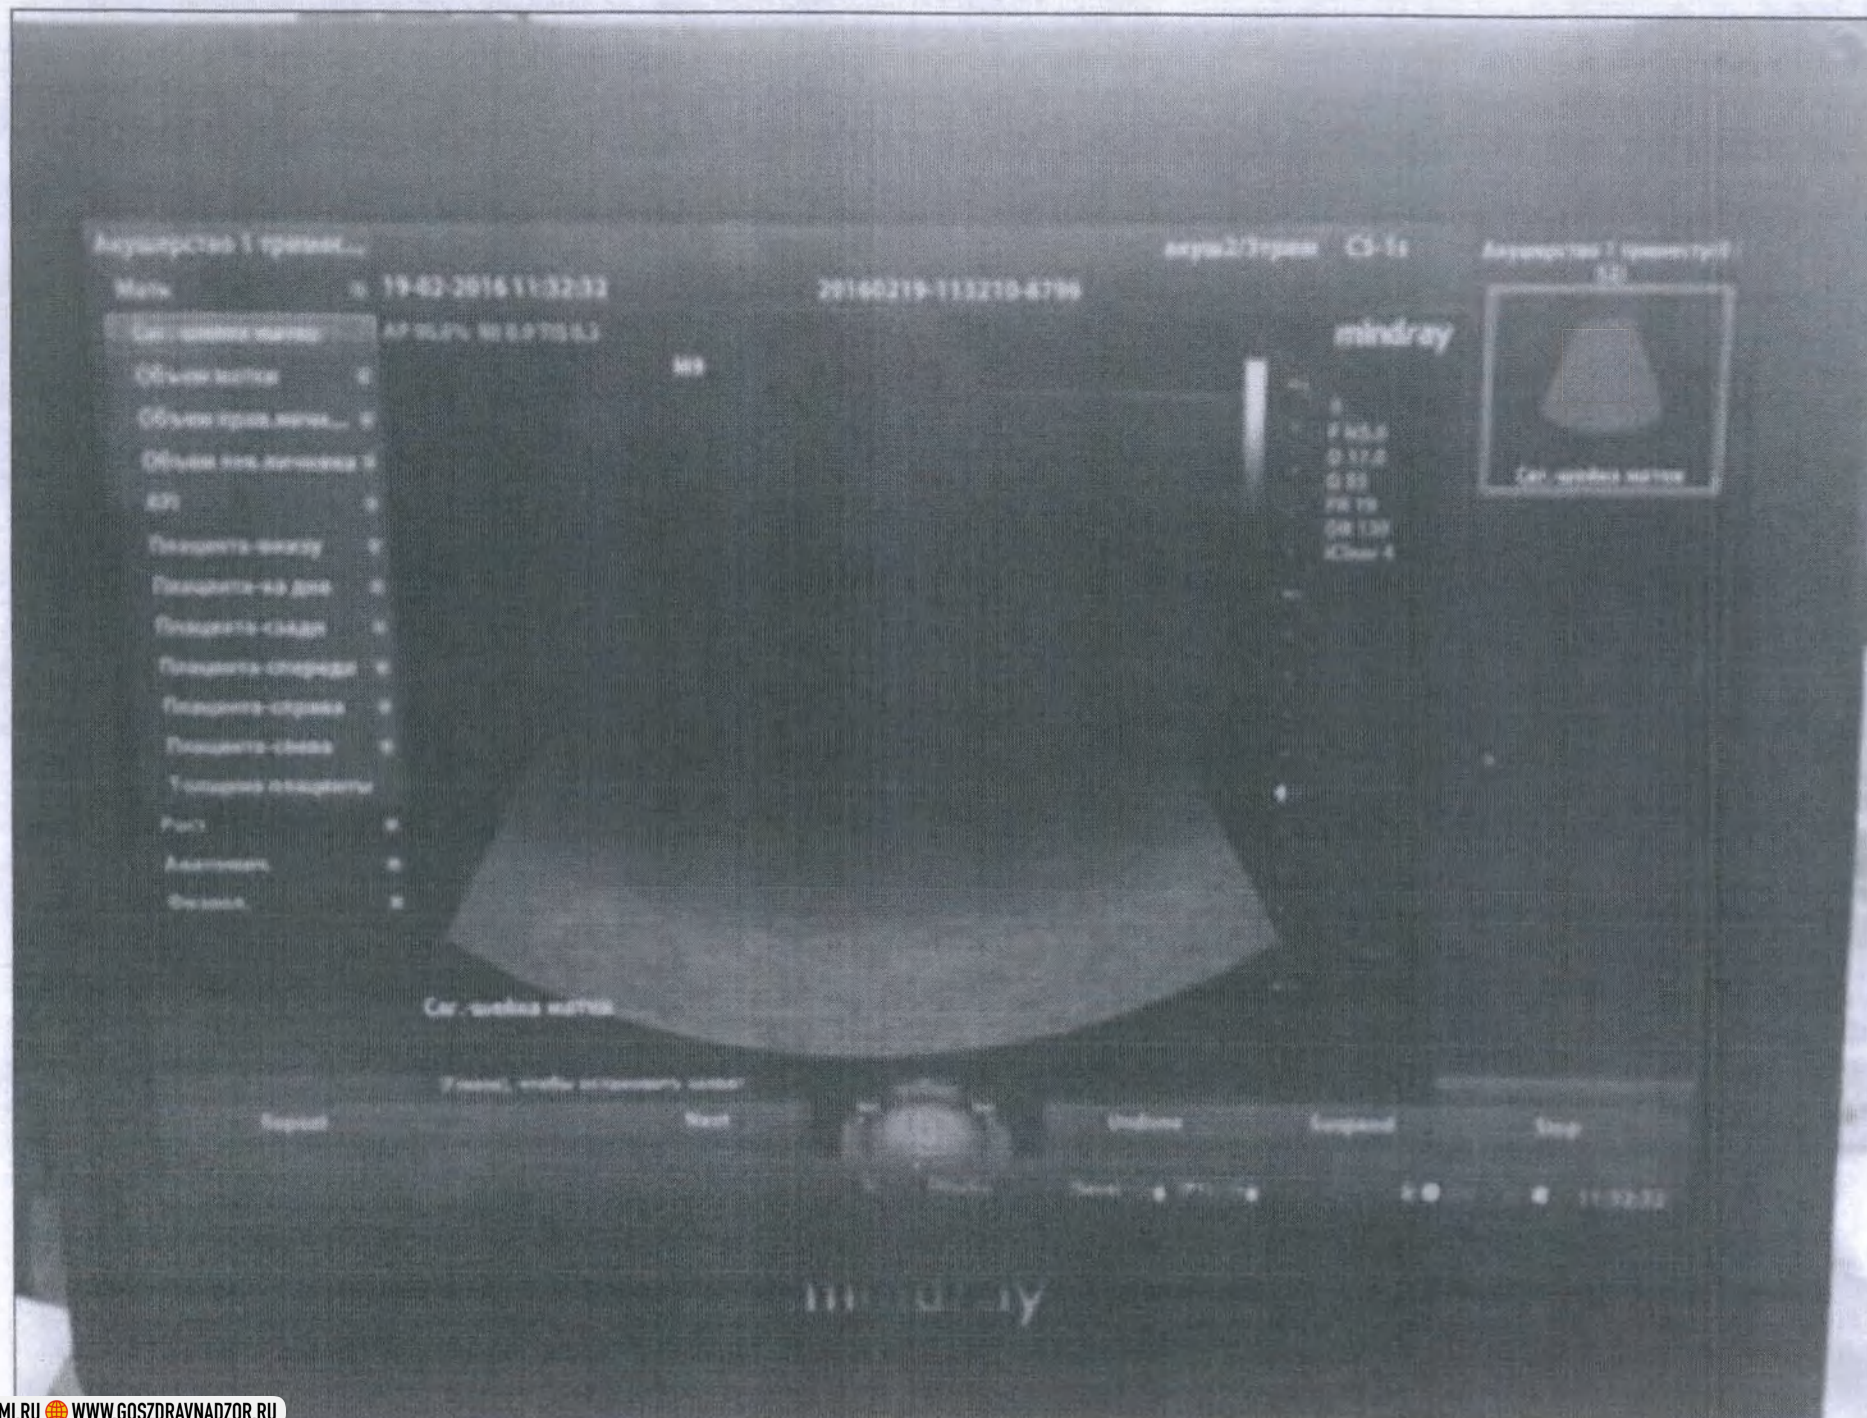


- для улучшения визуализации биопсийной иглы (iNeedle) (при необходимости).

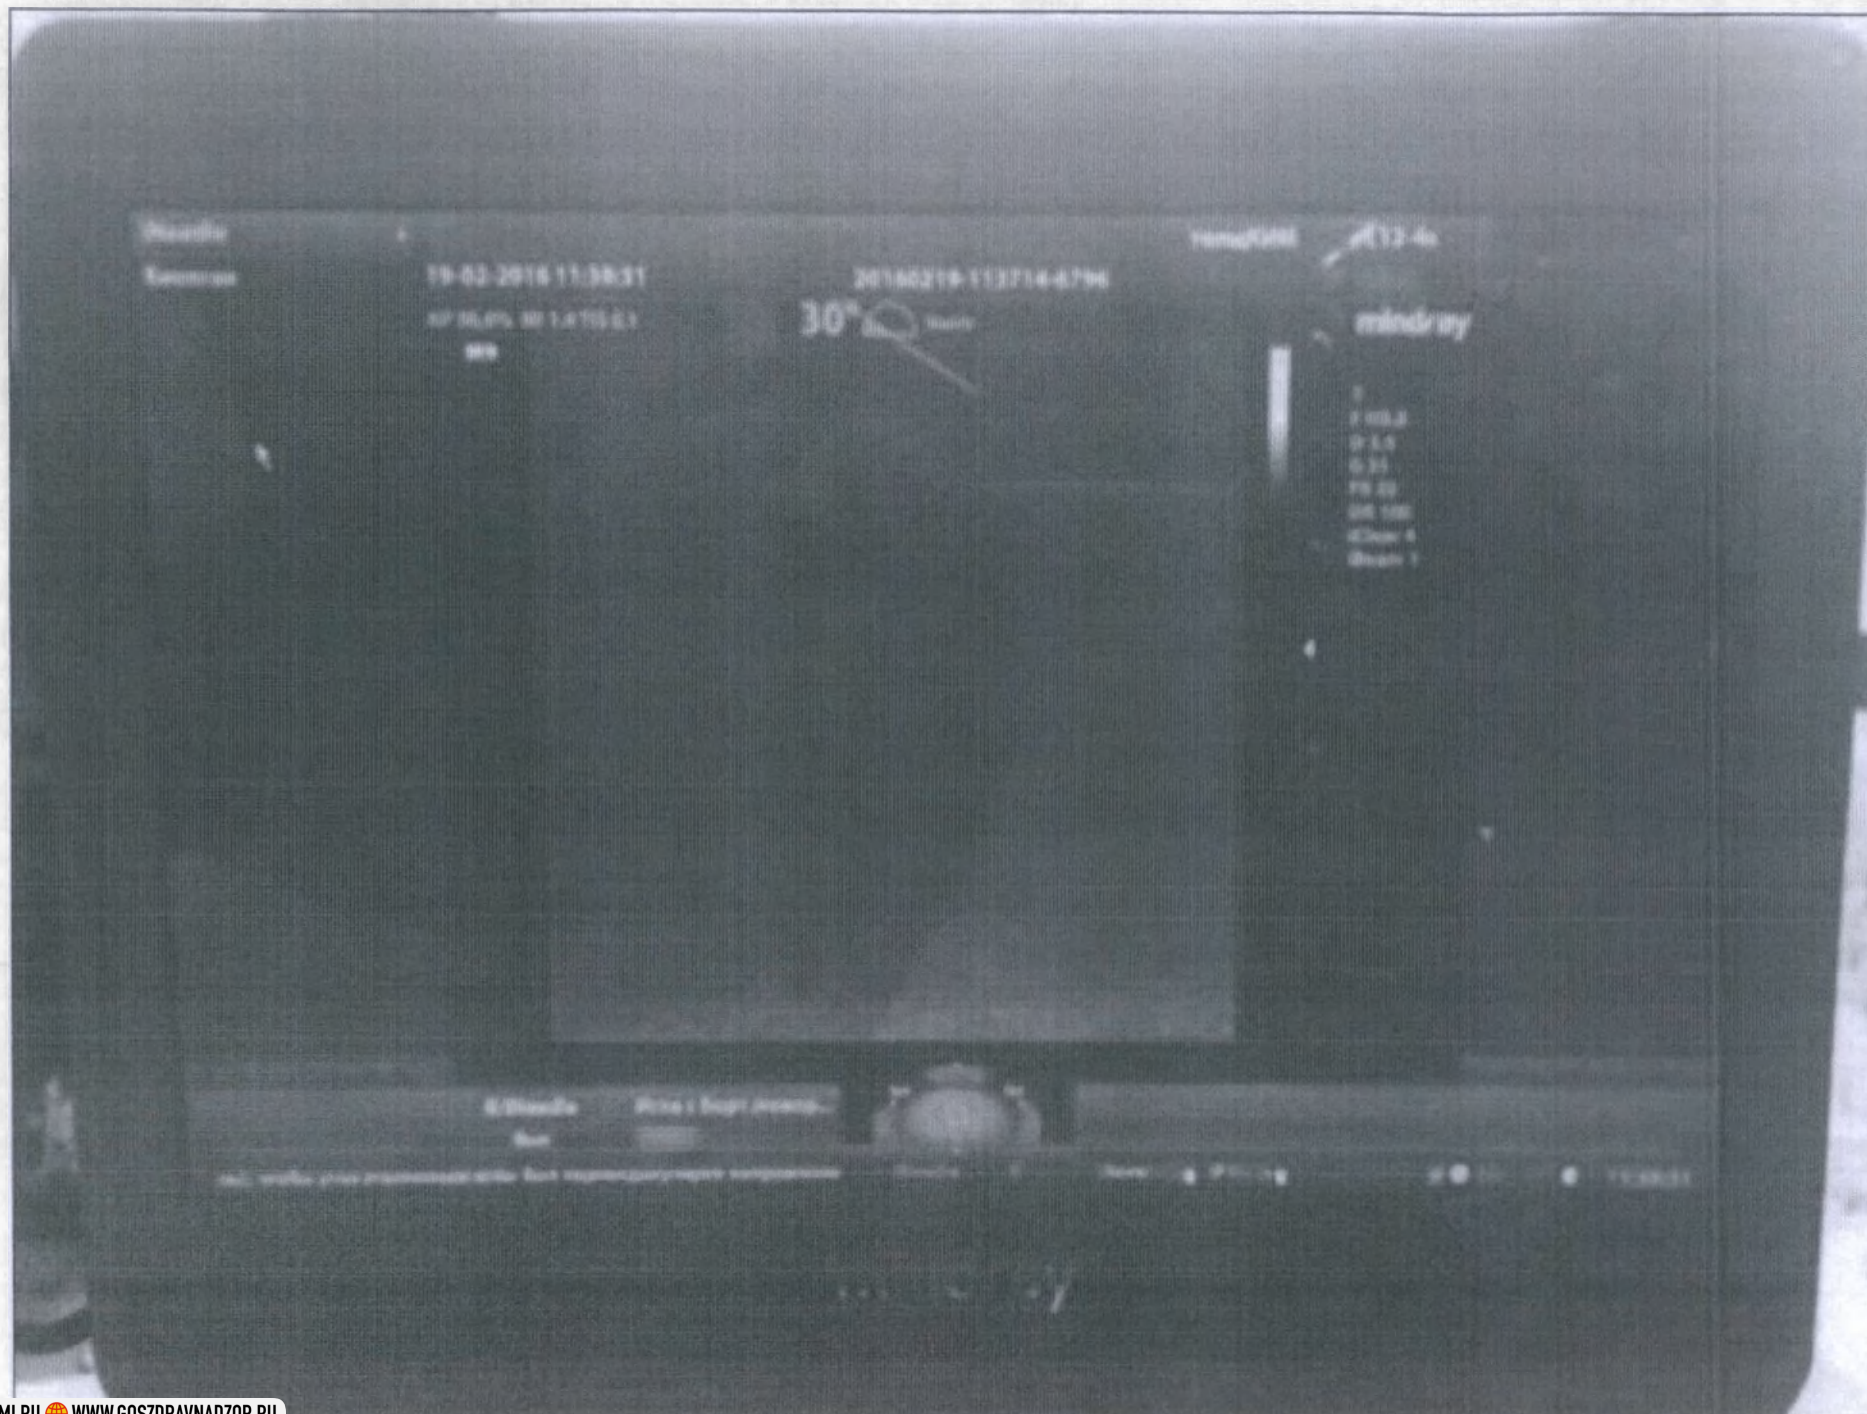


- для проведения и оценки результатов стресс-эхокардиографии (Stress Echo) (при необходимости).

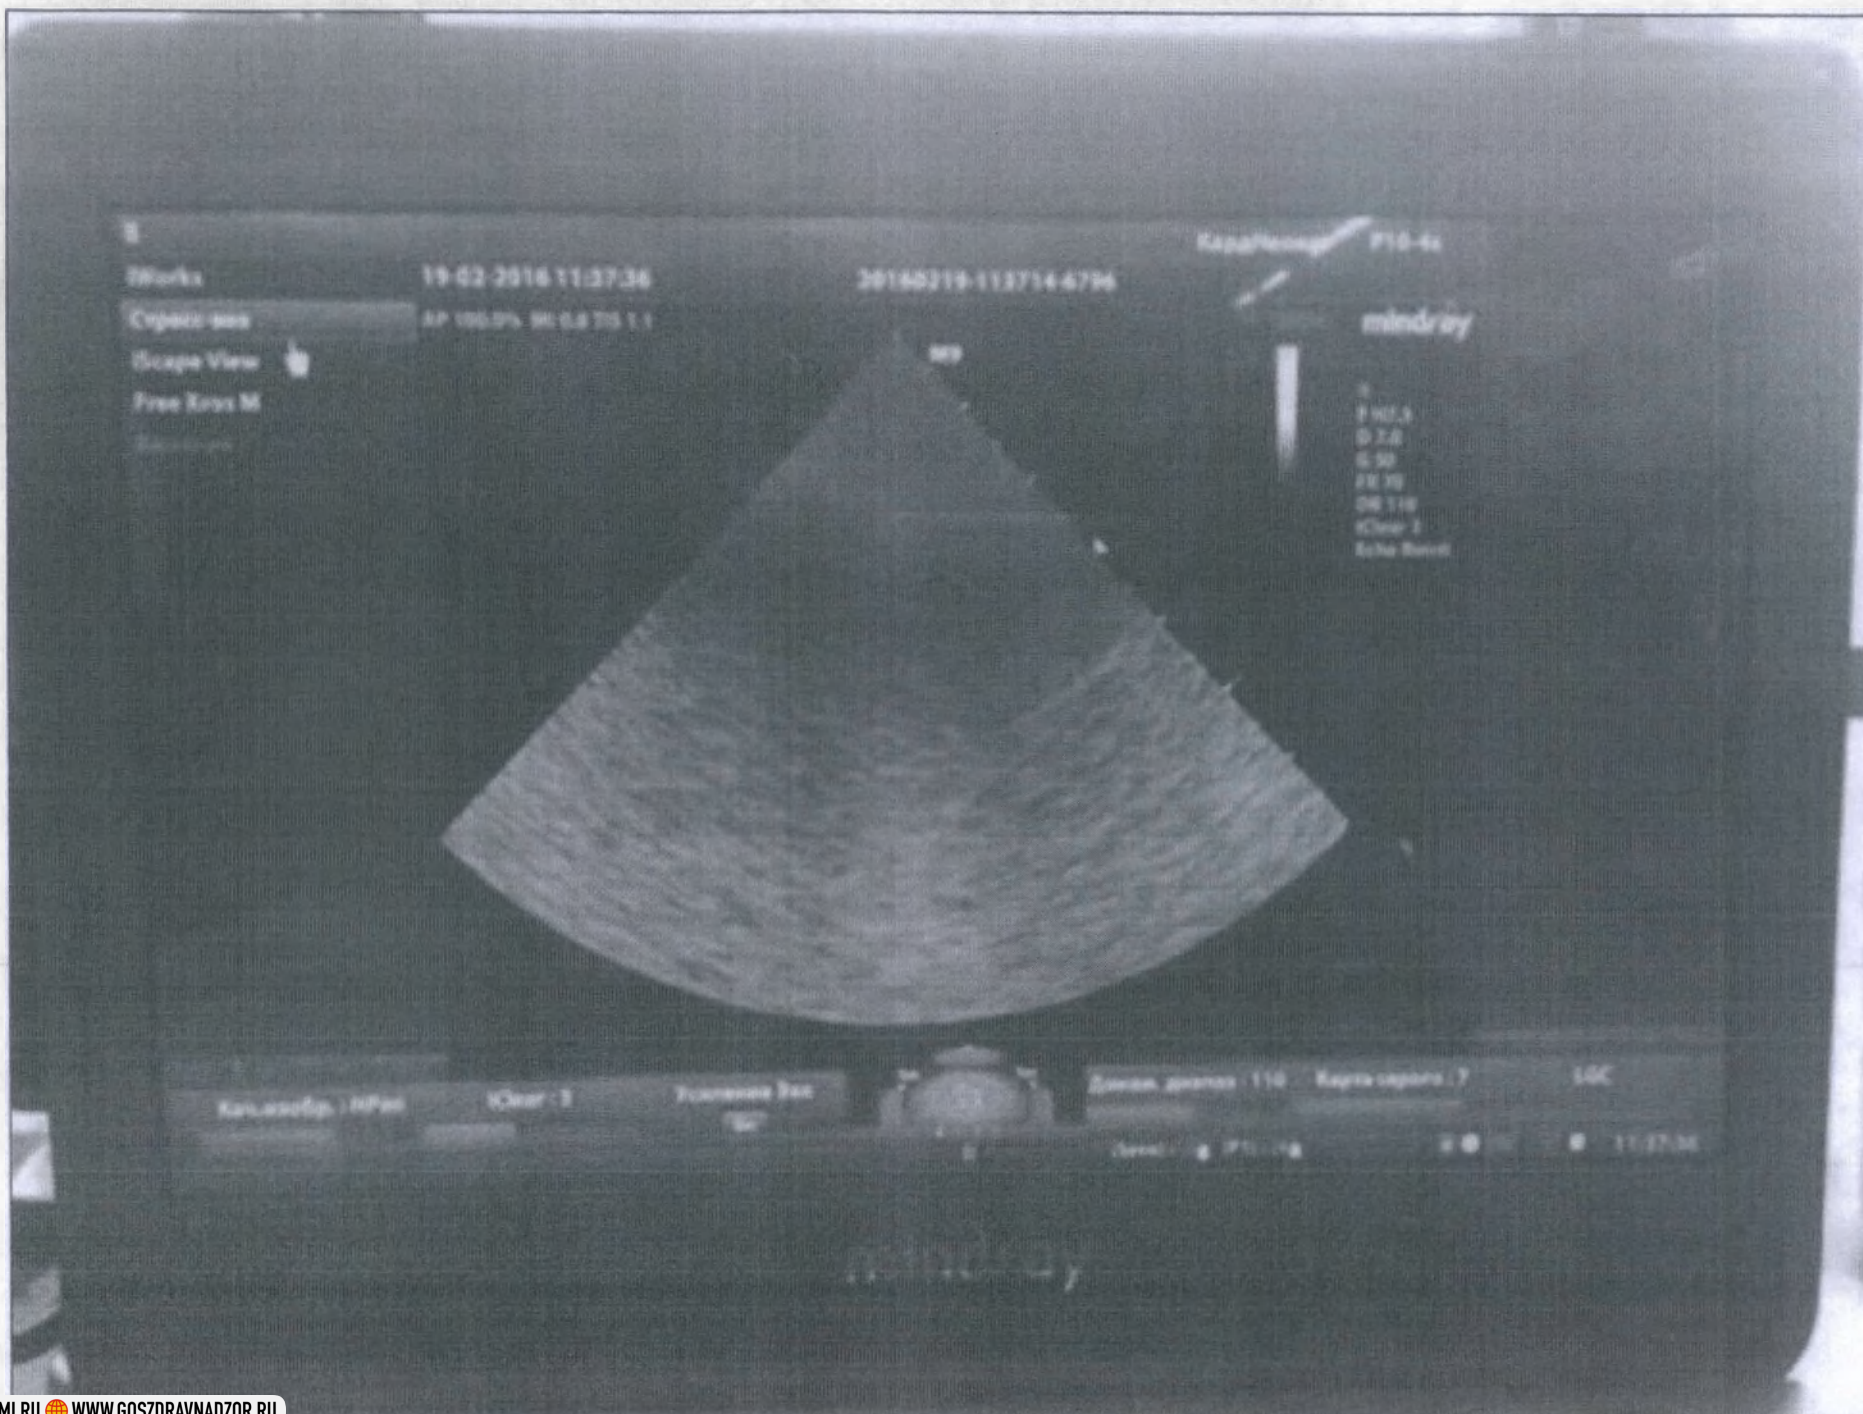


- для недоплеровской количественной оценки движения и деформации миокарда (Tissue Tracking with Quantitative Analysis) (при необходимости).

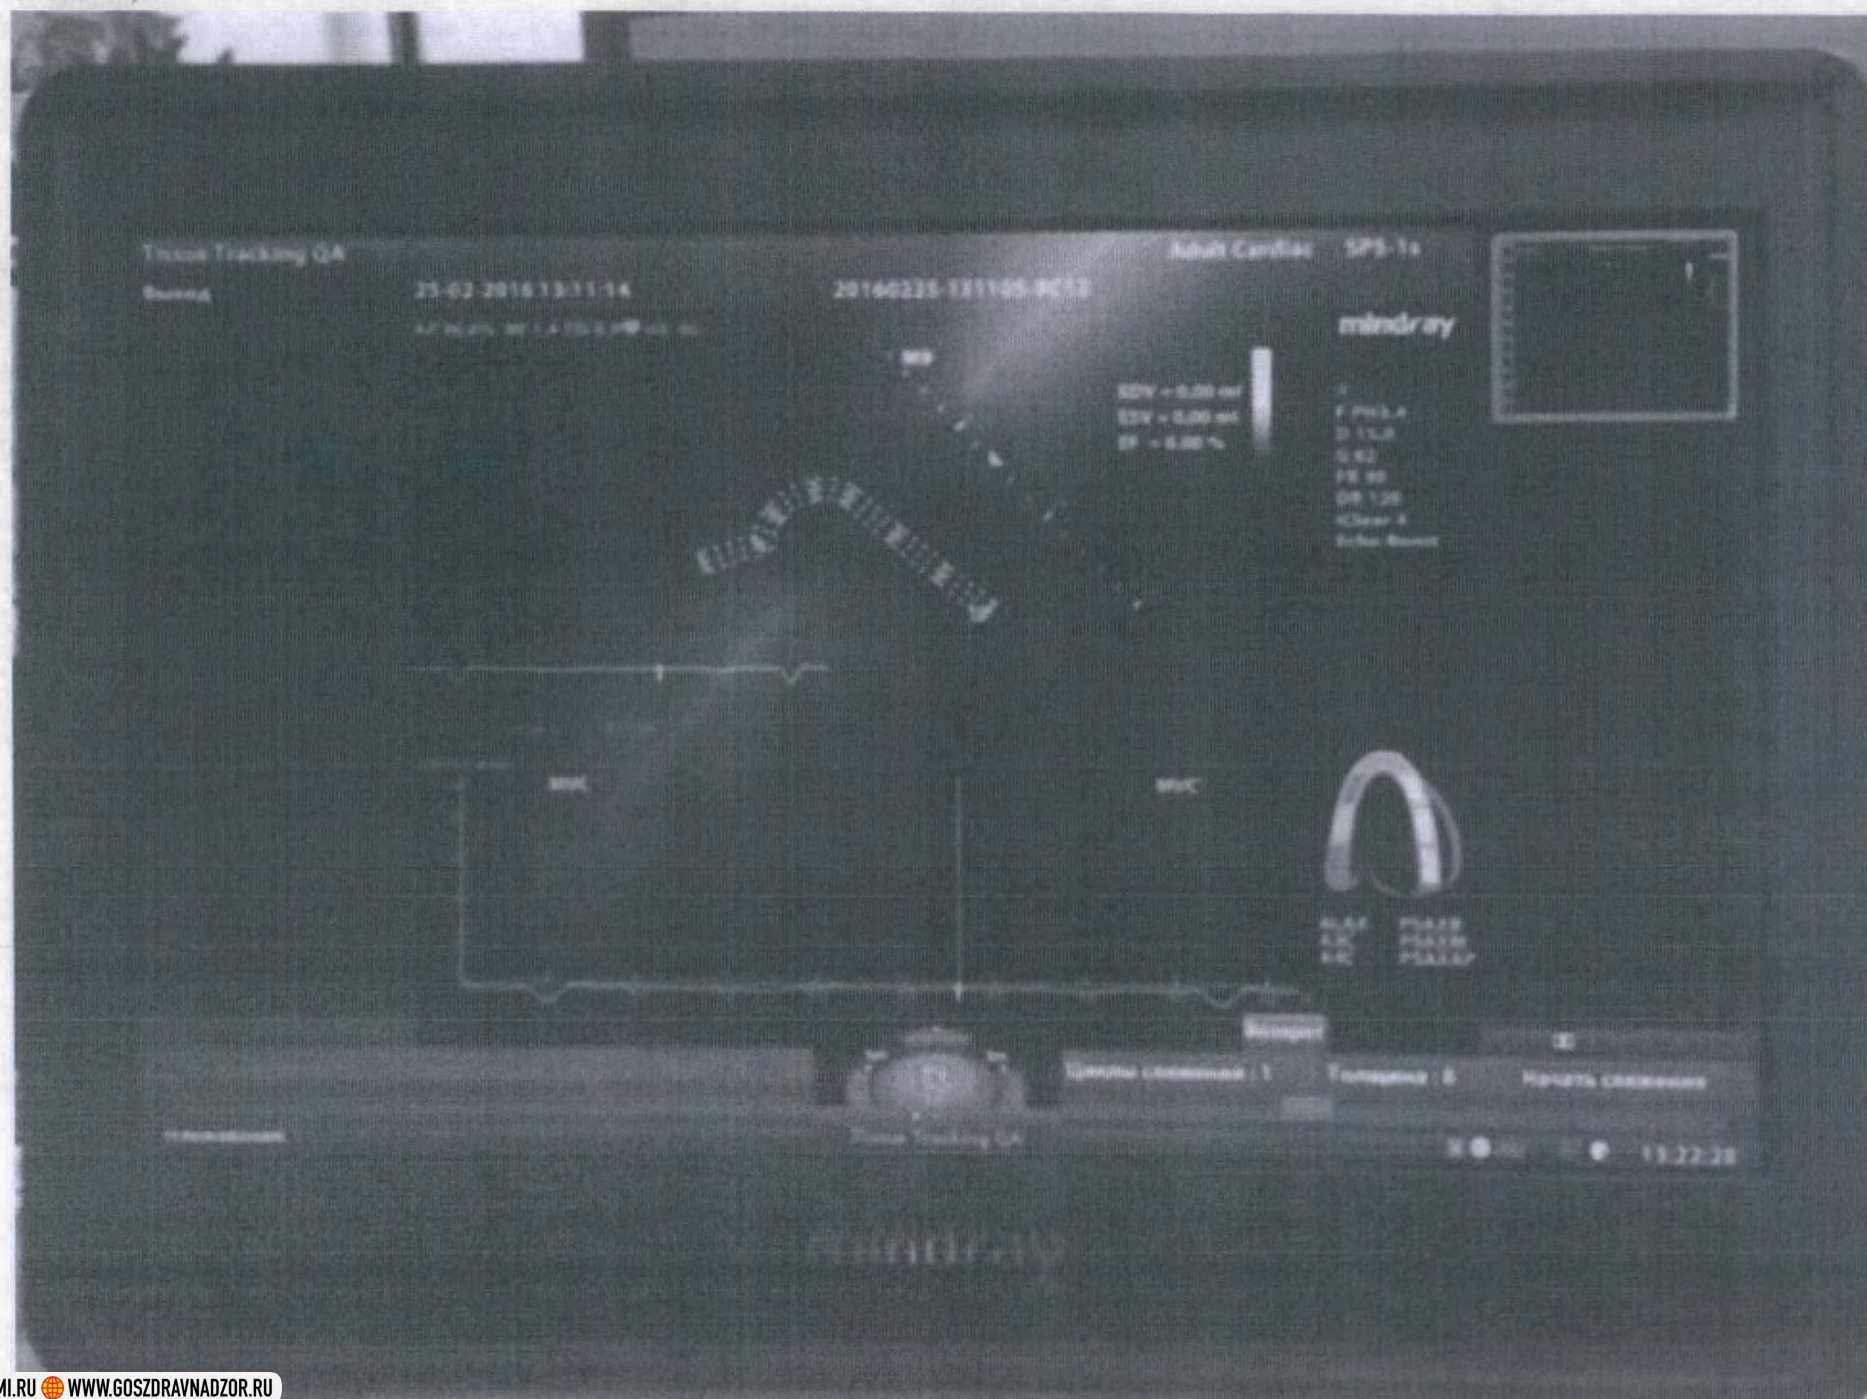


- режима исследований с контрастированием (UWN+Contrast) (при необходимости).

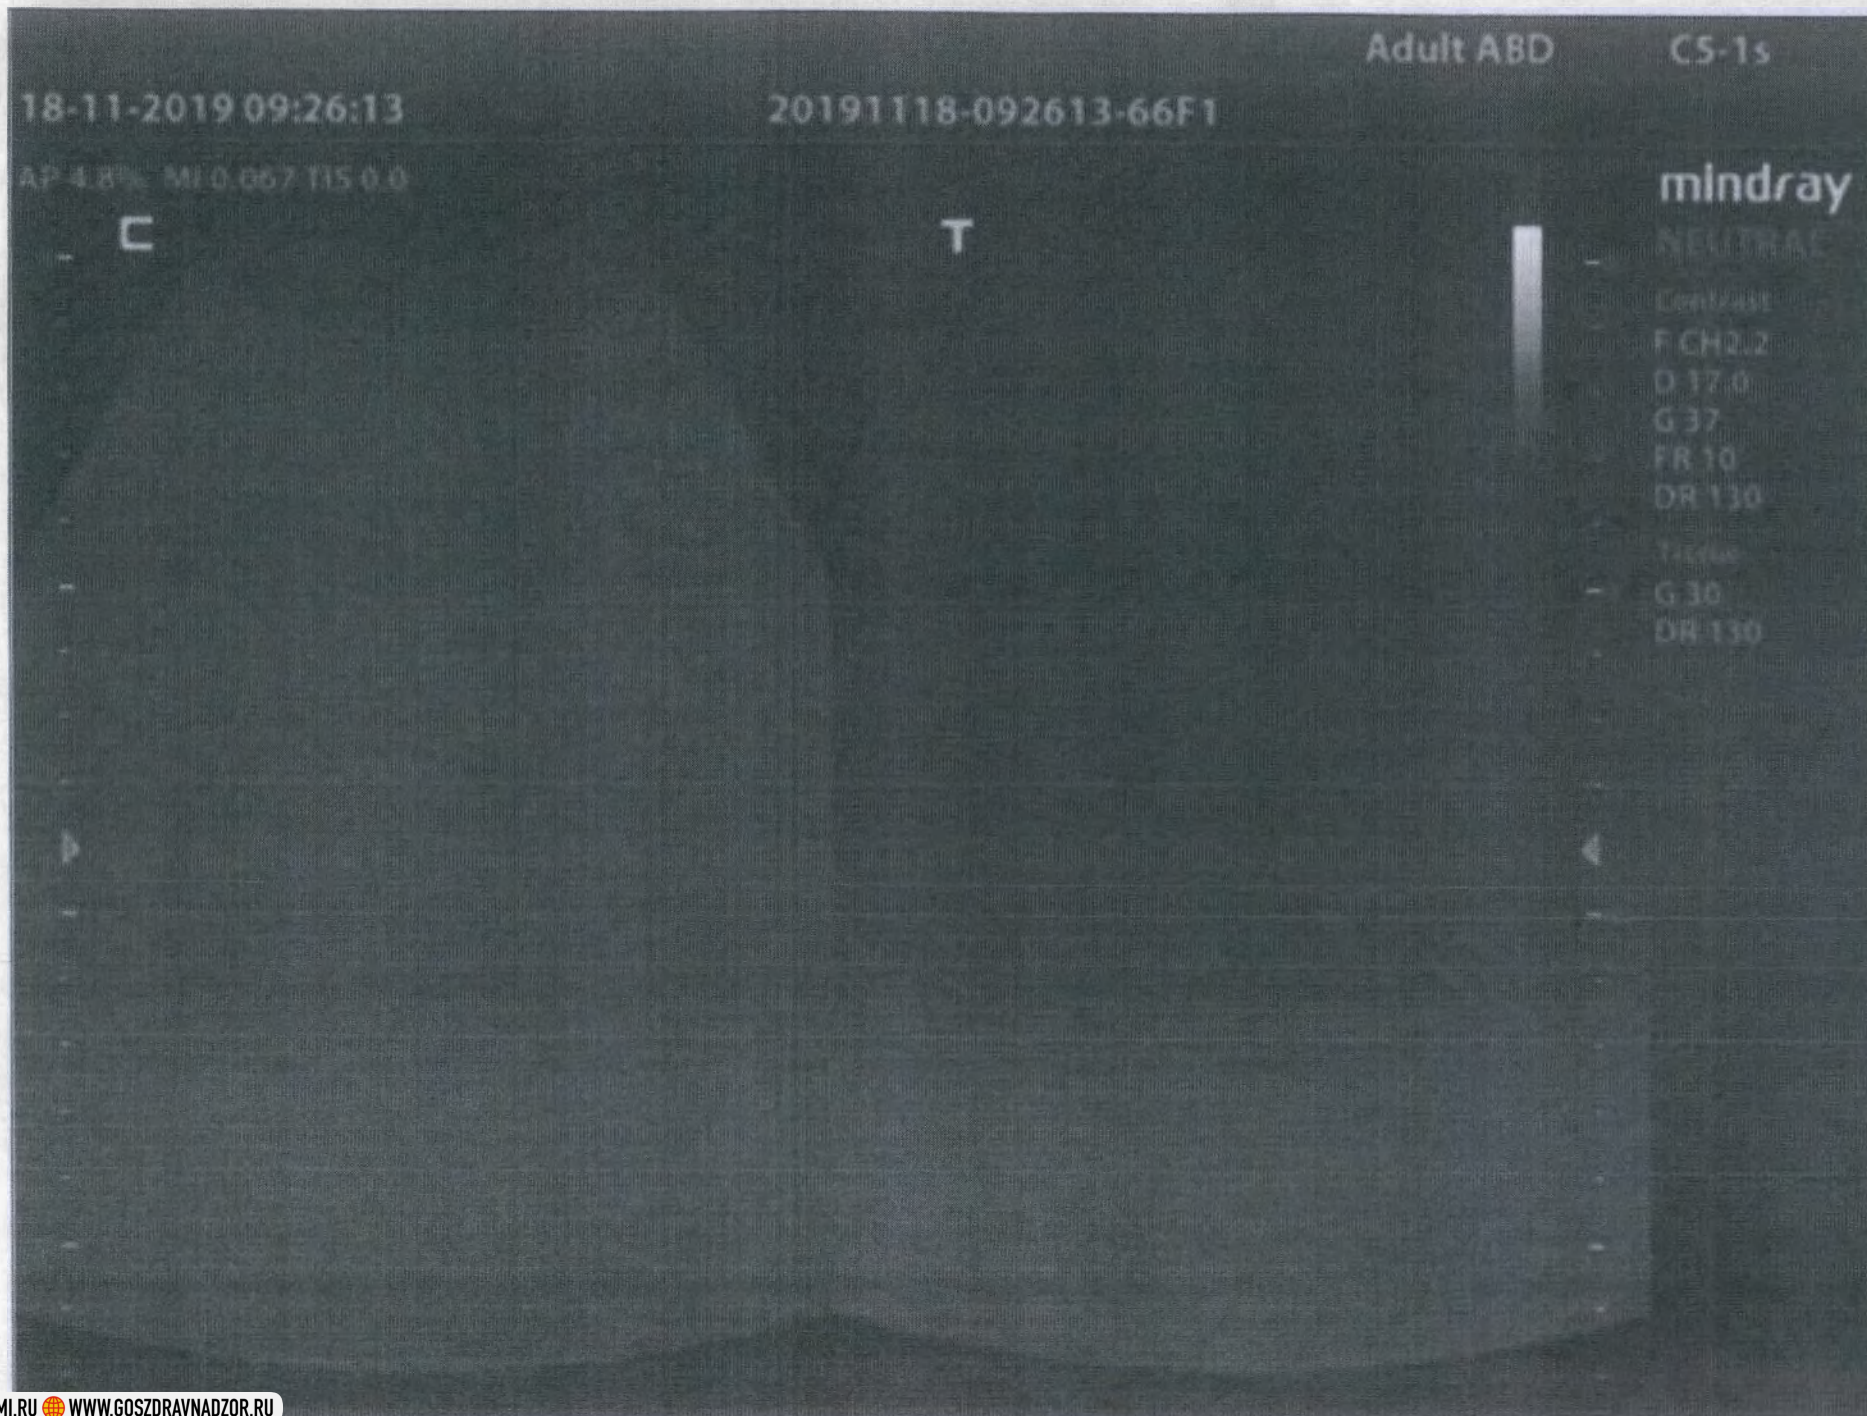


- для количественной оценки при работе в режиме исследований с контрастированием (UWN+Contrast QA) (при необходимости).

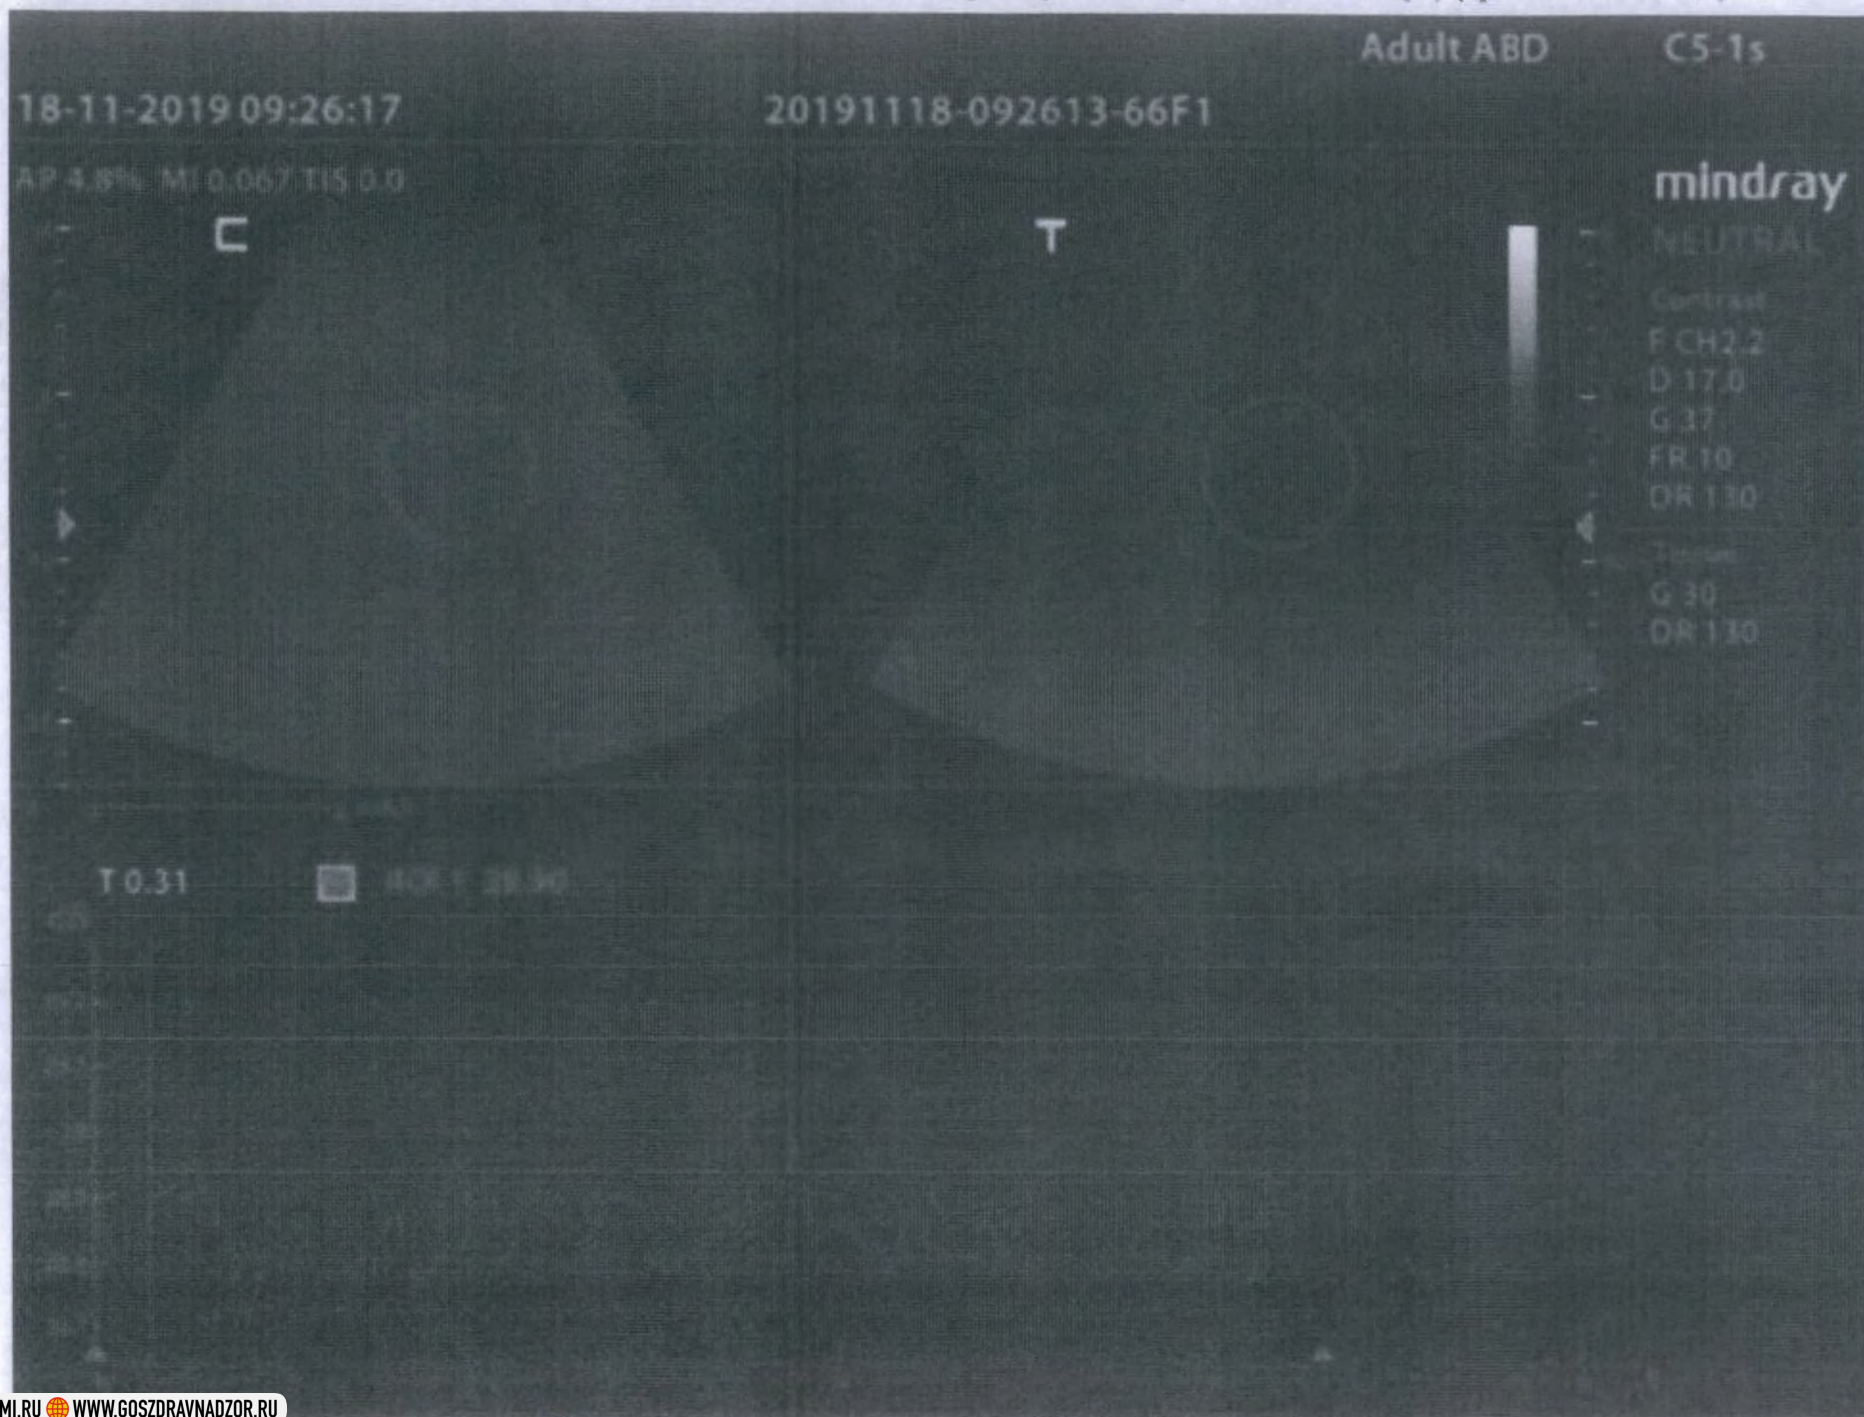

- для исследований ЛДЖ с контрастированием (LVO Contrast) (при необходимости).

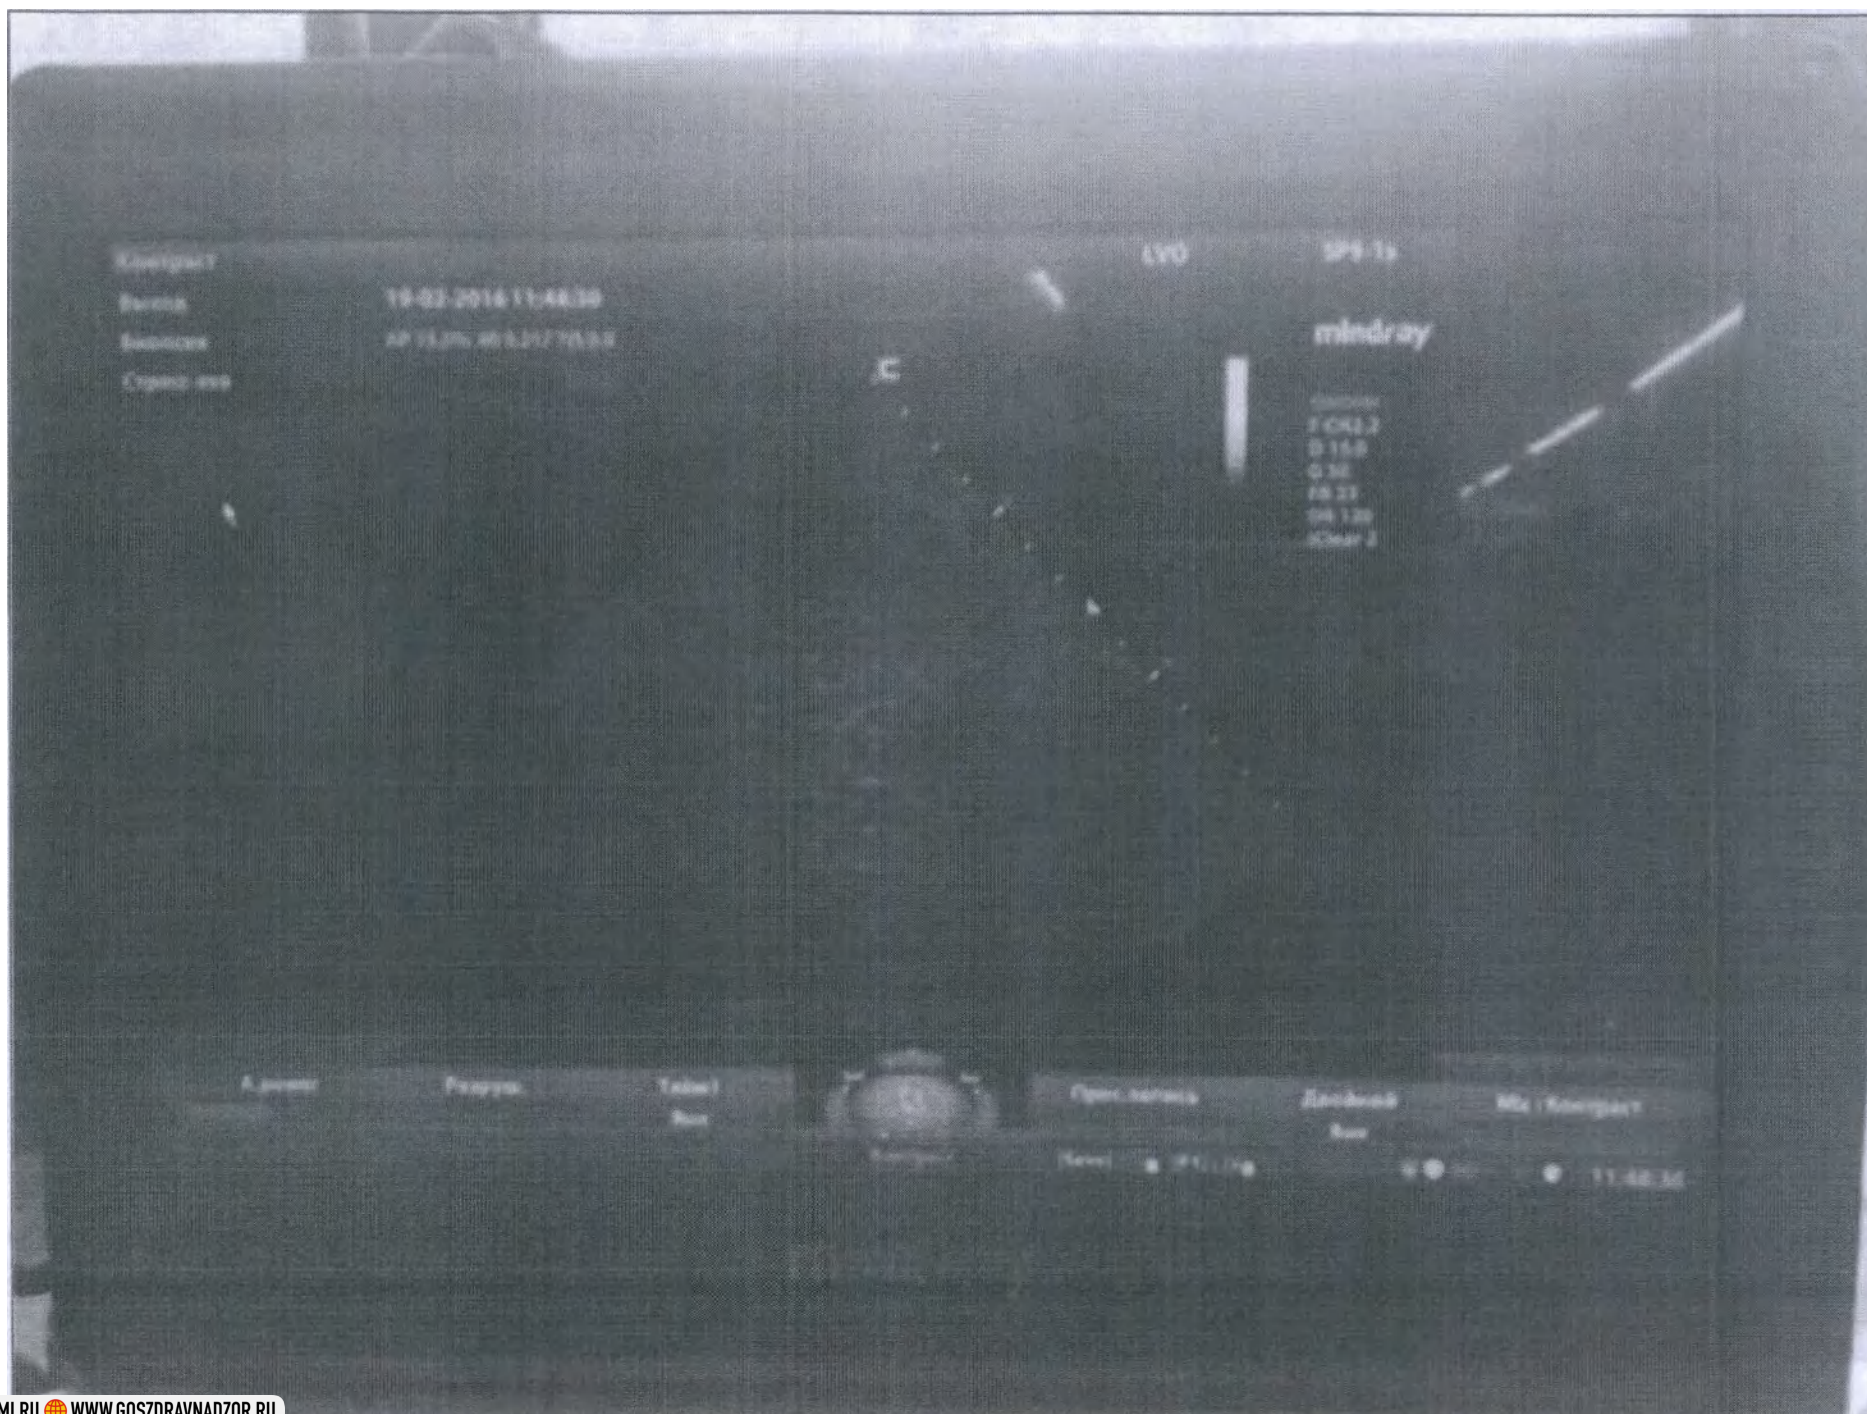


- для автоматического измерения акушерских параметров (Smart OB) (при необходимости).

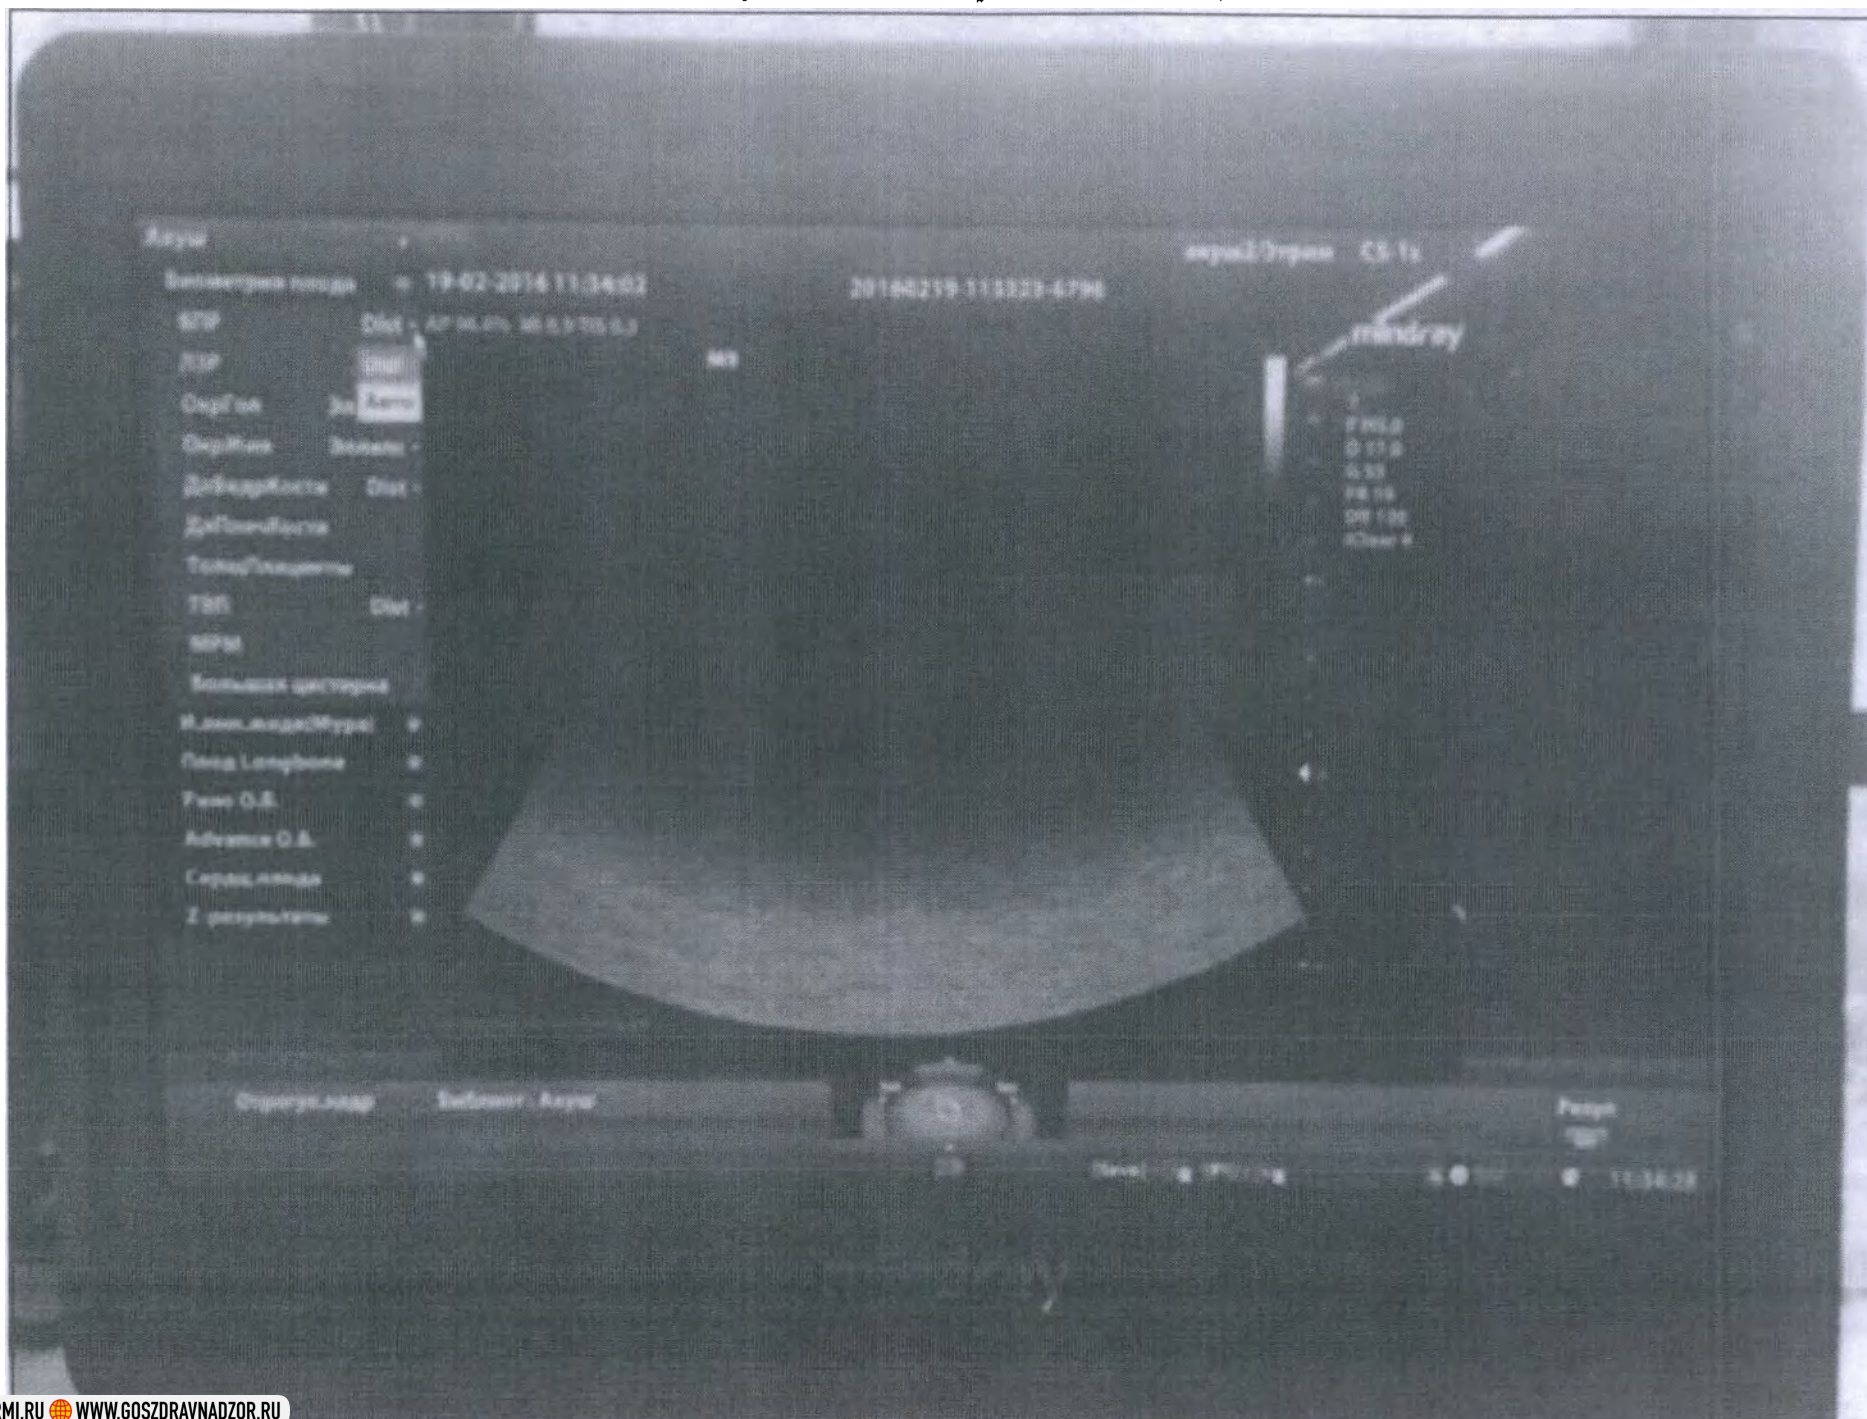





- для построения 3D изображений при помощи 2D датчиков Smart 3D (Freehand 3D) (при необходимости).

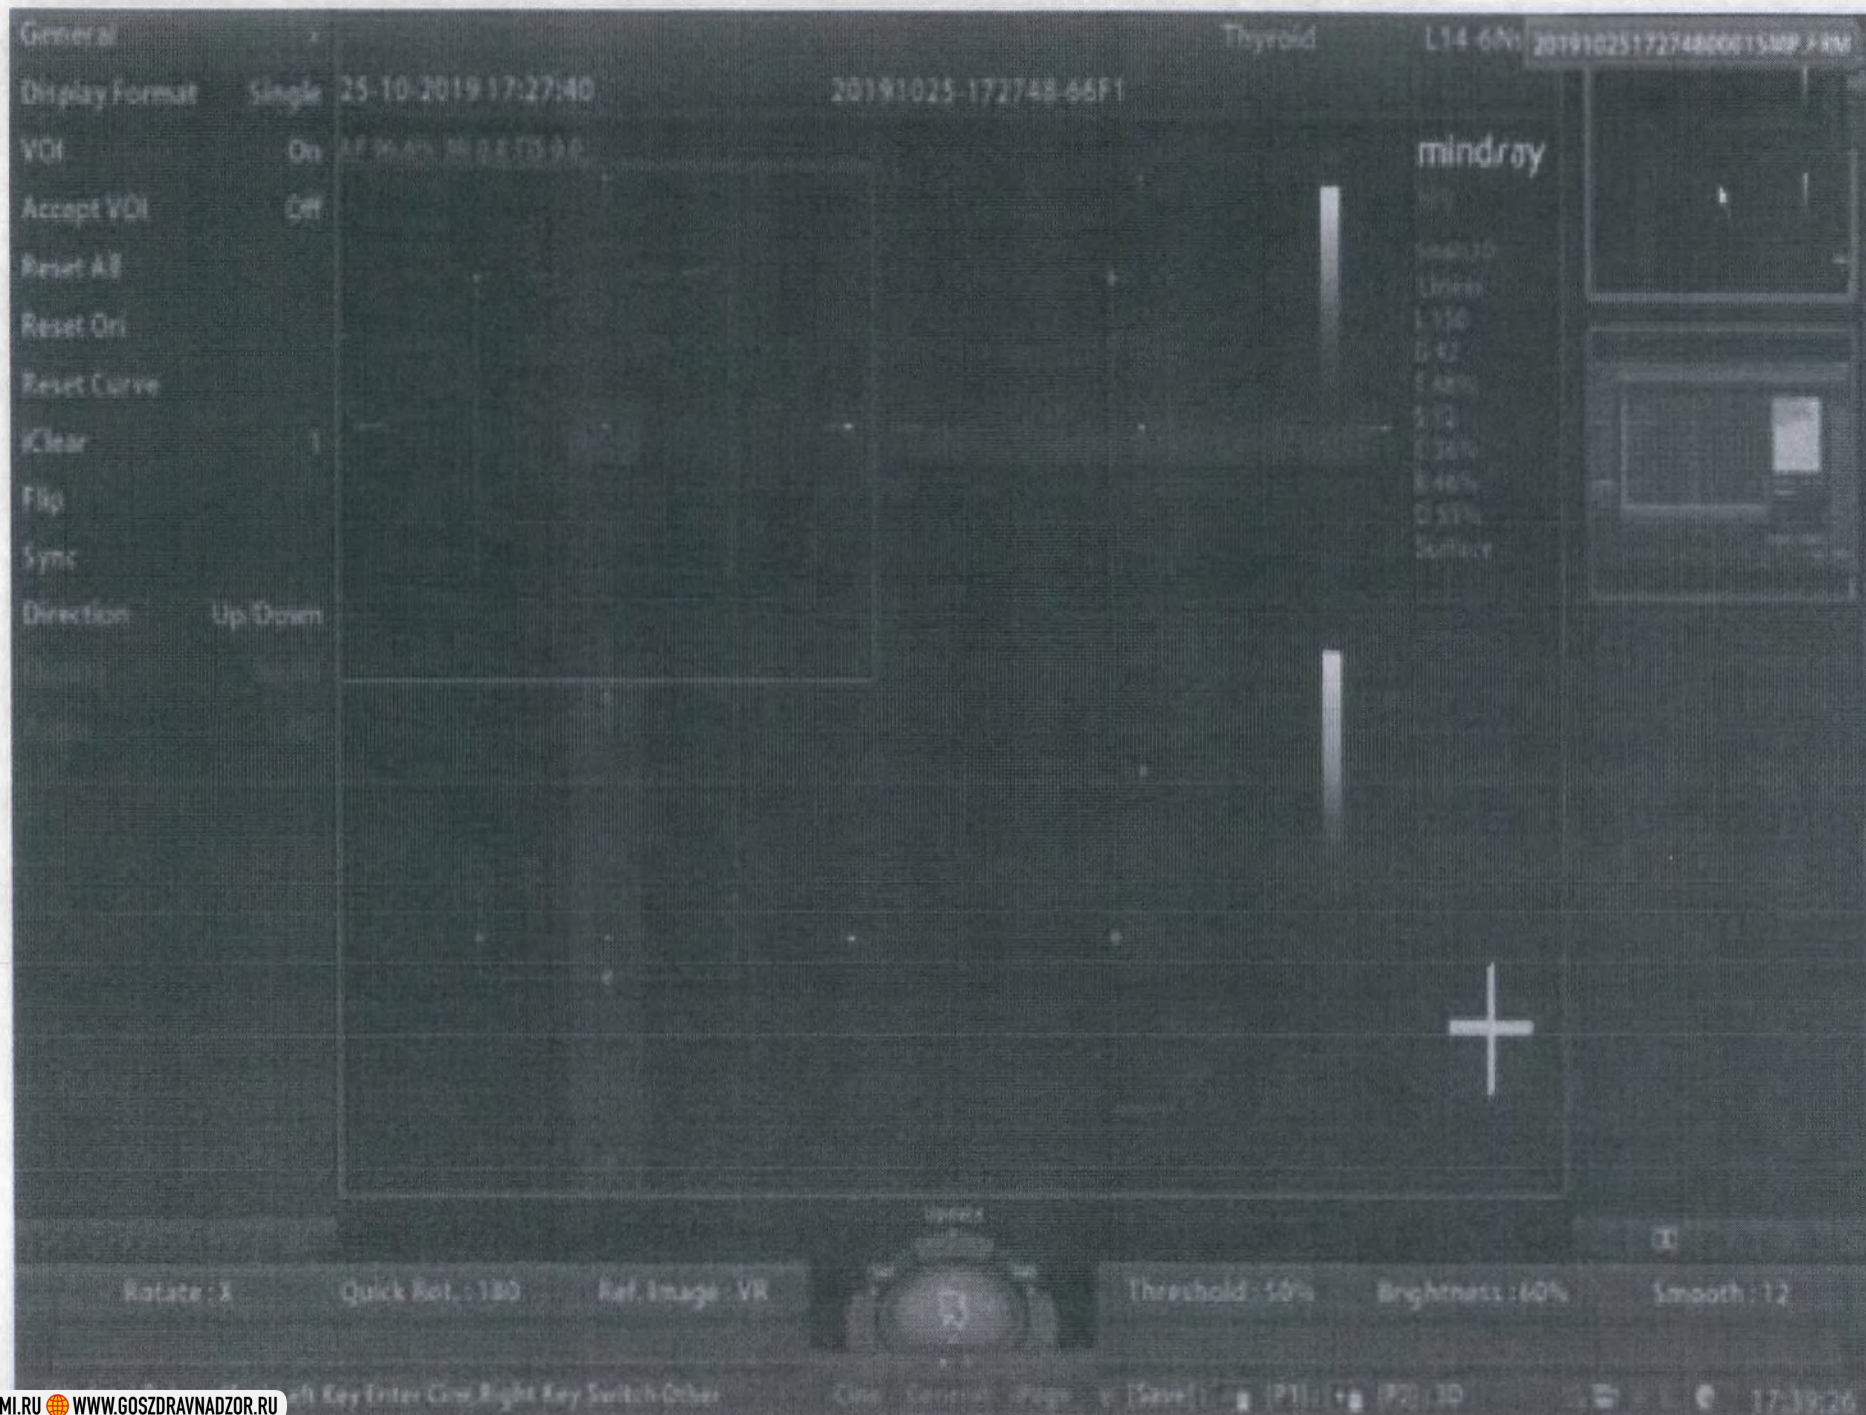


- для получения мультисрезового томографического отображения из объемных данных (iPage) (при необходимости).

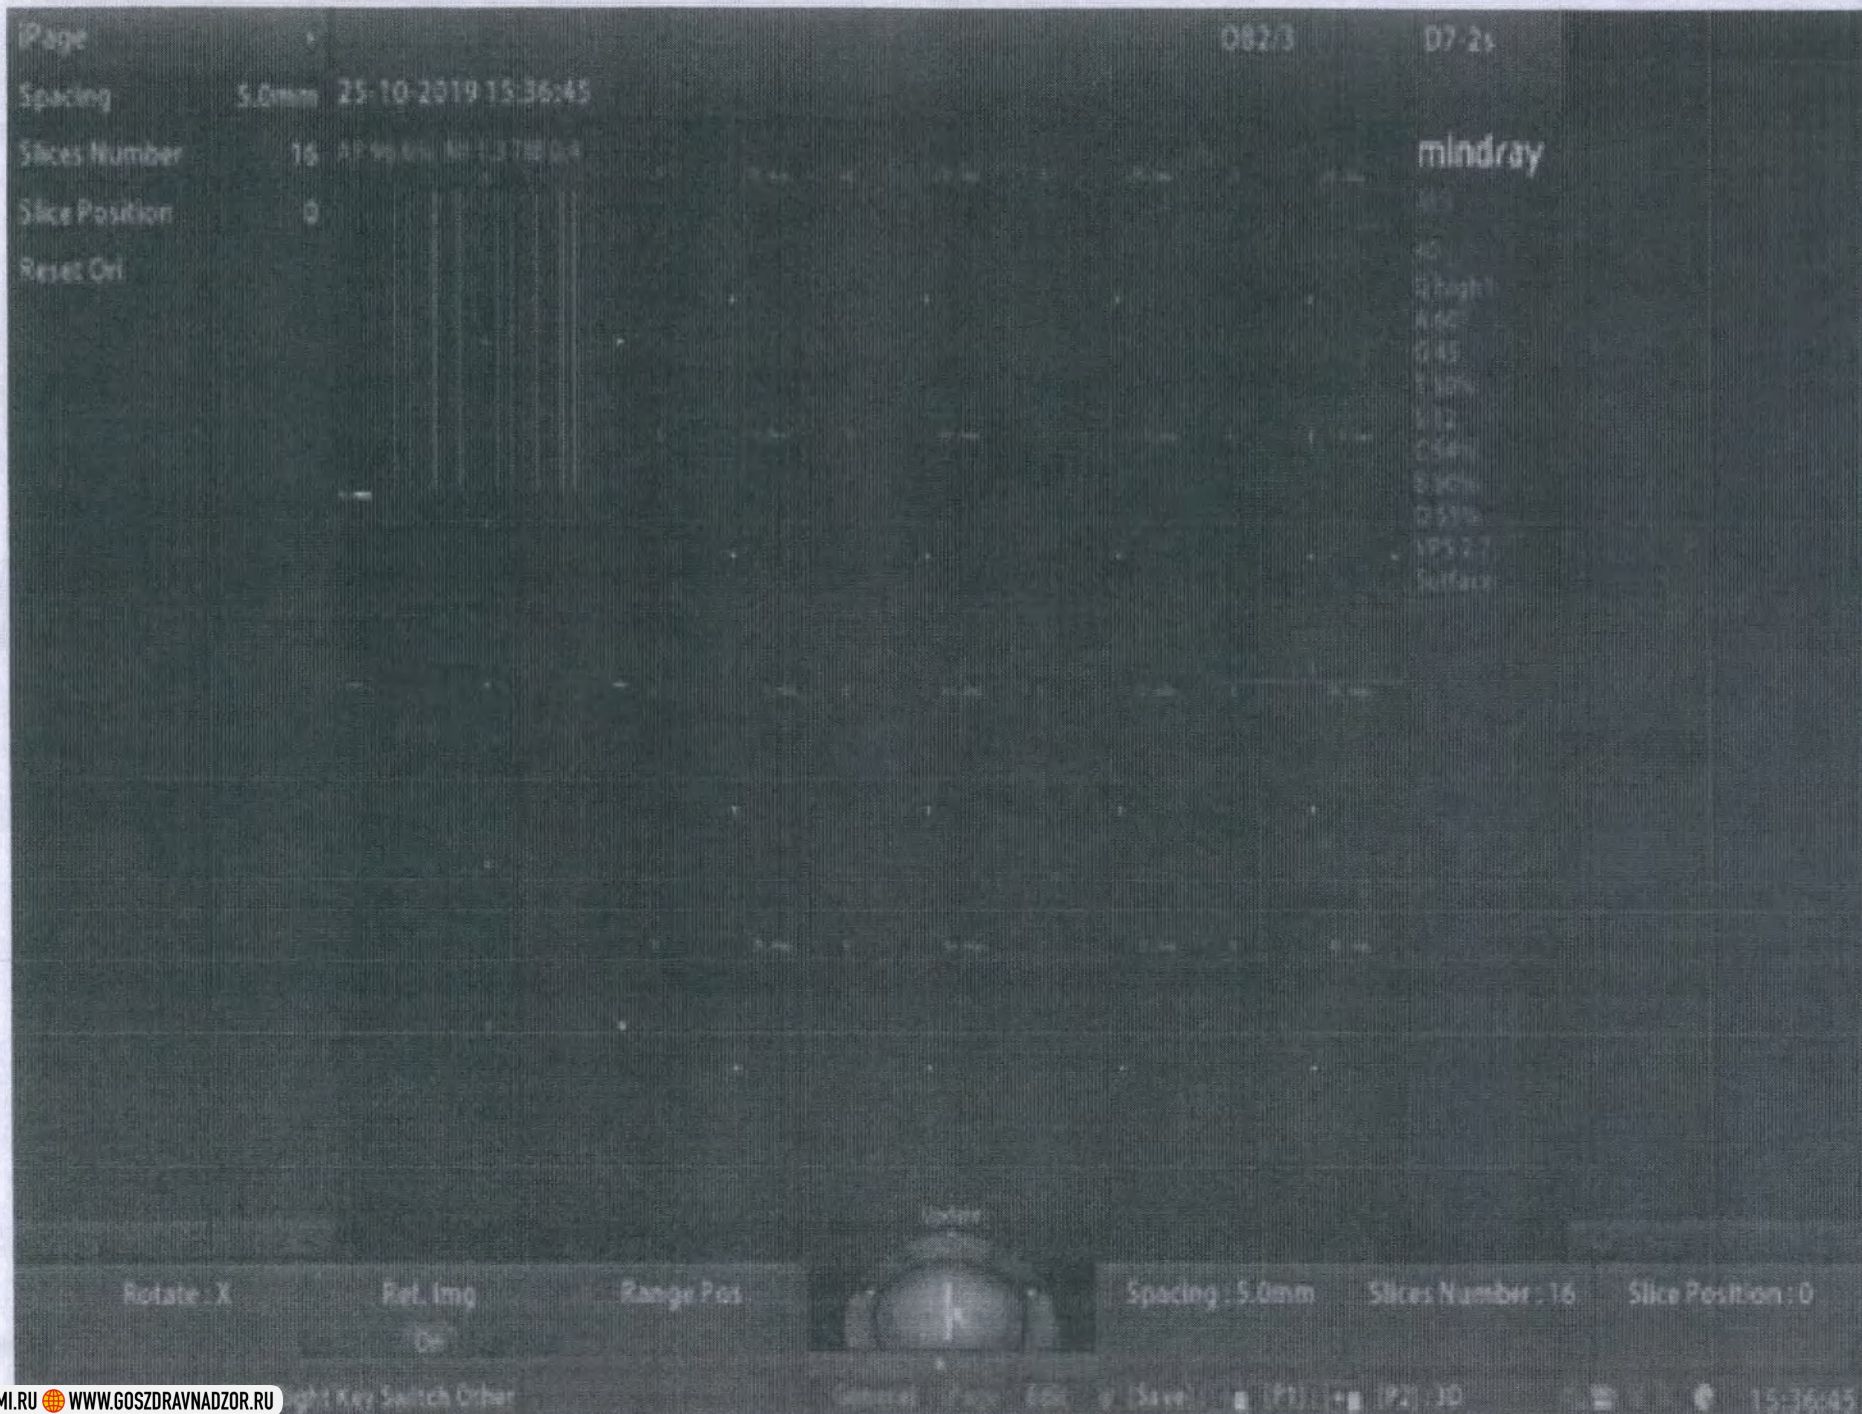


- для автоматического определения размеров и расчета объема структур в объемном изображении (Smart-V) (при необходимости).

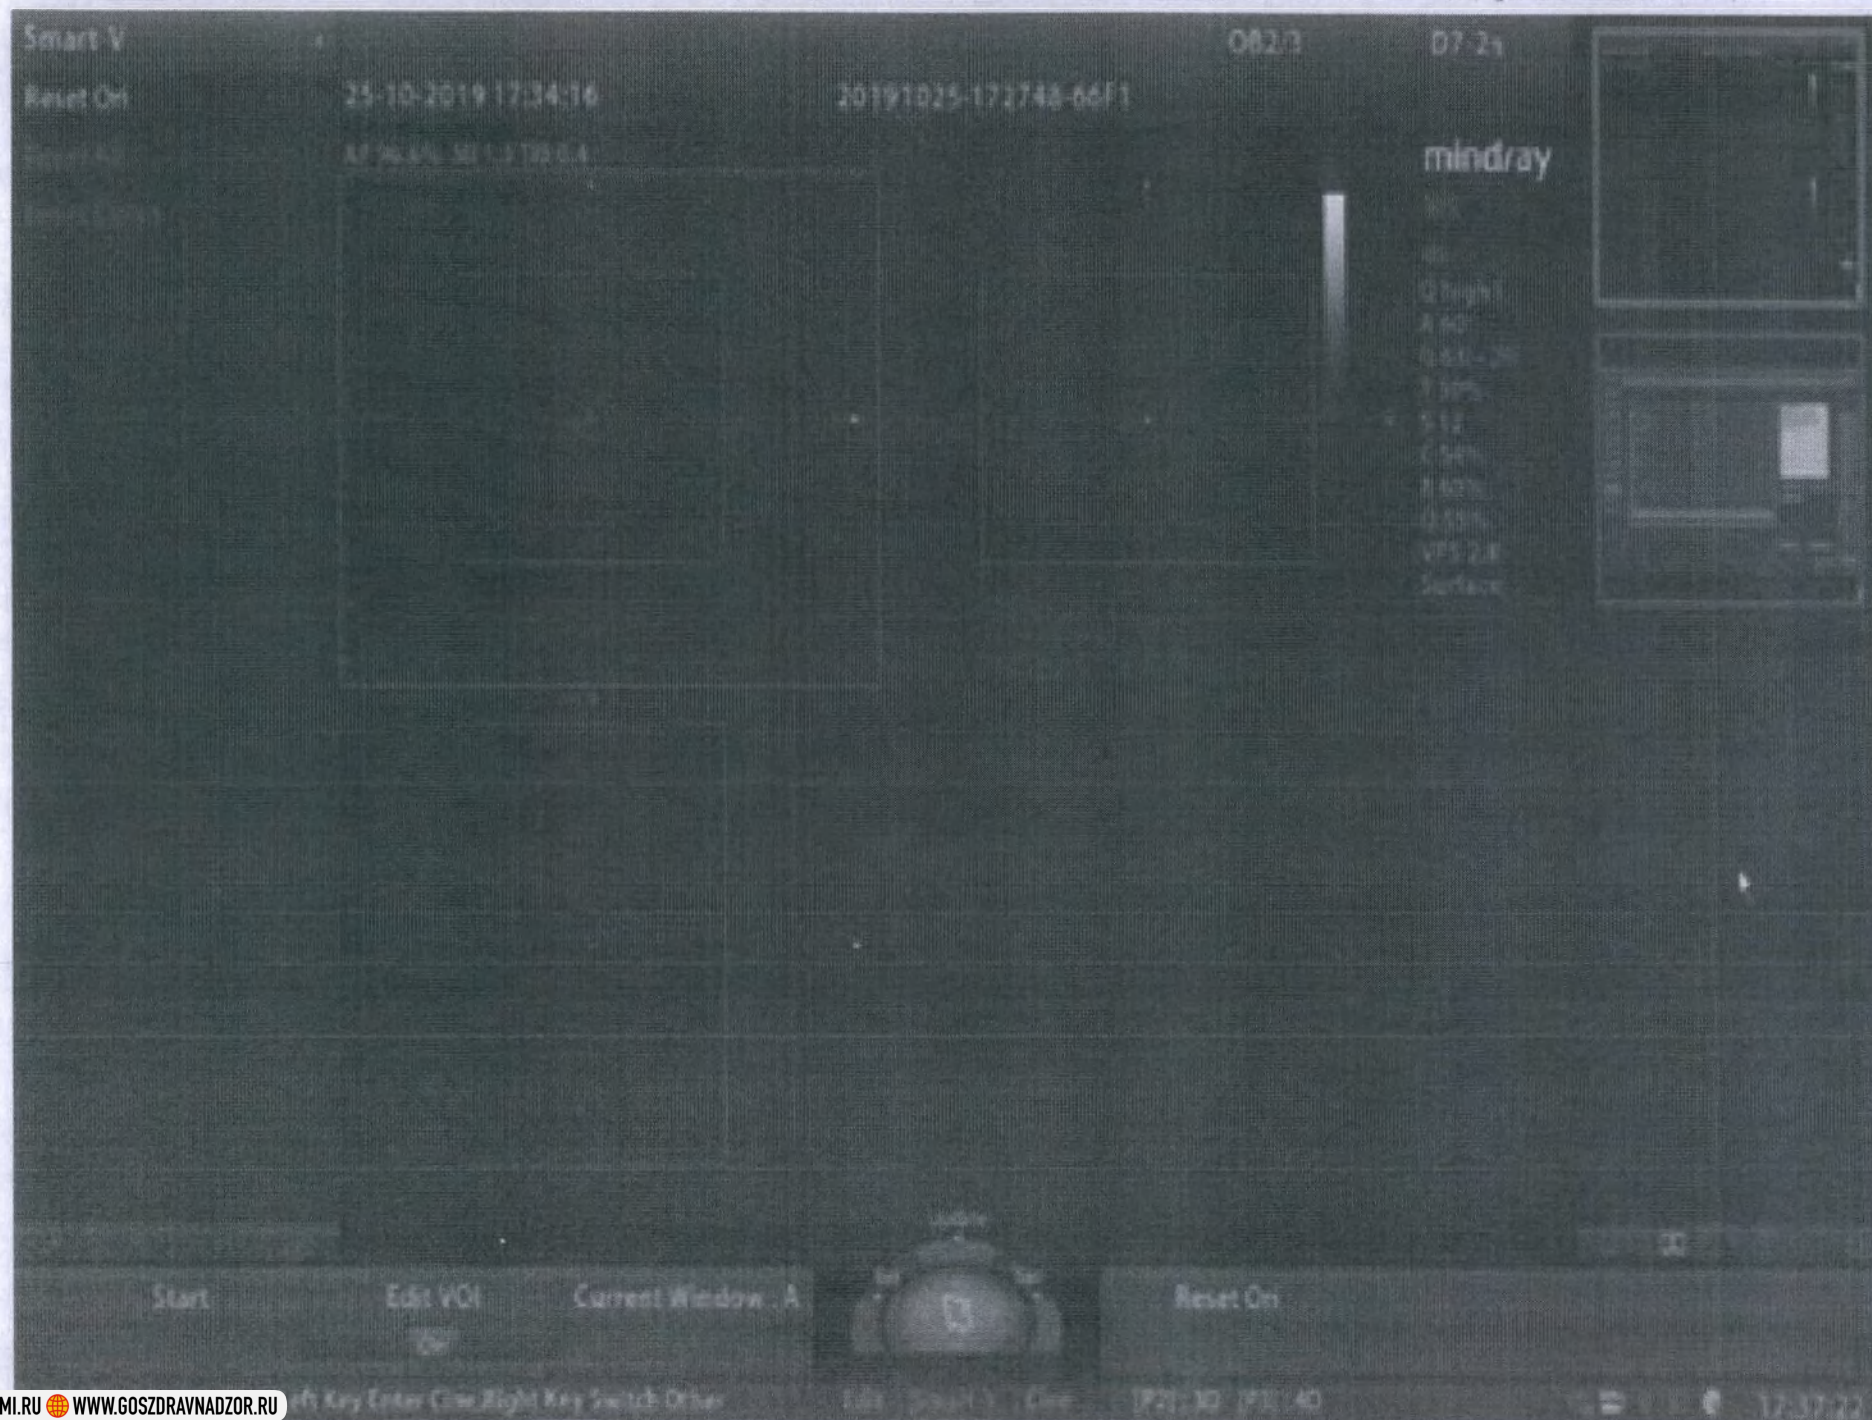


Принадлежности: 1. Дополнительный кабель питания (Power cord), не более 5 шт.

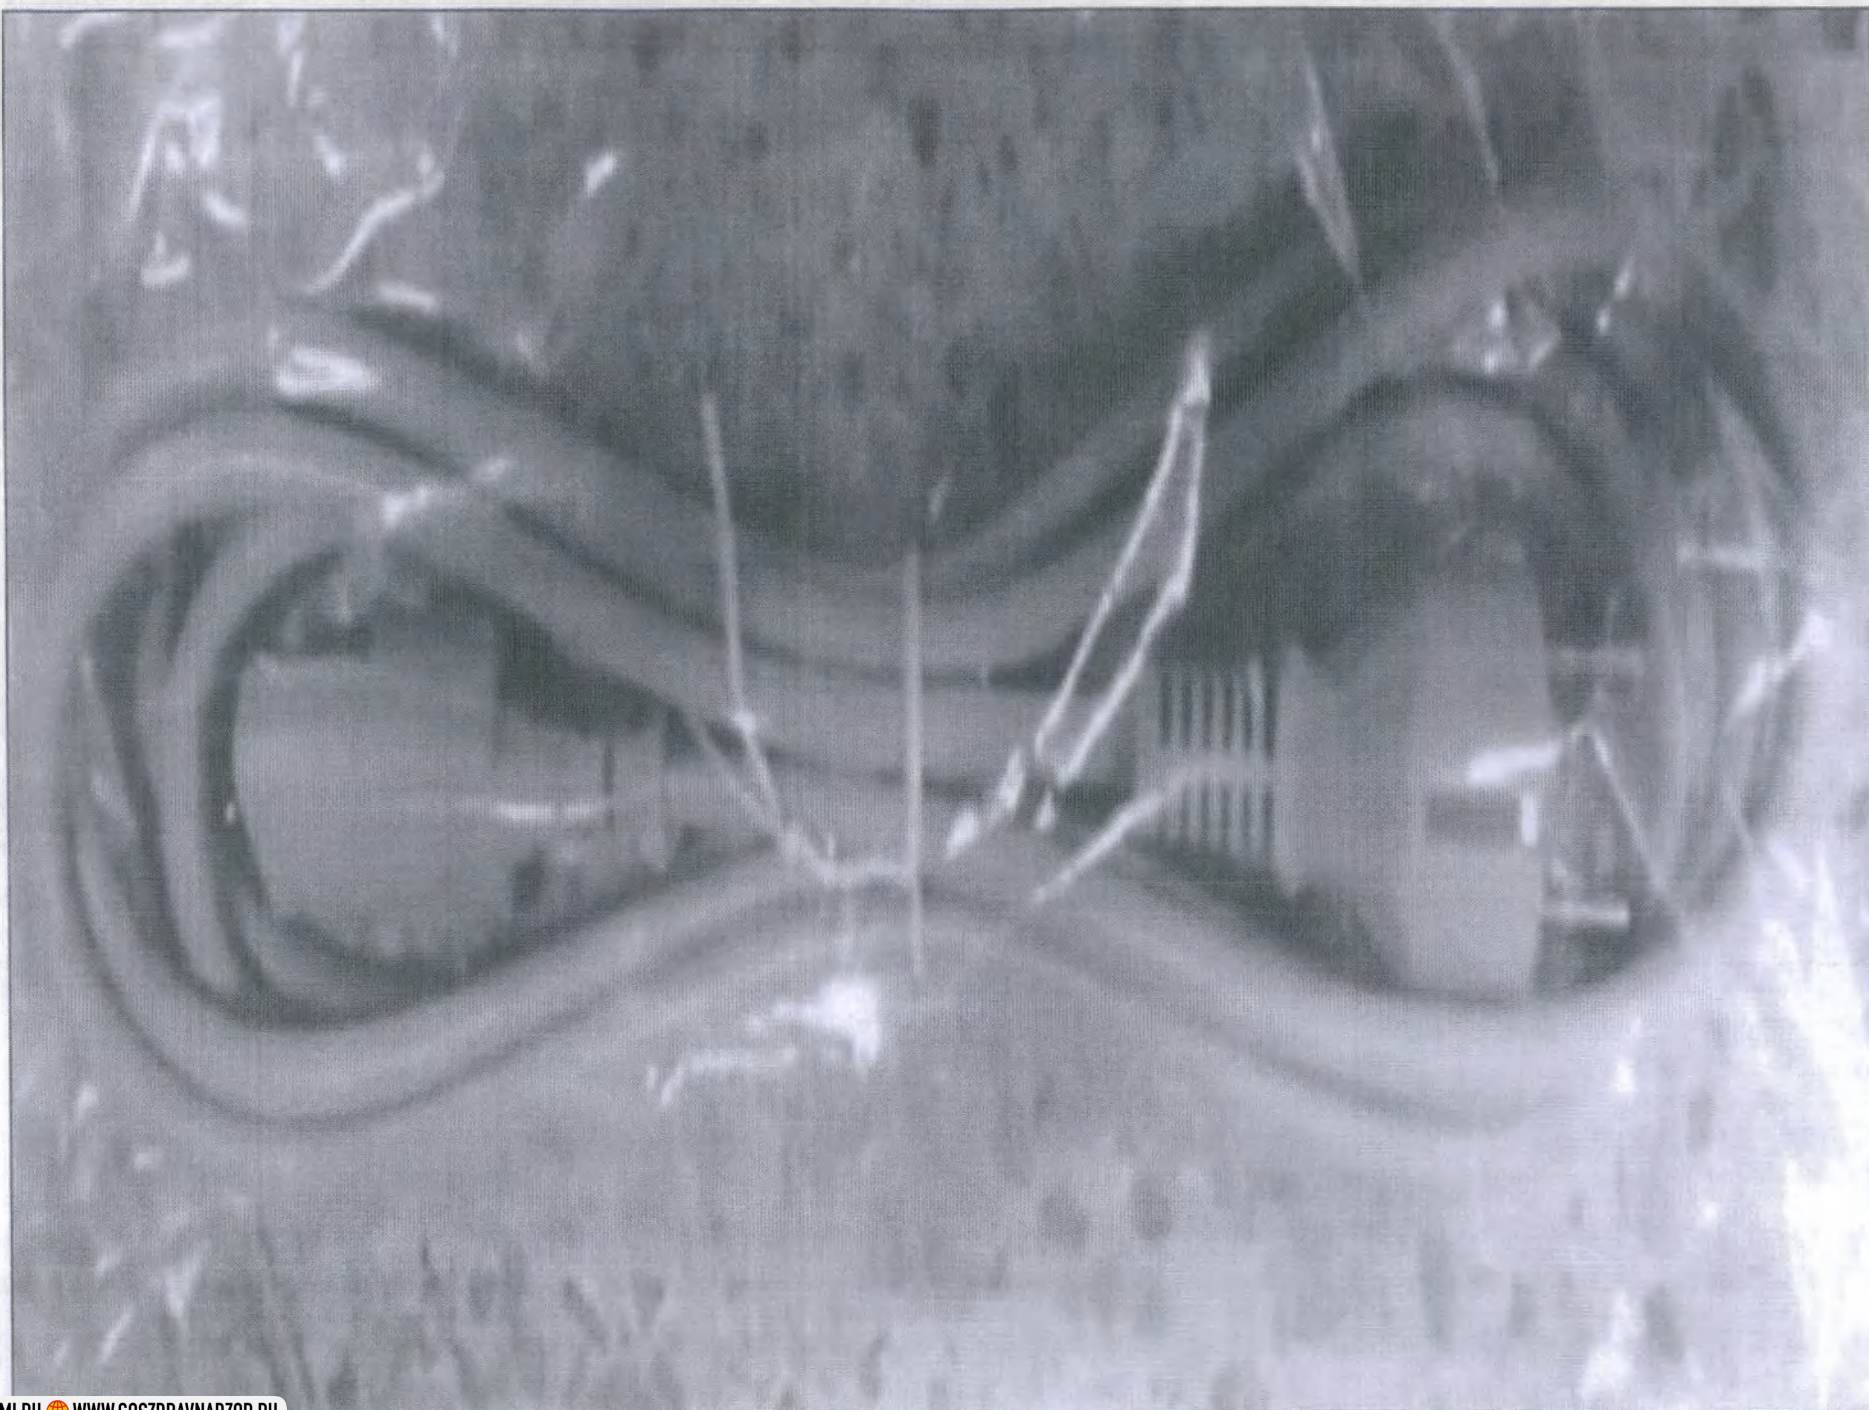


2. Тележка передвижная (Mobile trolley), тип: UMT-500 (Mobile Trolley UMT-500) -1 шт.

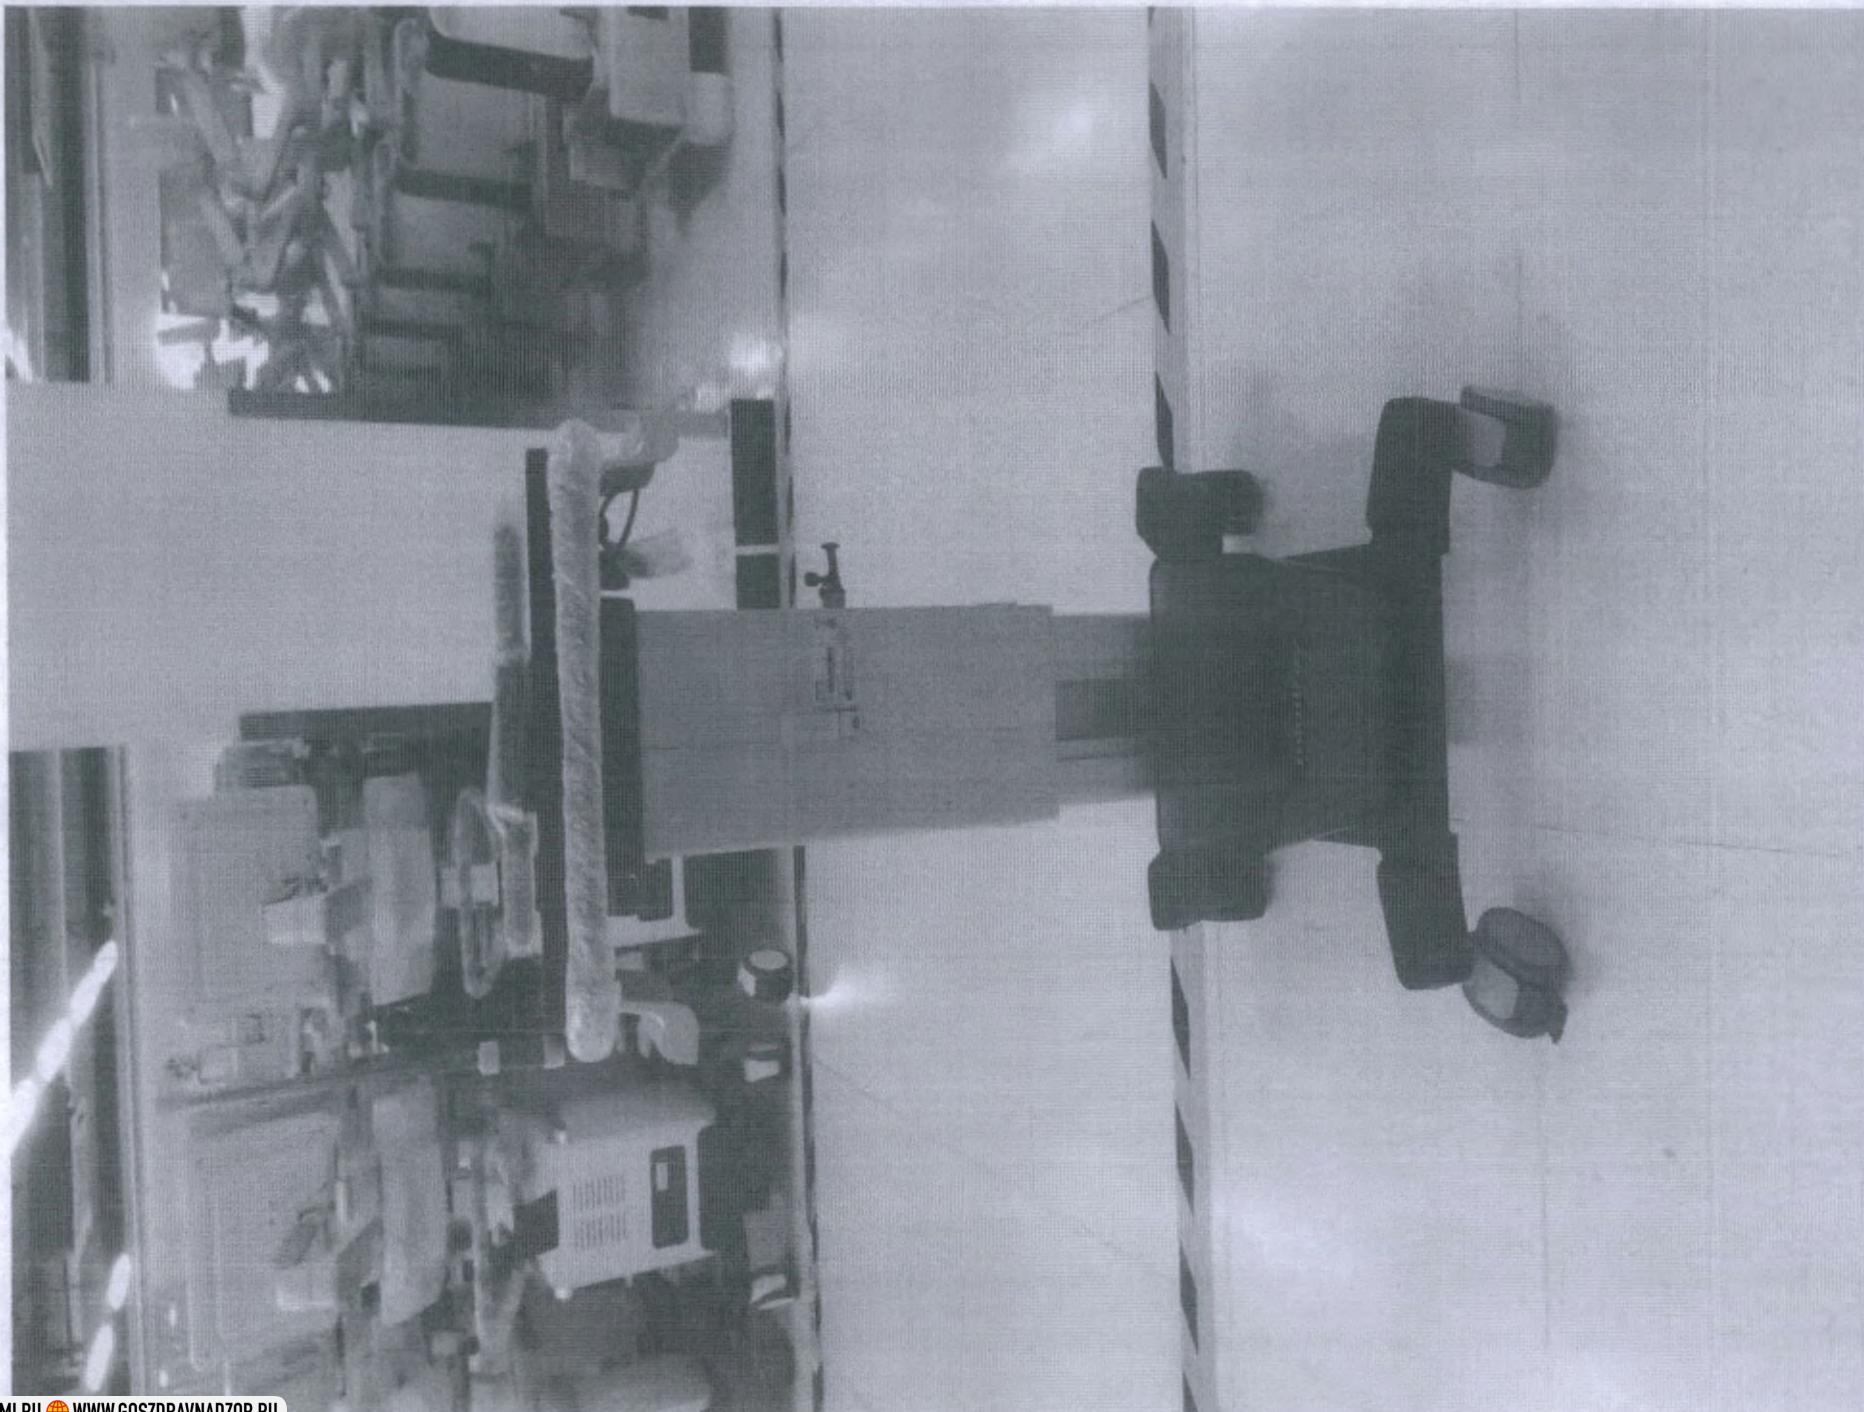

2. Тележка передвижная (Mobile trolley), тип: UMT-500PLUS(Mobile Trolley UMT-500PLUS) -1 шт.

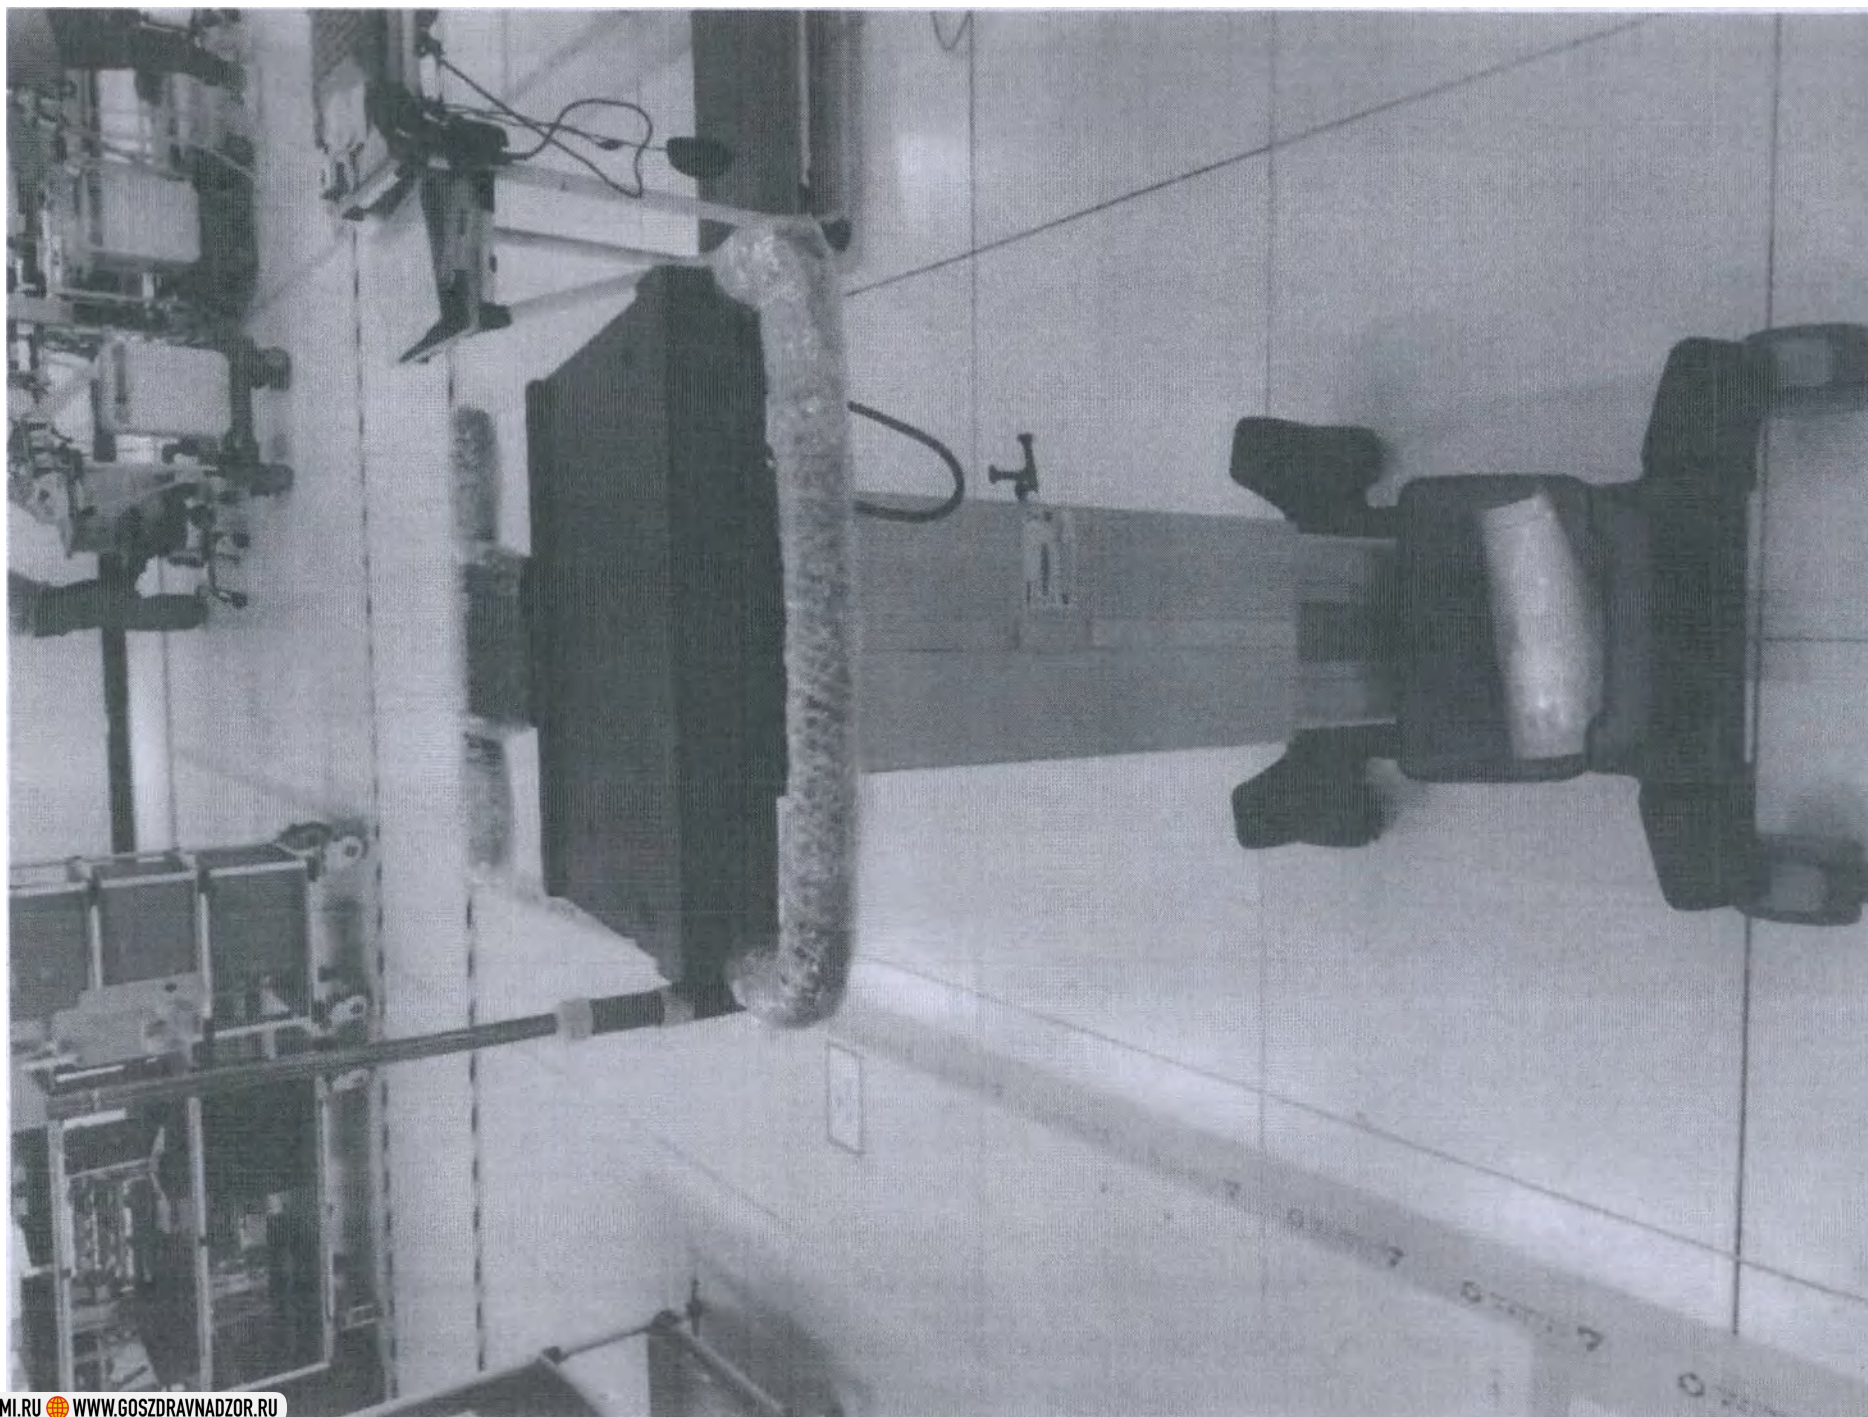


3. Разветвитель на три порта для датчиков (Transducer extension module for triple transducer connection, PEM-51) – 1 шт.

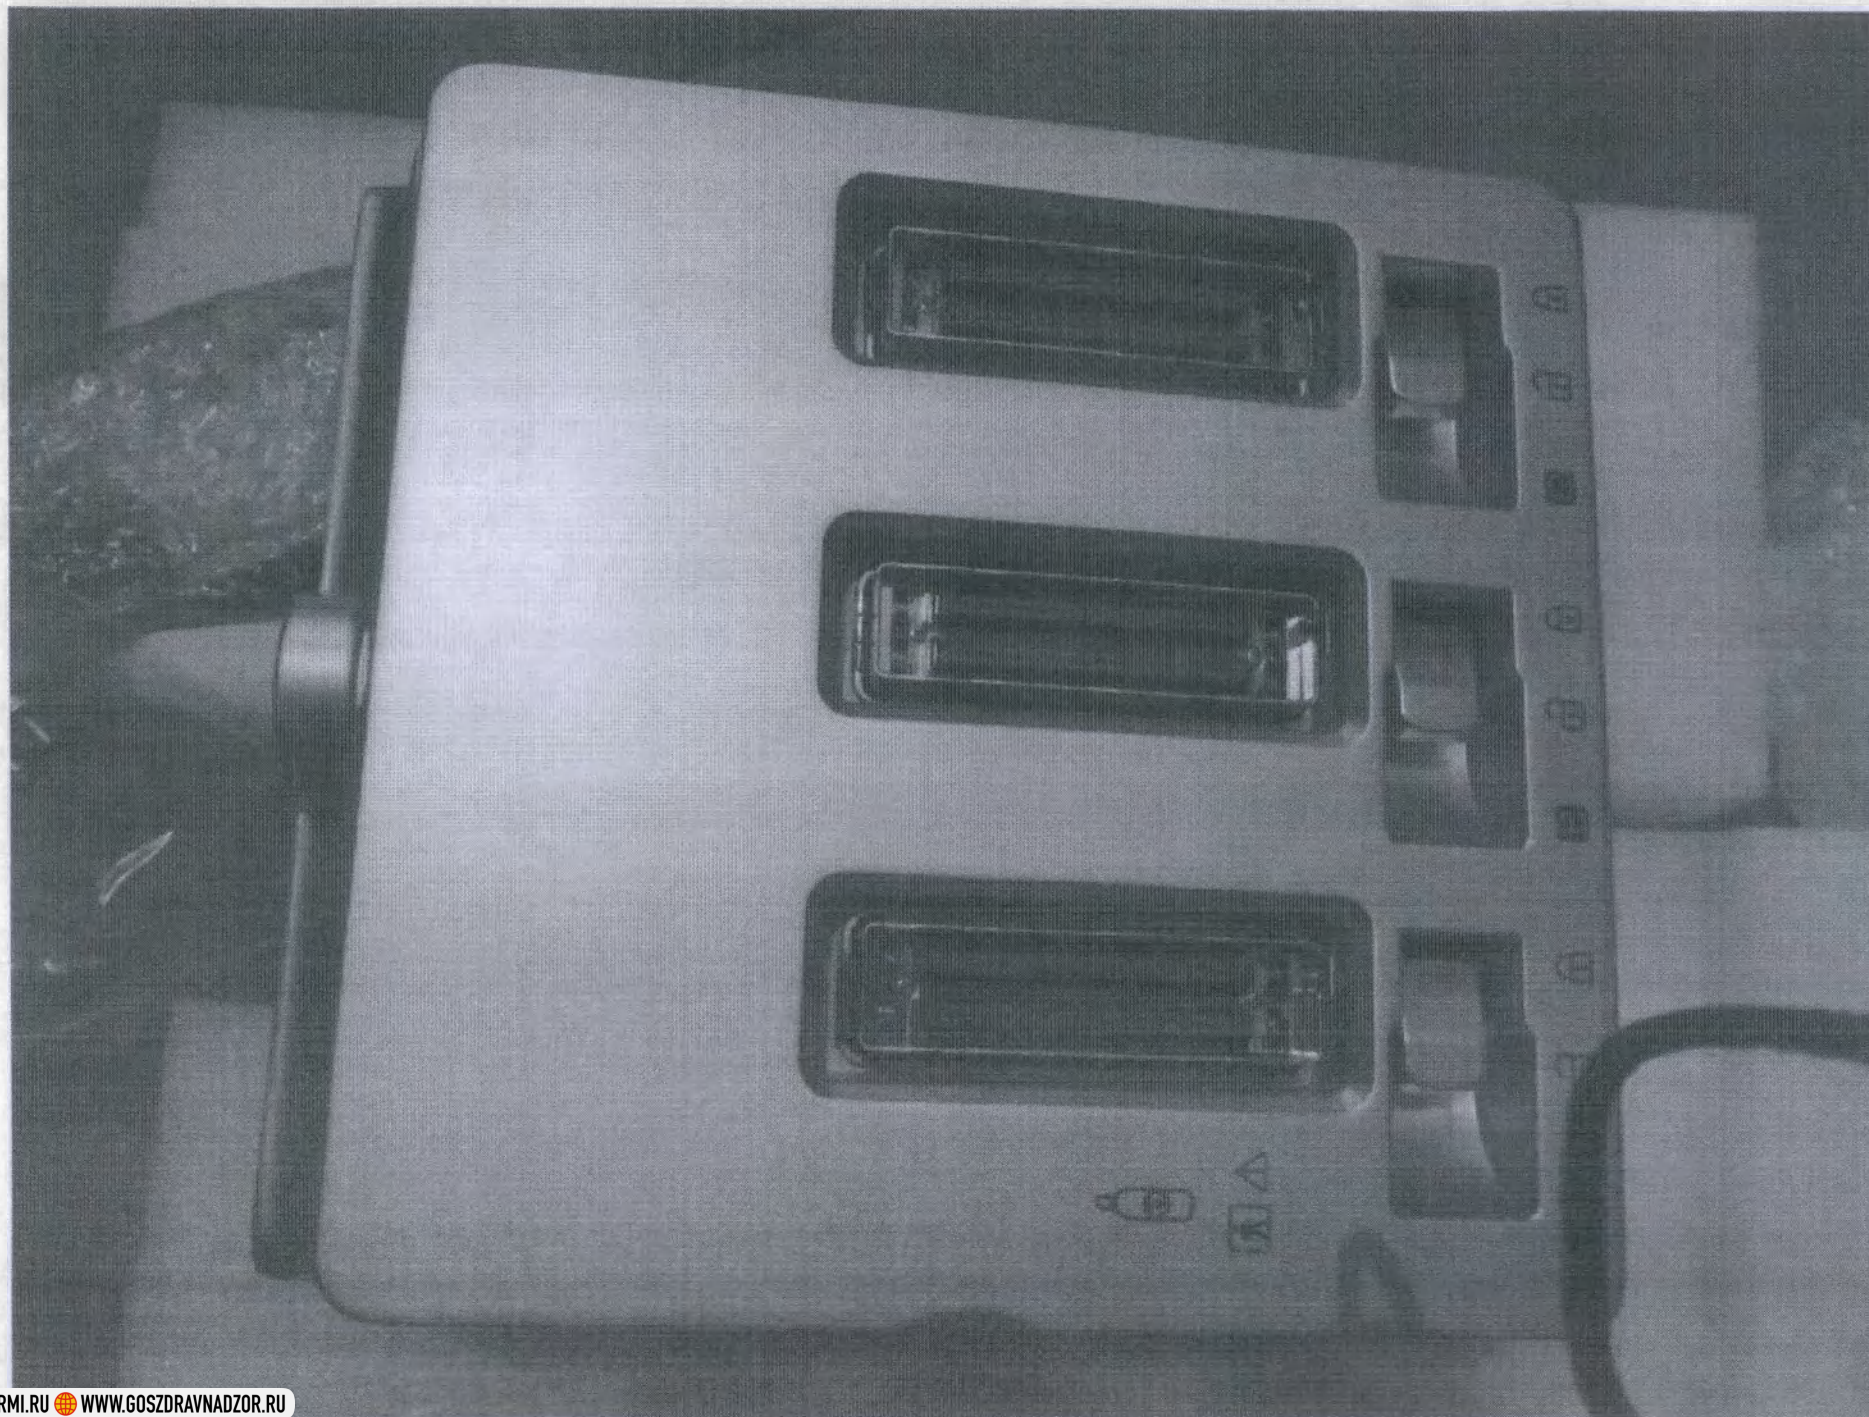


4. Док-станция с набором портов для подключения внешних устройств (IOM-51, iDock) – 1 шт.




5. Дополнительная батарея (Rechargeable battery), не более 5 шт.

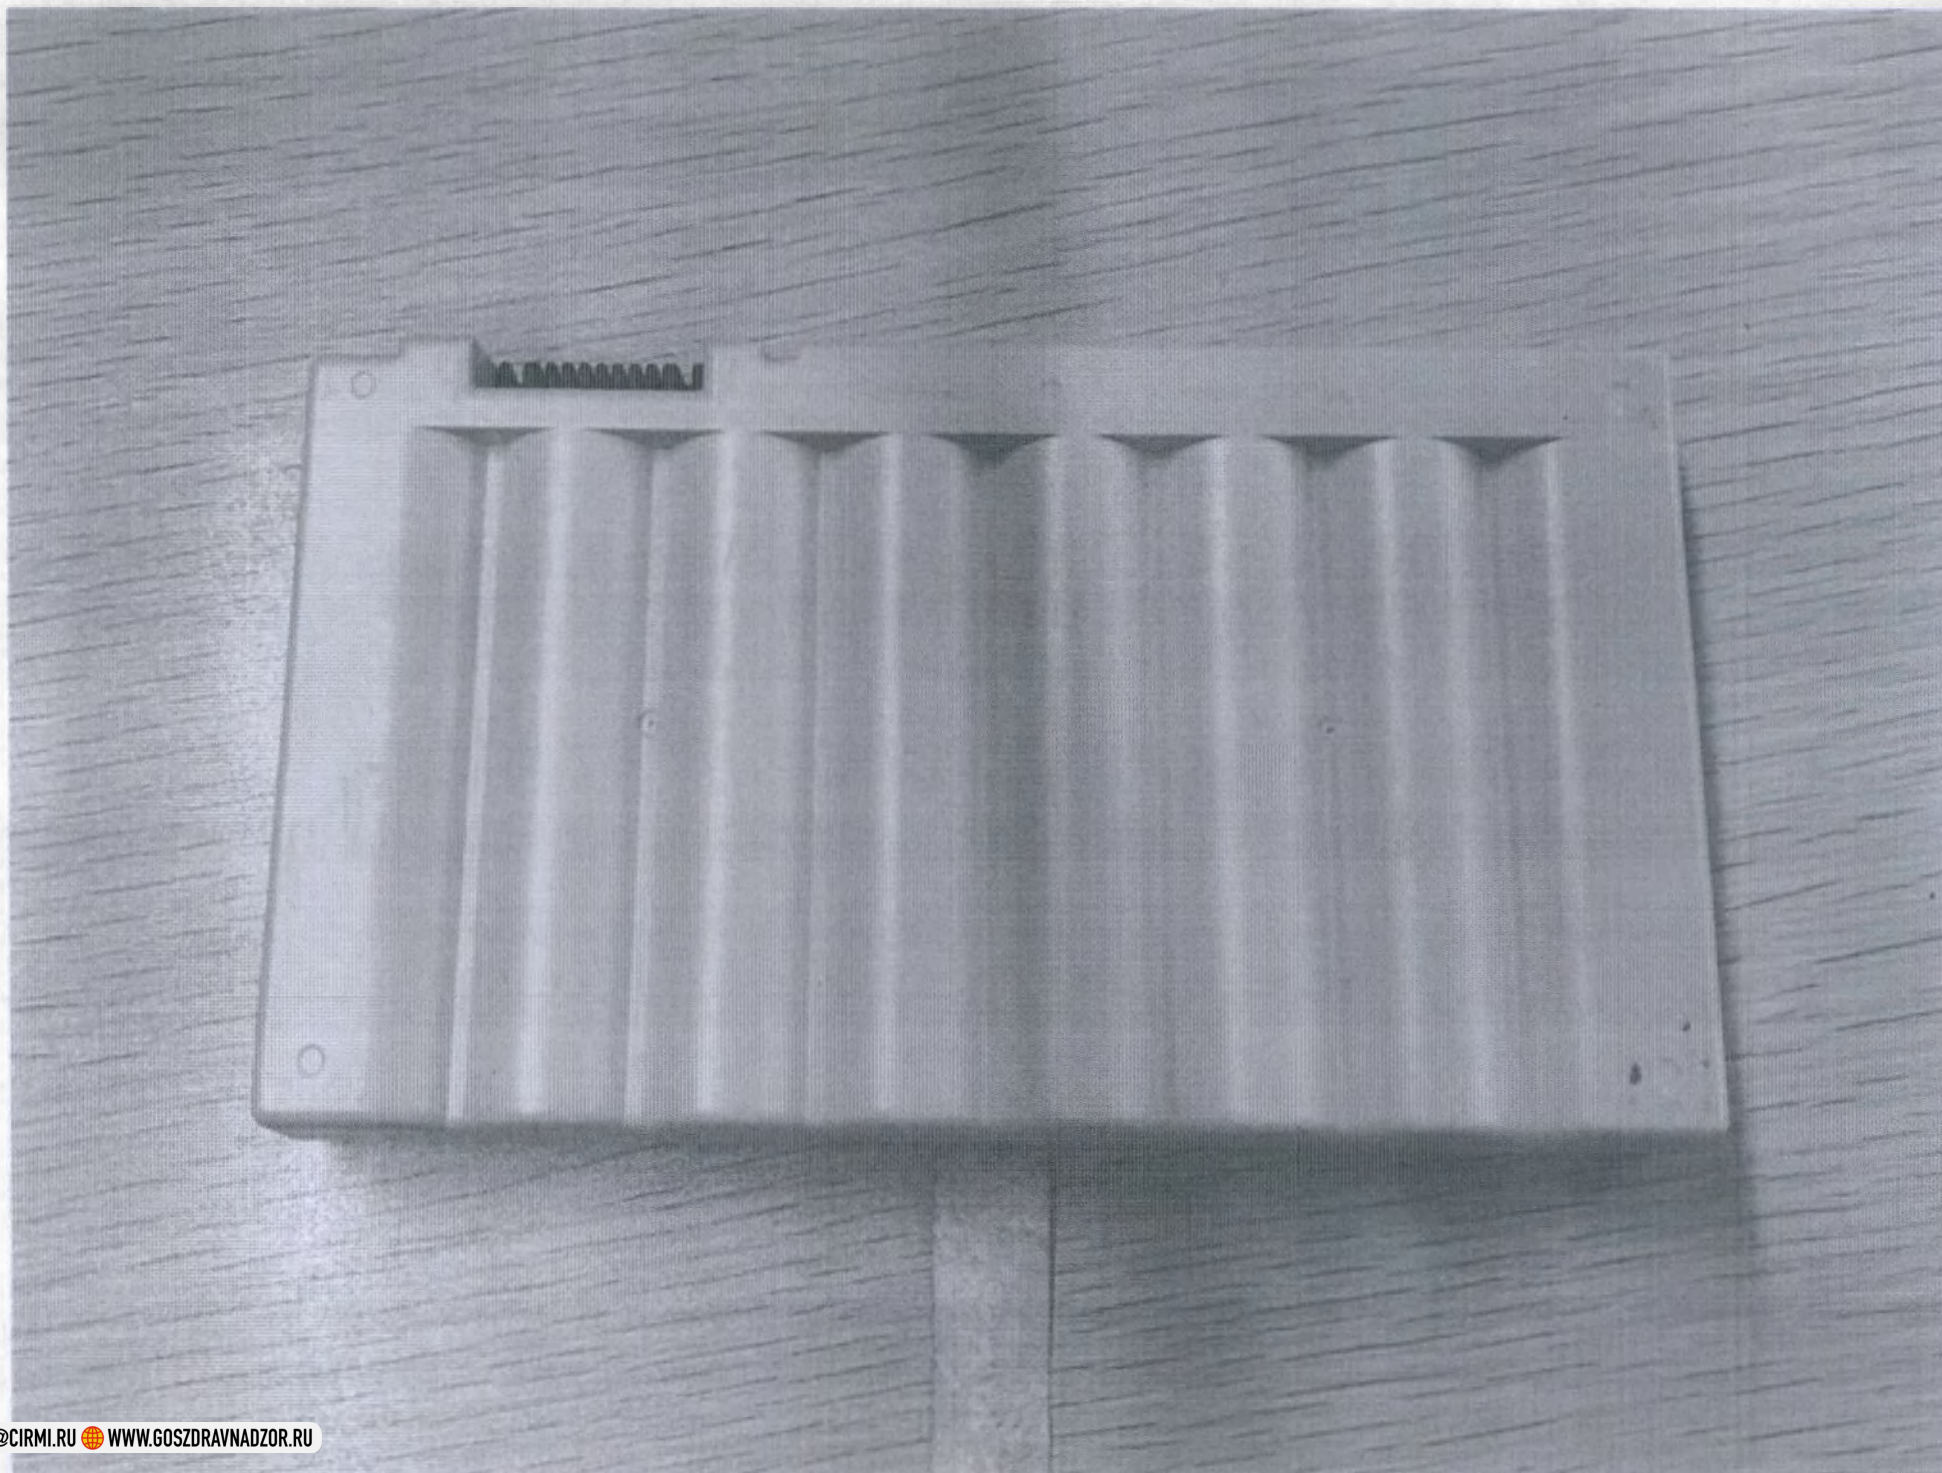


6. Чехол для клавиатуры (Keyboard Cover), не более 5 шт.

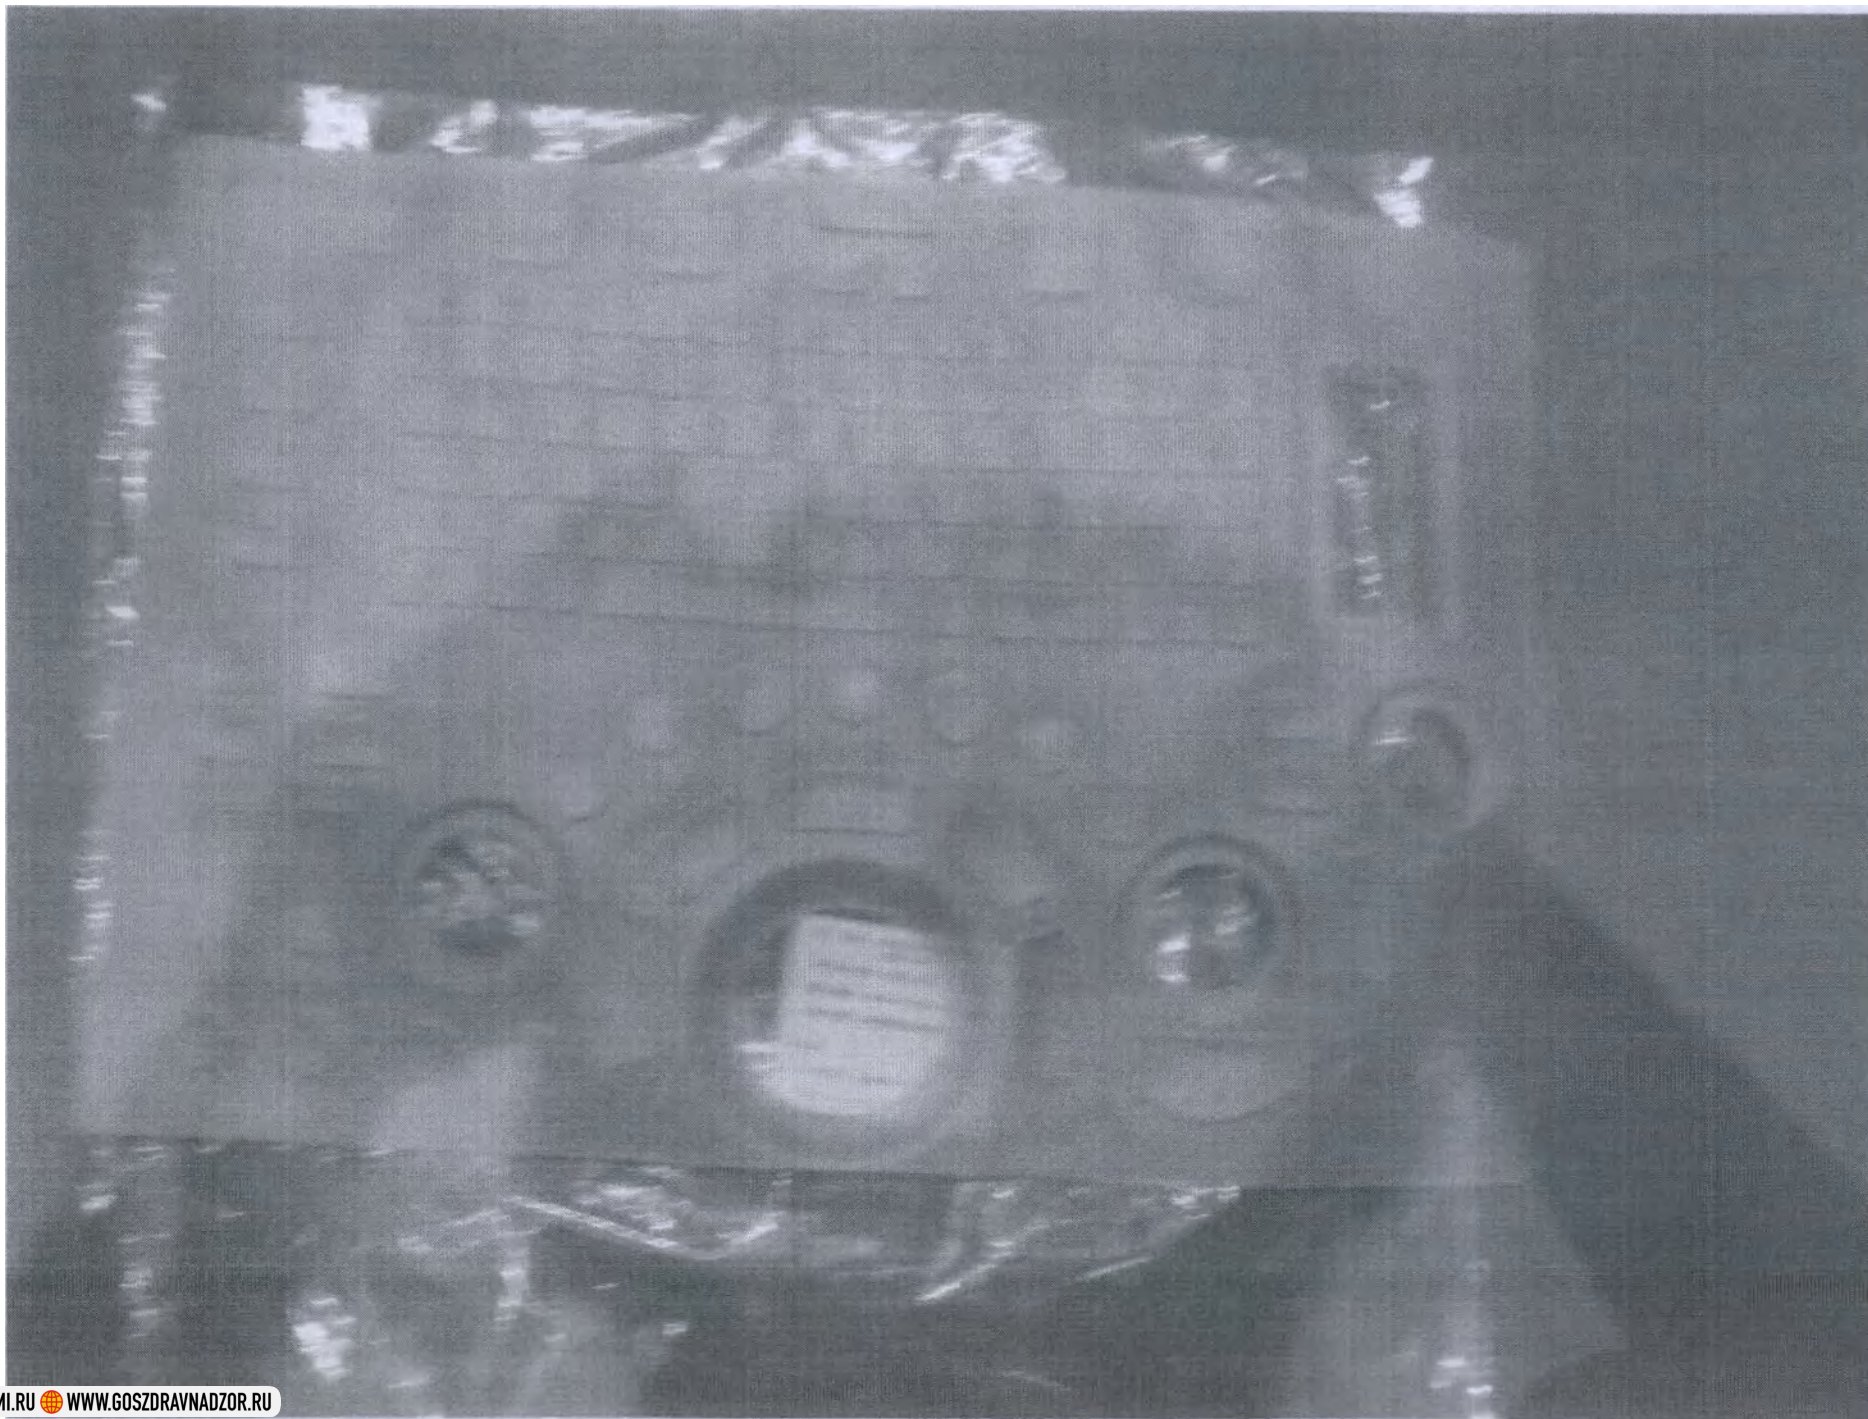


7. Внешнее записывающее DVD-устройство (DVD-RW) -1 шт.

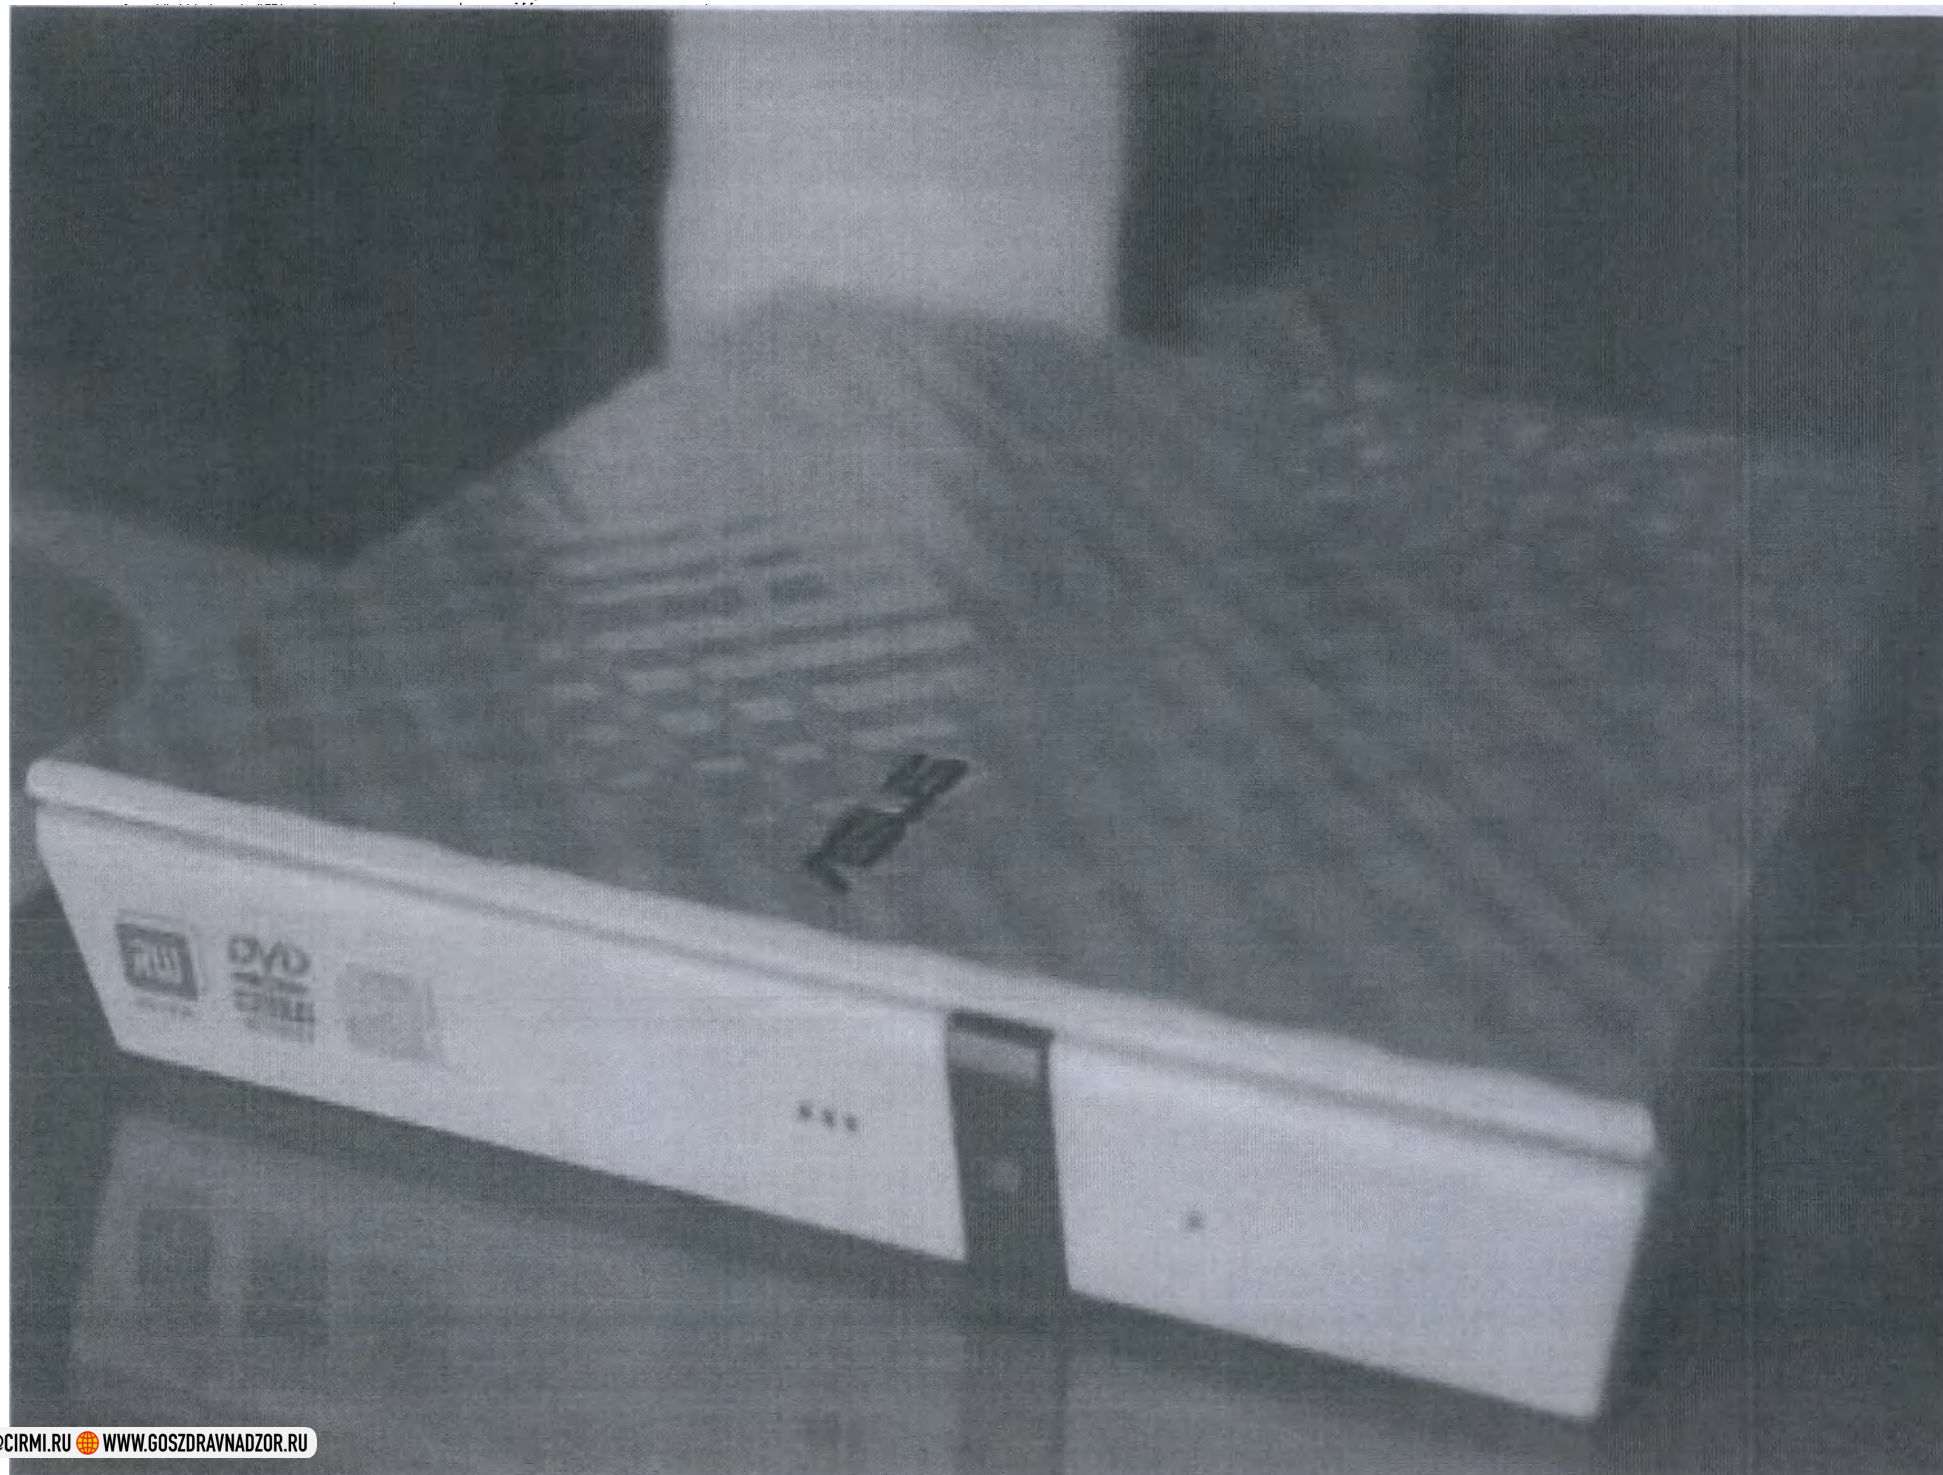

8. Чехол для сканера (Dust-proof cover for Main Unit), не более 3 шт.

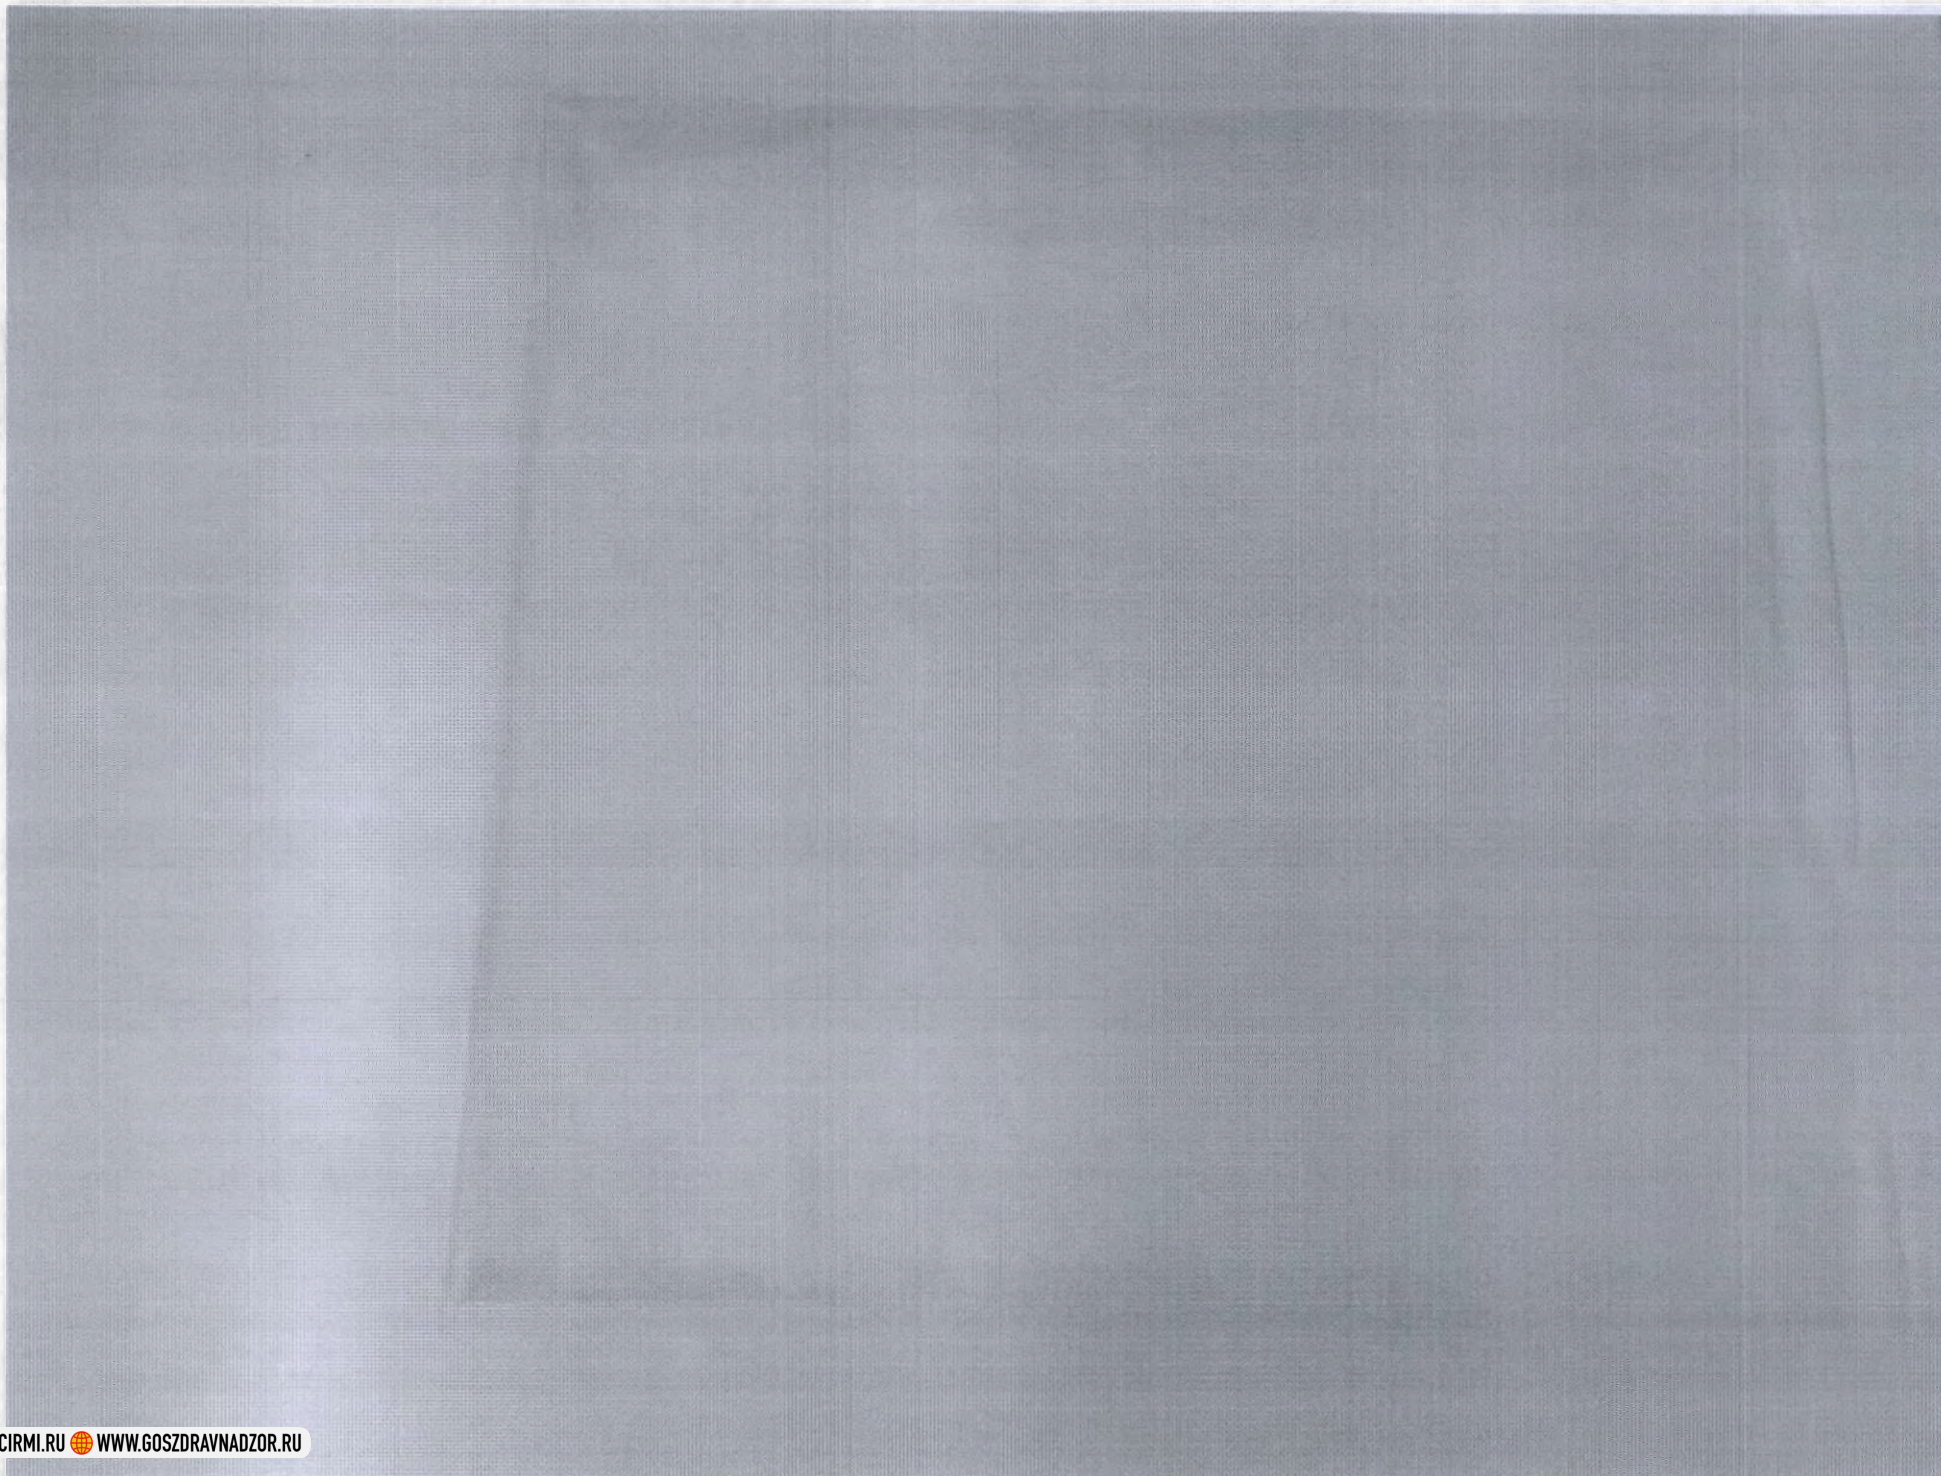

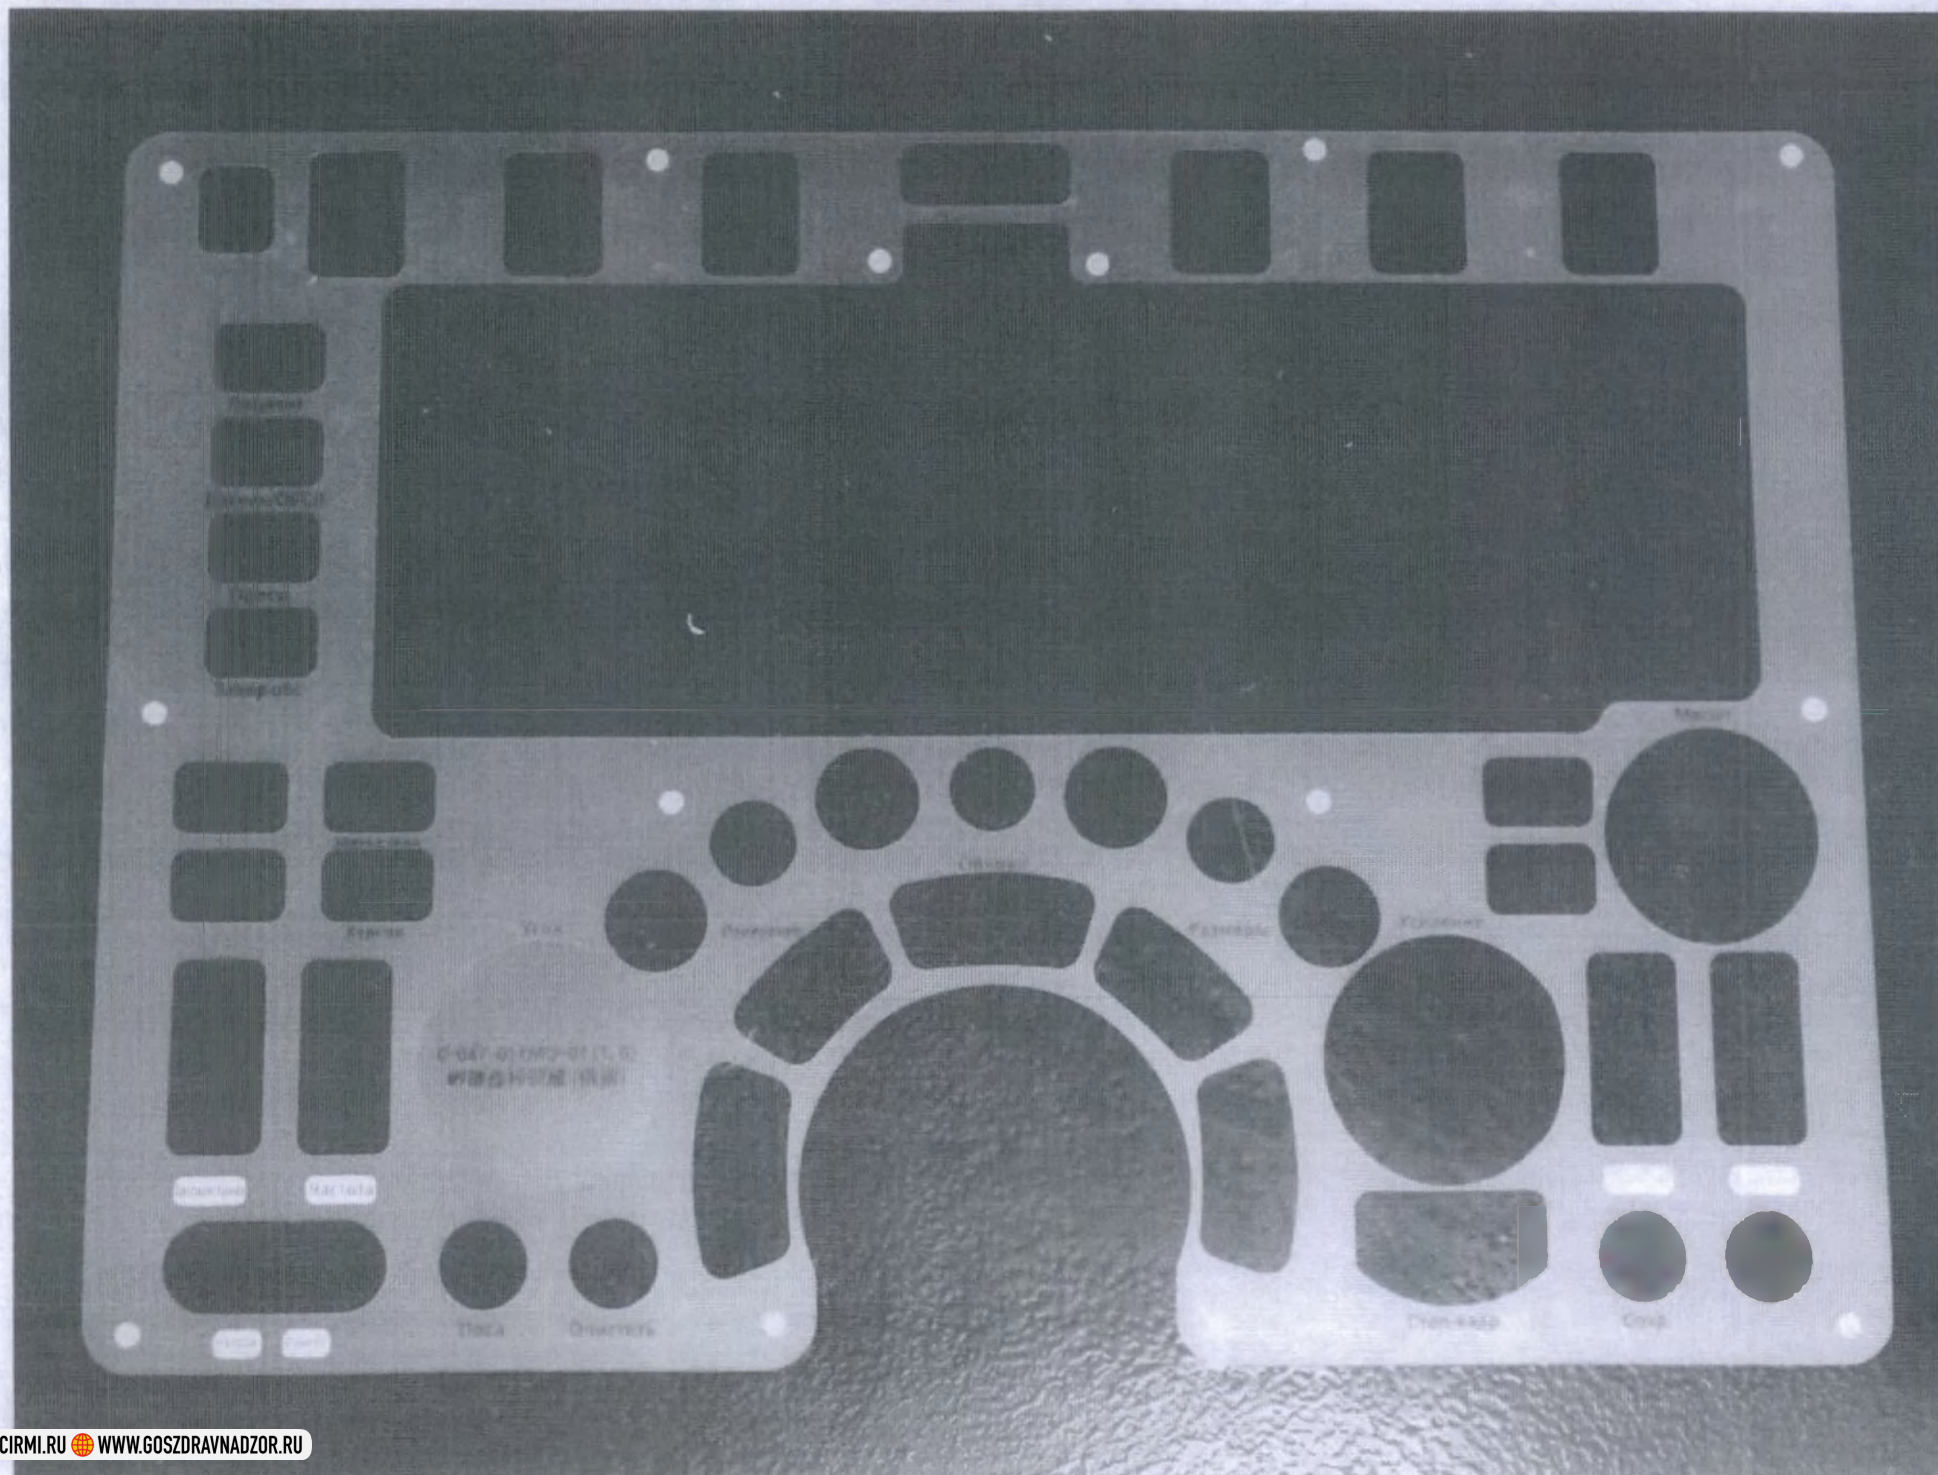


10. Кабель заземления (Grounding cable), не более 2 шт.




11. Сумка для переноски (Hand carried bag), не более 2 шт.



12. Ножной переключатель, две педали (Footswitch, 2 keys) - 1 шт.

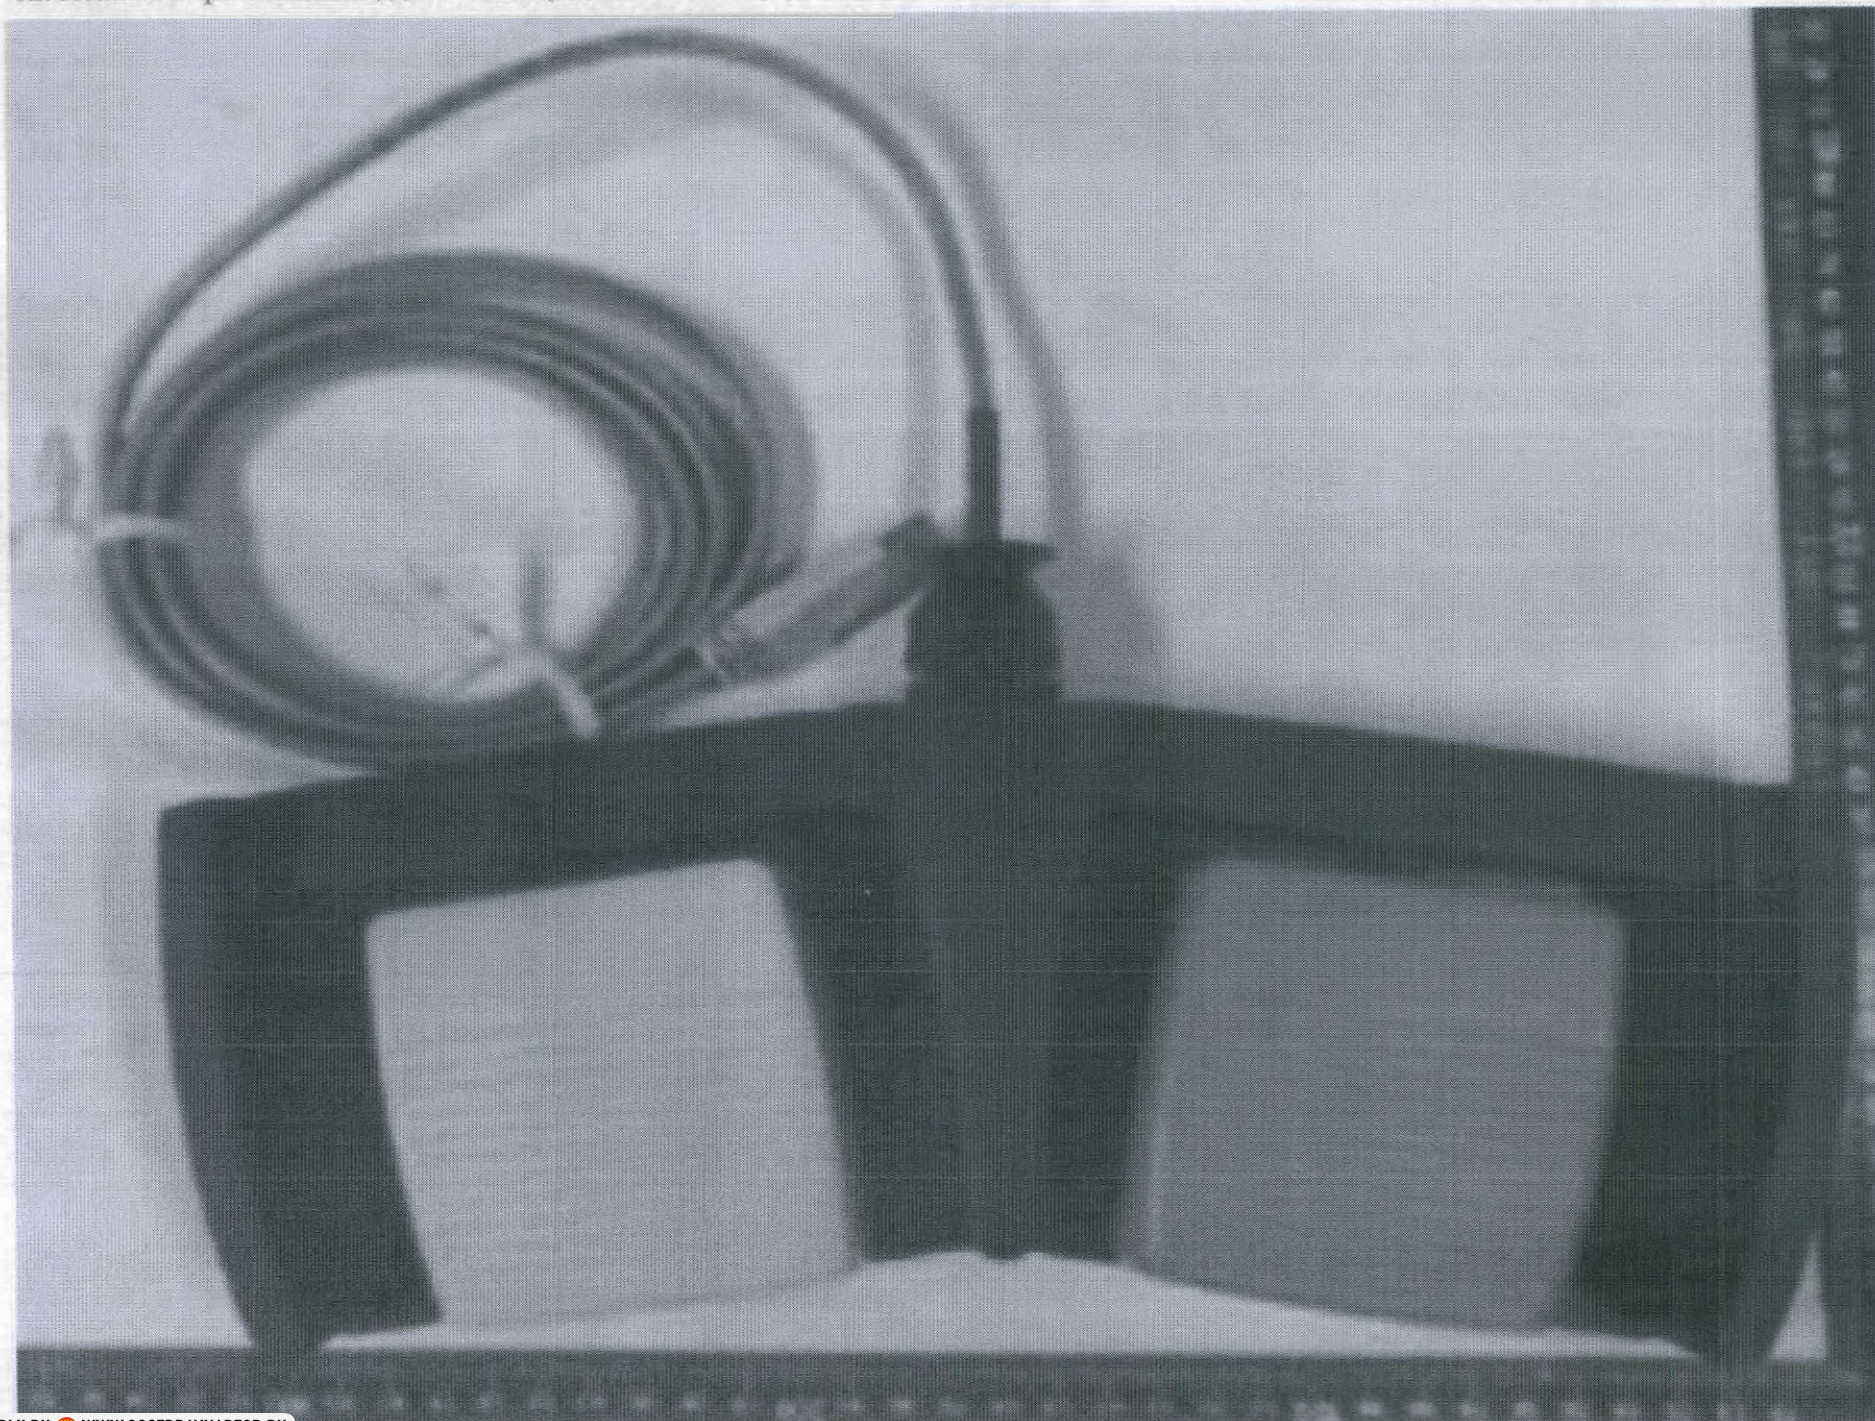

13. Ножной переключатель, три педали (Footswitch, 3 keys) - 1 шт.

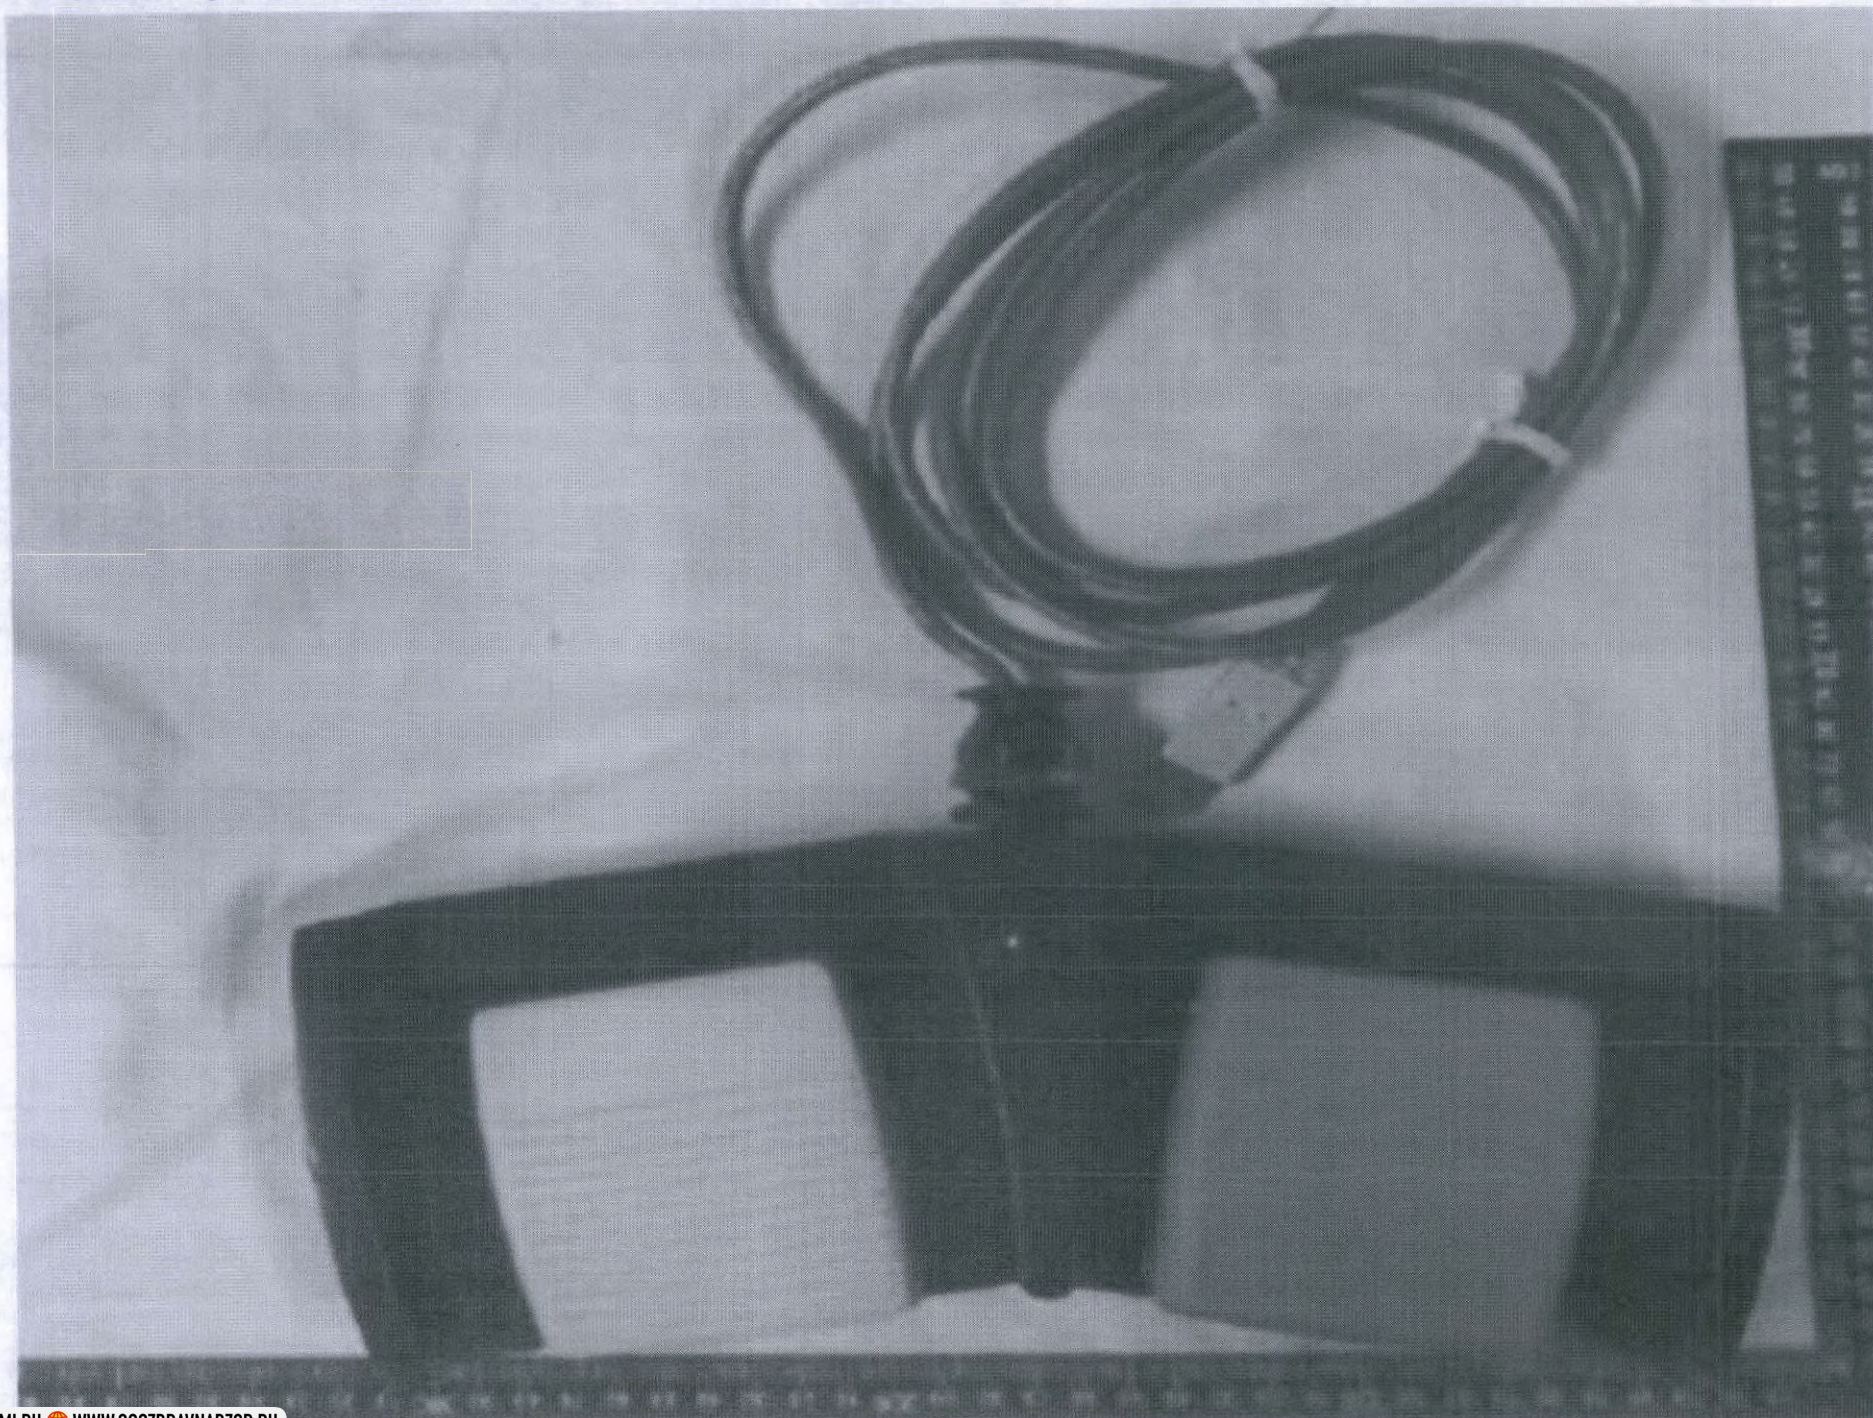

14. Переходник с USB на LAN (USB to network converter) - 1 шт.



15. Кабель питания для тележки передвижной (Power cable for mobile trolley), не более 2 шт.

