

		08P1401		
Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения фолата иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке, плазме и эритроцитах крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Фолат Калибраторы (Alinity i Folate Calibrators)» в составе: - Калибратор А (Alinity i Folate CAL A) - 1 флакон х 3,0 мл; - Калибратор В (Alinity i Folate CAL B) - 1 флакон х 3,0 мл; - Калибратор С (Alinity i Folate CAL C) - 1 флакон х 3,0 мл; - Калибратор D (Alinity i Folate CAL D) - 1 флакон х 3,0 мл; - Калибратор Е (Alinity i Folate CAL E) - 1 флакон х 3,0 мл; - Калибратор F (Alinity i Folate CAL F) - 1 флакон х 3,0 мл; инструкция по применению. Производитель: «Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия) Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland Страна происхождения: Ирландия РУ № ____/____ от ____/____/____ / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU/ Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции. <i>Данный продукт содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.</i> Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ: Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1, Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)				

Макет маркировки на медицинское изделие

Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения фолата иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке, плазме и эритроцитах крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "Фолат Калибраторы (Alinity i Folate Calibrators)"

670510R02

[illegible]

Abbott

Alinity[®] Folate Calibrators

Alinity i Folate Calibrators

Abbott




 Abbott Ireland
Diagnostics Division
Ustramuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000


PRODUCT OF IRELAND




Folate Cals




- Калибратор А (Alinity і Folate CAL A) - 1 флакон х 3,0 мл

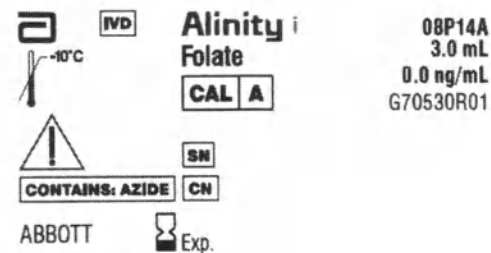

- Калибратор В (Alinity і Folate CAL В) - 1 флакон х 3,0 мл

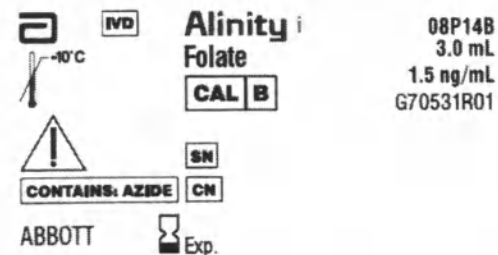


- Калибратор С (Alinity і Folate CAL C) - 1 флакон х 3,0 мл

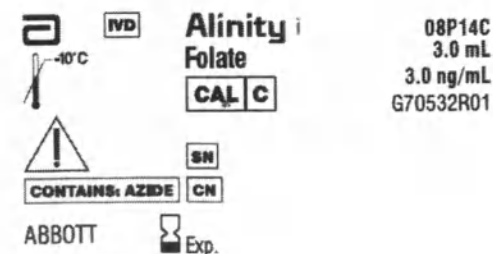


- Калибратор D (Alinity i Folate CAL D) - 1 флакон х 3,0 мл



- Калибратор E (Alinity i Folate CAL E) - 1 флакон х 3,0 мл

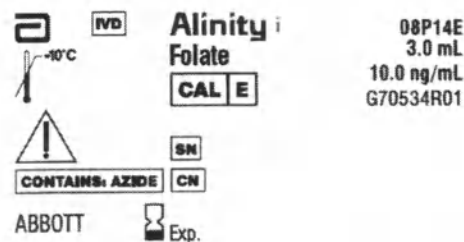

- Калибратор F (Alinity i Folate CAL F) - 1 флакон х 3,0 мл

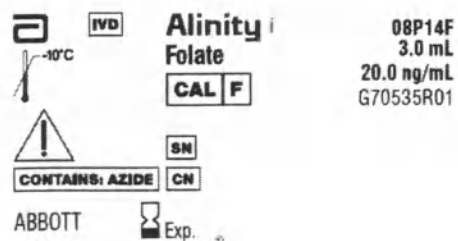

Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:


Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования
ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования

Расшифровка символов представлена в инструкции.


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Калибраторы для обеспечения правдивости количественного определения фолата иммунохимическим методом в сыворотке, плазме и эритроцитах крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "Фолат Калибраторы (Alinity i Folate Calibrators)"


Фототрафаретное воспроизведение отпечатка некачественное. Фотографировать (Анализ и Поиск Сопоставлений), Экз. № 0001-001

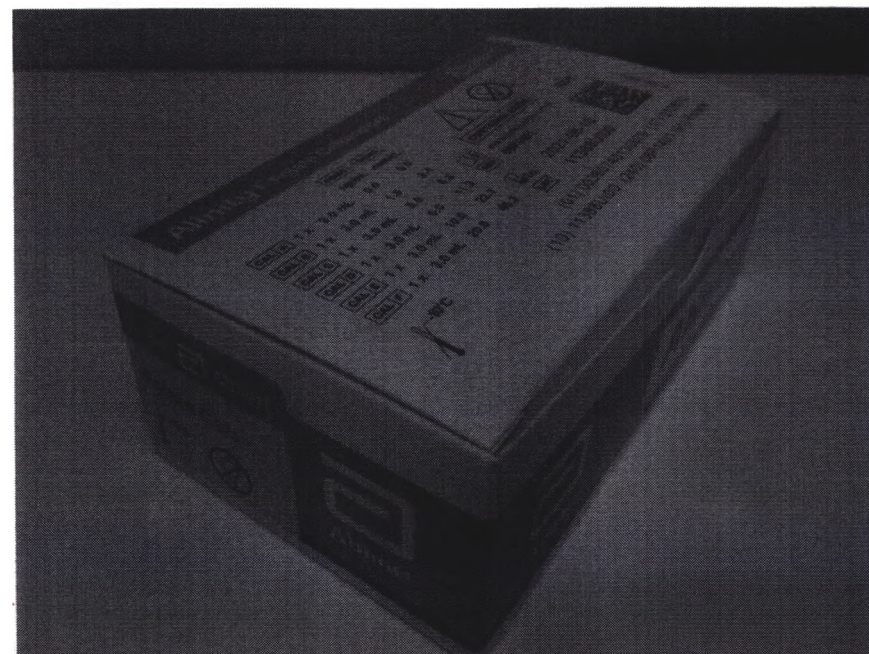

Фотографическое изображение общего вида упаковки (в открытом виде) Фолат Калибраторы (Alinity i Folate Calibrators), Кат. № 08P1401

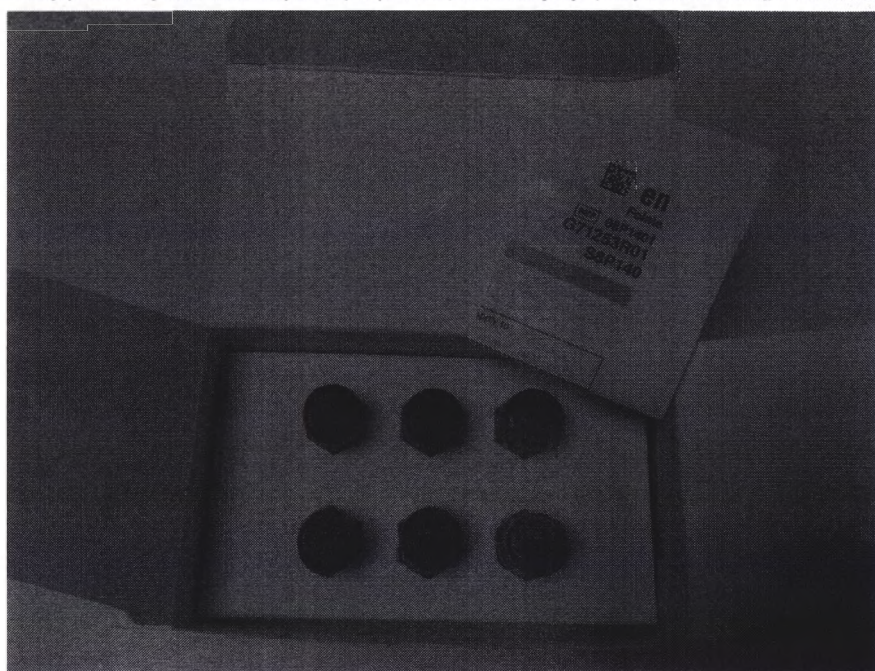

Фотографическое изображение флаконов калибраторов, входящих в состав МИ Фолат Калибраторы (Alinity i Folate Calibrators), Кат. № 08P1401

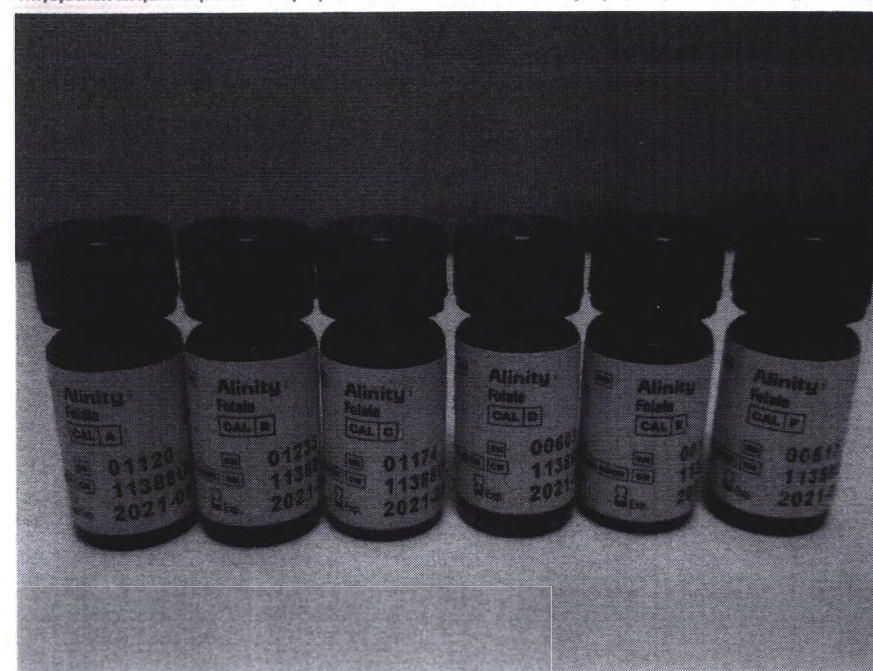

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 листов

