

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации

Фолат RBC Лизирующий дилюент (Alinity i Folate RBC Lysis Diluent), Кат № 08P1440



08P1440



Лизирующий дилюент для приготовления гемолизата эритроцитов в тесте, использующем «Фолат Реагенты (Alinity i Folate Reagent Kit)» на иммунохимических анализаторах Alinity i «Фолат RBC Лизирующий дилюент (Alinity i Folate RBC Lysis Diluent)»

в составе:

- RBC Лизирующий дилюент (Alinity i Folate RBC Lysis Diluent) - 1 флакон х 12,5 мл;

Инструкция по применению.

Производитель: «Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия)

Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland

Страна происхождения: Ирландия

РУ № ____/____ от ____/____/____ / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Макет маркировки на медицинское изделие

Лизирующий дилюент для приготовления гемолизата эритроцитов в тесте, использующем

"Фолат Реагенты (Alinity i Folate Reagent Kit)" на иммунохимических анализаторах

Alinity i "Фолат RBC Лизирующий дилюент (Alinity i Folate RBC Lysis Diluent)"

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия Фолат RBC Лизирующий дилуэнт (Alinity i Folate RBC Lysis Diluent), Кат. № 08P1440

G72103R02




www.abbottdiagnostics.com/RU

08P1440 Folate RBC Lysis Diluent




Alinity i Folate RBC Lysis Diluent




RBC LYSIS DILUENT

1 x 12.5 mL



Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

PRODUCT OF IRELAND



Folate RBC Lysis Diluent

Макет маркировки компонента медицинского изделия Фолат RBC Лизирующий дилуэнт (Alinity i Folate RBC Lysis Diluent), Кат. № 08P1440

Alinity i Folate RBC Lysis Diluent

IVD 08P14S
12.5 mL

RBC LYSIS DILUENT L2

G70529R01

ABBOTT
AID Longford, Ireland



Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:


Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования
ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании из медицинских изделий, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования

Расшифровка символов представлена в инструкции.


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Лизирующий дилюент для приготовления гемолизата эритроцитов в тесте, использующем "Фолат Реагент (Alinity i Folate Reagent Kit)" на иммунохимических анализаторах Alinity i "Фолат RBC Лизирующий дилюент (Alinity i Folate RBC Lysis Diluent)"

Фотографическое изображение общего вида упаковки Фолат RBC Лизирующий дилюент (Alinity i Folate RBC Lysis Diluent), Кат № 001440

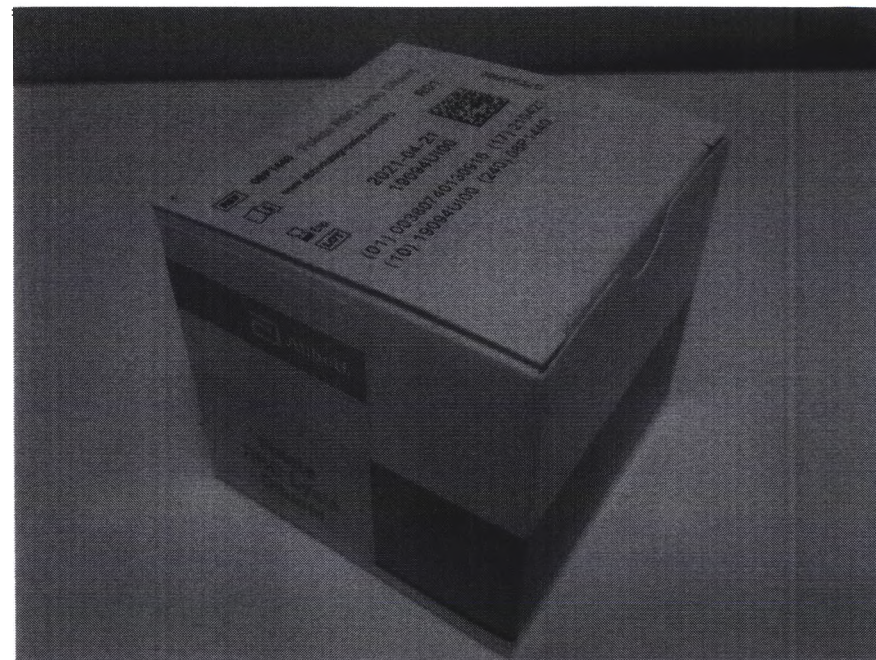

Фотографическое изображение общего вида упаковки (в открытом виде) Фалат КНС. Антигравитационный диализатор (Alinity i Folate RBC Lysis Diluent), Кат. № 08P140

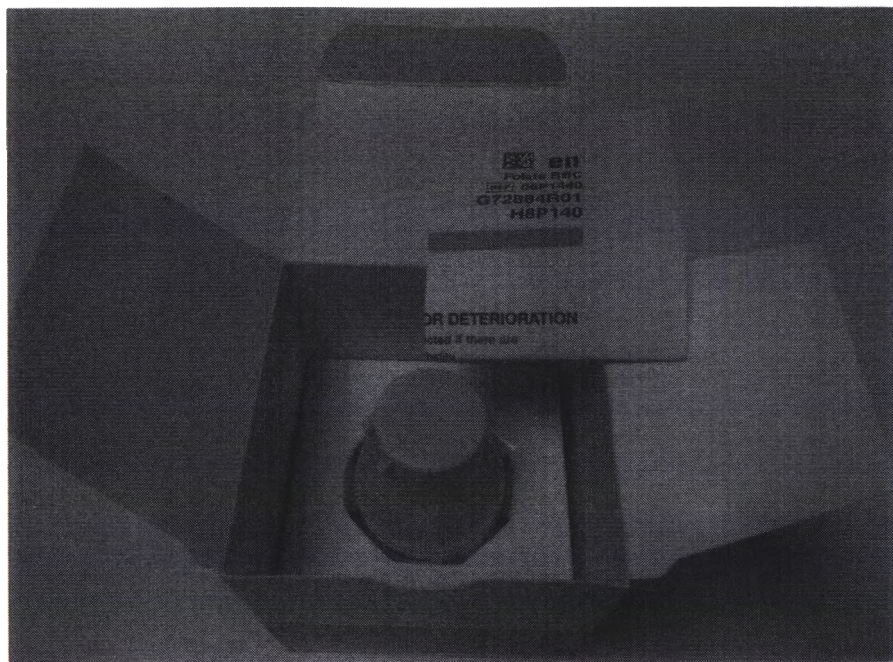

Фотографическое изображение флакона диализата, входящего в состав МК Фалат КНС. Антигравитационный диализатор (Alinity i Folate RBC Lysis Diluent), Кат. № 08P140

