


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Дилуэнт (разбавитель) для ручного разведения образцов при количественном определении фолата иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке, плазме и эритроцитах крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Фолат Дилуэнт для ручного разведения (Alinity i Folate Manual Diluent)»


Фотографическое изображение общего вида упаковки Фолат Дилуэнт для ручного разведения (Alinity i Folate Manual Diluent), Кат. № 08P1460



Фотографическое изображение общего вида упаковки (в открытом виде) Фолат Дилуэнт для ручного разведения (Alinity i Folate Manual Diluent), Кат. № 08000000000000000000

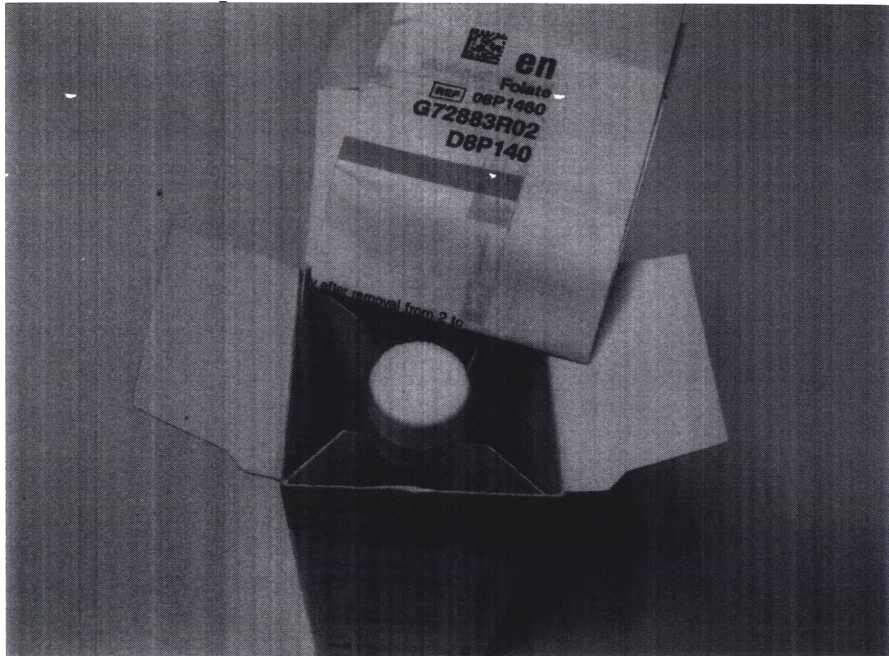

Фотографическое изображение флакона дилуэнта, входящего в состав ИБС Фолат Дилуэнт для ручного разведения (Alinity i Folate Manual Diluent), Кат. № 08000000000000000000

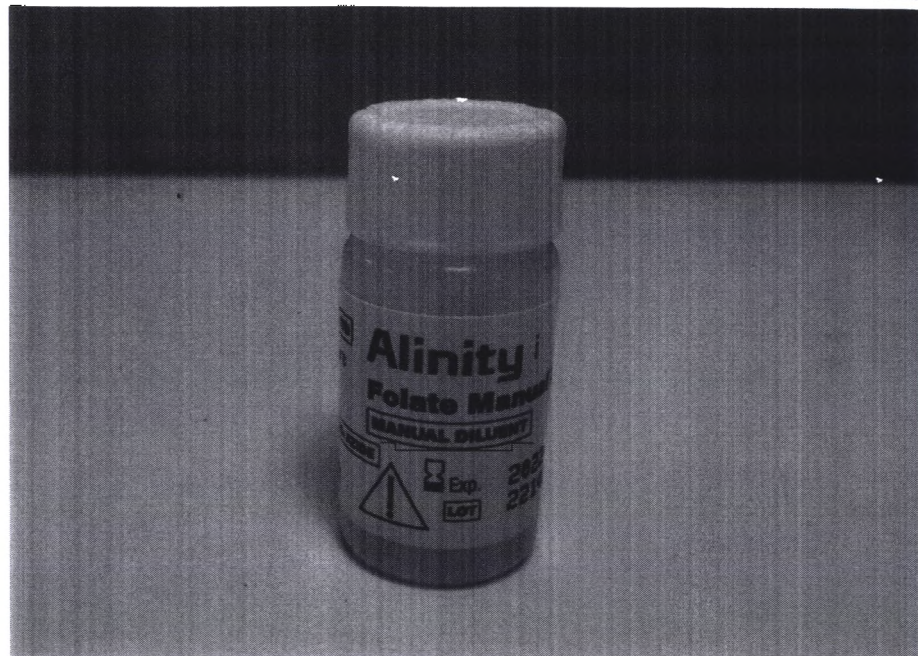

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
4 листов

Подпись

Инициалы

Макет маркировки на медицинское изделие

Дилуэнт (разбавитель) для ручного разведения образцов при количественном определении фолата иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке, плазме и эритроцитах крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Фолат

Дилуэнт для ручного разведения (Alinity i Folate Manual Diluent)»



Дилуэнт (разбавитель) для ручного разведения образцов при количественном определении фолата иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке, плазме и эритроцитах крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Фолат Дилуэнт для ручного разведения (Alinity i Folate Manual Diluent)»

в составе:

- Ручной разбавитель (Alinity i Folate Manual Diluent) - 1 флакон x 4.0 мл;
Инструкция по применению.

Производитель: «Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия)
Место производства: Abbot Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland
Страна происхождения: Ирландия
РУ № ____/____ от ____/____/____ / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU/
Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.
Данный продукт содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.
Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ: Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лаборатории», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1.
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия Фолат Дилуэнт для ручного разведения
(Alinity i Folate Manual Diluent), Кат № 06P1460



672004R02

06P 06P1460

MANUAL DILUENT

1 x 4 mL



CONTAINS: AZIDE



Abbott Laboratories
Diagnostic Division
Lugansk, Lugansk
Co, Lugansk
Ukraine
+380-46-3334000

PRODUCT OF IRELAND



www.abbottdiagnostics.com/AL



Folate
Manual Diluent

Макет маркировки компонента медицинского изделия Фолат Дилуэнт для ручного разведения
(Alinity i Folate Manual Diluent), Кат № 06P1460



Alinity i
Folate Manual Diluent

06P14P
4 mL

MANUAL DILUENT

G70528R02

CONTAINS: AZIDE



Exp.

LOT

ABBOTT

Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования
ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования

Расшифровка символов представлена в инструкции.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
4 листа

Подпись

