




Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Лизирующий реагент для количественного определения фолата
иммунохемилюминесцентным методом в эритроцитах крови человека на
иммунохимических анализаторах Alinity i "Фолат Лизирующий реагент (Alinity i Folate Lysis
Reagent)"**

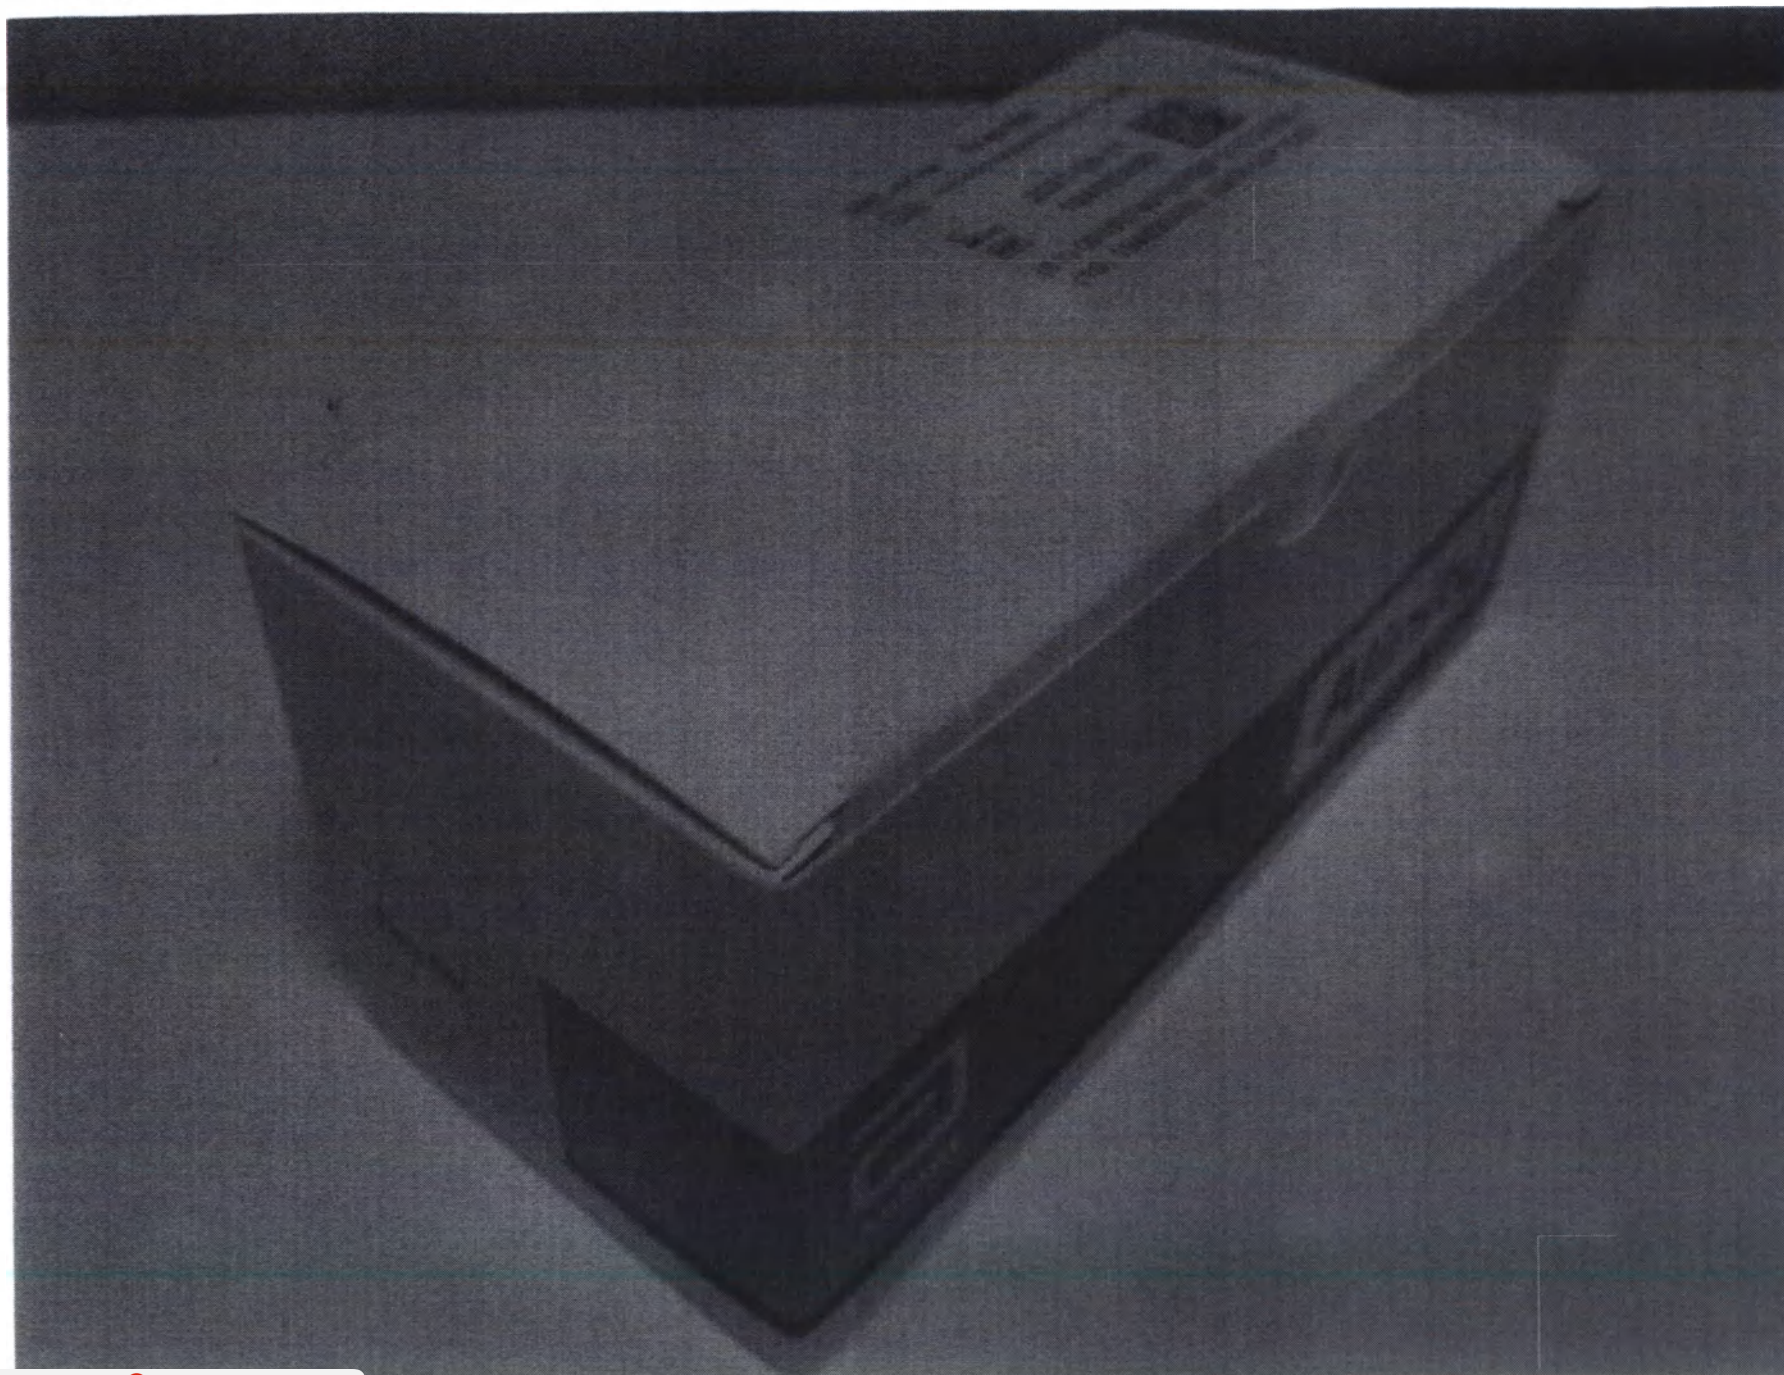

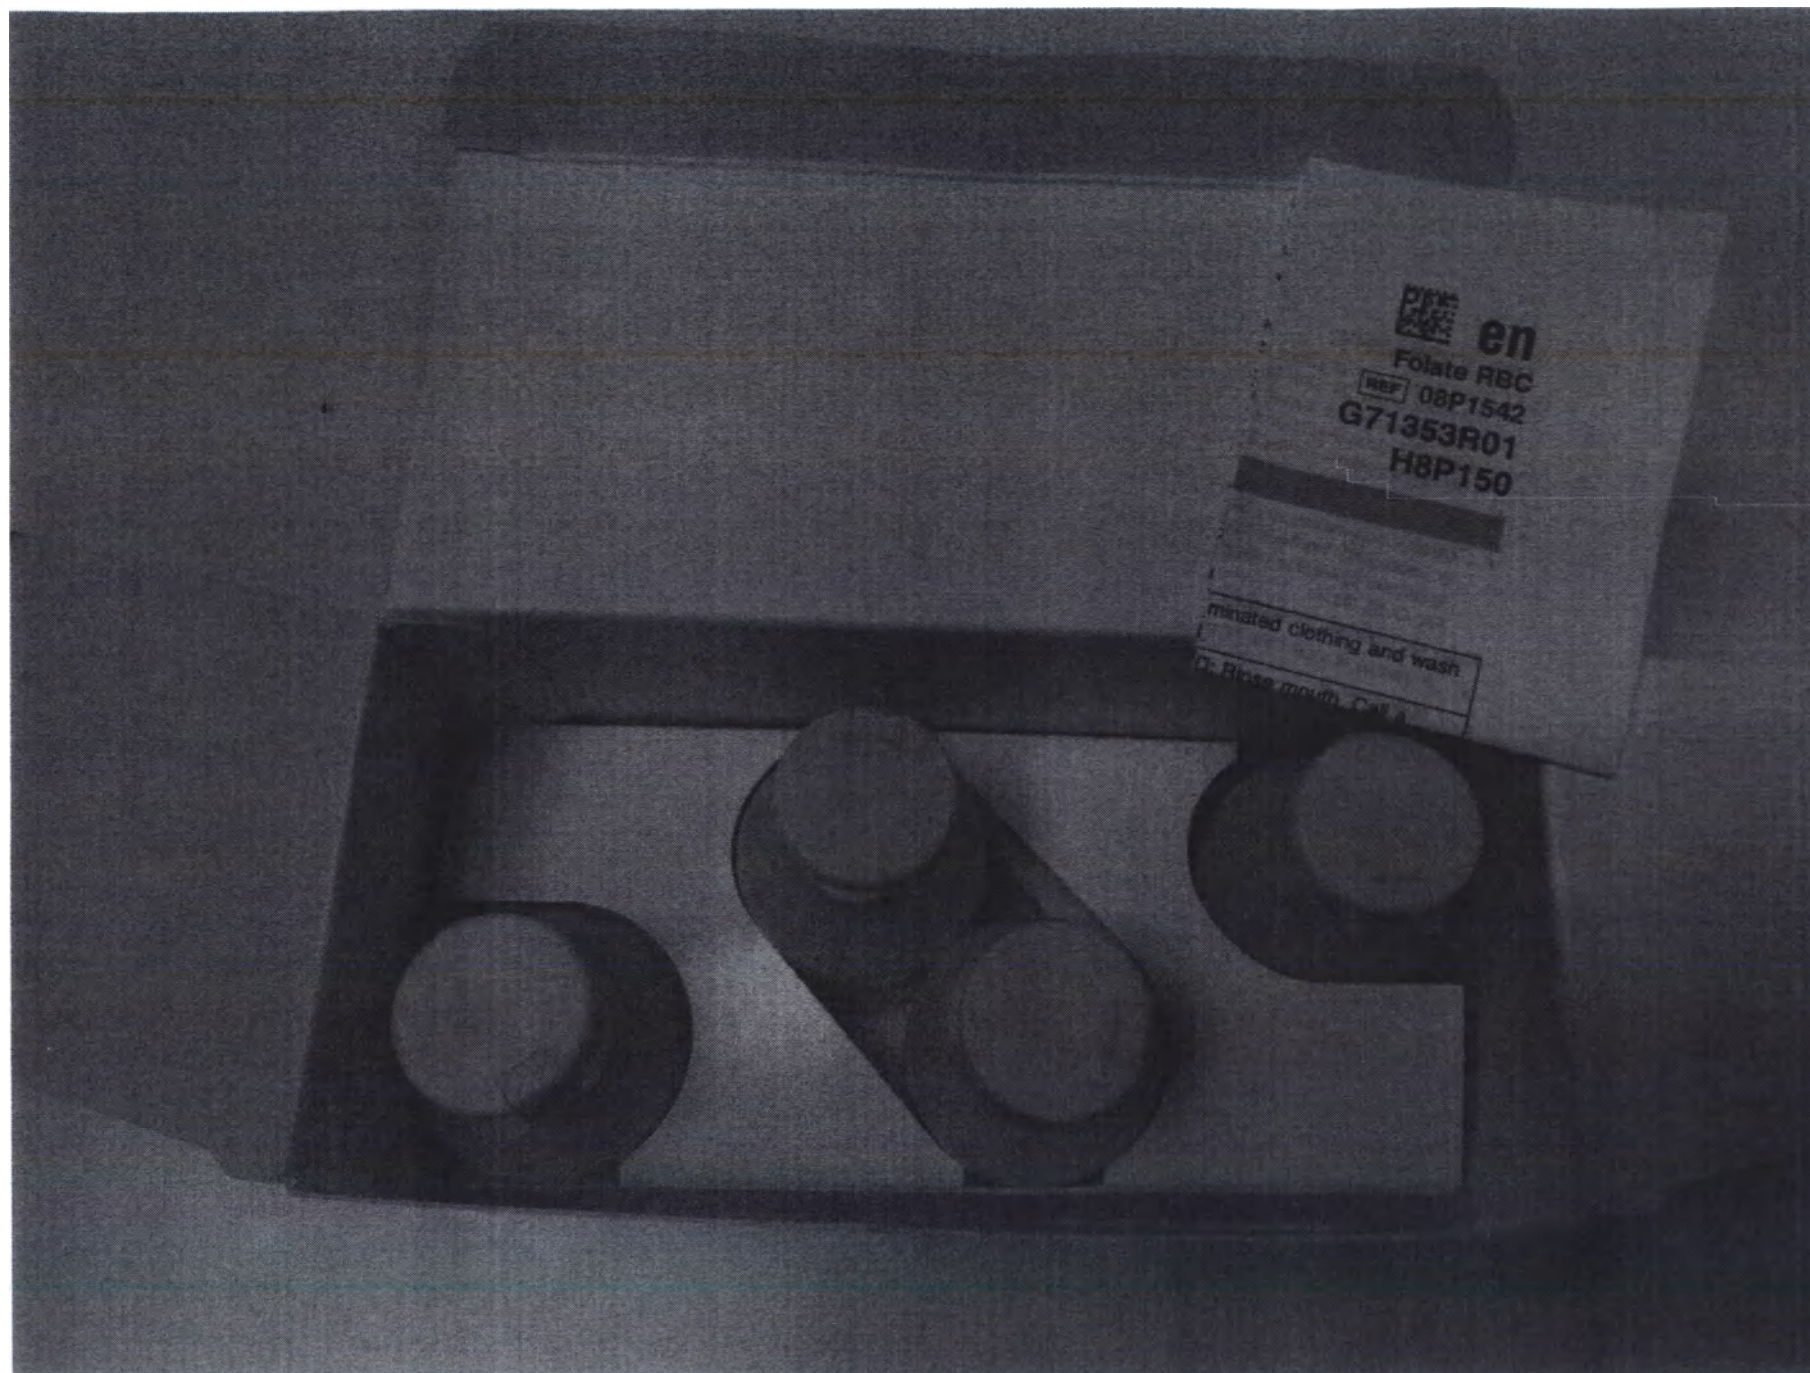

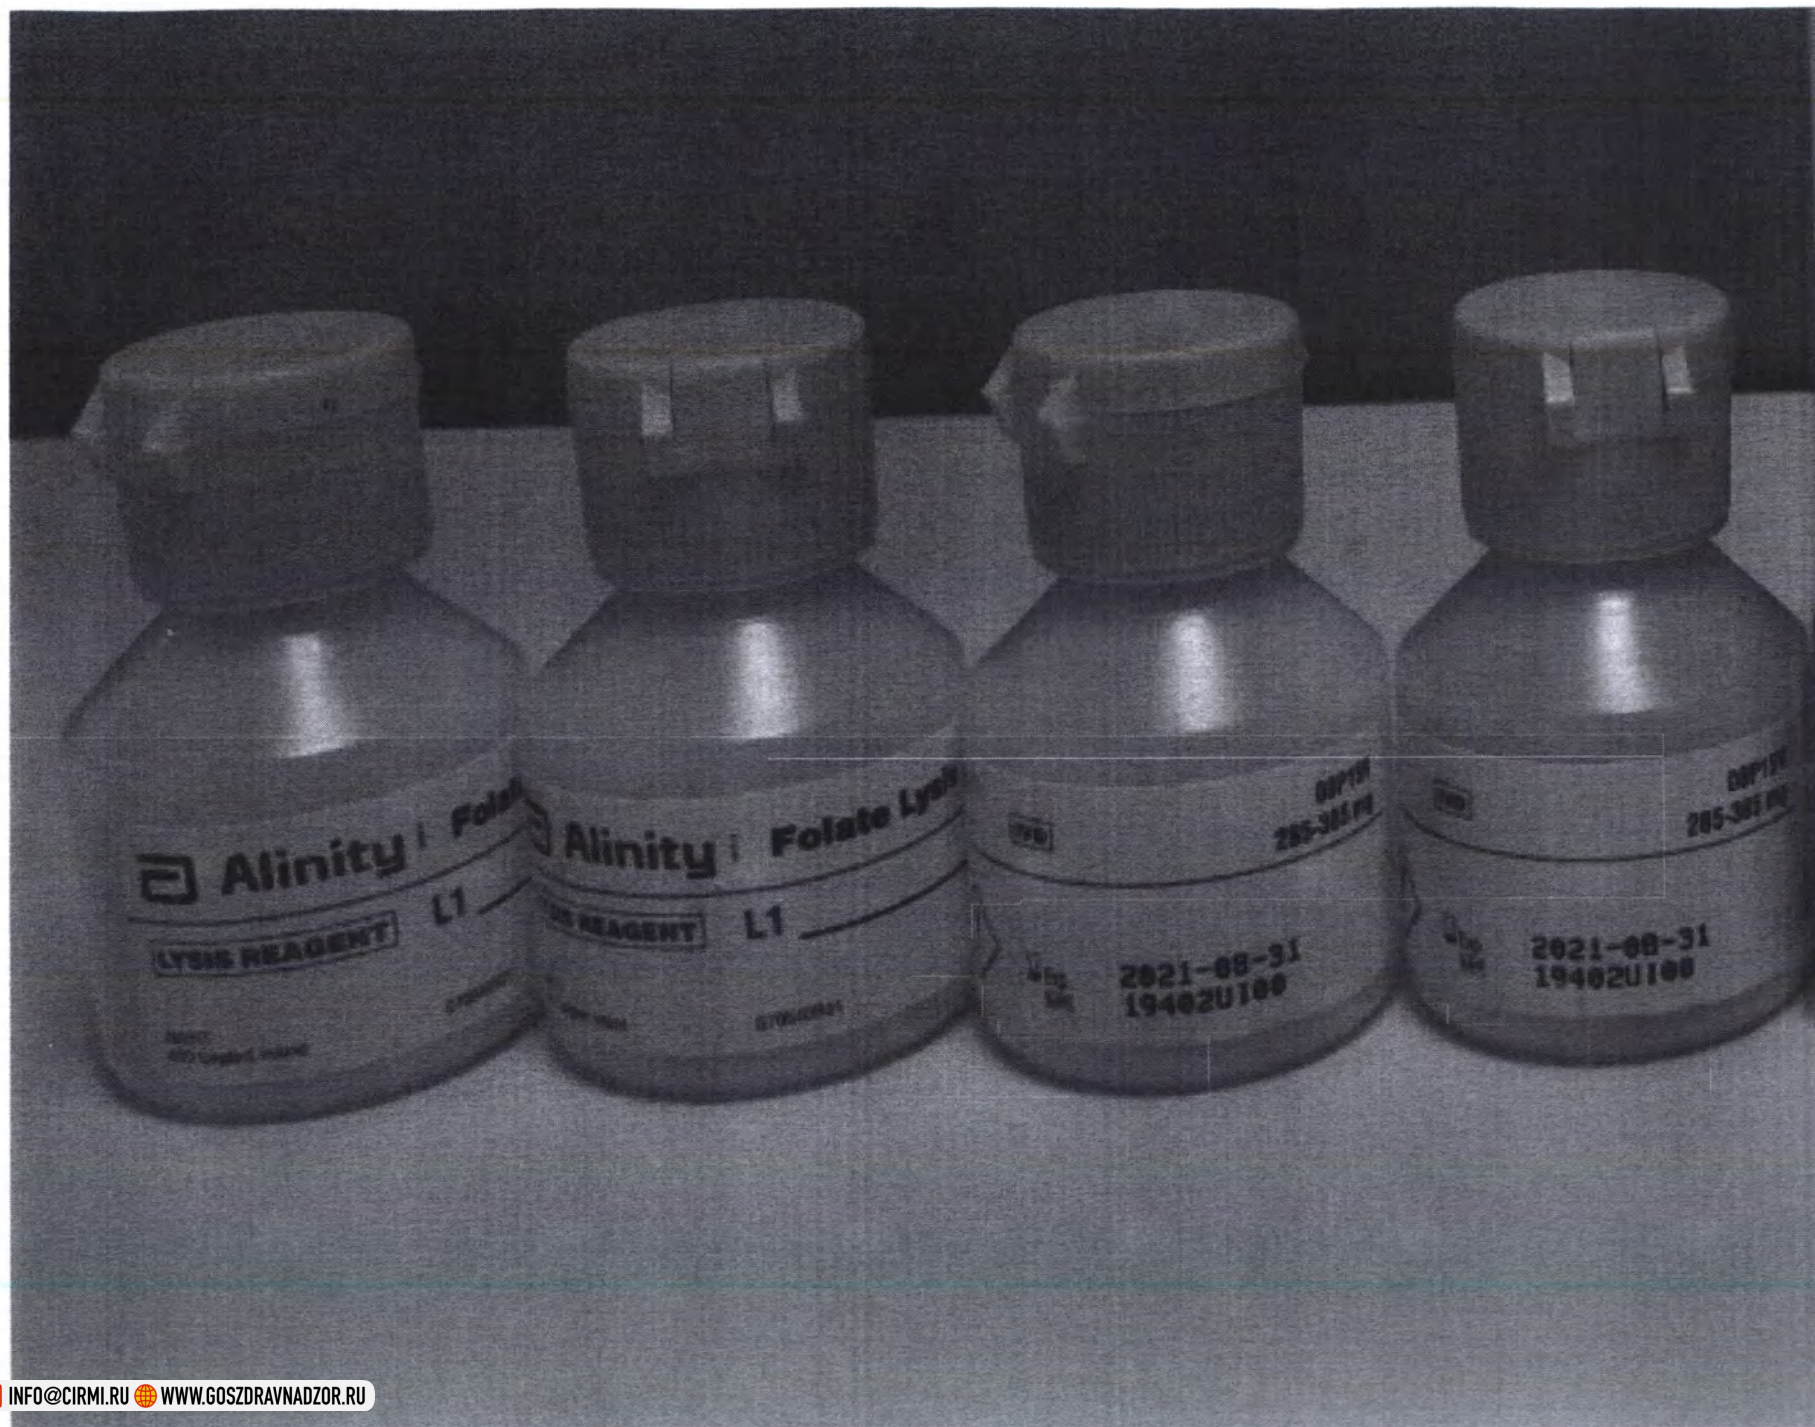

Макет маркировки на медицинское изделие
Лизирующий реагент для количественного определения фолата
иммунохемилюминесцентным методом в эритроцитах крови человека на
иммунохимических анализаторах Alinity i "Фолат Лизирующий реагент (Alinity i Folate
Lysis Reagent)"

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации

Фолат Лизирующий реагент (Alinity i Folate Lysis Reagent), Кат № 08P1542



08P1542



Лизирующий реагент для количественного определения фолата иммунохемилюминесцентным методом в эритроцитах крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "Фолат Лизирующий реагент (Alinity i Folate Lysis Reagent)"

В составе: Лизирующий реагент (Alinity i Folate Lysis Reagent) – 4 флакона х 285-385 мг; инструкция по применению.

Производитель: «Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия)

Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland

Страна происхождения: Ирландия

РУ № ____ / ____ от ____ / ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия Фолат Лизирующий реагент (Alinity i Folate Lysis Reagent), Кат № 08P1542

G70539R01

REF 08P1542 Folate RBC
www.abbott-diagnostics.com/IRU
LOT
Exp.

Alinity i Folate Lysis Reagent

Abbott

LYSIS REAGENT 4 x 285 - 385 mg



2°C 8°C

AFTER RECONSTITUTION

15°C 30°C

UNTIL FIRST USE

IVD



Folate RBC

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

PRODUCT OF IRELAND

 Alinity i Folate Lysis		IVD	08P15V 285-385 mg
LYSIS REAGENT L1			
ABBOTT AIDD Longford, Ireland	G70540R01		 Exp. LOT

Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования
ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования

Расшифровка символов представлена в инструкции.