

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «АРКРЭЙ»

Нисеяма Томоя



Данные о маркировке


Прибор для измерения уровня глюкозы в крови

ГЛЮКОКАРД Σ+ Сигма плюс по ТУ 26.51.53-003-69603232-2020

1. Этикетка на прибор

Вариант исполнения:

- ГЛЮКОКАРД Σ+ Сигма плюс

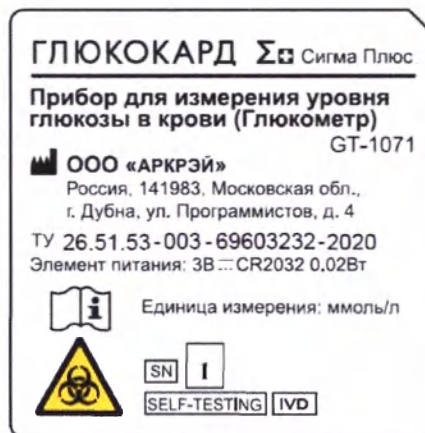

Вариант исполнения:

- ГЛЮКОКАРД Σ+Линк Сигма плюс Линк



1- здесь будет указан серийный номер изделия

2. Этикетка на коробку комплекта прибора

Вариант поставки 1:

ГЛЮКОКАРД Σ Сигма Плюс

Прибор для измерения уровня глюкозы в крови
по ТУ 26.51.53-003-69603232-2020

Для диагностики *in vitro*

Рег. уд. № РЗН xxxx/xxx от xx.xx.xxxx

Единица измерения: ммоль/л

Батарея CR2032 установлена в прибор

Вариант поставки

1. Глюкометр ГЛЮКОКАРД Σ Сигма Плюс

SN 1071KRXXXXXX

Изготовлено: YYYY-MM

2. Тест-полоски ГЛЮКОКАРД Σ 10 шт.

Рег. уд. № ФСР 2012/14224

LOT XXXXXXXXX



XXXX-XX

3. Прокалывающее устройство Multi-Lancet
Device2, 1 шт, рег. уд. РЗН 2015/3329

LOT XXXXXXXXX

4. Ланцеты одноразовые NANOLET 10 шт.
Рег. уд. № РЗН 2021/14019

LOT XXXXXXXXX



XXXX-XX-XX

5. Чехол



ООО «АРКРЭЙ»

Россия, 141983, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Программистов, д. 4
Тел. (499) 703 34 92



IVD

Для самотестирования



REF

107073

Сделано в России



4 987486 031482



Вариант поставки 2:

ГЛЮКОКАРД Σ Линк

Сигма Плюс Линк

Прибор для измерения уровня глюкозы в крови
по ТУ 26.51.53-003-69603232-2020

Для диагностики *in vitro*

Рег. уд. № РЗН xxxx/xxx от xx.xx.xxxx

Единица измерения: ммоль/л

Батарея CR2032 установлена в прибор

Вариант поставки

1. Глюкометр ГЛЮКОКАРД Σ Линк

Сигма Плюс Линк

SN 1072KRXXXXXX

Изготовлено: YYYY-MM

2. Тест-полоски ГЛЮКОКАРД Σ 10 шт.

Рег. уд. № ФСР 2012/14224

LOT XXXXXXXXX



XXXX-XX

3. Прокалывающее устройство Multi-Lancet
Device2, 1 шт, рег. уд. РЗН 2015/3329

LOT XXXXXXXXX

4. Ланцеты одноразовые NANOLET 10 шт.
Рег. уд. № РЗН 2021/14019

LOT XXXXXXXXX



XXXX-XX-XX

5. Чехол



ООО «АРКРЭЙ»

Россия, 141983, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Программистов, д. 4
Тел. (499) 703 34 92



IVD

Для самотестирования



REF

107850

Сделано в России



4 987486 031482



Вариант поставки 3:

ГЛЮКОКАРД Σ Сигма Плюс

Прибор для измерения уровня глюкозы в крови
по ТУ 26.51.53-003-69603232-2021

Для диагностики *in vitro*

Рег. уд. № РЗН xxxx/xxx от xx.xx.xxxx

Единица измерения: ммоль/л

Батарея CR2032 установлена в прибор

Вариант поставки

1. Глюкометр ГЛЮКОКАРД Σ Сигма Плюс

SN 1071KRXXXXXX

Изготовлено: YYYY-MM

2. Прокалывающее устройство Multi-Lancet
Device2, 1 шт, рег.уд. РЗН 2015/3329


LOT XXXXXXXXX

3. Чехол



ООО «АРКРЭЙ»

Россия, 141983, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Программистов, д. 4
Тел. (499) 703 34 92



IVD

Для самотестирования



REF

107073

Сделано в России



4 987486 031482



Вариант поставки 4:

ГЛЮКОКАРД Σ Линк Сигма Плюс Линк

Прибор для измерения уровня глюкозы в крови
по ТУ 26.51.53-003-69603232-2021

Для диагностики *in vitro*

Рег. уд. № РЗН xxxx/xxx от xx.xx.xxxx

Единица измерения: ммоль/л

Батарея CR2032 установлена в прибор

Вариант поставки

1. Глюкометр ГЛЮКОКАРД Σ Линк
Сигма Плюс Линк

SN 1072KRXXXXXX

Изготовлено: YYYY-MM

2. Прокалывающее устройство Multi-Lancet
Device2, 1 шт, рег.уд. РЗН 2015/3329

LOT XXXXXXXXX

3. Чехол



ООО «АРКРЭЙ»

Россия, 141983, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Программистов, д. 4
Тел. (499) 703 34 92



IVD


Для самотестирования



REF

107850

Сделано в России



4 987486 031482



Вариант поставки 5:

ГЛЮКОКАРД Σ Сигма Плюс

Прибор для измерения уровня глюкозы в крови
по ТУ 26.51.53-003-69603232-2020

Для диагностики *in vitro*

Рег. уд. № РЗН xxxx/xxx от xx.xx.xxxx

Единица измерения: ММОЛЬ/Л

Батарея CR2032 установлена в прибор

Вариант поставки

1. Глюкометр **ГЛЮКОКАРД Σ Сигма Плюс**

SN 1071KRXXXXXX

Изготовлено: YYYY-MM

2. Чехол



ООО «АРКРЭЙ»

Россия, 141983, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Программистов, д. 4
Тел. (499) 703 34 92



IVD

Для самотестирования



REF

107073

Сделано в России



4 987486 031482



Вариант поставки 6:

ГЛЮКОКАРД Σ Линк Сигма Плюс Линк

Прибор для измерения уровня глюкозы в крови
по ТУ 26.51.53-003-69603232-2020

Для диагностики *in vitro*

Рег. уд. № РЗН xxxx/xxx от xx.xx.xxxx

Единица измерения: ММОЛЬ/Л

Батарея CR2032 установлена в прибор

Вариант поставки

1. Глюкометр **ГЛЮКОКАРД Σ Линк
Сигма Плюс Линк**

SN 1072KRXXXXXX

Изготовлено: YYYY-MM

2. Чехол



ООО «АРКРЭЙ»

Россия, 141983, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Программистов, д. 4
Тел. (499) 703 34 92



IVD

Для самотестирования



REF

107850

Сделано в России



4 987486 031482




- PANTONE 300C
- PANTONE 8400C
- PANTONE COOL Gray 4C
- Cyan
- Magenta
- Yellow
- Black

H162 × W63 × 63 mm



- PANTONE 300C
- PANTONE 8400C
- PANTONE COOL Gray 4C
- Cyan
- Magenta
- Yellow
- Black

H162 × W53 × 63 mm

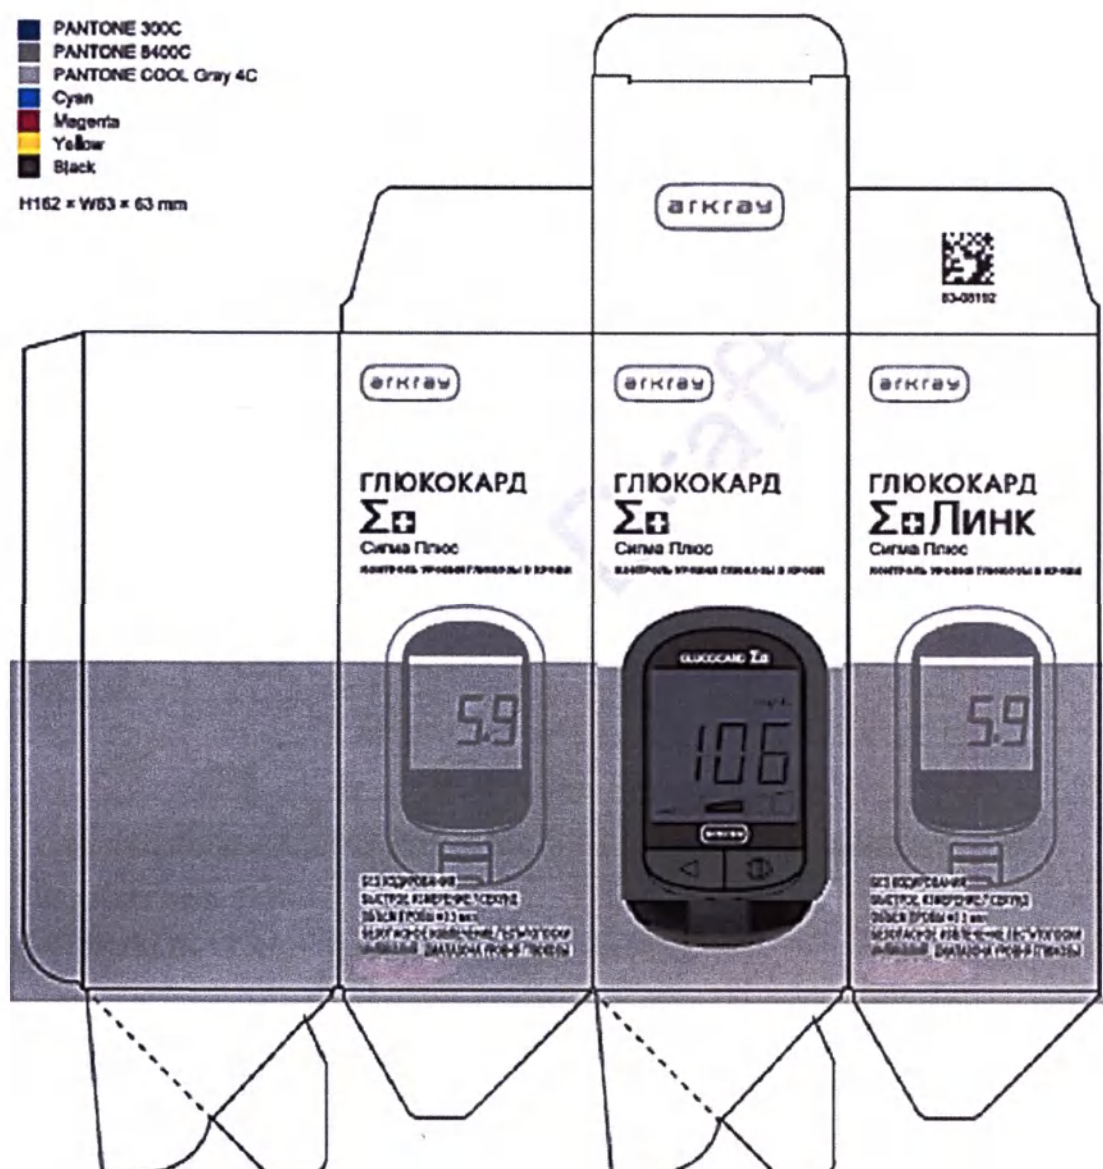

3. Транспортная этикетка

Для транспортировки прибор упаковывается в транспортный гофрокороб, на который наносится следующая этикетка*:

***Примечание:** в случае нанесения манипуляционных знаков на гофрокоробе, на транспортной этикетке их не размещают.

Вариант исполнения:

- ГЛЮКОКАРД Σ+ Сигма плюс

Прибор для измерения уровня глюкозы в крови ГЛЮКОКАРД Σ+ Сигма плюс
по ТУ 26.51.53-003-69603232-2020

(вариант исполнения: ГЛЮКОКАРД Σ+ Сигма плюс)



Артикул: XXXXXX

Заказ: X

Кол-во: X шт.

Короб №: X

Серийные номера:

ООО "АРКРЭЙ"
Россия, 141983, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Программистов, д. 4
Тел. (499) 703 34 92


Сделано в России

Вариант исполнения:

- ГЛЮКОКАРД Σ+Линк Сигма плюс Линк

Прибор для измерения уровня глюкозы в крови ГЛЮКОКАРД Σ+ Сигма плюс
по ТУ 26.51.53-003-69603232-2020

(вариант исполнения: ГЛЮКОКАРД Σ+Линк Сигма плюс Линк)

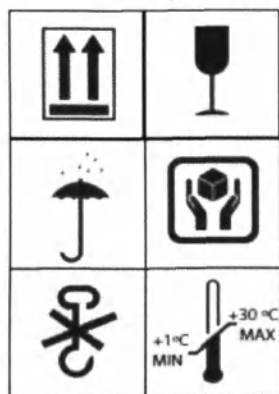

Артикул: XXXXXX

Заказ: X

Кол-во: X шт.

Короб №: X

Серийные номера:

ООО "АРКРЭЙ"
Россия, 141983, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Программистов, д. 4
Тел. (499) 703 34 92

Сделано в России



Пронумеровано и прошнуровано
_____ листа (ов)
Зам. директора по качеству
ООО АРКРЭЙ
Семенова М.Ю. 

Фотографическое изображение внешнего вида медицинского изделия:
«Прибор для измерения уровня глюкозы в крови ГЛЮКОКАРД Σ+ Сигма плюс
по ТУ 26.51.53-003-69603232-2020»

варианты исполнения:

- ГЛЮКОКАРД Σ+ Сигма плюс
- ГЛЮКОКАРД Σ+Линк Сигма плюс Линк

Вариант поставки 1:

1. Прибор ГЛЮКОКАРД Σ+ Сигма плюс - 1 шт.;
2. Тест-полоски ГЛЮКОКАРД Σ для определения уровня глюкозы в крови, рег.уд. № ФСР 2012/14224 - 1 упаковка (10 шт.);
3. Прокалывающее устройство Multi-Lancet Device2, рег. уд. № РЗН 2015/3329 – 1шт;
4. Ланцеты одноразовые NANOLET, рег. уд. № РЗН 2021/14019– 1 упаковка (10 шт.);
5. Чехол – 1 шт.;

Вариант поставки 2:

1. Прибор ГЛЮКОКАРД Σ+Линк Сигма плюс Линк - 1 шт.;
2. Тест-полоски ГЛЮКОКАРД Σ для определения уровня глюкозы в крови, рег.уд. № ФСР 2012/14224 - 1 упаковка (10 шт.);
3. Прокалывающее устройство Multi-Lancet Device2, рег. уд. № РЗН 2015/3329 – 1шт;
4. Ланцеты одноразовые NANOLET, рег. уд. № РЗН 2021/14019– 1 упаковка (10 шт.);
5. Чехол – 1 шт.;

Вариант поставки 3:

1. Прибор ГЛЮКОКАРД Σ+ Сигма плюс - 1 шт.;
2. Прокалывающее устройство Multi-Lancet Device2, рег. уд. № РЗН 2015/3329 – 1шт;
3. Чехол – 1 шт.;

Вариант поставки 4:

1. Прибор ГЛЮКОКАРД Σ+Линк Сигма плюс Линк - 1 шт.;
2. Прокалывающее устройство Multi-Lancet Device2, рег. уд. № РЗН 2015/3329 – 1шт;
3. Чехол – 1 шт.;


Вариант поставки 5:

1. Прибор ГЛЮКОКАРД Σ+ Сигма плюс - 1 шт.;
2. Чехол – 1 шт.;

Вариант поставки 6:

1. Прибор ГЛЮКОКАРД Σ+Линк Сигма плюс Линк - 1 шт.;
2. Чехол – 1 шт.;



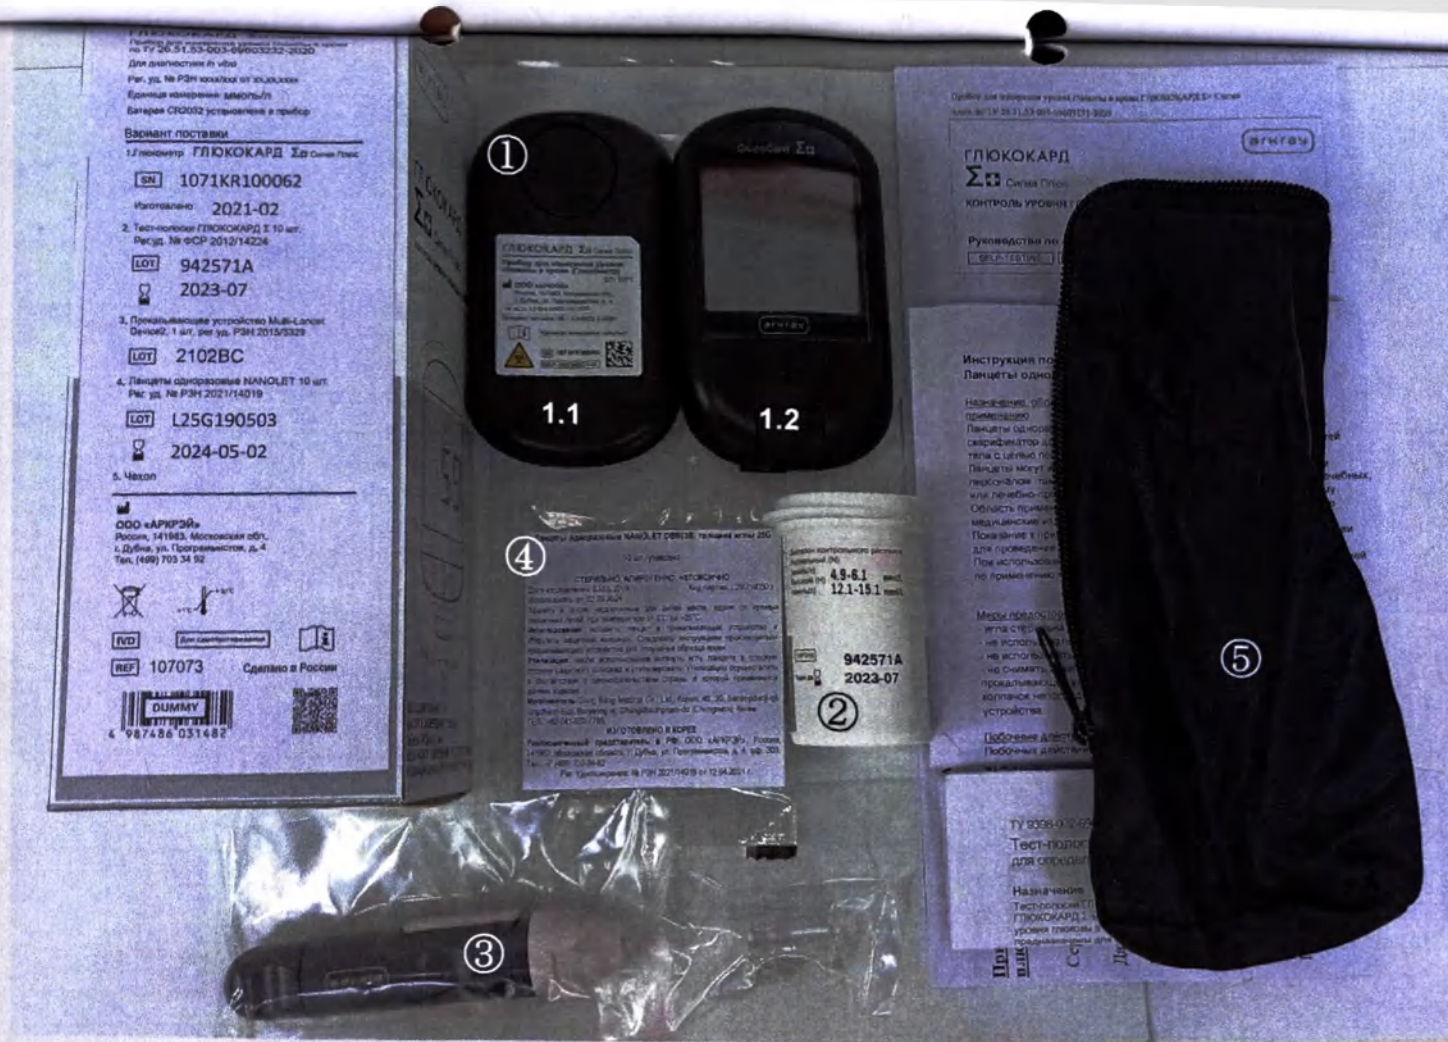

Вариант поставки 1

- ① Прибор ГЛЮКОКАРД Σ+ Сигма плюс - 1 шт.
- 1.1 – вид сзади
- 1.2 – вид спереди
- ② Тест-полоски ГЛЮКОКАРД Σ для определения уровня глюкозы в крови, рег.уд. ФСР 2012/14224 - 1 упаковка (10 шт.);
- ③ Прокалывающее устройство Multi-Lancet Device2, рег. уд. РЗН 2015/3329 – 1 шт.;
- ④ Ланцеты одноразовые NANOLET, рег. уд. РЗН 2021/14019– 1 упаковка (10 шт.);
- ⑤ Чехол – 1 шт.




Вариант поставки 3

① Прибор ГЛЮКОКАРД Σ+ Сигма плюс - 1 шт.

1.1 – вид сзади



1.2 – вид спереди

② Прокалывающее устройство Multi-Lancet Device2, рег. уд. РЗН 2015/3329 – 1 шт.;

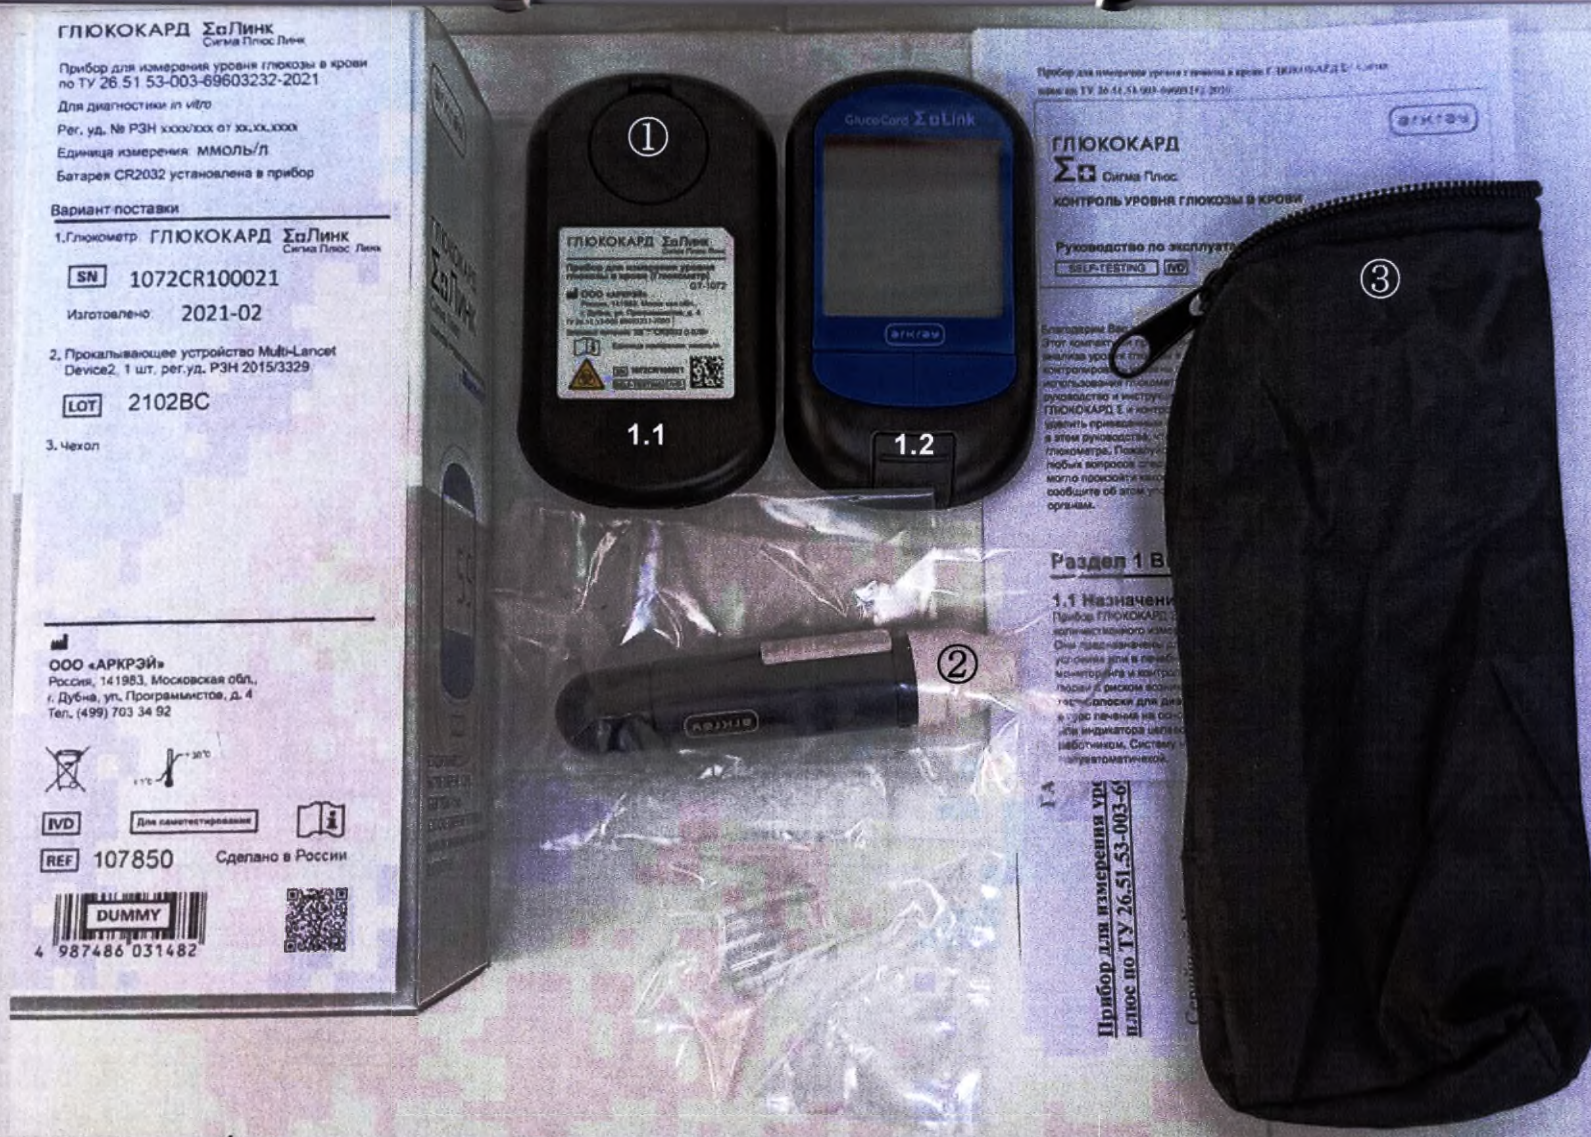

Вариант поставки 4

- ① Прибор ГЛЮКОКАРД Σ+Линк Сигма плюс Линк - 1 шт.
- 1.1 – вид сзади
- 1.2 – вид спереди
- ② Прокалывающее устройство Multi-Lancet Device2, рег. уд. РЗН 2015/3329 – 1 шт.;
- ③ Чехол – 1 шт.

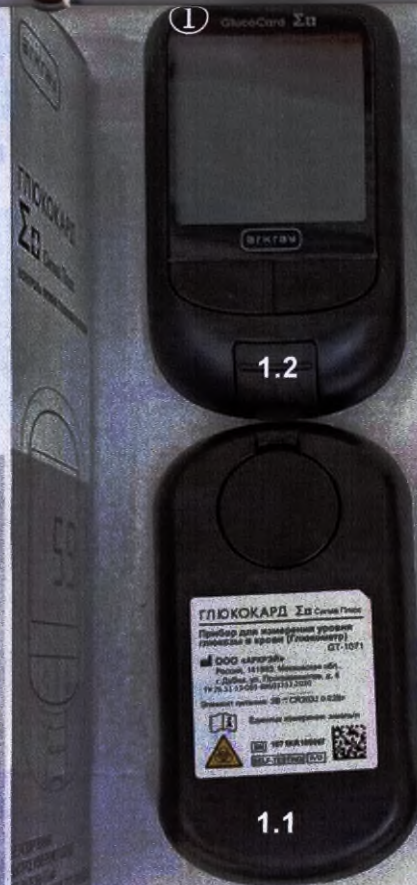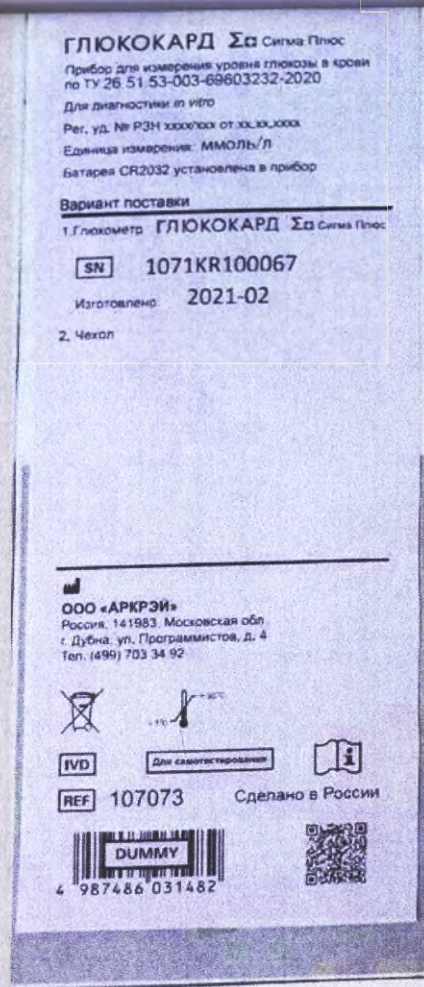


Вариант поставки 5

① Прибор ГЛЮКОКАРД Σ+ Сигма плюс - 1 шт.

1.1 – вид сзади

1.2 – вид спереди

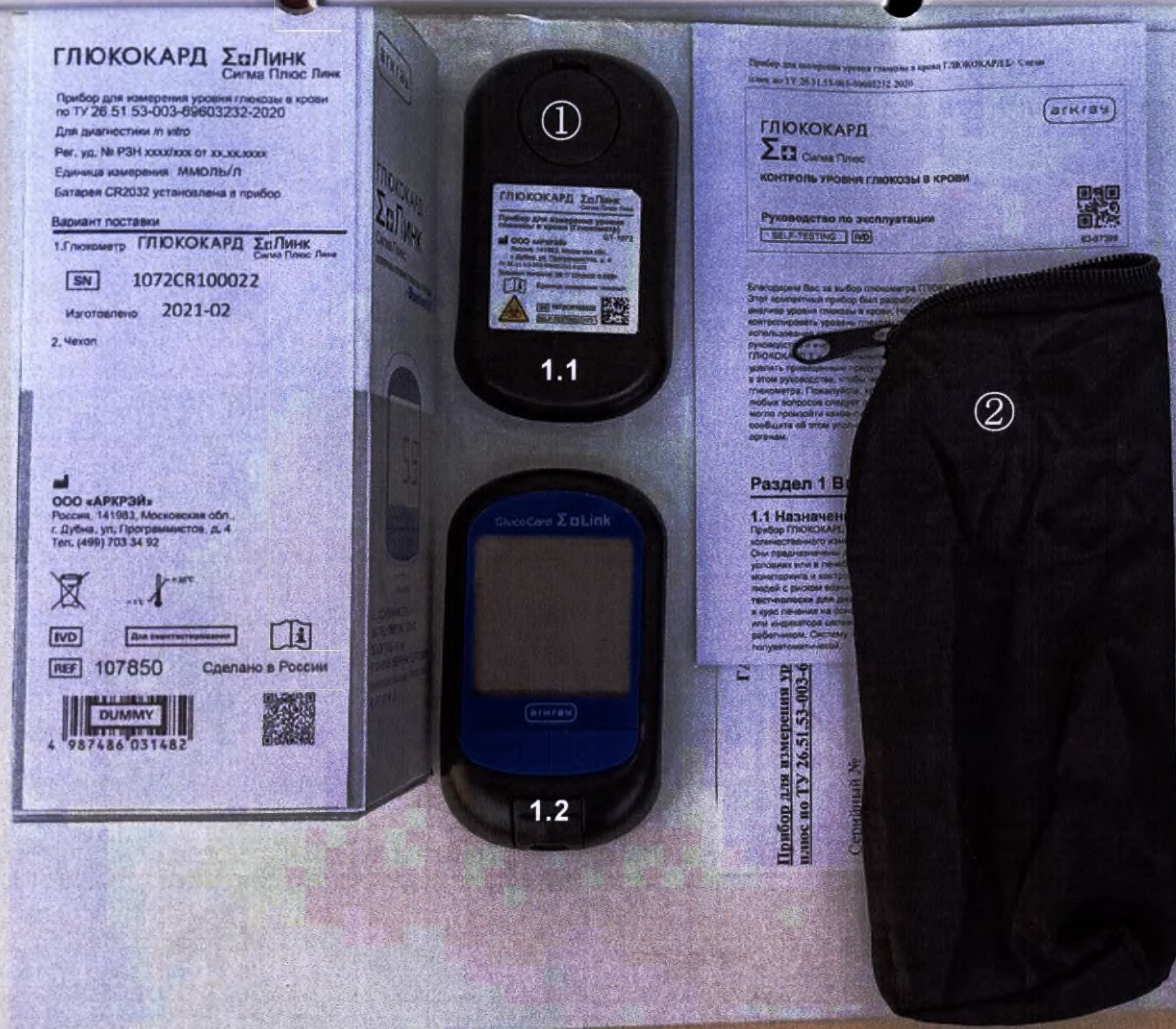

Вариант поставки 6

- ① Прибор ГЛЮКОКАРД Σ+Линк Сигма плюс Линк - 1 шт.
- 1.1 – вид сзади
- 1.2 – вид спереди
- ② Чехол – 1 шт.



Пронумеровано и прошнуровано
Семенова листа (ов)
Зам. директора по качеству
ООО АРКРЭЙ
Семенова М.Ю. *М*