

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «РУМЭКС Медикал»



Макарова Н. В.

«18» ноября 2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Система офтальмологическая лазерная VITRA 2 в вариантах исполнения: VITRA 2;
VITRA 2 с лампой щелевой модели SL9800; VITRA 2 с лампой щелевой модели SL 9900;
VITRA 2 с лампой щелевой модели SL9800 и паттерн-системой; VITRA 2 с лампой
щелевой модели SL 9900 и паттерн-системой

Вариант исполнения VITRA 2



Рисунок 1 – Консоль лазера со столешницей



Рисунок 2 – Шнур питания



Рисунок 3 – Штекер для порта дистанционного дверного выключателя



Рисунок 4 – Ключи



Рисунок 5 – Педаль



Рисунок 6 – Подлокотник



Рисунок 7 – Инструкция пользователя на USB-носителе

USER MANUAL

vitra²



**SINGLESPOT
MULTISPOT**



APRIL 2018

532nm Retinal Photocoagulation

11, rue du bois joli - CS 40015
63808 Courmon d'Auvergne Cedex
FRANCE
Tel.: +33 (0) 473 745 745
Fax: +33 (0) 473 745 700
E-mail: contact@quantel-medical.fr
Web site: www.quantel-medical.com

Quantel
medical



Directive 93/42/EEC

Рисунок 8 – Краткое руководство пользователя



Рисунок 9 – Защитные очки

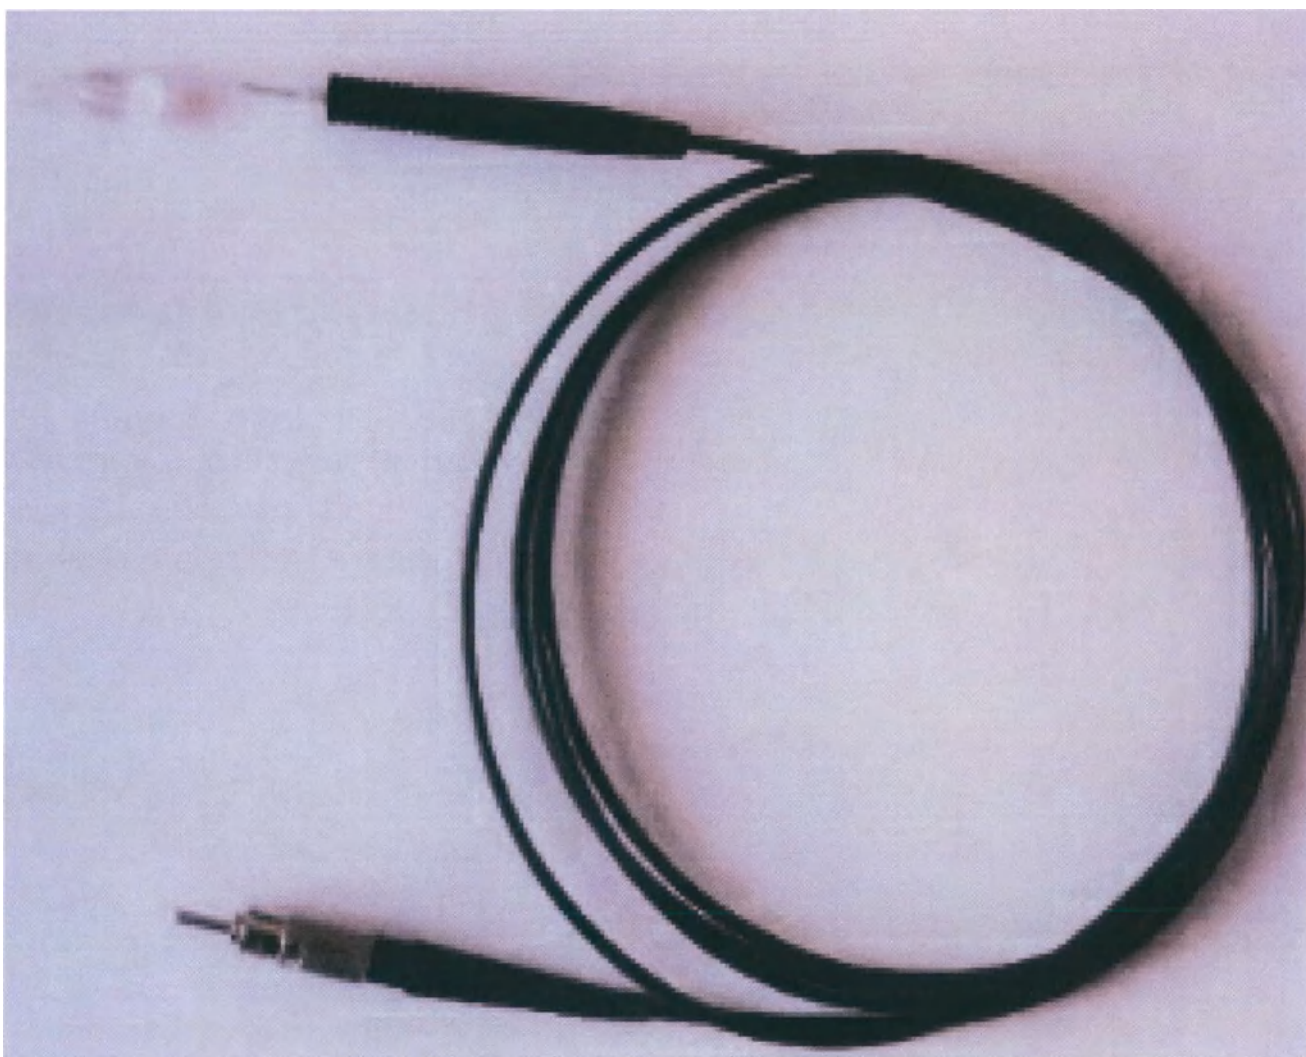


Рисунок 10 – Прямой эндоскоп



Рисунок 11 – Изогнутый эндоскоп

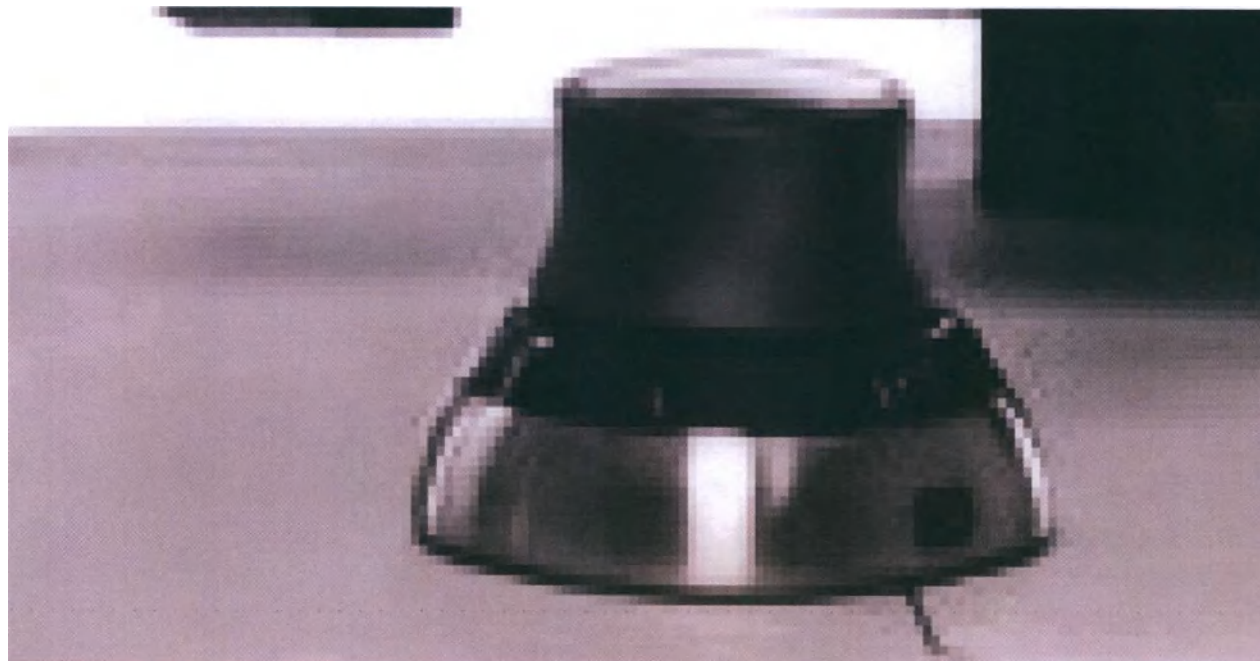


Рисунок 12 – Джойстик



Рисунок 13 – Монтажное кольцо

Вариант исполнения VITRA 2 с лампой щелевой модели SL9900



Рисунок 14 – Консоль лазера со столешницей



Рисунок 15 – Шнур питания



Рисунок 16 – Штекер для порта дистанционного дверного выключателя



Рисунок 17 – Ключи



Рисунок 18 – Педаль



Рисунок 19 – Подлокотник



Рисунок 20 – Инструкция пользователя на USB-носителе

USER MANUAL

vitra²



**SINGLESPOT
MULTISPOT**



APRIL 2018

532nm Retinal Photocoagulation

11, rue du bois joli - CS 40015
63808 Courmon d'Auvergne Cedex
FRANCE
Tel.: +33 (0) 473 745 745
Fax: +33 (0) 473 745 700
E-mail: contact@quantel-medical.fr
Web site: www.quantel-medical.com

**Quantel
medical**



Directive 93/42/EEC

Рисунок 21 – Краткое руководство пользователя



Рисунок 22 – Защитные очки



Рисунок 23 – Адаптер для щелевой лампы



Рисунок 24 – Лампа щелевая с принадлежностями модели SL 9900



Рисунок 25 – Стол электроподъемный



Рисунок 26 – Налобный офтальмоскоп со встроенным адаптером лазера



Рисунок 27 – Фильтр врача защитный



Рисунок 28 – Адаптер для микроскопа



Рисунок 29 – Кейс переносной

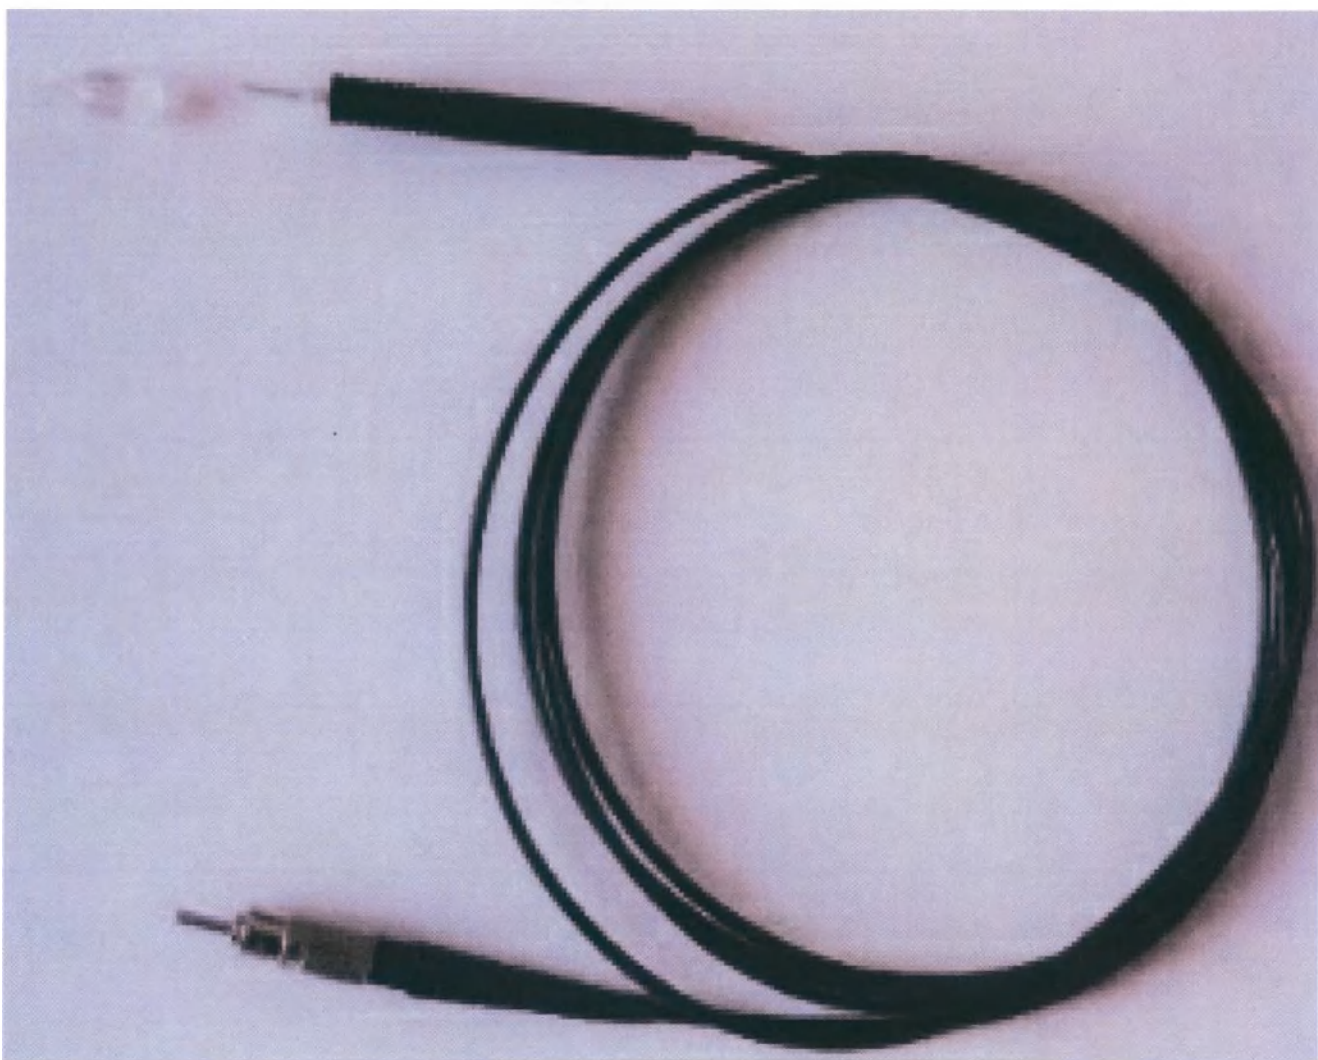


Рисунок 30 – Прямой эндоскоп

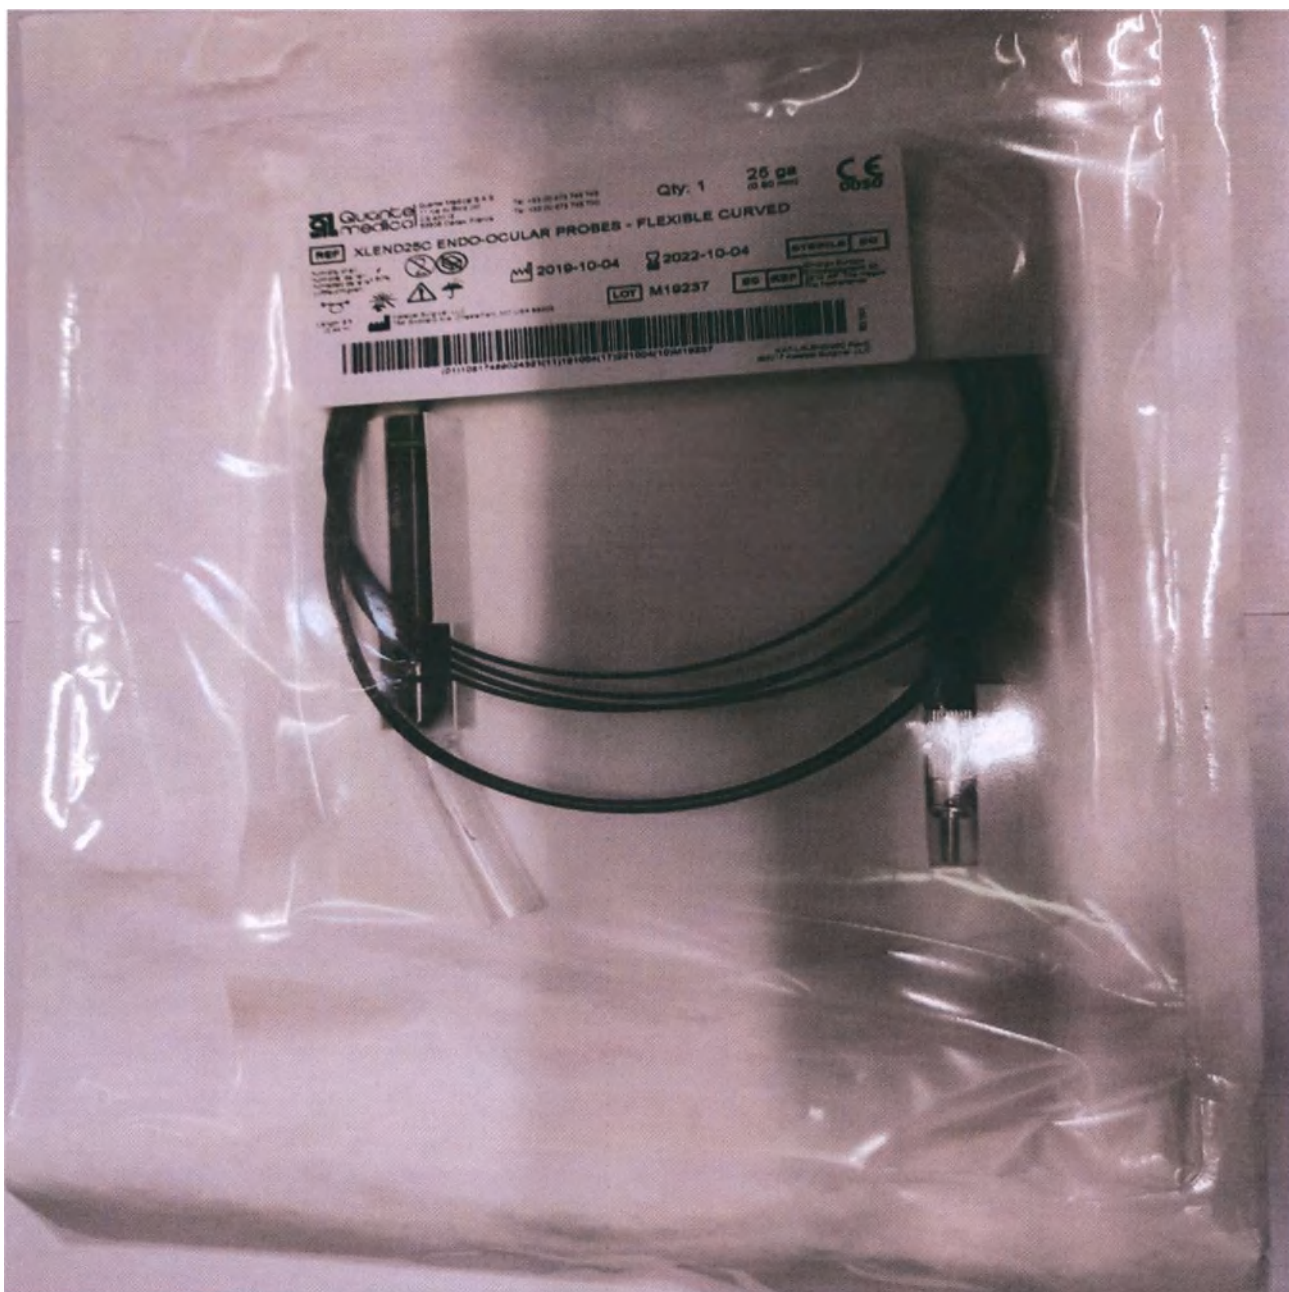


Рисунок 31 – Изогнутый эндозонд

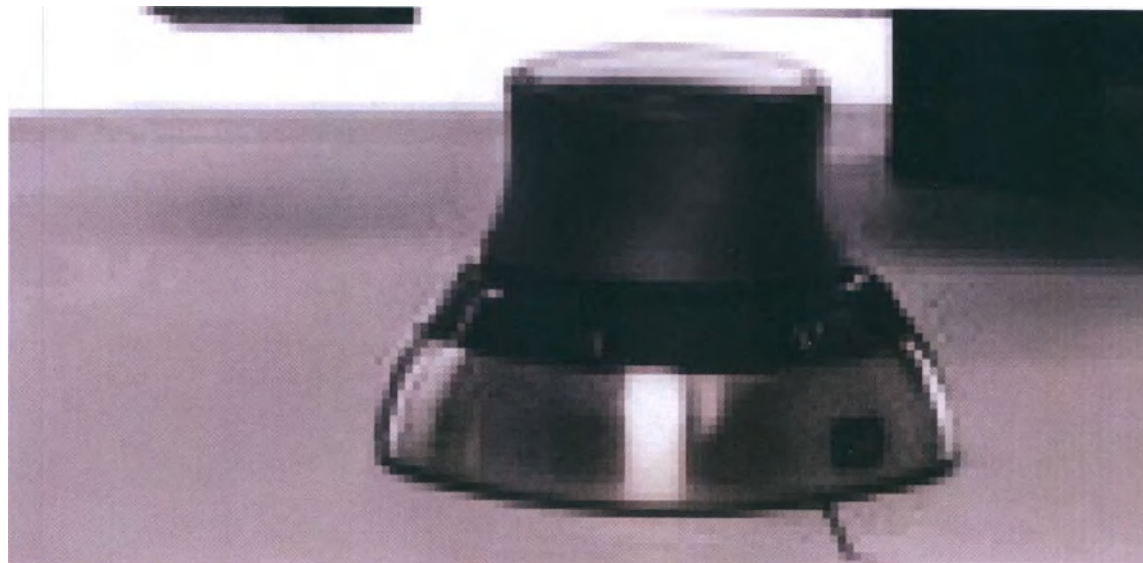


Рисунок 32 – Джойстик



Рисунок 33 – Зеркало для лампы щелевой модели SL 9900



Рисунок 34 – Монтажное кольцо

Вариант исполнения VITRA 2 с лампой щелевой модели SL9800



Рисунок 35 – Консоль лазера со столешницей



Рисунок 36 – Шнур питания



Рисунок 37 – Штекер для порта дистанционного дверного выключателя



Рисунок 38 – Ключи



Рисунок 39 – Педаль



Рисунок 40 – Подлокотник



Рисунок 41 – Инструкция пользователя на USB-носителе

USER MANUAL

vitra²



**SINGLESPOT
MULTISPOT**



APRIL 2018

532nm Retinal Photocoagulation

11, rue du bois joli - CS 40015
63808 Courmon d'Auvergne Cedex
FRANCE
Tel.: +33 (0) 473 745 745
Fax: +33 (0) 473 745 700
E-mail: contact@quantel-medical.fr
Web site: www.quantel-medical.com

Quantel
medical



Directive 93/42/EEC

Рисунок 42 – Краткое руководство пользователя



Рисунок 43 – Защитные очки



Рисунок 44 – Адаптер для щелевой лампы



**Рисунок 45 – Лампа щелевая с принадлежностями модели SL 9800 с призма-
удерживающей головкой**



Рисунок 46 – Стол электроподъемный



Рисунок 47 – Налобный офтальмоскоп со встроенным адаптером лазера



Рисунок 48 – Фильтр врача защитный



Рисунок 49 – Адаптер для микроскопа



Рисунок 50 – Кейс переносной

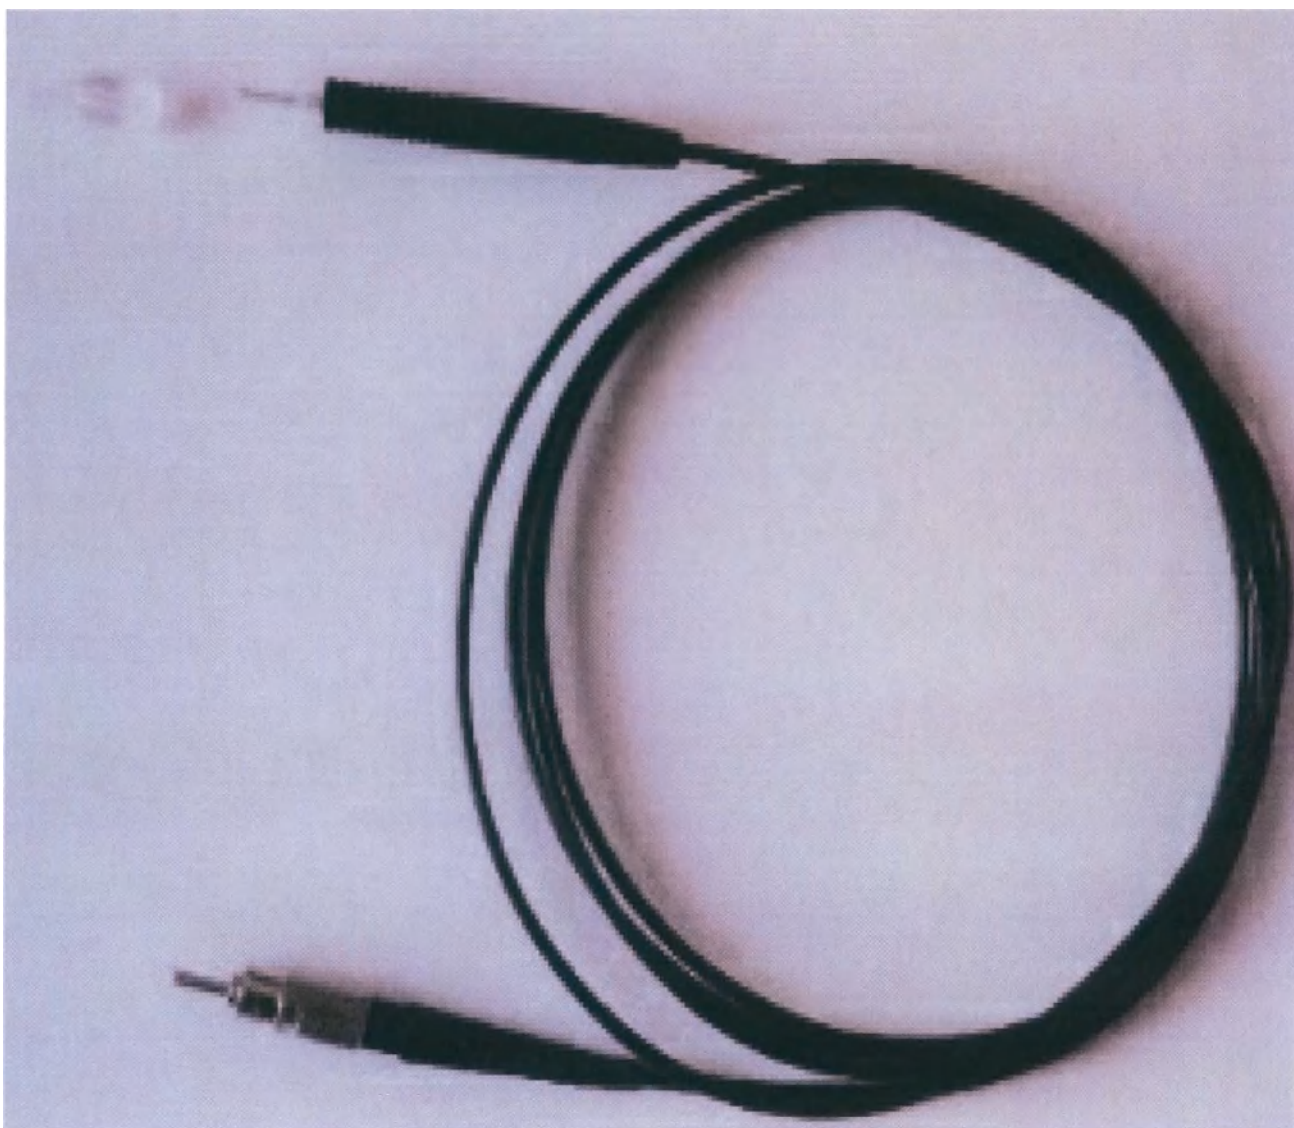


Рисунок 51 – Прямой эндоскоп

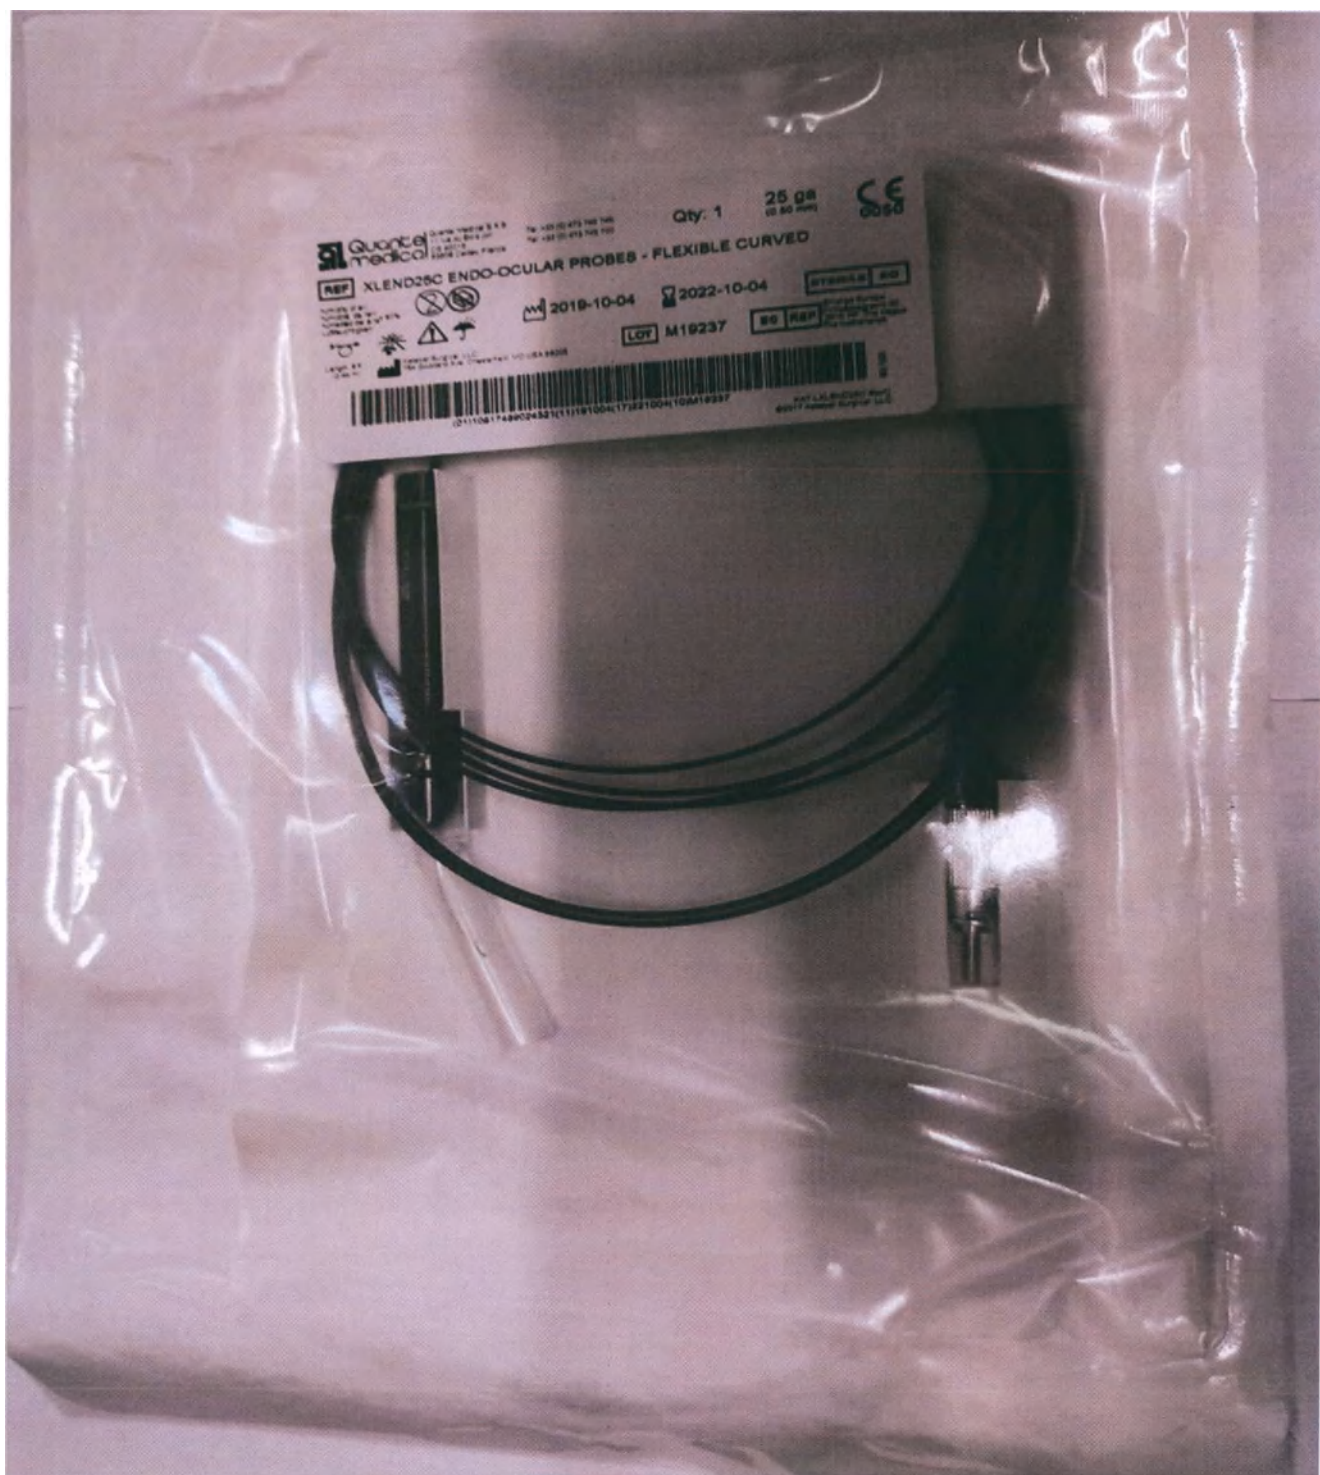


Рисунок 52 – Изогнутый эндозонд

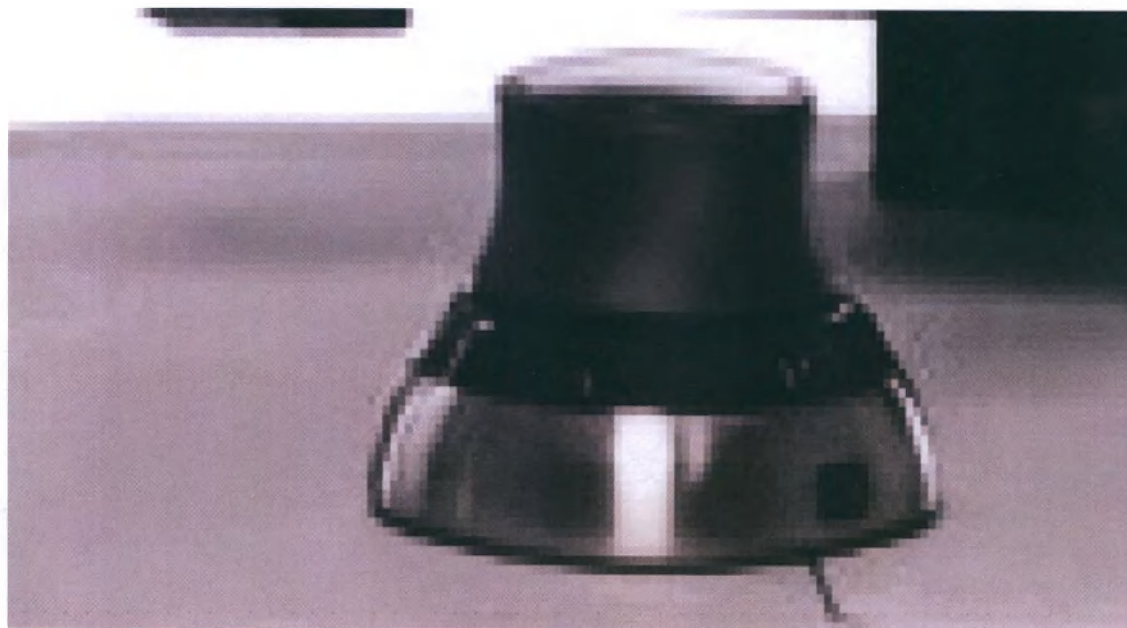


Рисунок 53 – Джойстик



Рисунок 54 – Зеркало для лампы щелевой модели SL 9800



Рисунок 55 – Монтажное кольцо

Вариант исполнения VITRA 2 с лампой щелевой модели SL 9900 и паттерн-системой:



Рисунок 56 – Консоль лазера со столешницей



Рисунок 57 – Шнур питания



Рисунок 58 – Штекер для порта дистанционного дверного выключателя



Рисунок 59 – Ключи



Рисунок 60 – Педаль



Рисунок 61 – Подлокотник



Рисунок 62 – Инструкция пользователя на USB-носителе

USER MANUAL

vitra²



SINGLESPOT
MULTISPOT



APRIL 2018

532nm Retinal Photocoagulation

11, rue du bois joli - CS 40015
63808 Courmon d'Auvergne Cedex
FRANCE
Tel.: +33 (0) 473 745 745
Fax: +33 (0) 473 745 700
E-mail: contact@quantel-medical.fr
Web site: www.quantel-medical.com

Quantel
medical



Directive 93/42/EEC

Рисунок 63 – Краткое руководство пользователя



Рисунок 64 – Защитные очки



Рисунок 65 – Лампа щелевая с принадлежностями модели SL 9900



Рисунок 66 – Щелевая лампа с встроенным адаптером для щелевой лампы и паттерн-системой



Рисунок 67 – Стол электроподъемный



Рисунок 68 – Налобный офтальмоскоп со встроенным адаптером лазера



Рисунок 69 – Фильтр врача защитный



Рисунок 70 – Адаптер для микроскопа



Рисунок 71 – Кейс переносной

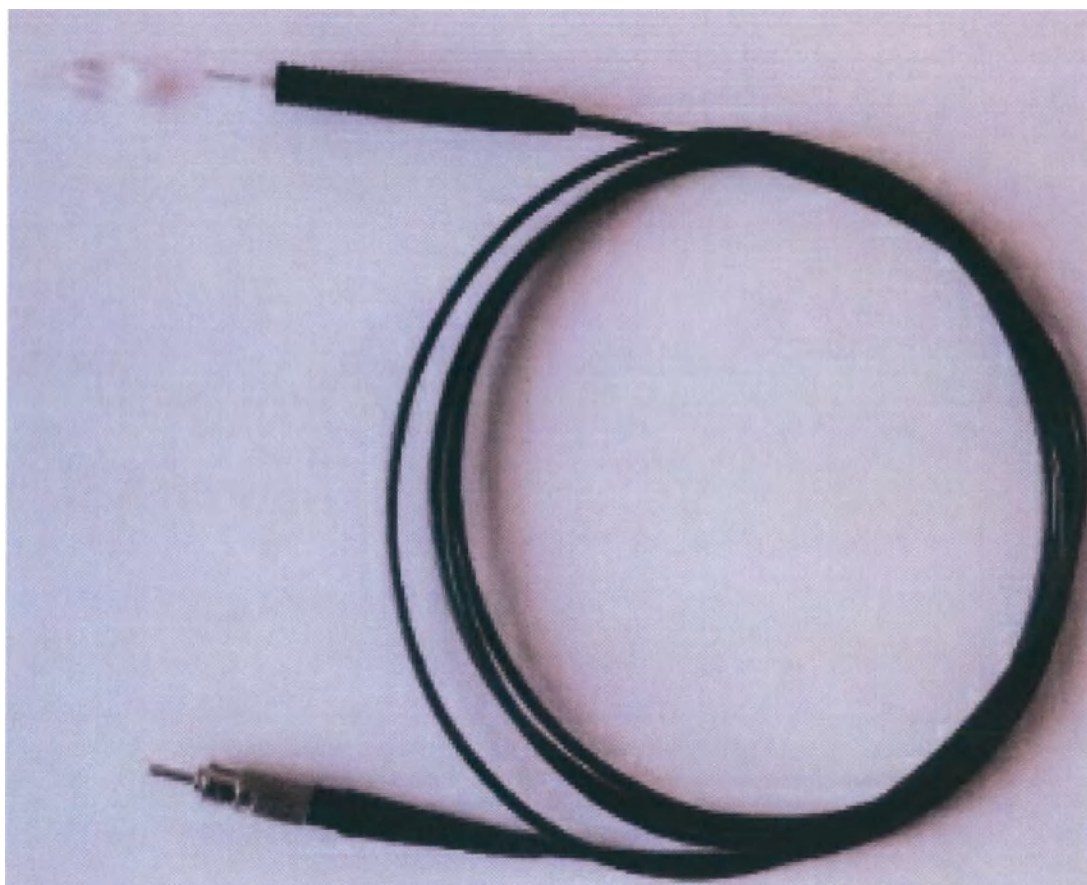


Рисунок 72 – Прямой эндоскоп

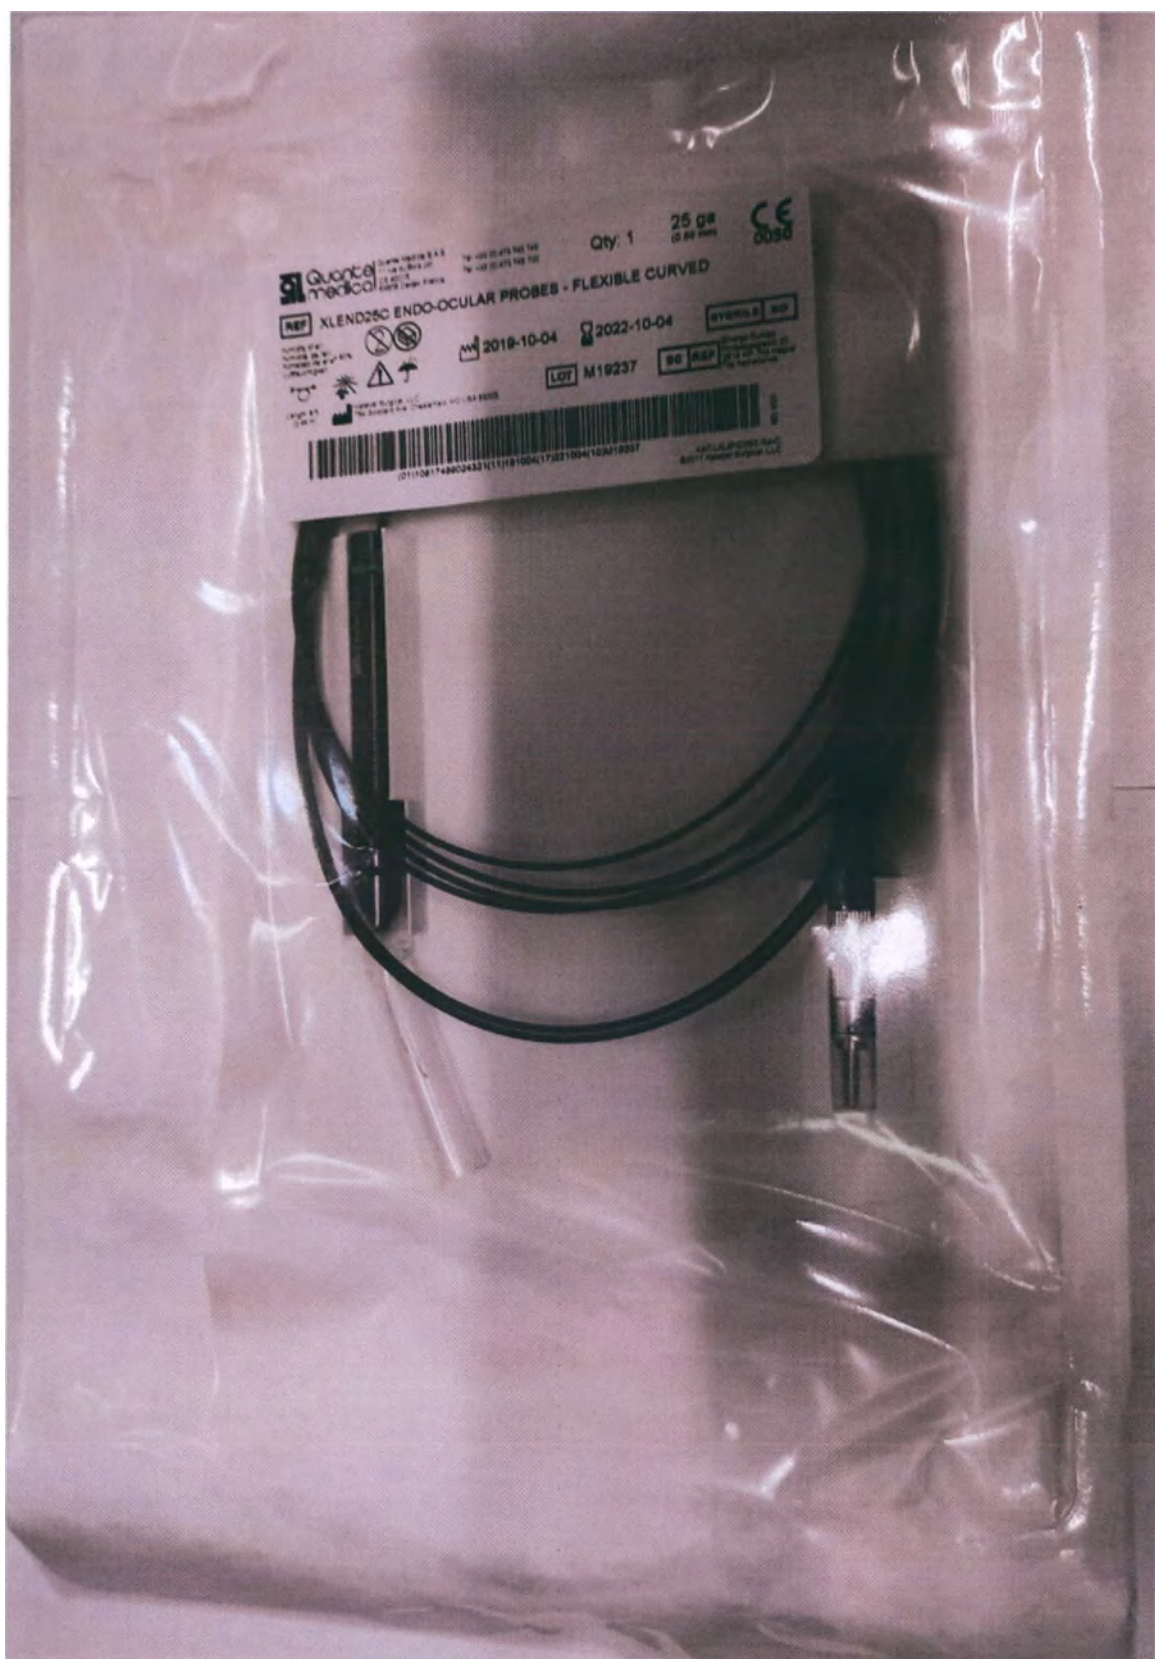


Рисунок 73 – Изогнутый эндозонд

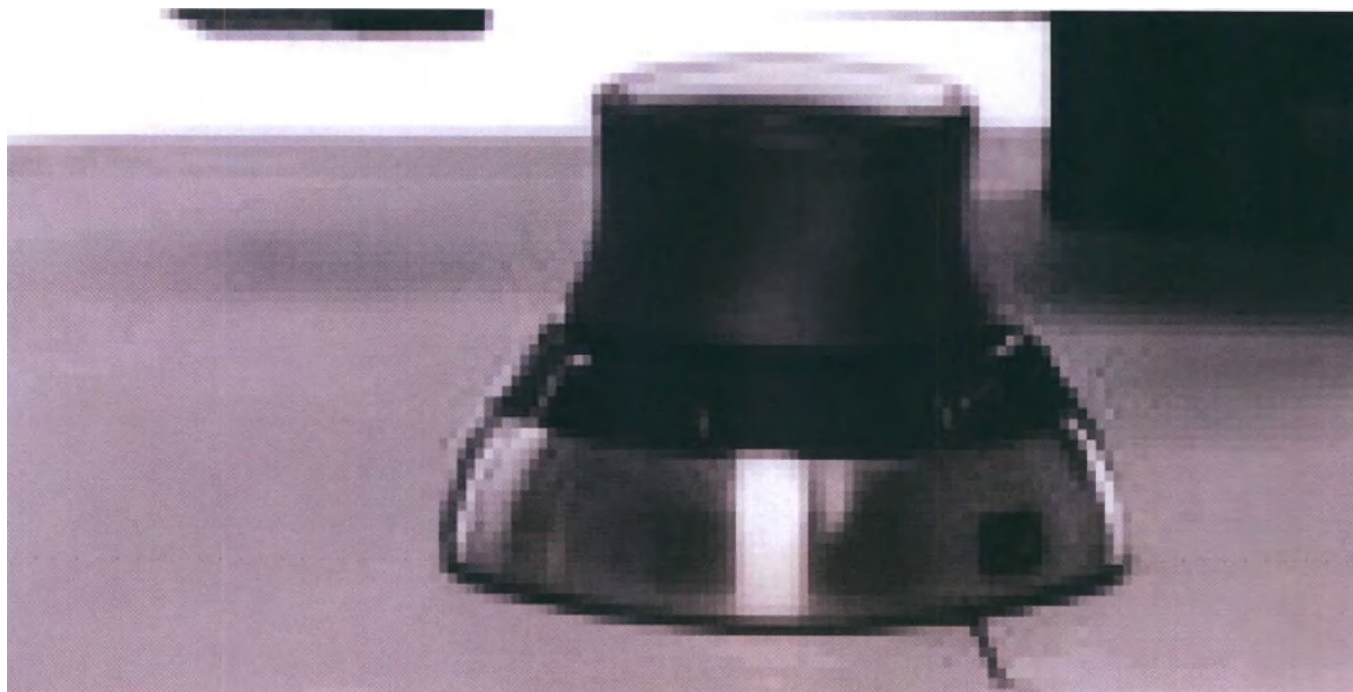


Рисунок 74 – Джойстик



Рисунок 75 – Зеркало для лампы щелевой модели SL 9900



Рисунок 76 – Монтажное кольцо

Вариант исполнения VITRA 2 с лампой щелевой модели SL 9800 и паттерн-системой:



Рисунок 77 – Консоль лазера со столешницей



Рисунок 78 – Шнур питания



Рисунок 79 – Штекер для порта дистанционного дверного выключателя



Рисунок 80 – Ключи



Рисунок 81 – Педаль



Рисунок 82 – Подлокотник



Рисунок 83 – Инструкция пользователя на USB-носителе

USER MANUAL

vitra²



**SINGLESPOT
MULTISPOT**



APRIL 2018

532nm Retinal Photocoagulation

11, rue du bois joli - CS 40015
63808 Courmon d'Auvergne Cedex
FRANCE
Tel.: +33 (0) 473 745 745
Fax: +33 (0) 473 745 700
E-mail: contact@quantel-medical.fr
Web site: www.quantel-medical.com

**Quantel
medical**



Directive 93/42/EEC

Рисунок 84 – Краткое руководство пользователя



Рисунок 85 – Защитные очки



**Рисунок 86 – Лампа щелевая с принадлежностями модели SL 9800 с призма-
удерживающей головкой**



Рисунок 87 – Паттерн-система



Рисунок 88 – Стол электроподъемный

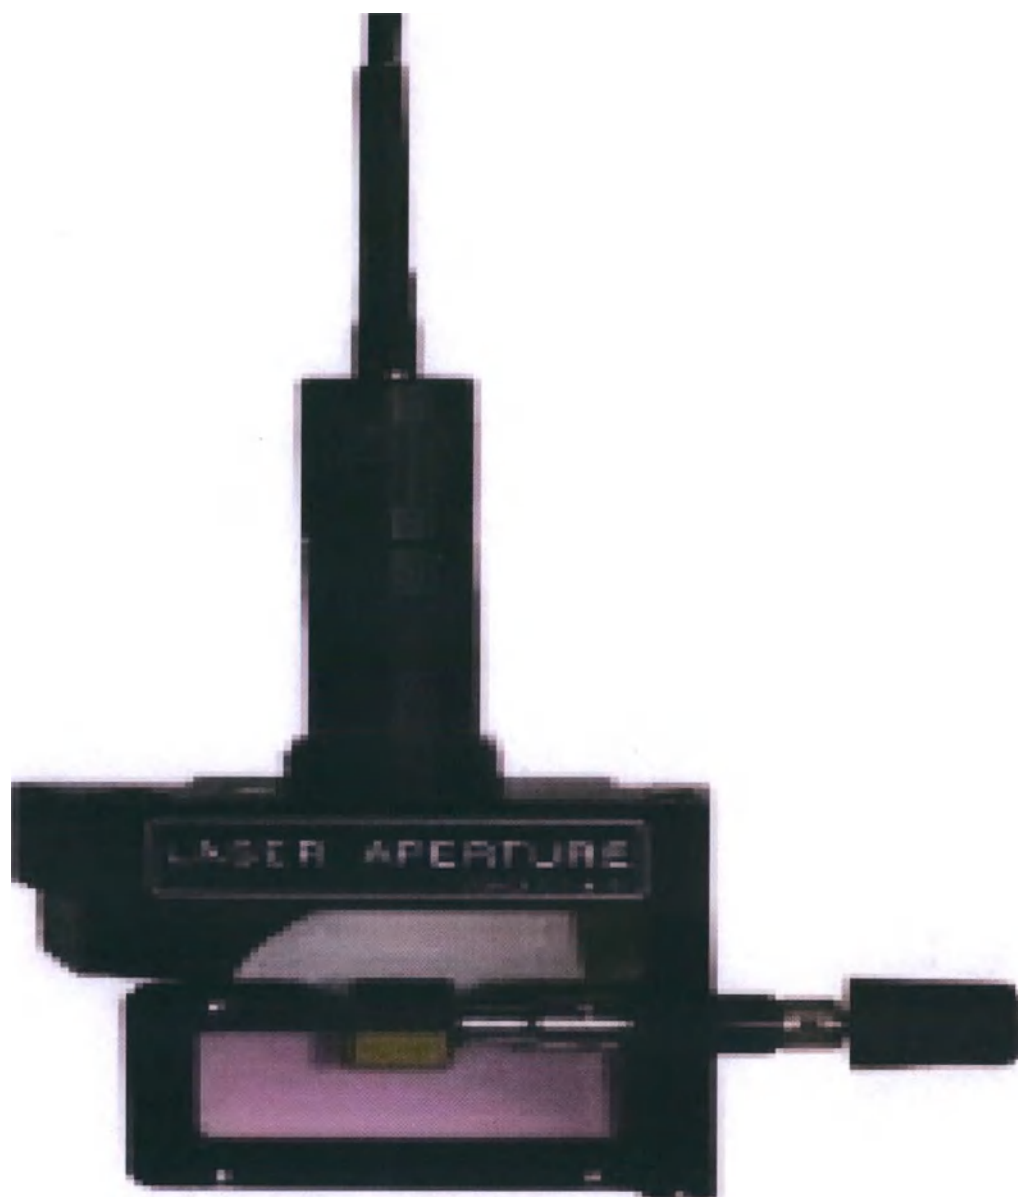


Рисунок 89 – Налобный офтальмоскоп со встроенным адаптером лазера



Рисунок 90 – Фильтр врача защитный



Рисунок 91 – Адаптер для микроскопа



Рисунок 92 – Кейс переносной

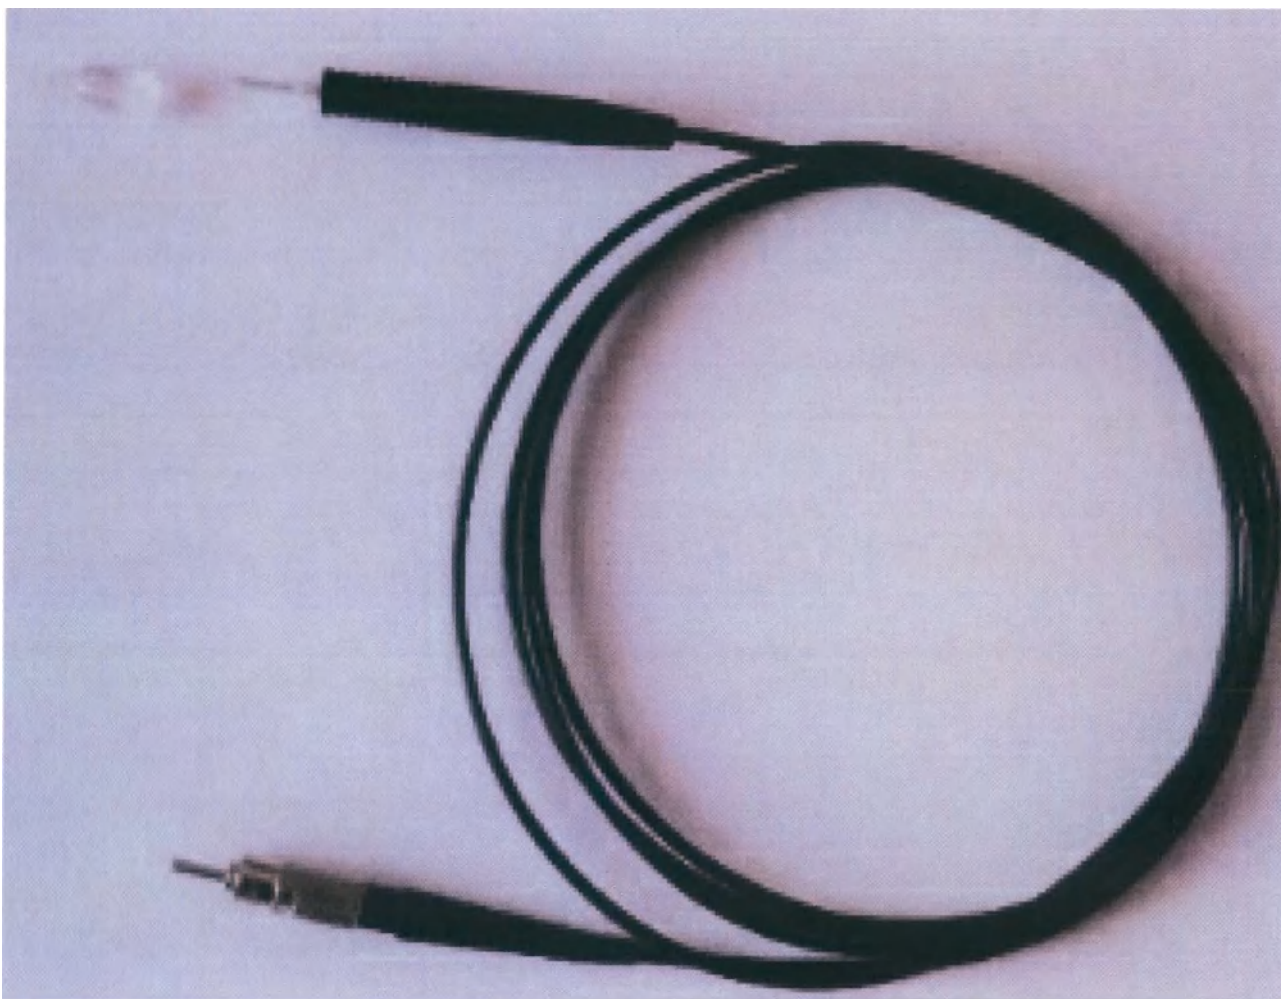


Рисунок 93 – Прямой эндозонд



Рисунок 94 – Изогнутый эндоскоп

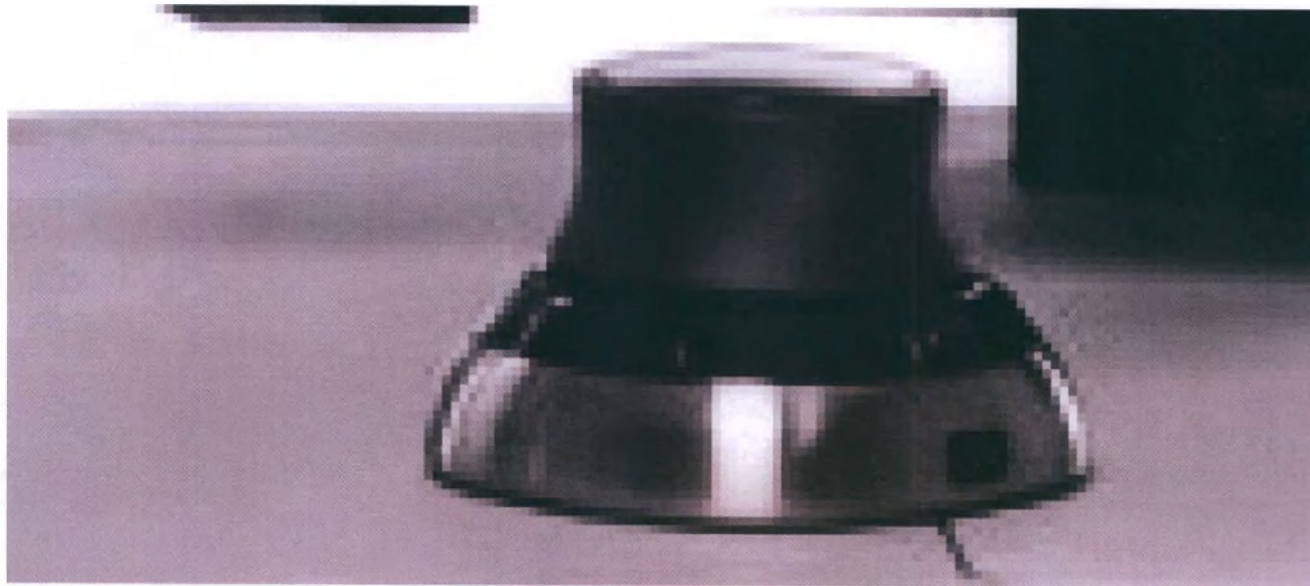


Рисунок 95 – Джойстик



Рисунок 96 – Зеркало для лампы щелевой модели SL 9800



Рисунок 97 – Монтажное кольцо



Рисунок 98 – маркировка консоли лазера со столешницей



Рисунок 99 – маркировка педали



Рисунок 100 – маркировка лампы щелевой

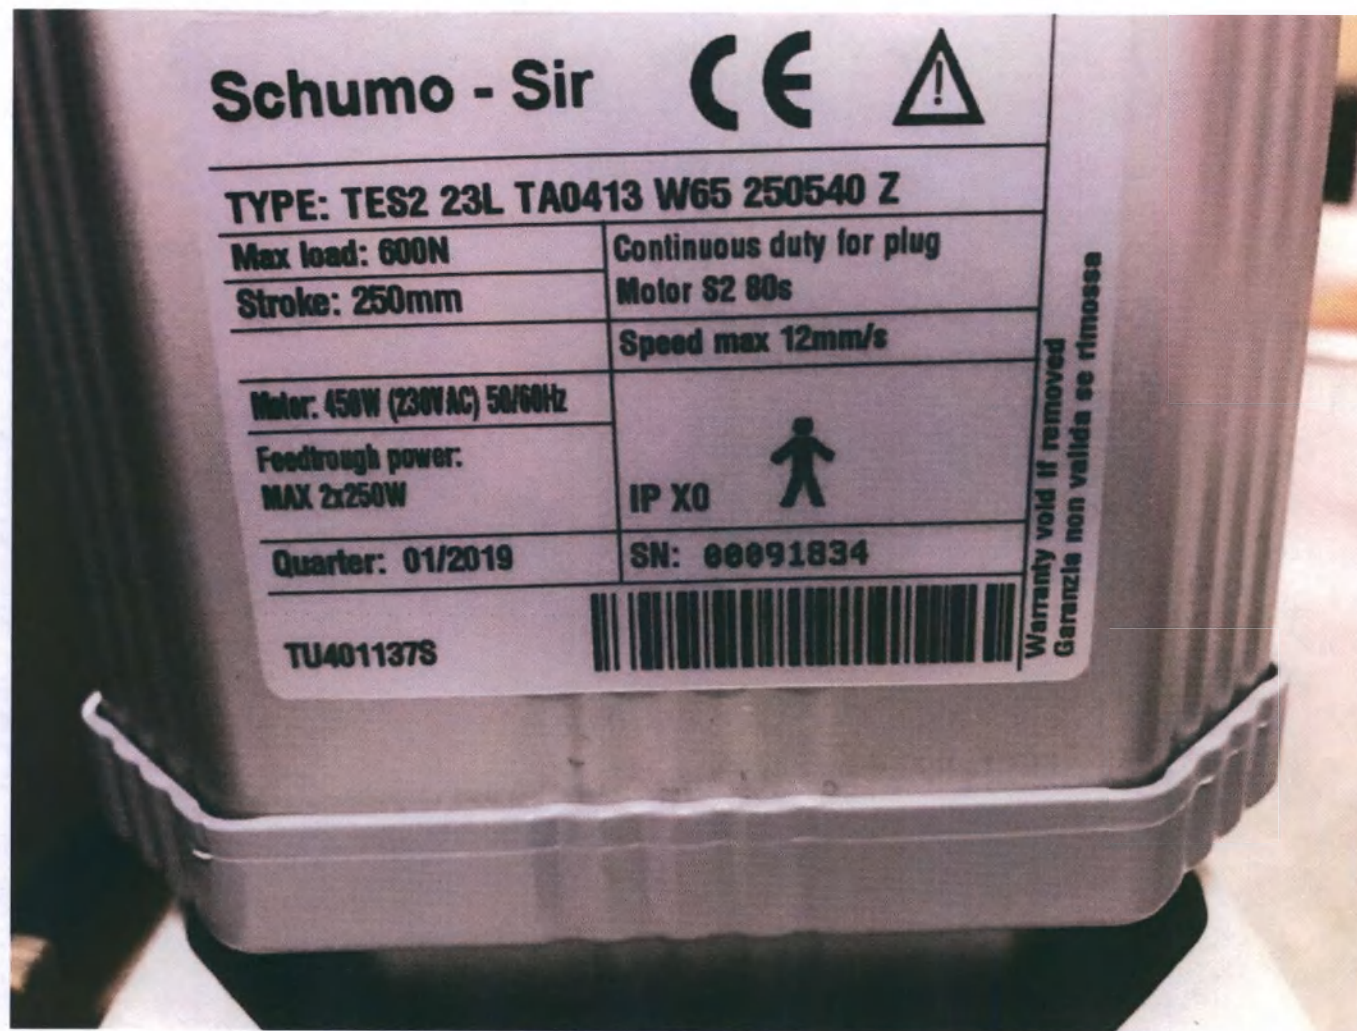


Рисунок 101 – маркировка стола электроподъемного (колонна)



Рисунок 102 – маркировка транспортной упаковки

Прошито, пронумеровано

111 (сто один-
кадцать)

лист (а/ов)

Скреплено печатью.

Манаф

