

УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный директор
ООО «РУМЭКС Медикал»**



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Система офтальмологическая лазерная VITRA 810, в вариантах исполнения: VITRA 810; VITRA 810 с лампой щелевой модели SL 9800; VITRA 810 с лампой щелевой модели SL 9900

Вариант исполнения VITRA 810



Рисунок 1 – Консоль лазера со столешницей



Рисунок 2 – Шнур питания



Рисунок 3 – Штекер для порта дистанционного дверного выключателя



Рисунок 4 – Ключи



Рисунок 5 – Педаль



Рисунок 6 – Инструкция пользователя на USB-носителе



11, rue du bois joli - CS 40015
63808 Courmon d'Auvergne Cedex
FRANCE
Tel.: +33 (0) 473 745 745
Fax: +33 (0) 473 745 700
E-mail: contact@quantel-medical.fr
Web site: www.quantel-medical.com



Рисунок 7 – Краткое руководство пользователя



Рисунок 8 – Защитные очки



Рисунок 9 – Подлокотник



Рисунок 10 – Прямой эндозонд



Рисунок 11 – Изогнутый эндозонд

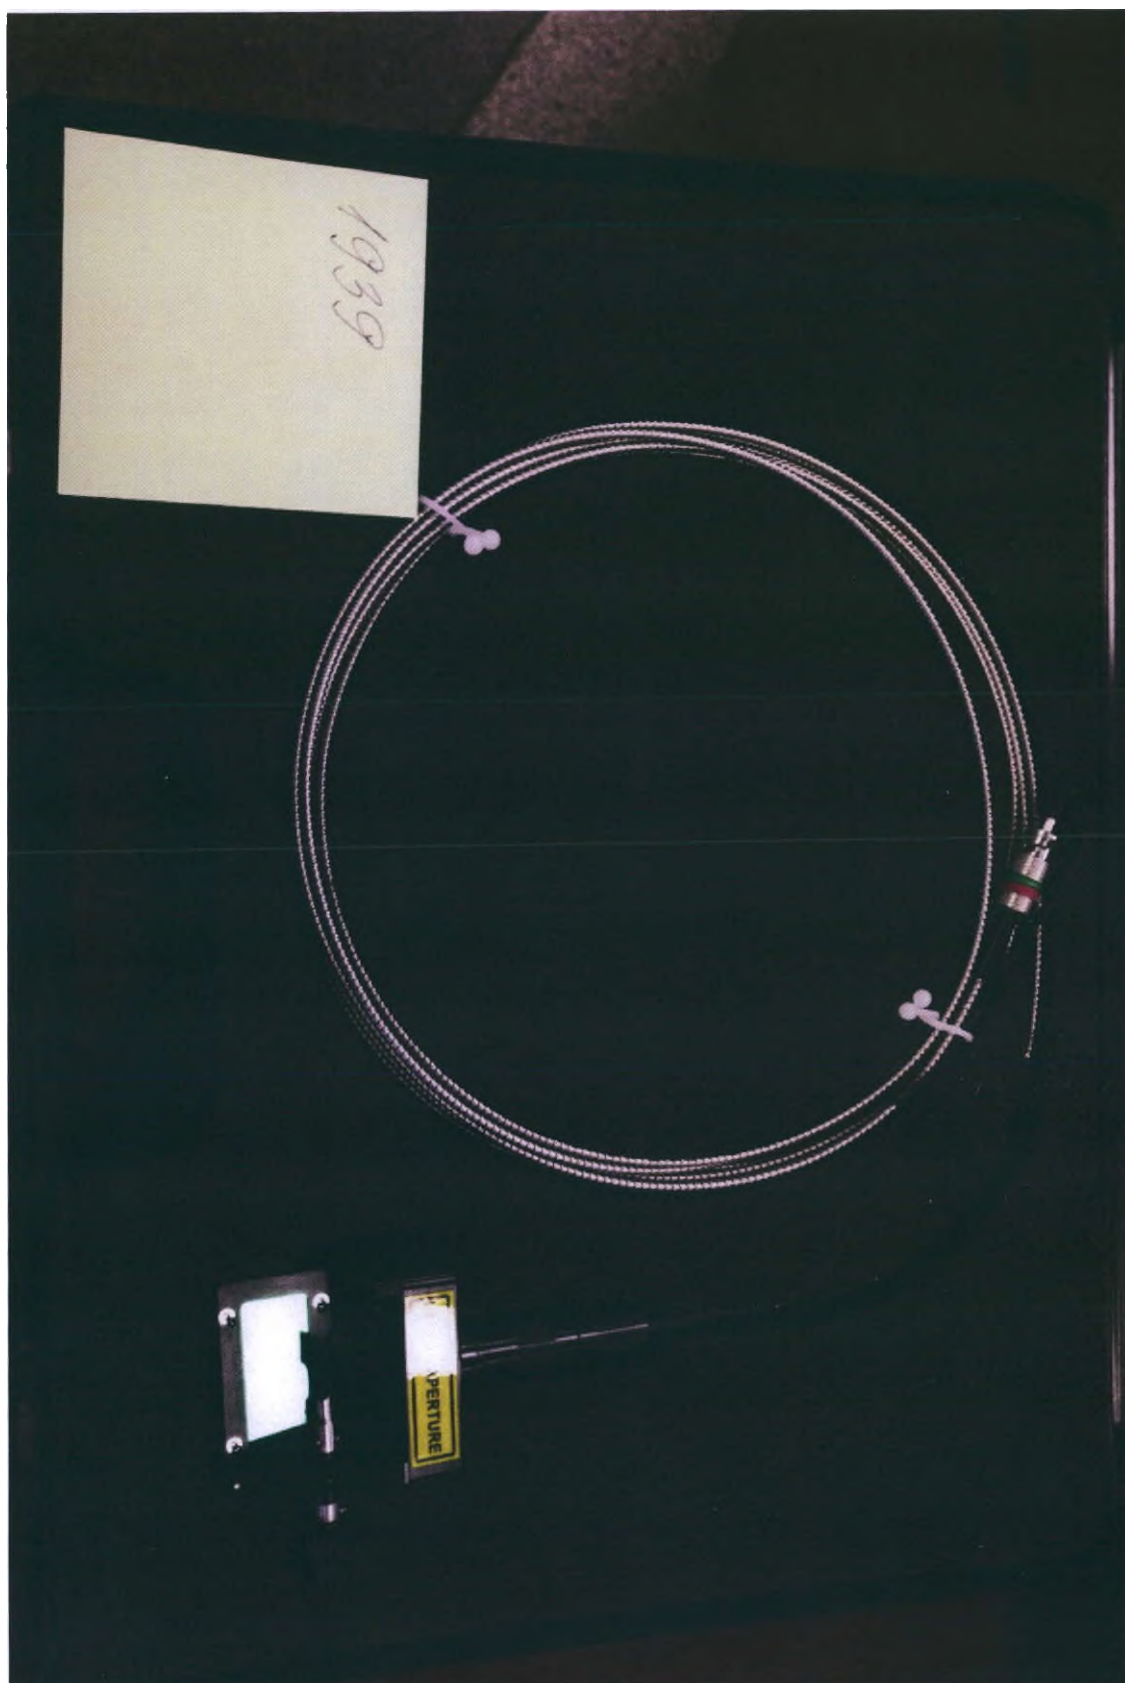


Рисунок 12 – Зонд для проведения ретинопексии

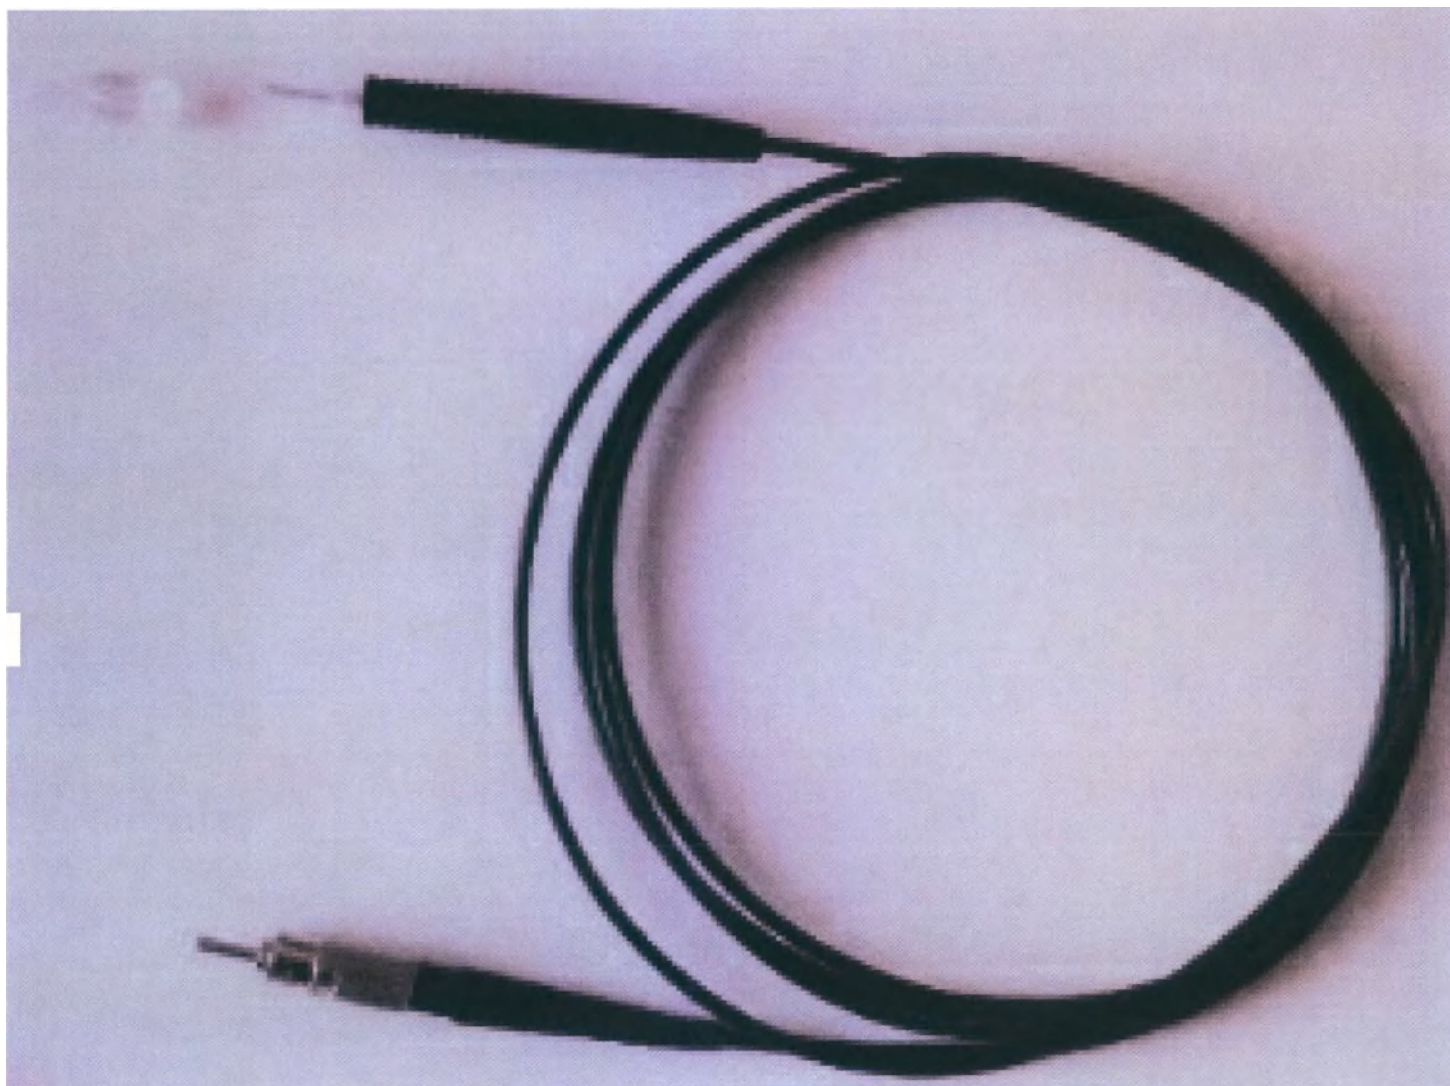


Рисунок 13 – Зонд для проведения циклофотокоагуляции



Рисунок 14 – Плата для установки зонда для проведения циклофотокоагуляции



Рисунок 15 – Монтажное кольцо

Вариант исполнения VITRA 810 с лампой щелевой модели SL 9800



Рисунок 16 – Консоль лазера со столешницей



Рисунок 17 – Шнур питания



Рисунок 18 – Штекер для порта дистанционного дверного выключателя



Рисунок 19 – Ключи



Рисунок 20 – Педадь



Рисунок 21 – Инструкция пользователя на USB-носителе



Directive 93/42/EEC

11, rue du bois joli - CS 40015
63808 Courmon d'Auvergne Cedex
FRANCE
Tel : +33 (0) 473 745 745
Fax : +33 (0) 473 745 700
E-mail : contact@quantel-medical.fr
Web site : www.quantel-medical.com

Quantel
medical

Рисунок 22 – Краткое руководство пользователя



Рисунок 23 – Защитные очки

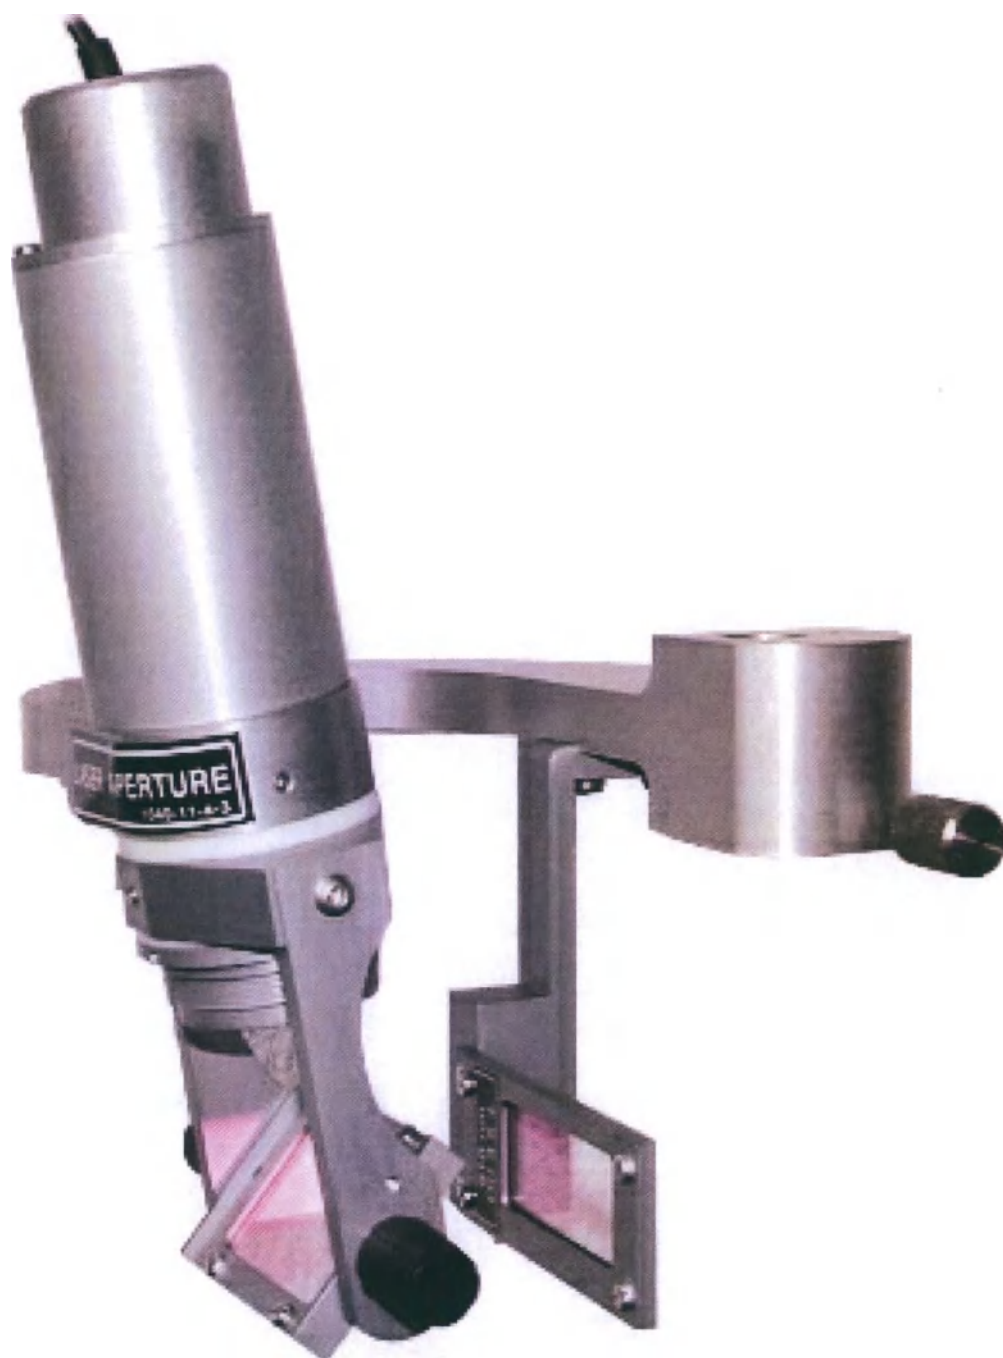


Рисунок 24 – Адаптер для щелевой лампы

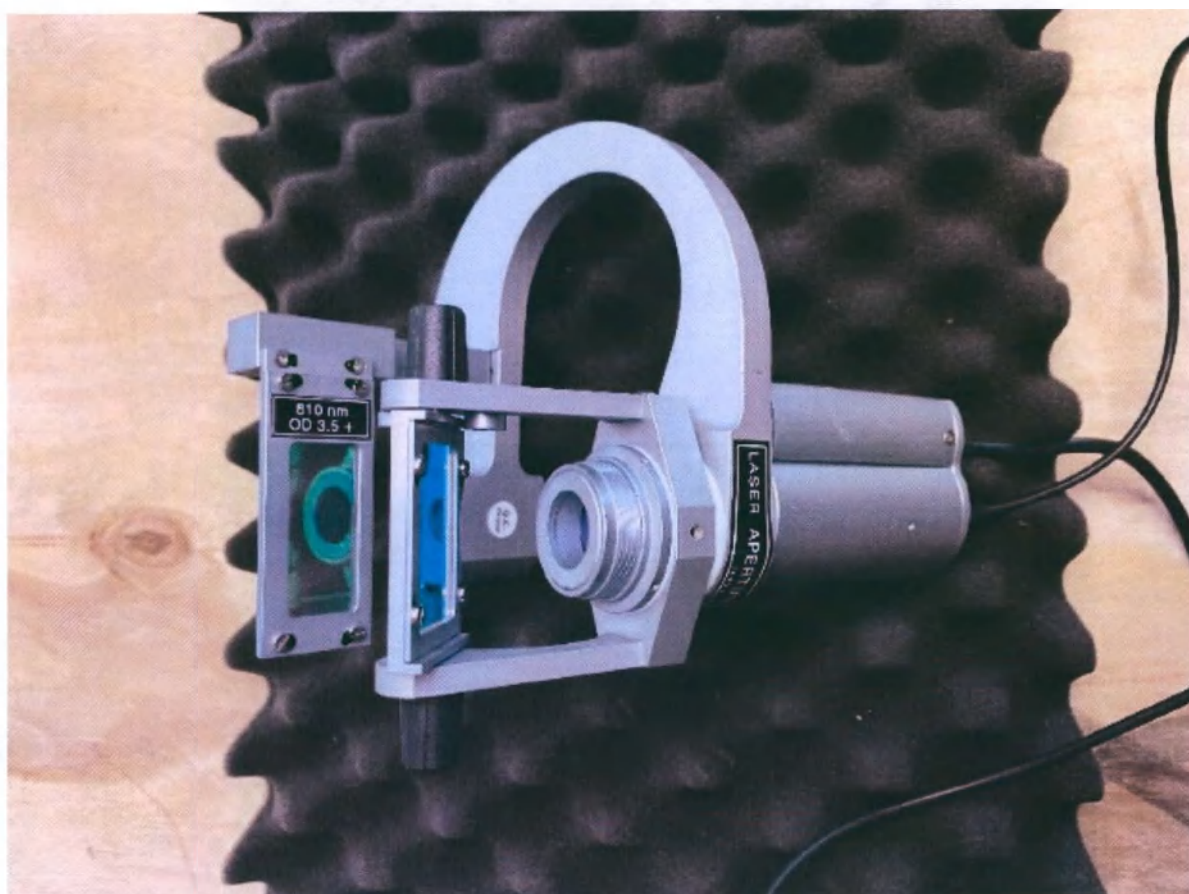


Рисунок 25 – Адаптер для щелевой лампы с широким пятном



Рисунок 26 – Лампа щелевая с принадлежностями модели SL 9800



Рисунок 27 – Стол электроподъемный



Рисунок 28 – Налобный офтальмоскоп со встроенным адаптером лазера



Рисунок 29 – Фильтр врача защитный



Рисунок 30 – Адаптер для микроскопа



Рисунок 31 – Кейс переносной



Рисунок 32 – Подлокотник



Рисунок 33 – Прямой эндозонд



Рисунок 34 – Изогнутый эндозонд

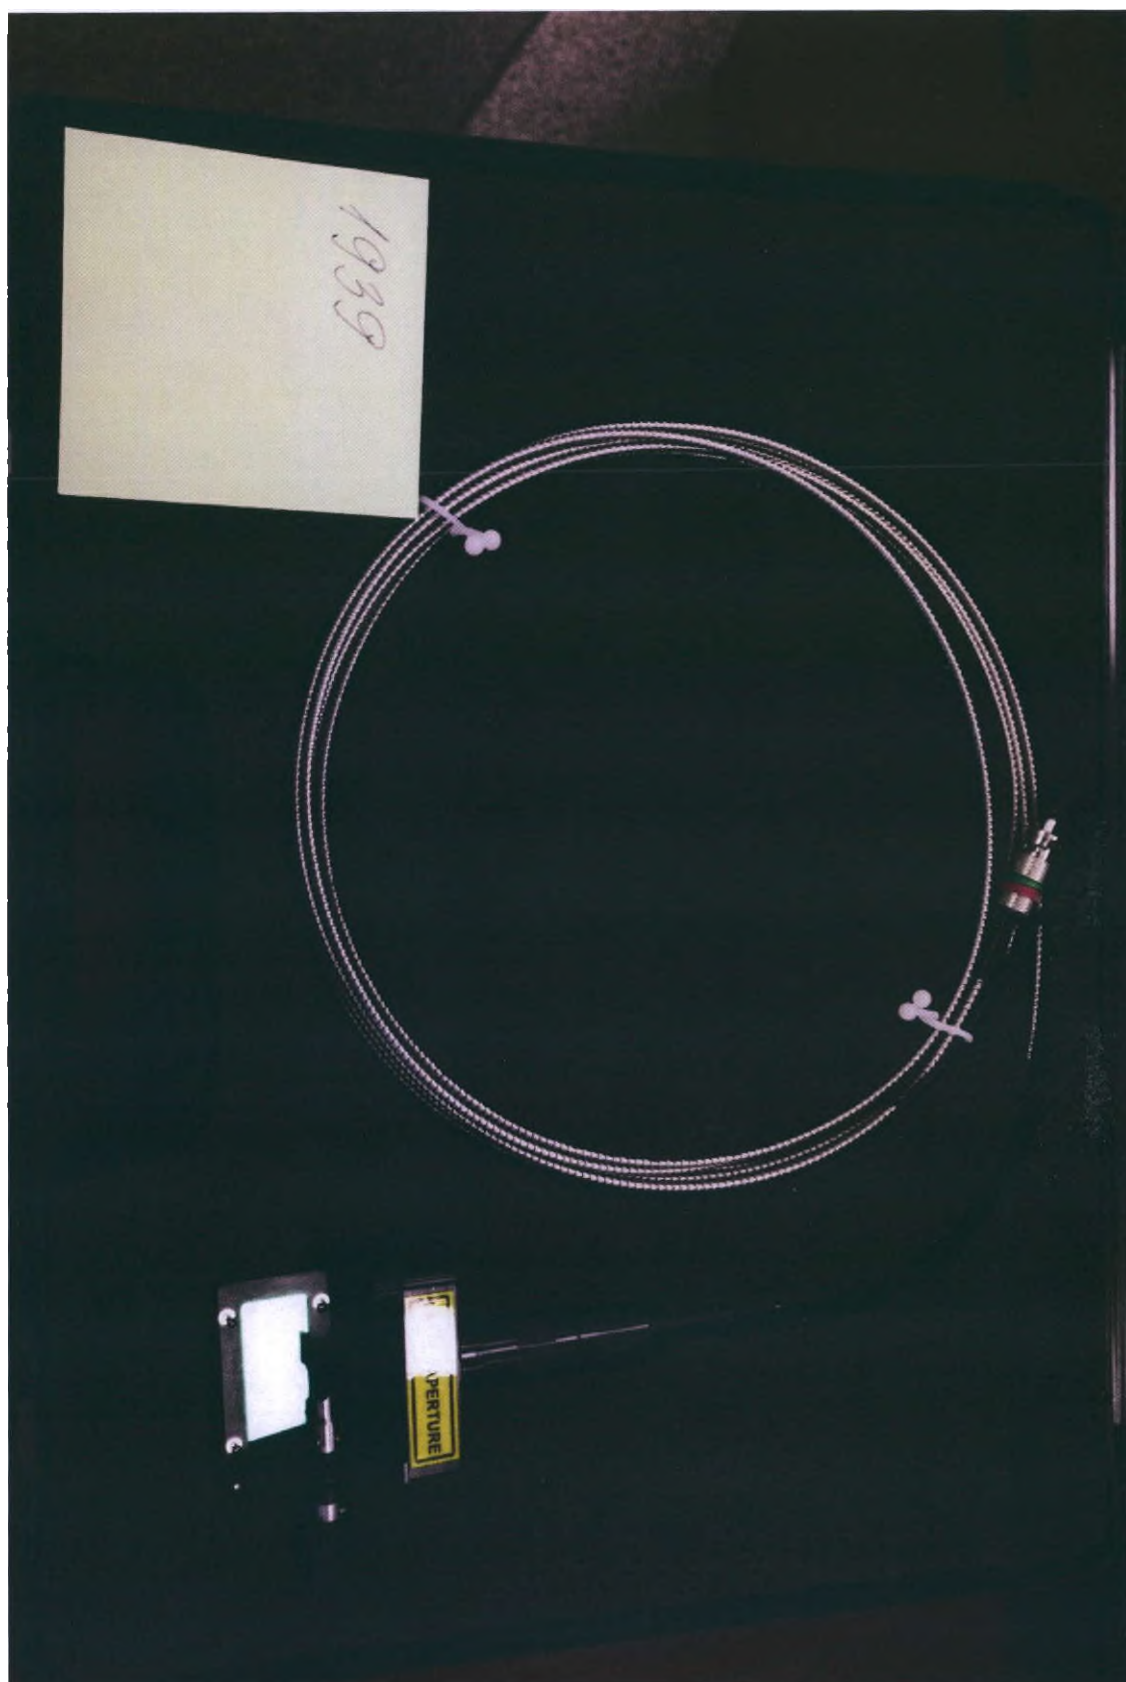


Рисунок 35 – Зонд для проведения ретинопексии

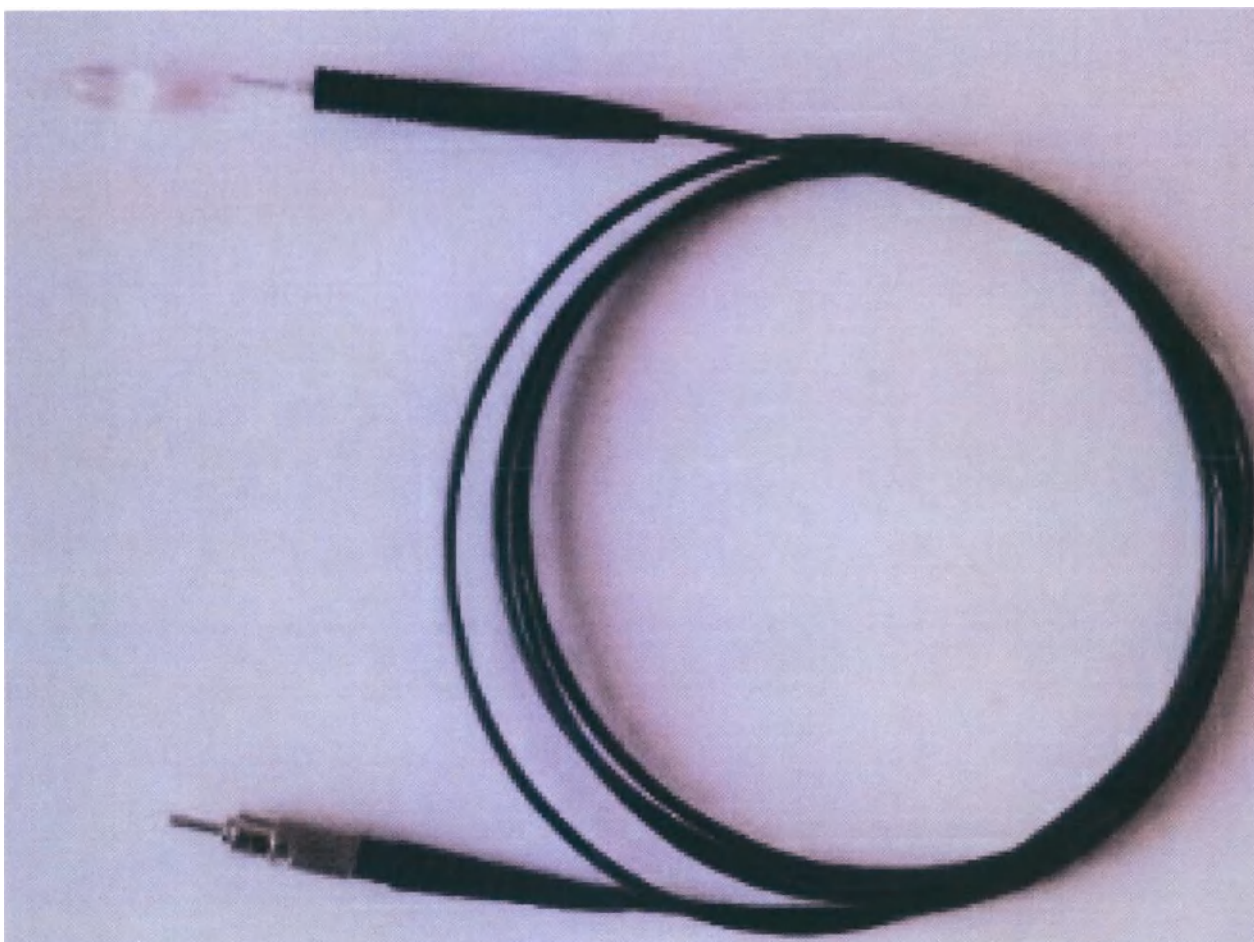


Рисунок 36 – Зонд для проведения циклофотокоагуляции



Рисунок 37 – Плата для установки зонда для проведения
циклофотокоагуляции



Рисунок 38 – Зеркало для лампы щелевой модели SL 9800



Рисунок 39 – Монтажное кольцо

Вариант исполнения VITRA 810 с лампой щелевой модели SL 9900



Рисунок 40 – Консоль лазера со столешницей



Рисунок 41 – Шнур питания



Рисунок 42 – Штекер для порта дистанционного дверного выключателя



Рисунок 43 – Ключи



Рисунок 44 – Педаль



Рисунок 45 – Инструкция пользователя на USB-носителе



11, rue du bois joli - CS 40015
63808 Courmon d'Auvergne Cedex
FRANCE
Tel. : +33 (0) 473 745 745
Fax : +33 (0) 473 745 700
E-mail : contact@quantel-medical.fr
Web site: www.quantel-medical.com

Quantel
medical

Рисунок 46 – Краткое руководство пользователя



Рисунок 47 – Защитные очки

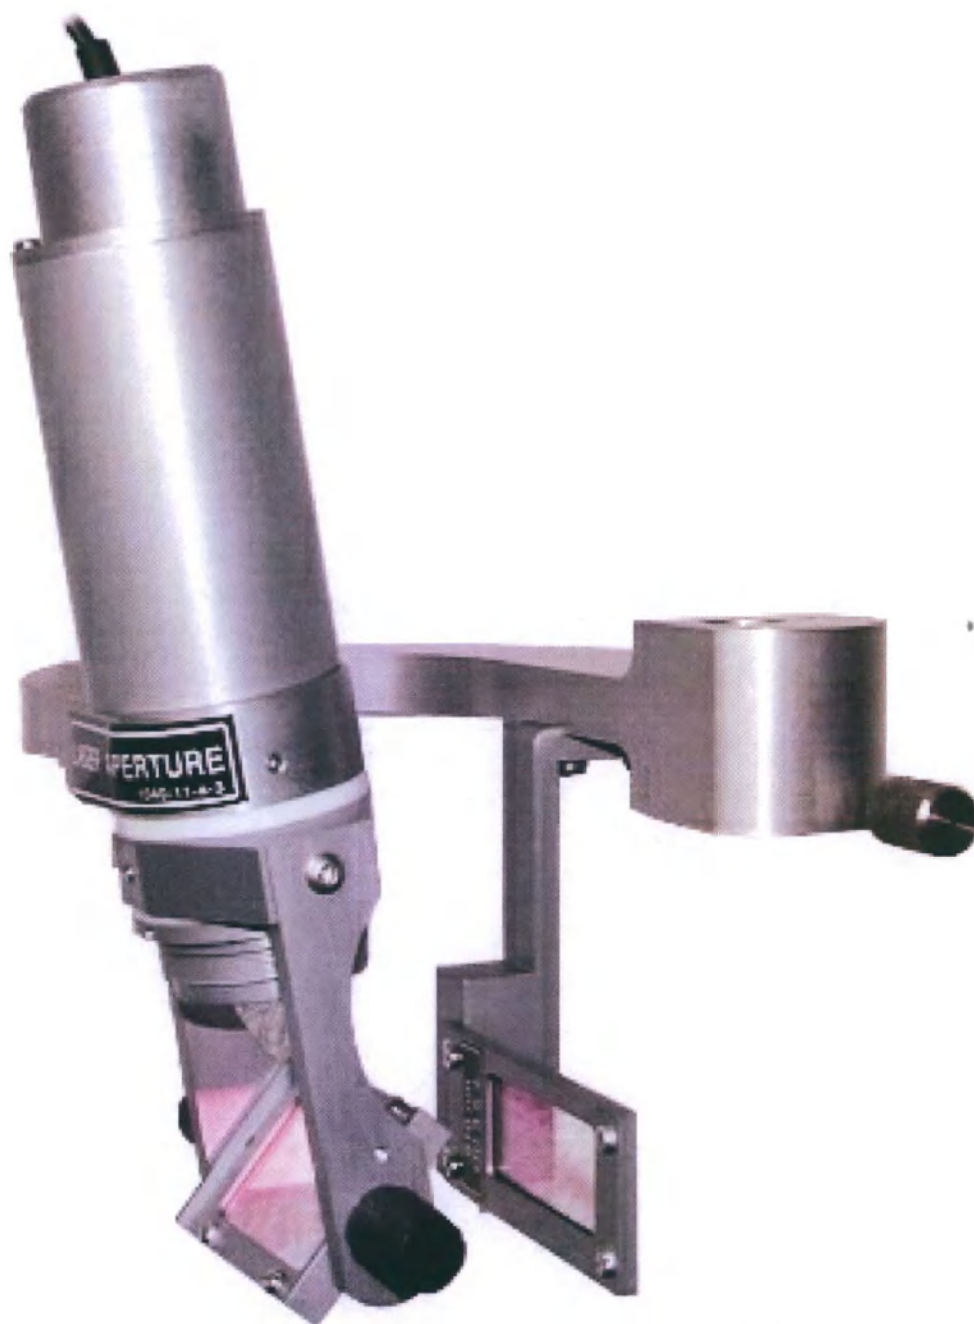


Рисунок 48 – Адаптер для щелевой лампы

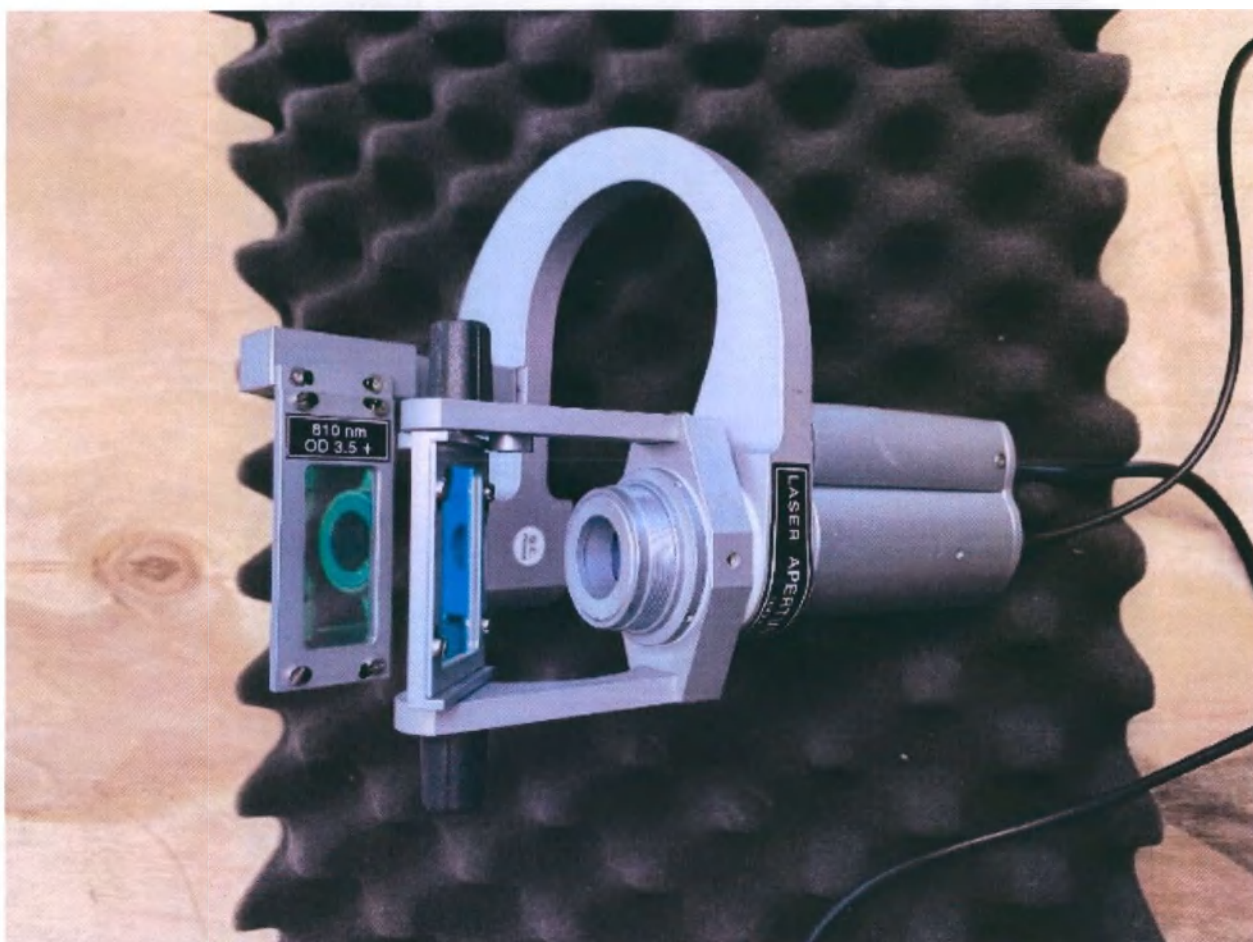


Рисунок 49 – Адаптер для щелевой лампы с широким пятном

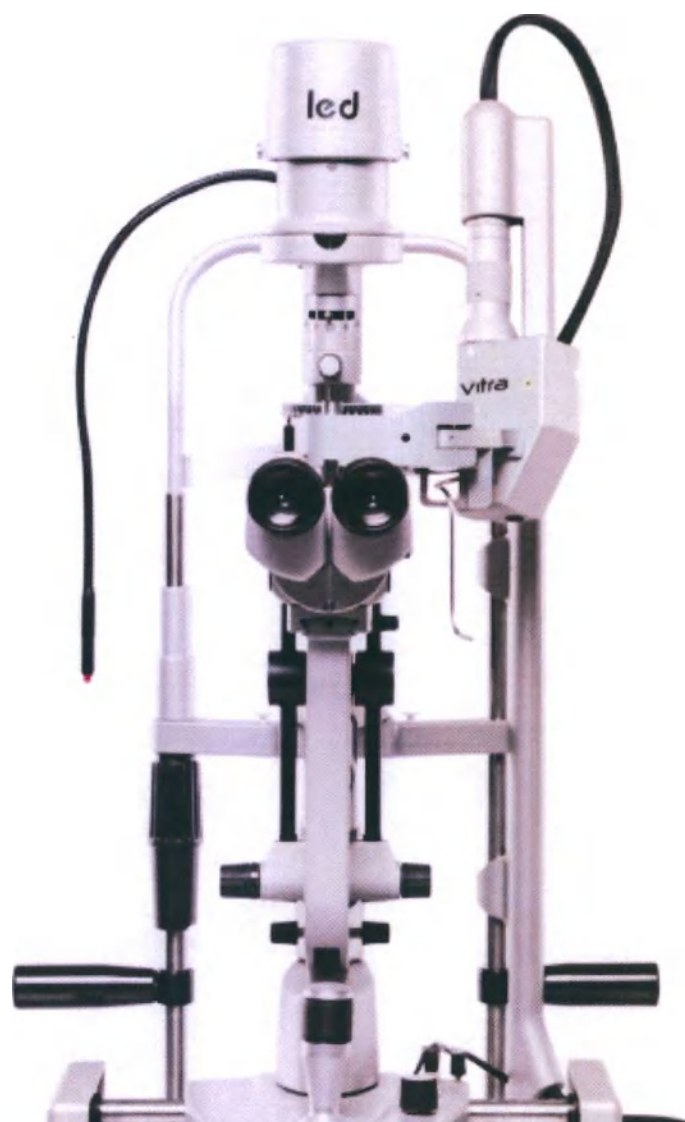


Рисунок 50 – Лампа щелевая с принадлежностями модели SL 9800



Рисунок 51 – Стол электроподъемный



Рисунок 52 – Налобный офтальмоскоп со встроенным адаптером лазера



Рисунок 53 – Фильтр врача защитный



Рисунок 54 – Адаптер для микроскопа



Рисунок 55 – Кейс переносной



Рисунок 56 – Подлокотник

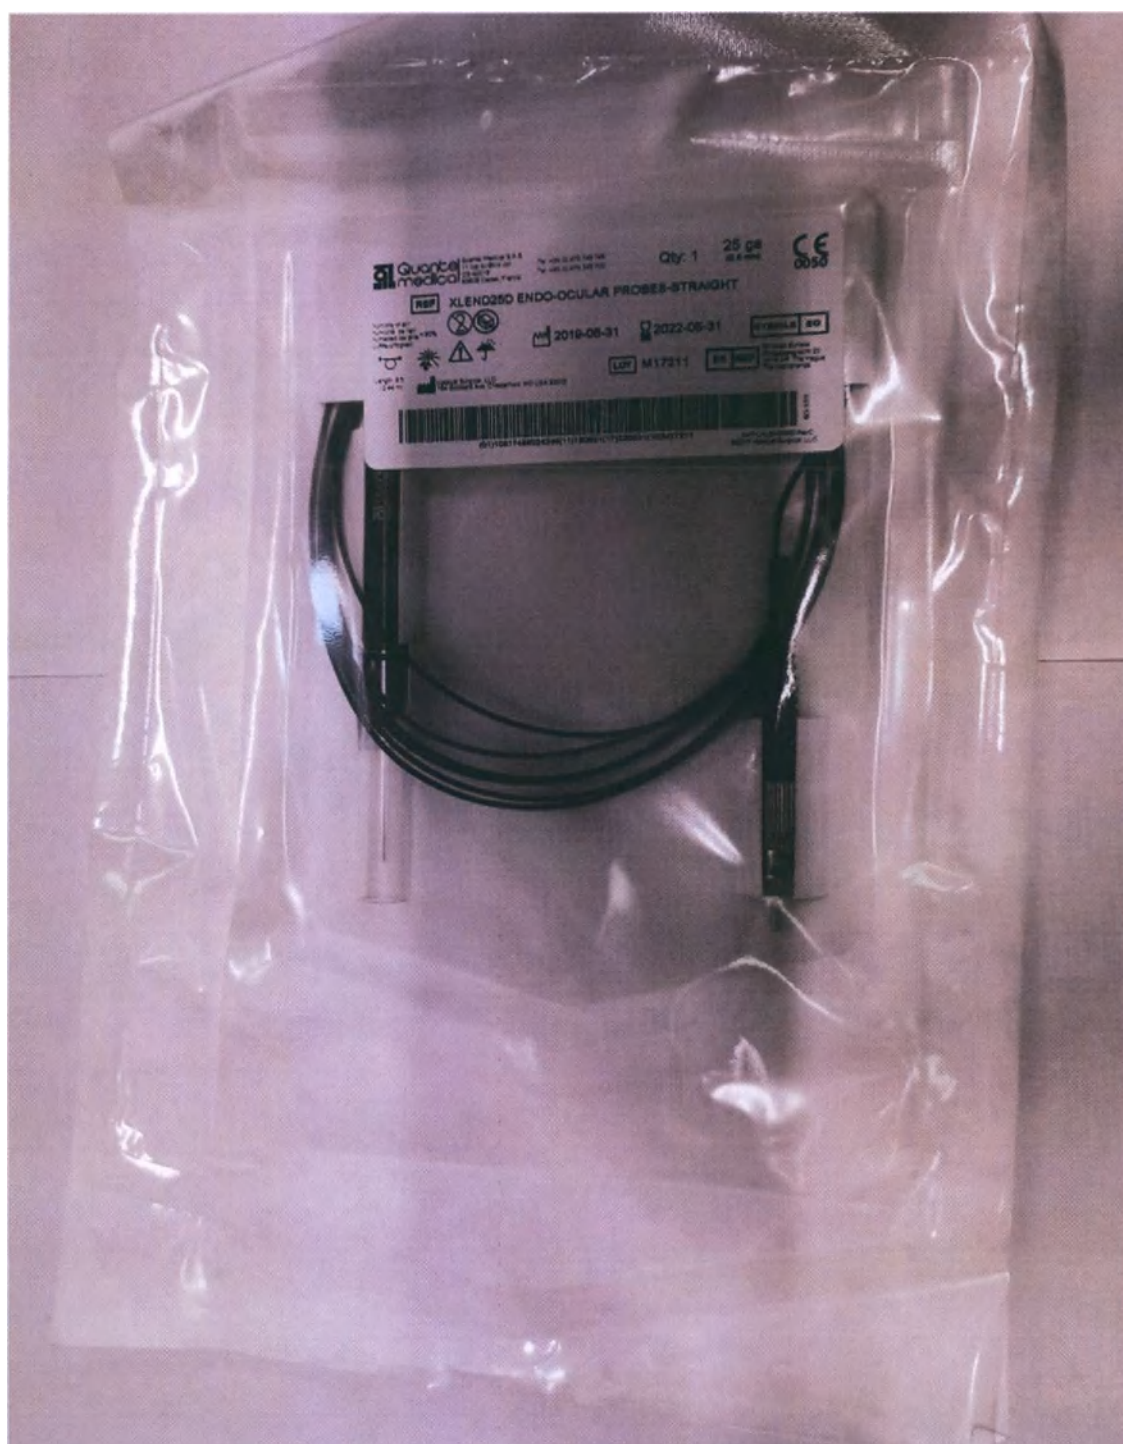


Рисунок 57 – Прямой эндозонд

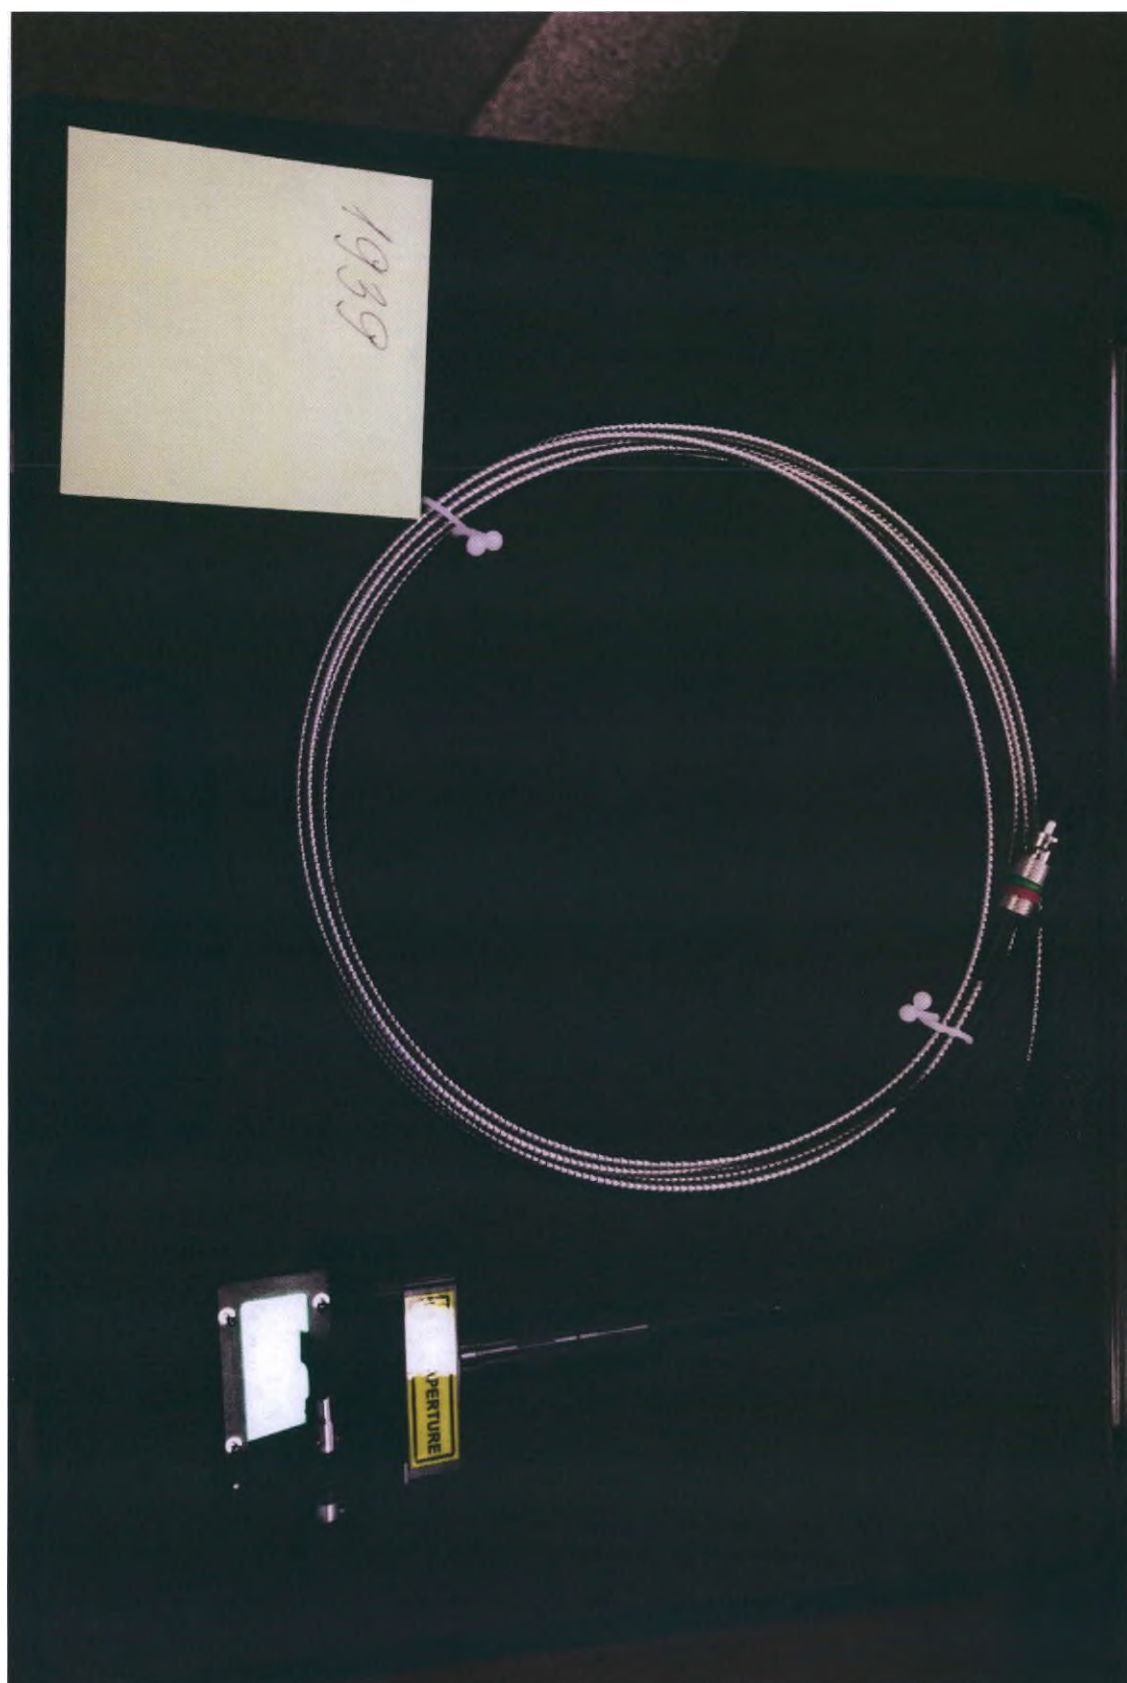


Рисунок 59 – Зонд для проведения ретинопексии

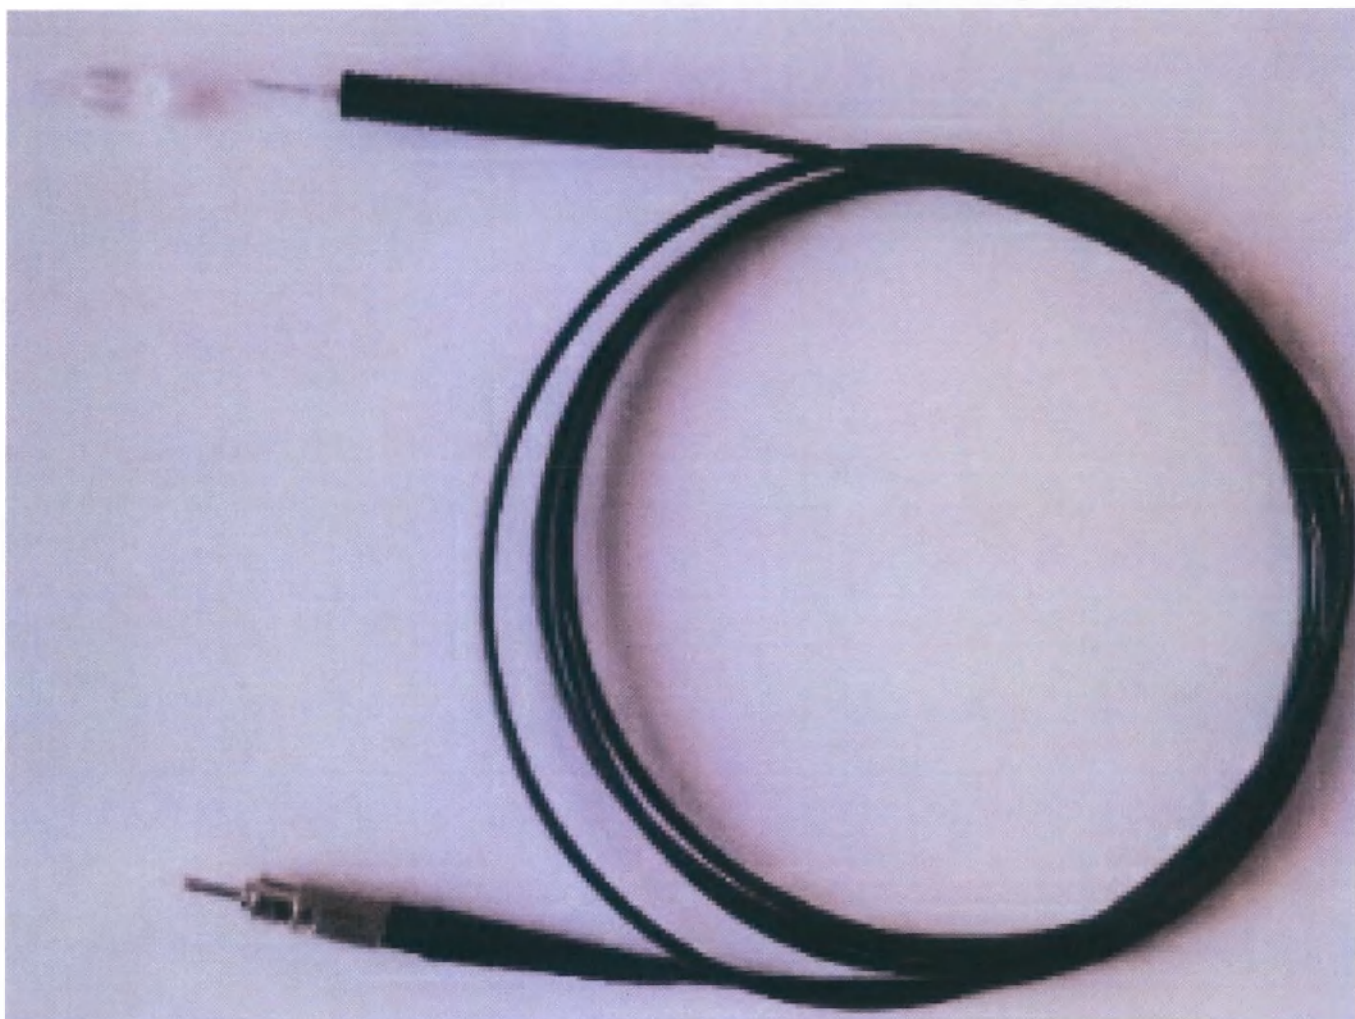


Рисунок 60 – Зонд для проведения циклофотокоагуляции

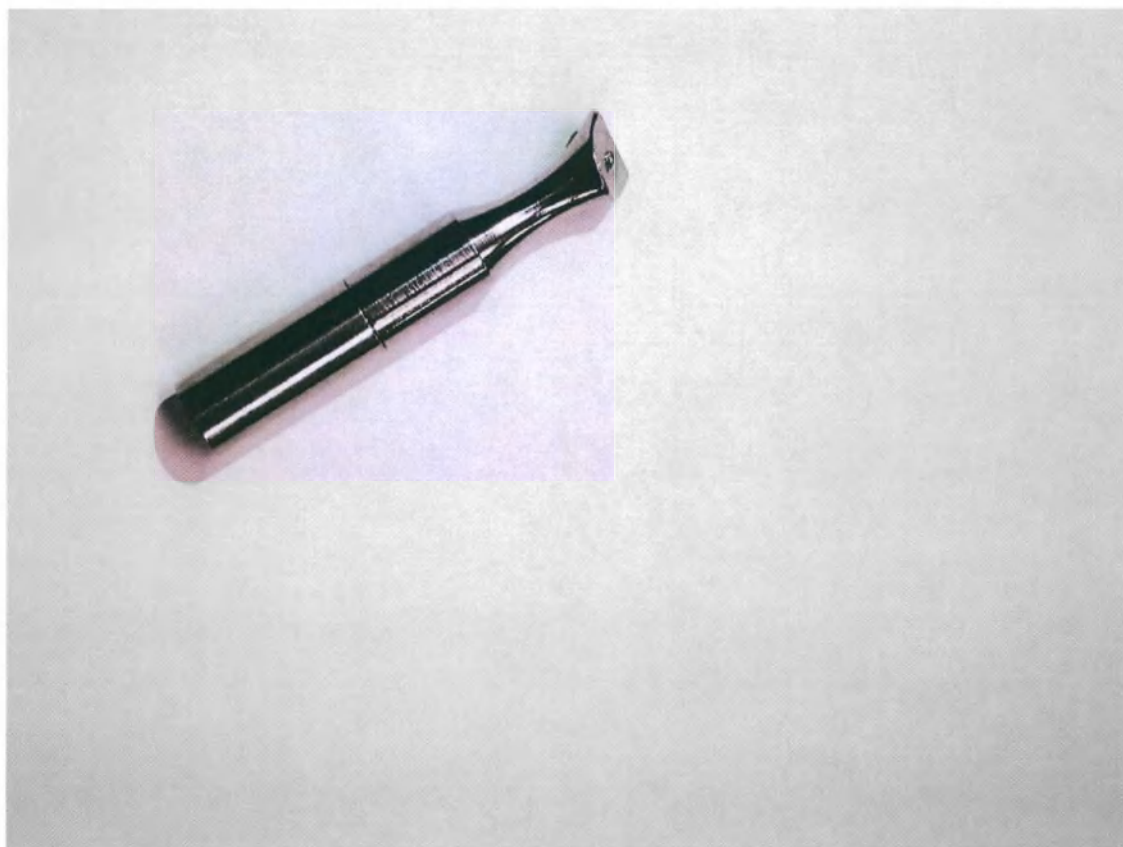



Рисунок 61 – Плата для установки зонда для проведения
циклофотокоагуляции



Рисунок 62 – Зеркало для лампы щелевой модели SL 9800



Рисунок 63 – Монтажное кольцо

 **CSO S.r.l.**

via degli Stagnacci, 12/E Badia a Settimo

50018 Scandicci (FI) Italy

SN **19080044**

Fuses 2xT(5x20)

100-120V ~ 15A/250V 

230-240V ~ 8A/250V 

50/60 Hz



Рисунок 64 – маркировка консоли лазера со столешницей



Рисунок 64 – маркировка педали



Рисунок 64 – маркировка лампы щелевой

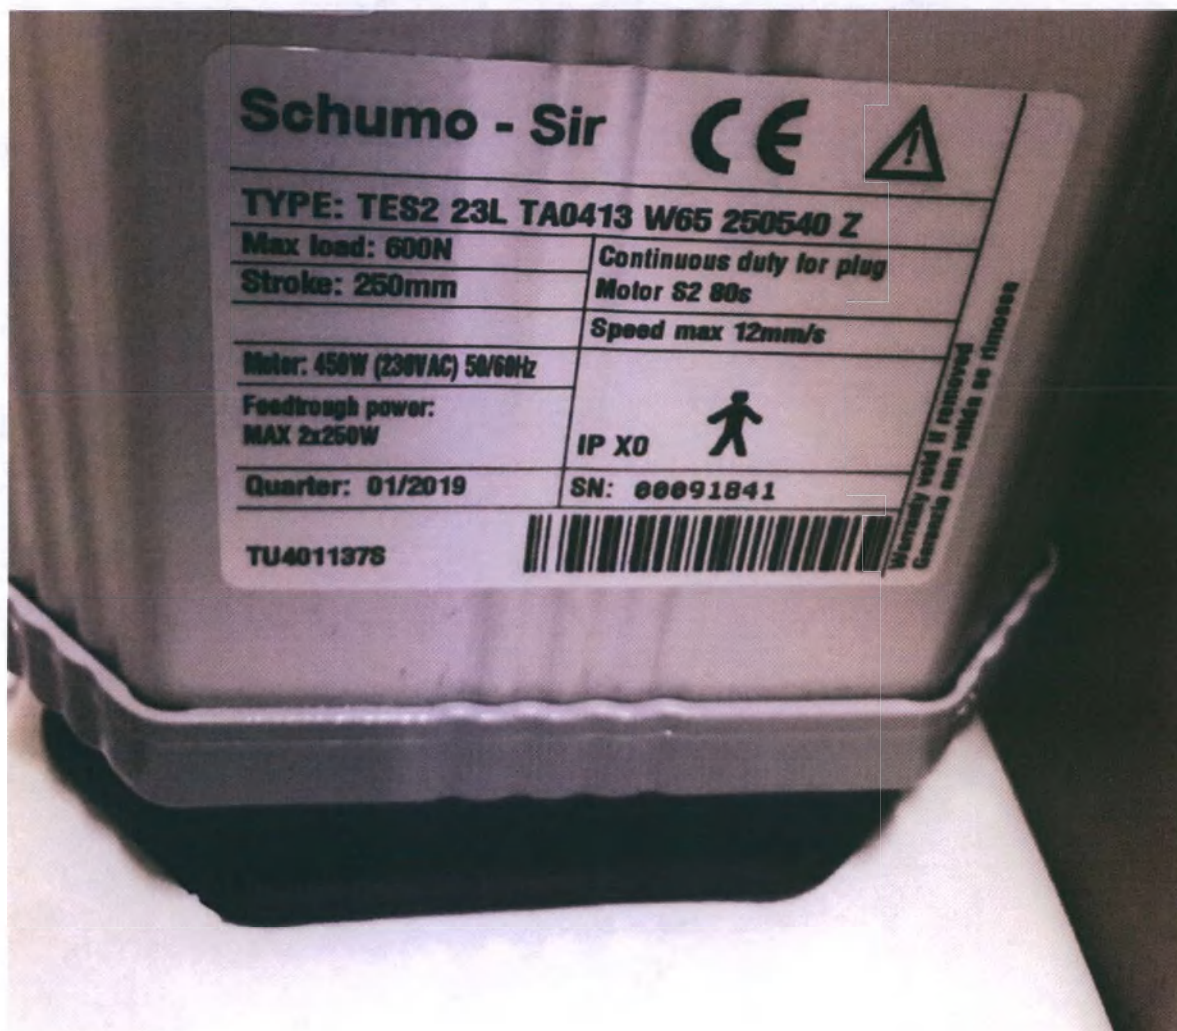


Рисунок 64 – маркировка стола электроподъемного

Прошито, пронумеровано

67 (шестьдесят
семь)

лист (а/ов)

Скреплено печатью

Макарыч

