

Фотографии медицинского изделия
Аппарат флюорографический
Р-600 «Флюоро-Плюс»
производства ООО «ВКО Медпром», Россия




МЕДПРОМ

АППАРАТ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ Р-600 «ФЛЮОРО-ПЛЮС», ИСПОЛНЕНИЕ 1

ПРОИЗВОДСТВА ООО «ВКО МЕДПРОМ», РОССИЯ

Процедурная:

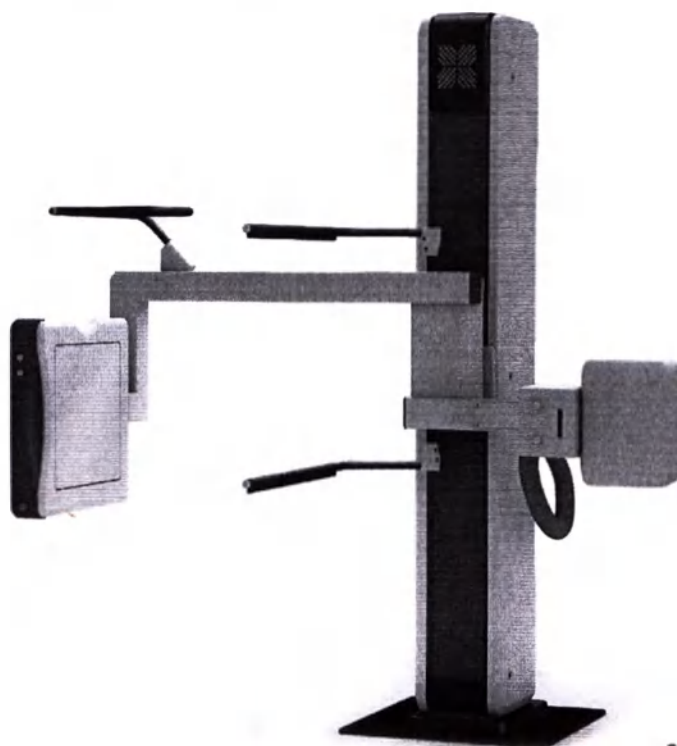

Штатив с кронштейном

Пультовая:



АРМ лаборанта




МЕДПРОМ

АППАРАТ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ Р-600 «ФЛЮОРО-ПЛЮС», ИСПОЛНЕНИЕ 2

ПРОИЗВОДСТВА ООО «ВКО МЕДПРОМ», РОССИЯ

Процедурная:

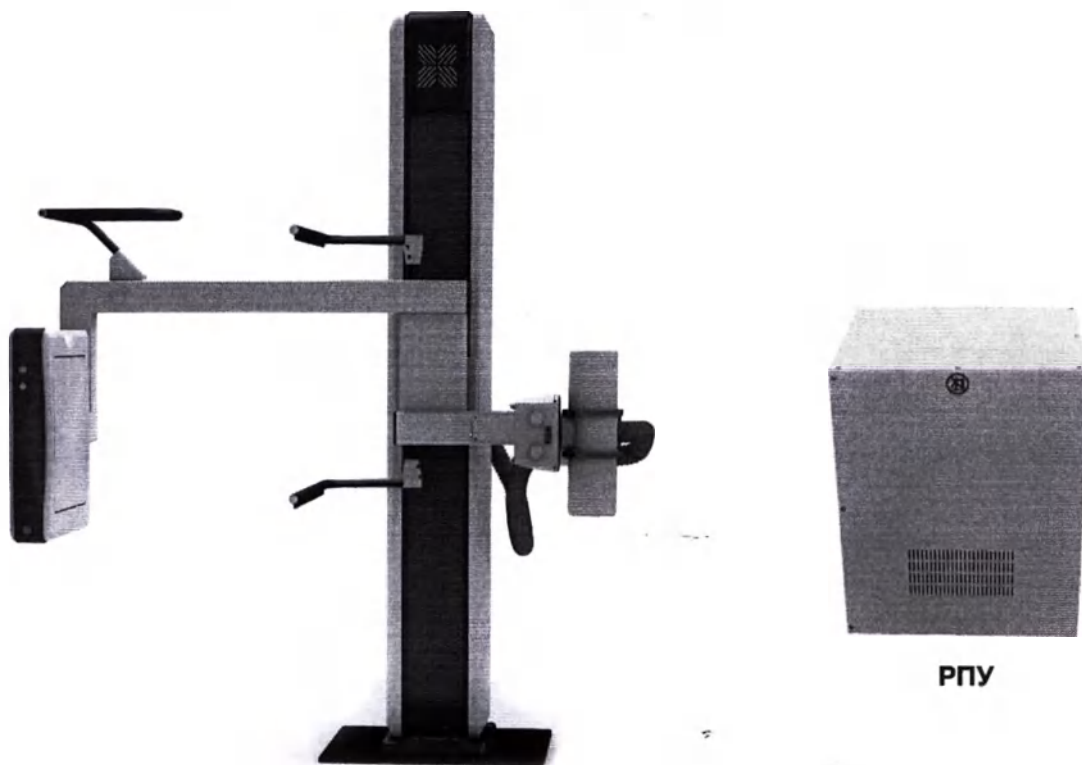

Штатив с кронштейном

РПУ

Пультная:



АРМ лаборанта




МЕДПРОМ

АППАРАТ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ Р-600 «ФЛЮОРО-ПЛЮС», ИСПОЛНЕНИЕ 3.1

ПРОИЗВОДСТВА ООО «ВКО МЕДПРОМ», РОССИЯ

Процедурная:

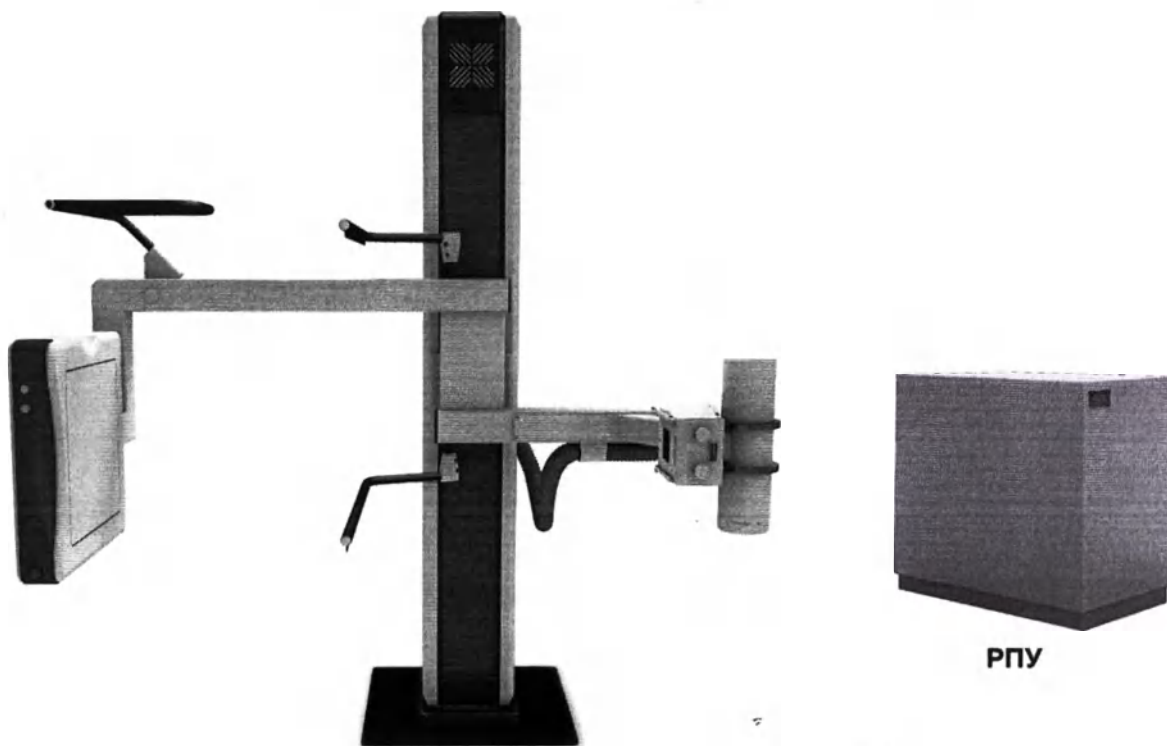

Штатив с кронштейном

РПУ

Пультовая:



АРМ лаборанта




МЕДПРОМ

АППАРАТ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ Р-600 «ФЛЮОРО-ПЛЮС», ИСПОЛНЕНИЕ 3.2

ПРОИЗВОДСТВА ООО «ВКО МЕДПРОМ», РОССИЯ

Процедурная:

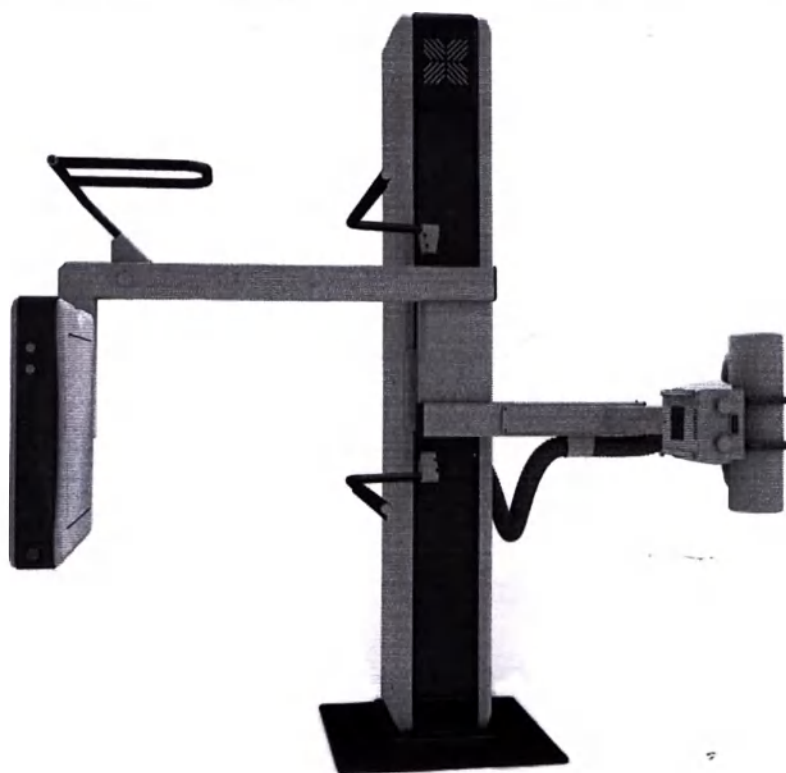

Штатив с кронштейном




РПУ

Пультовая:




АРМ лаборанта

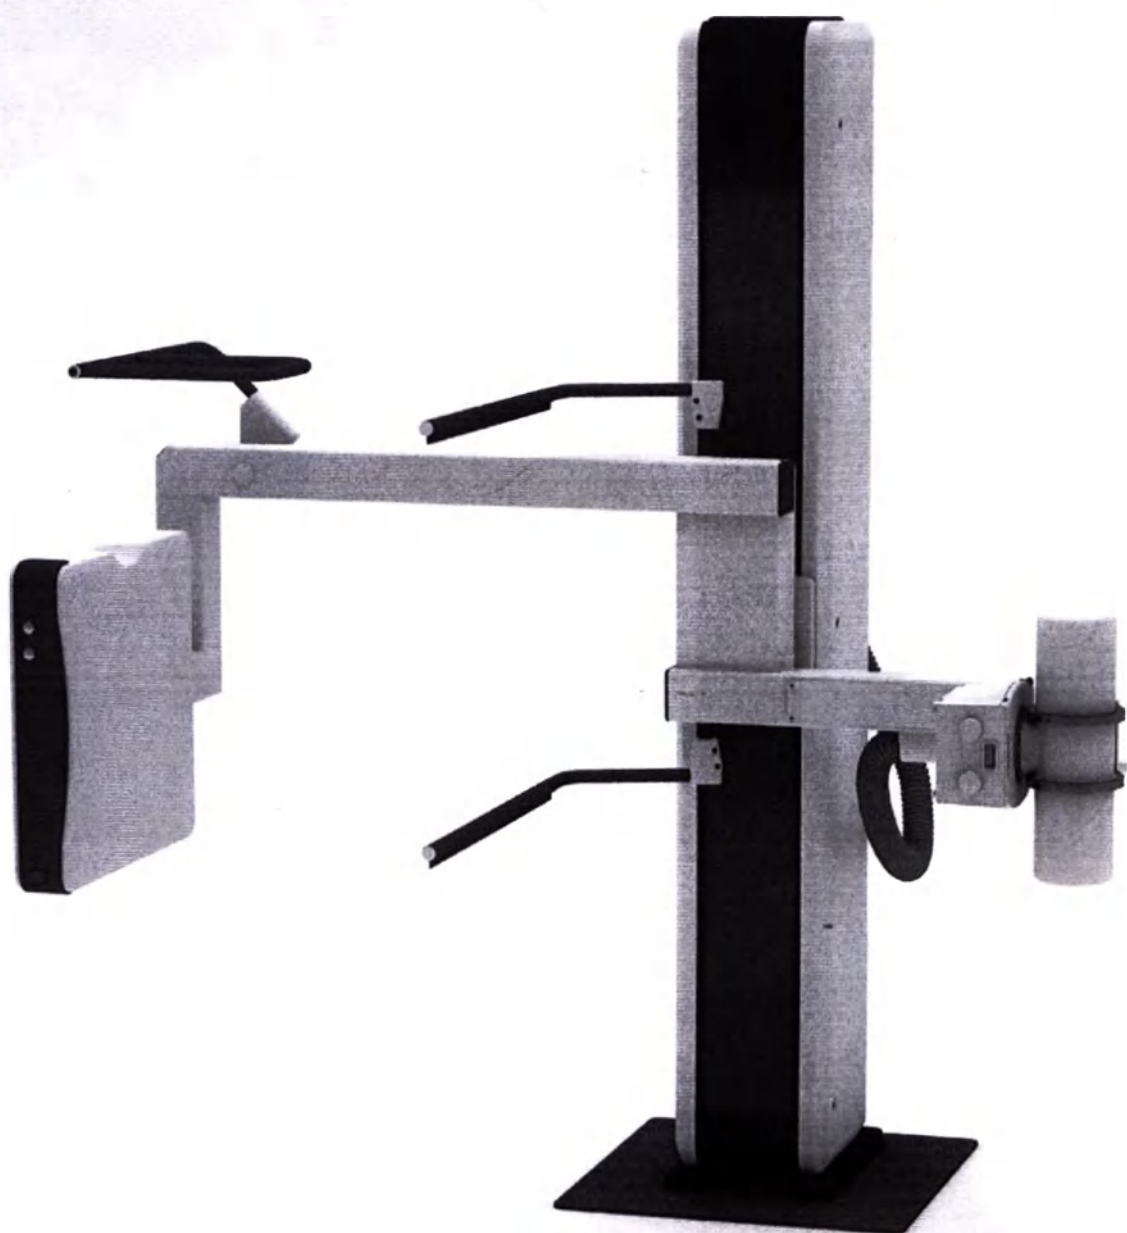


Штатив с кронштейном Y2-B0100 по спецификации, производства
ООО «ВКО Медпром», Россия




Штатив с кронштейном Y2-B0200 по спецификации, производства
ООО «ВКО Медпром», Россия

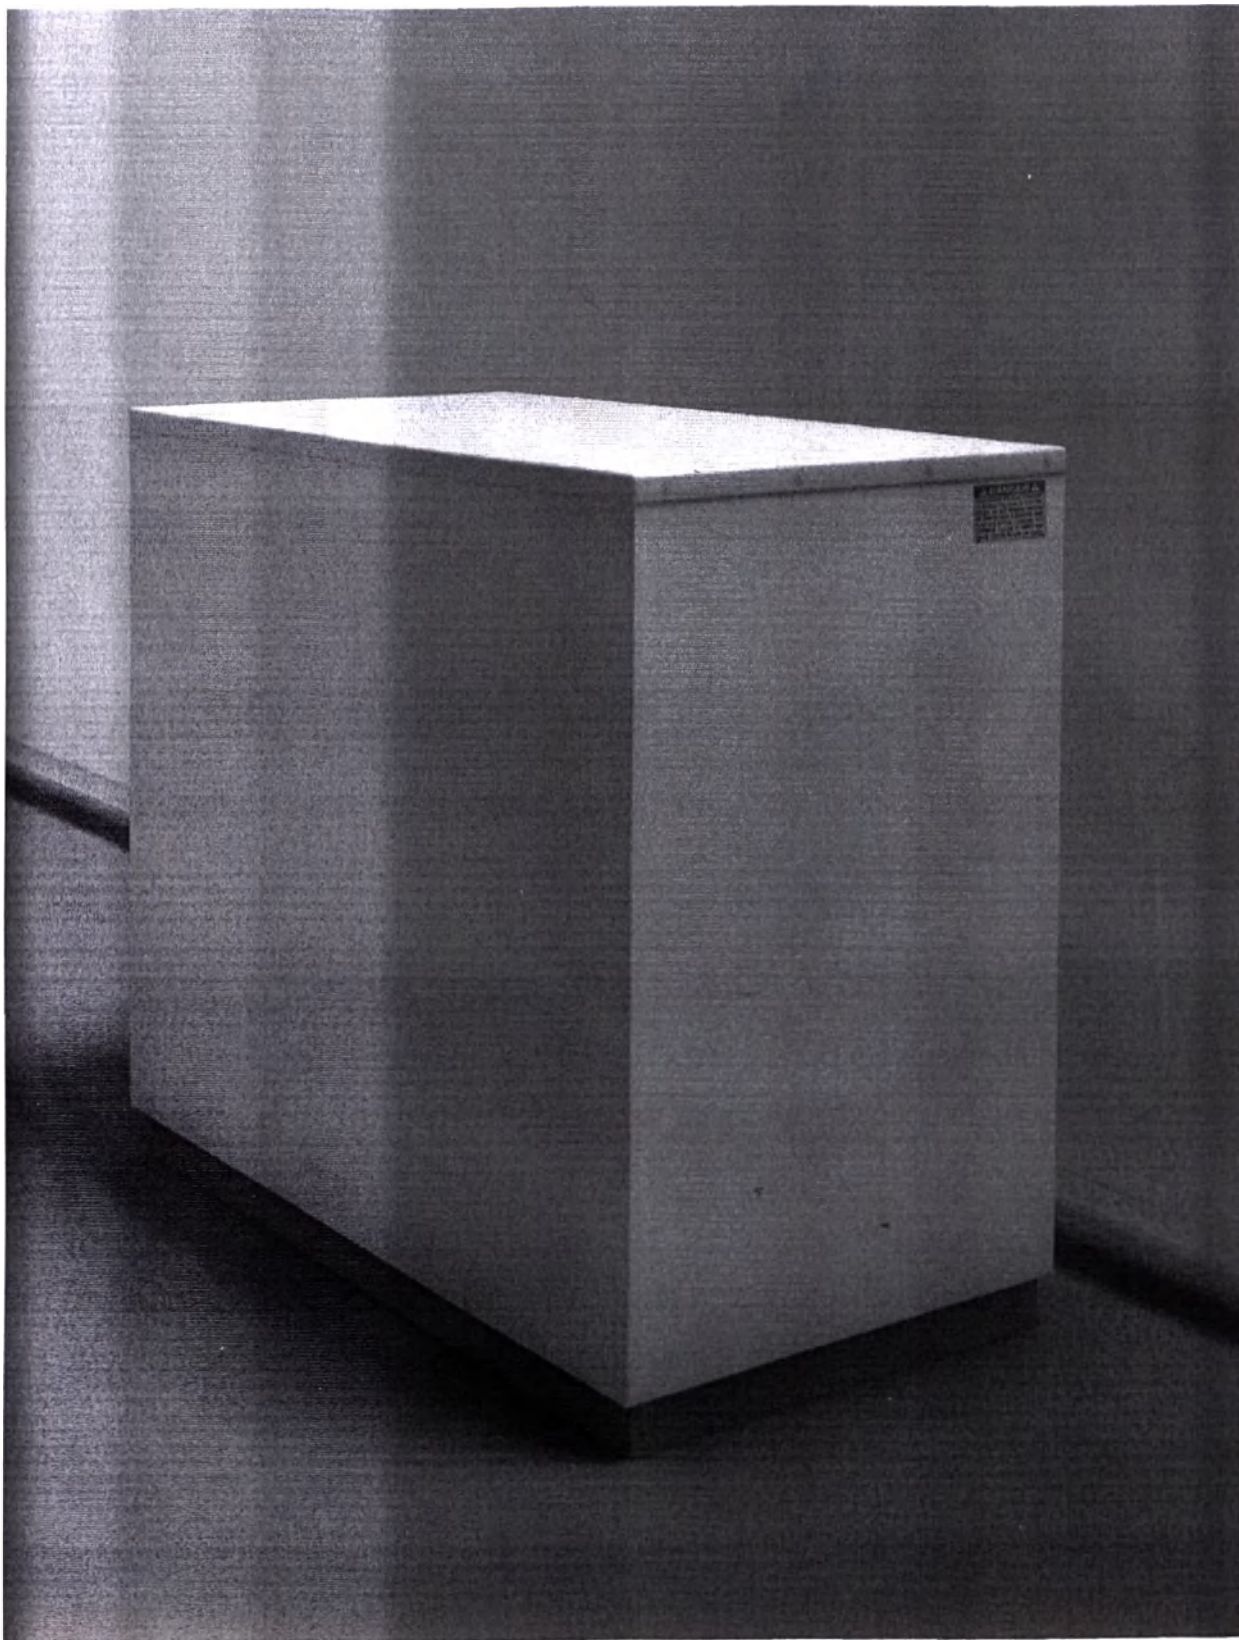


Рентгеновское питающее устройство (РПУ) серии ZR75PN40 или серии ZR75PN50 или серии ZR75PN65 или серии ZR75PN80, производства Spellman, США или Spellman High Voltage Electronics GmbH, Германия или Spellman High Voltage Electronics (SIP) Co., Ltd, Китай

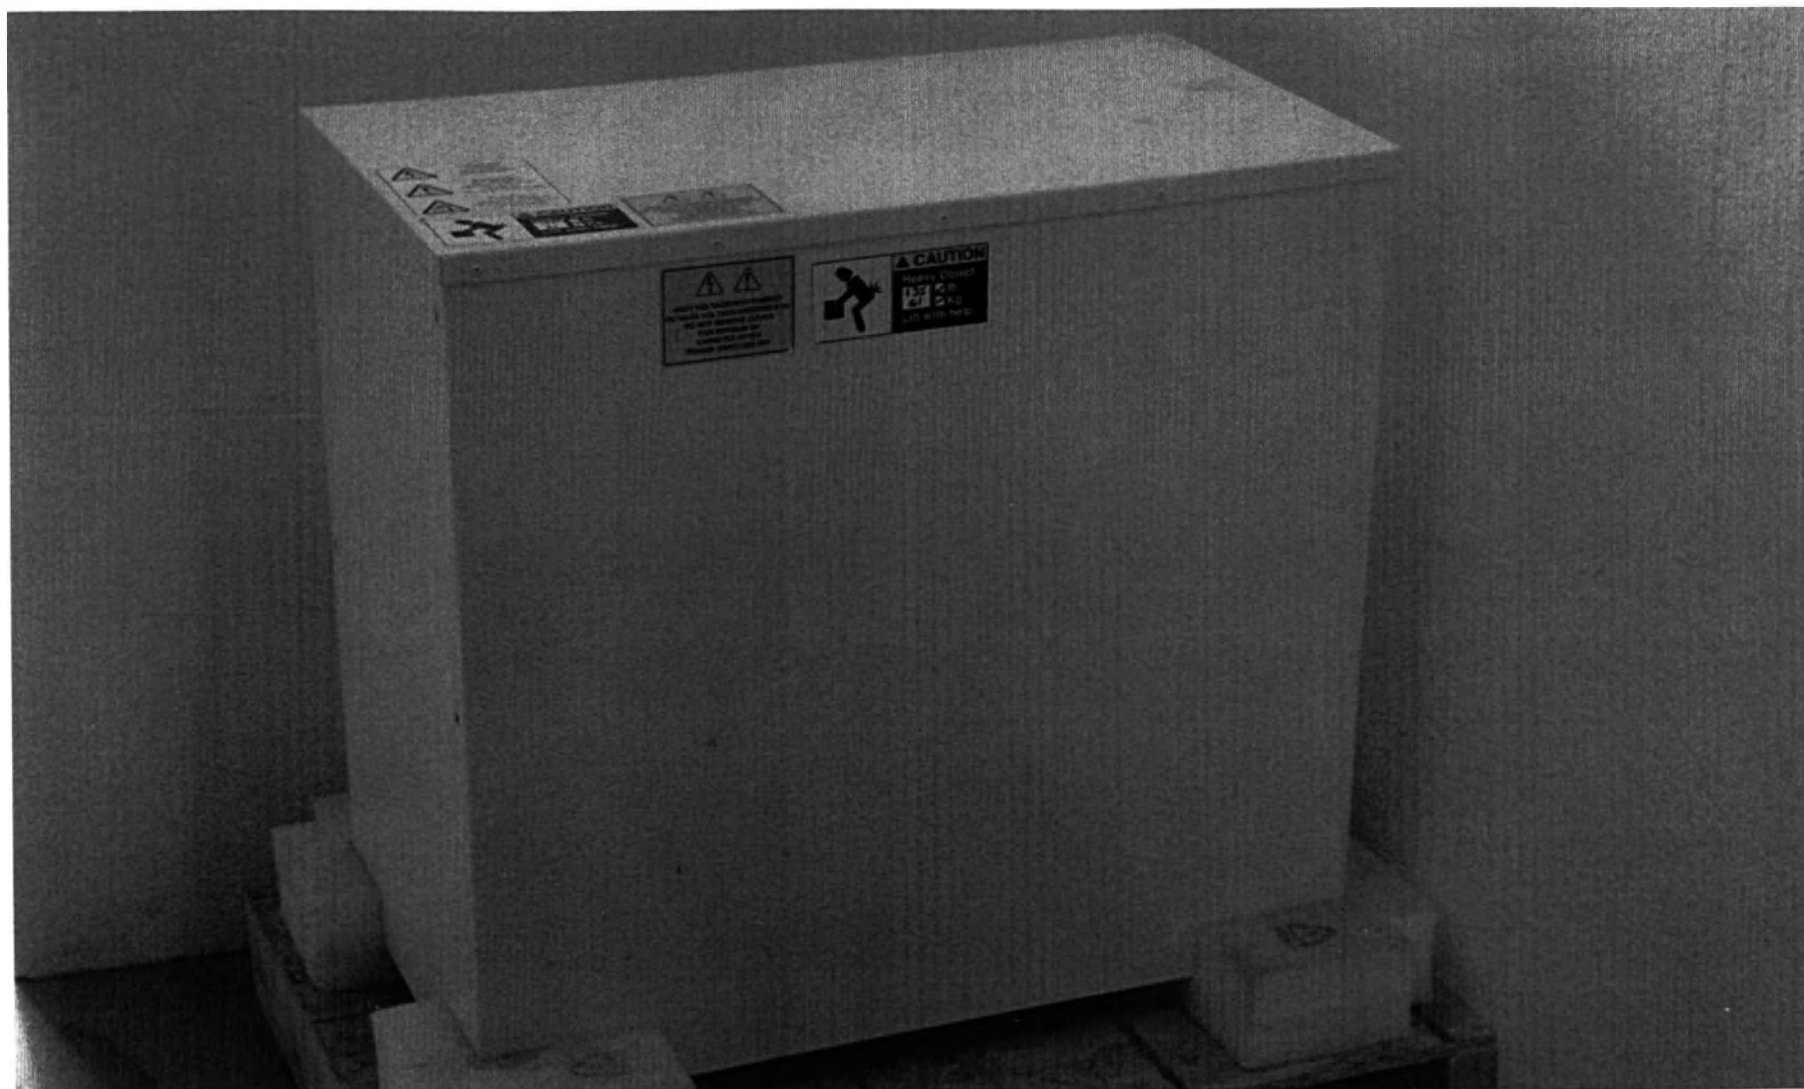

Рентгеновское питающее устройство (РПУ) серии CMP 200, производства Communications & Power Industries Canada Inc., Канада

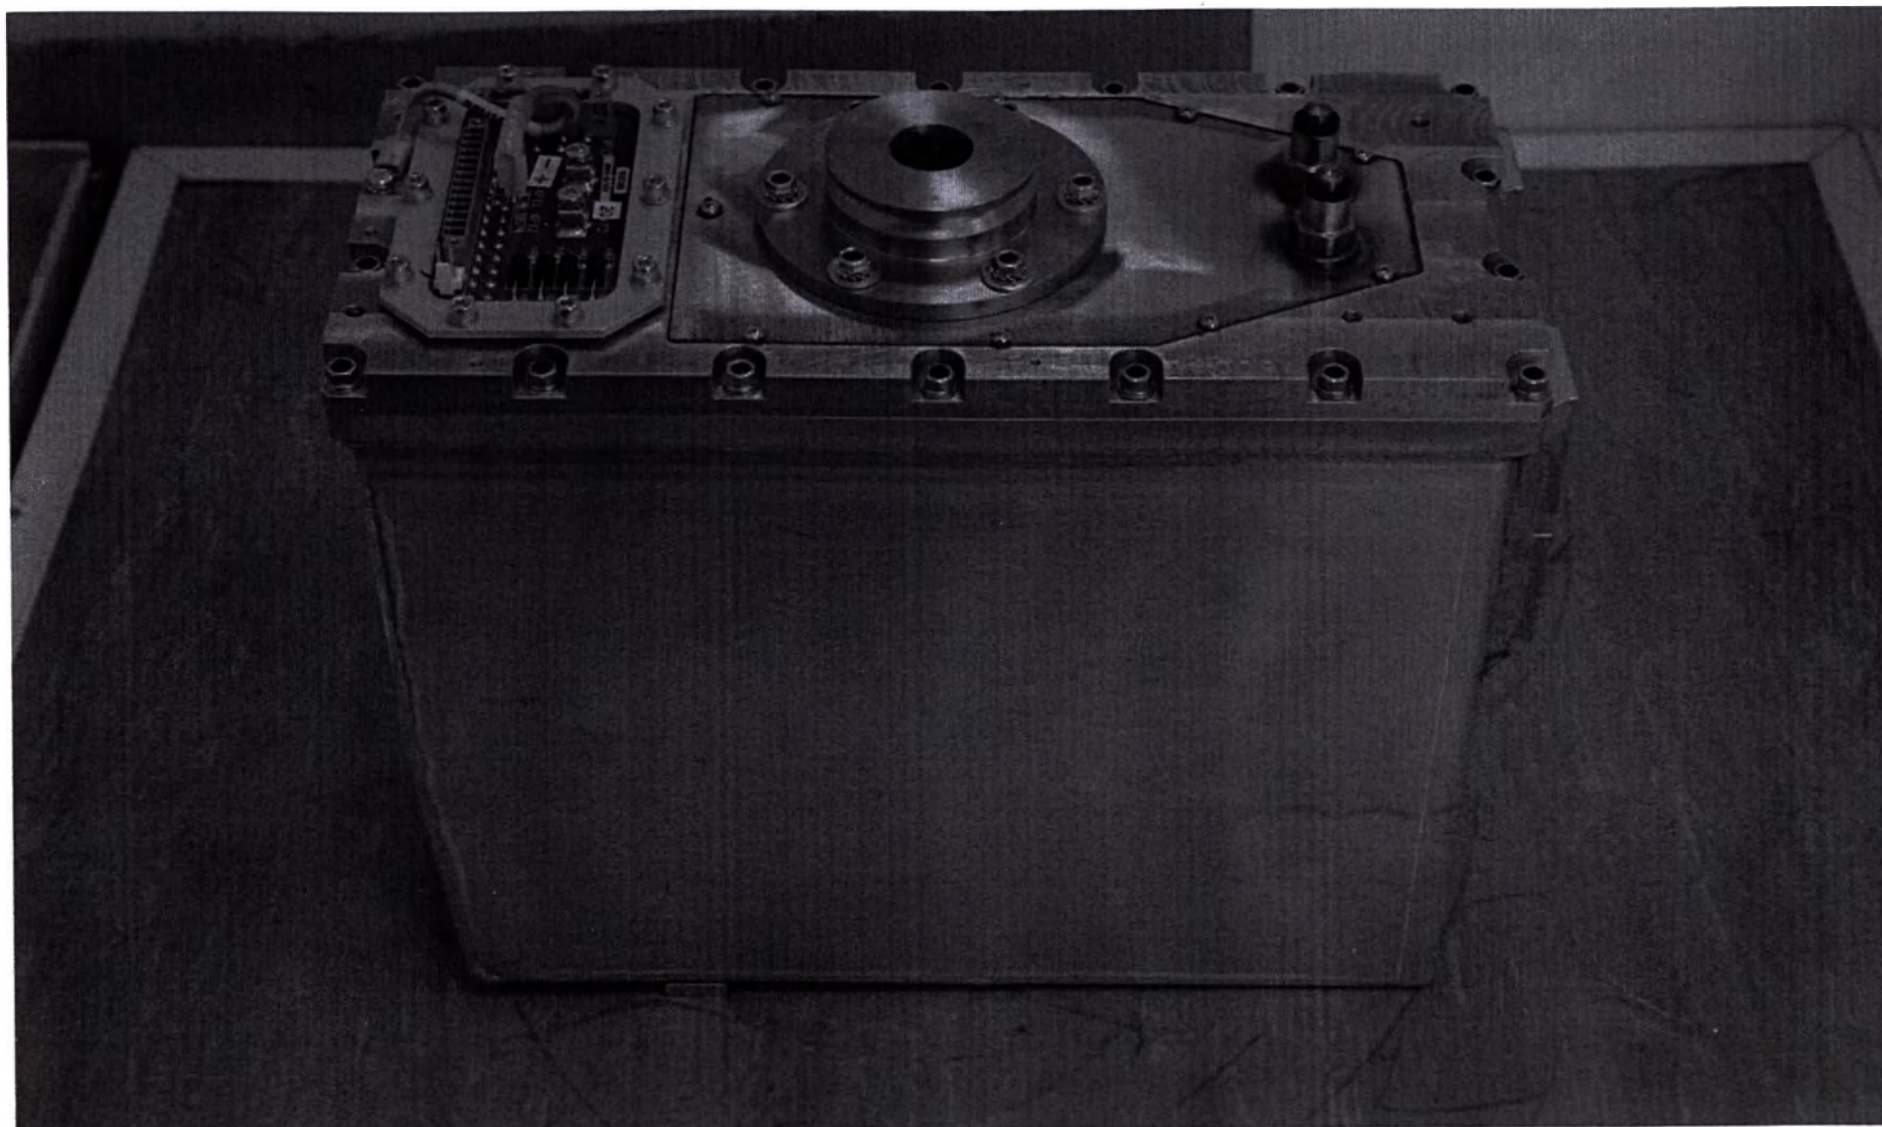


Рентгеновское питающее устройство (РПУ) X1-B0500, производства ООО «ВКО Медпром», Россия

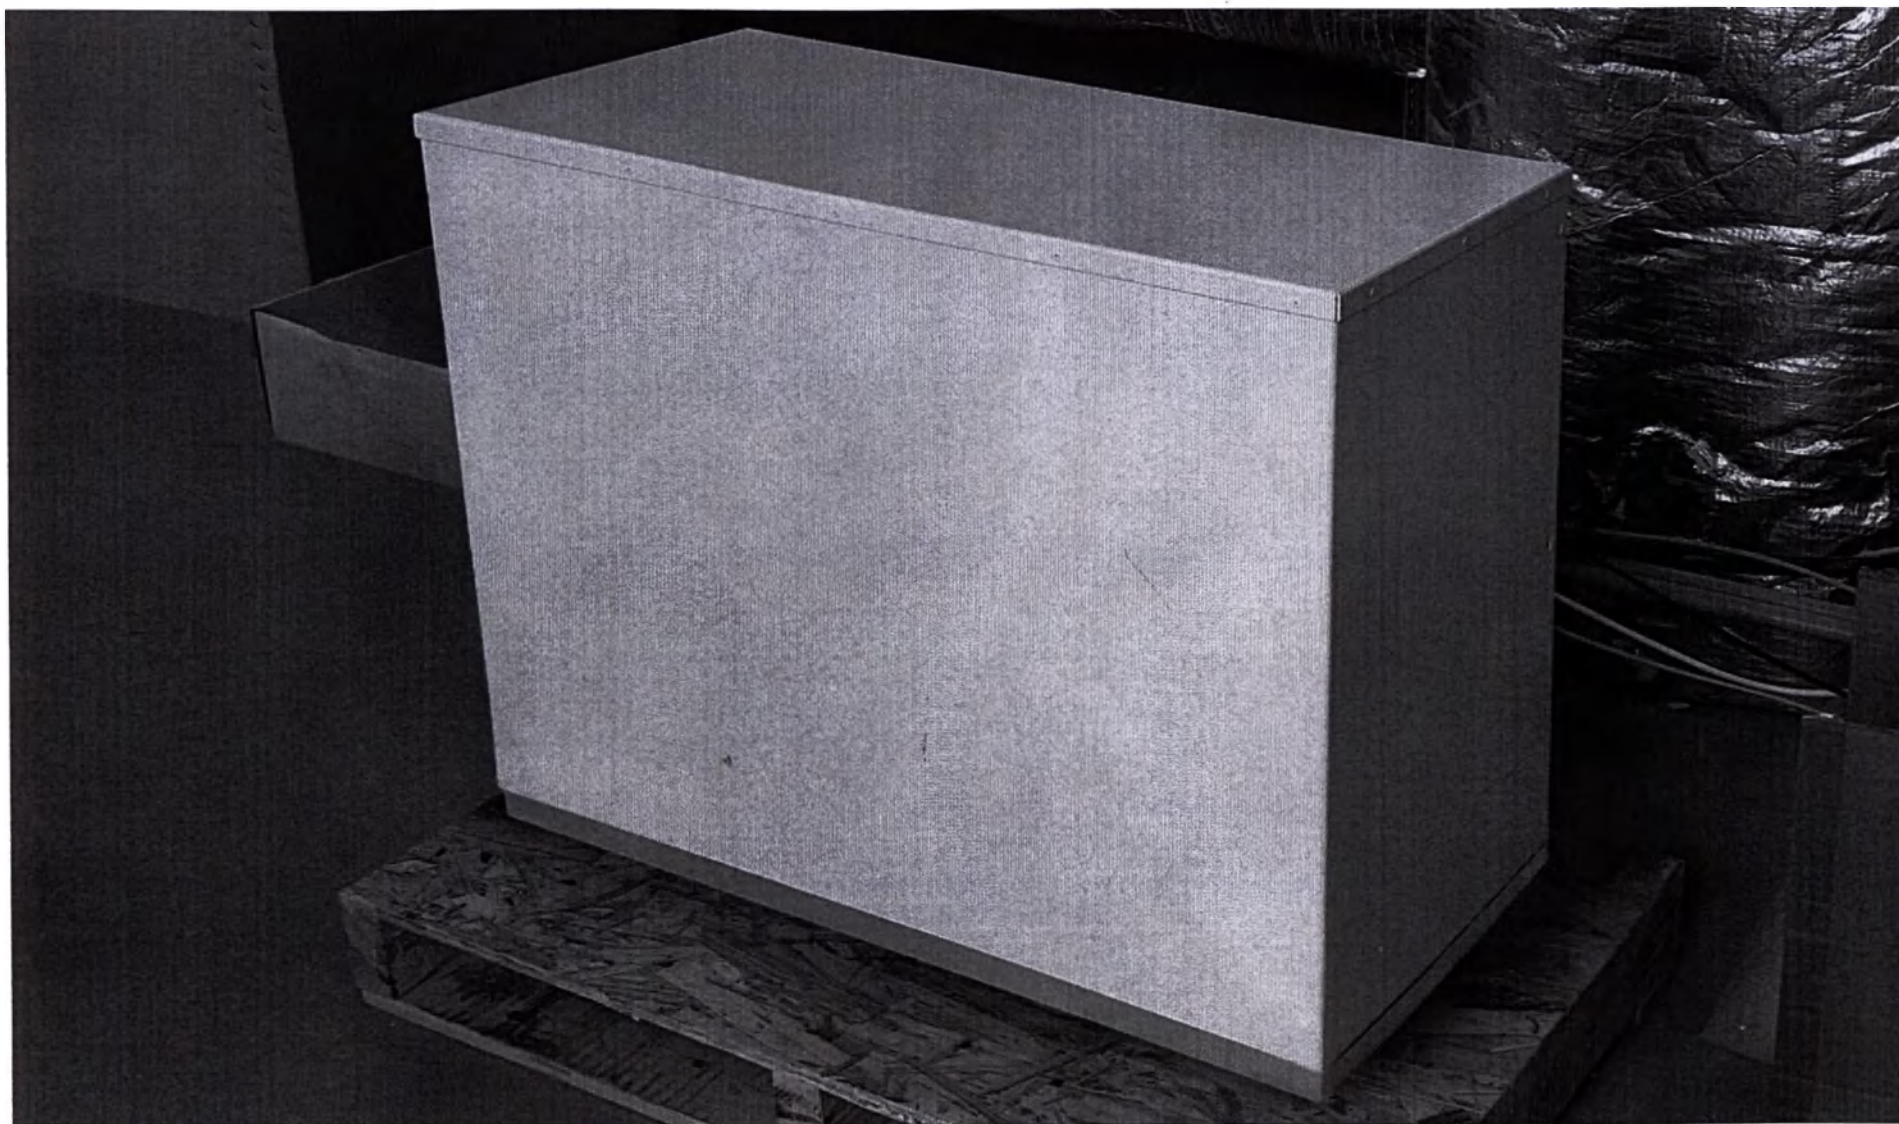


Рентгеновское питающее устройство (РПУ) X1-B0600 или X1-B0700 или X1-B0800, производства ООО «ВКО Медпром», Россия



Комплект (пара) кабелей высоковольтных с наконечниками производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины или Varex Imaging Corporation, Китай или Tianjin Wanbo Wire & Cable Co.,Ltd, Китай

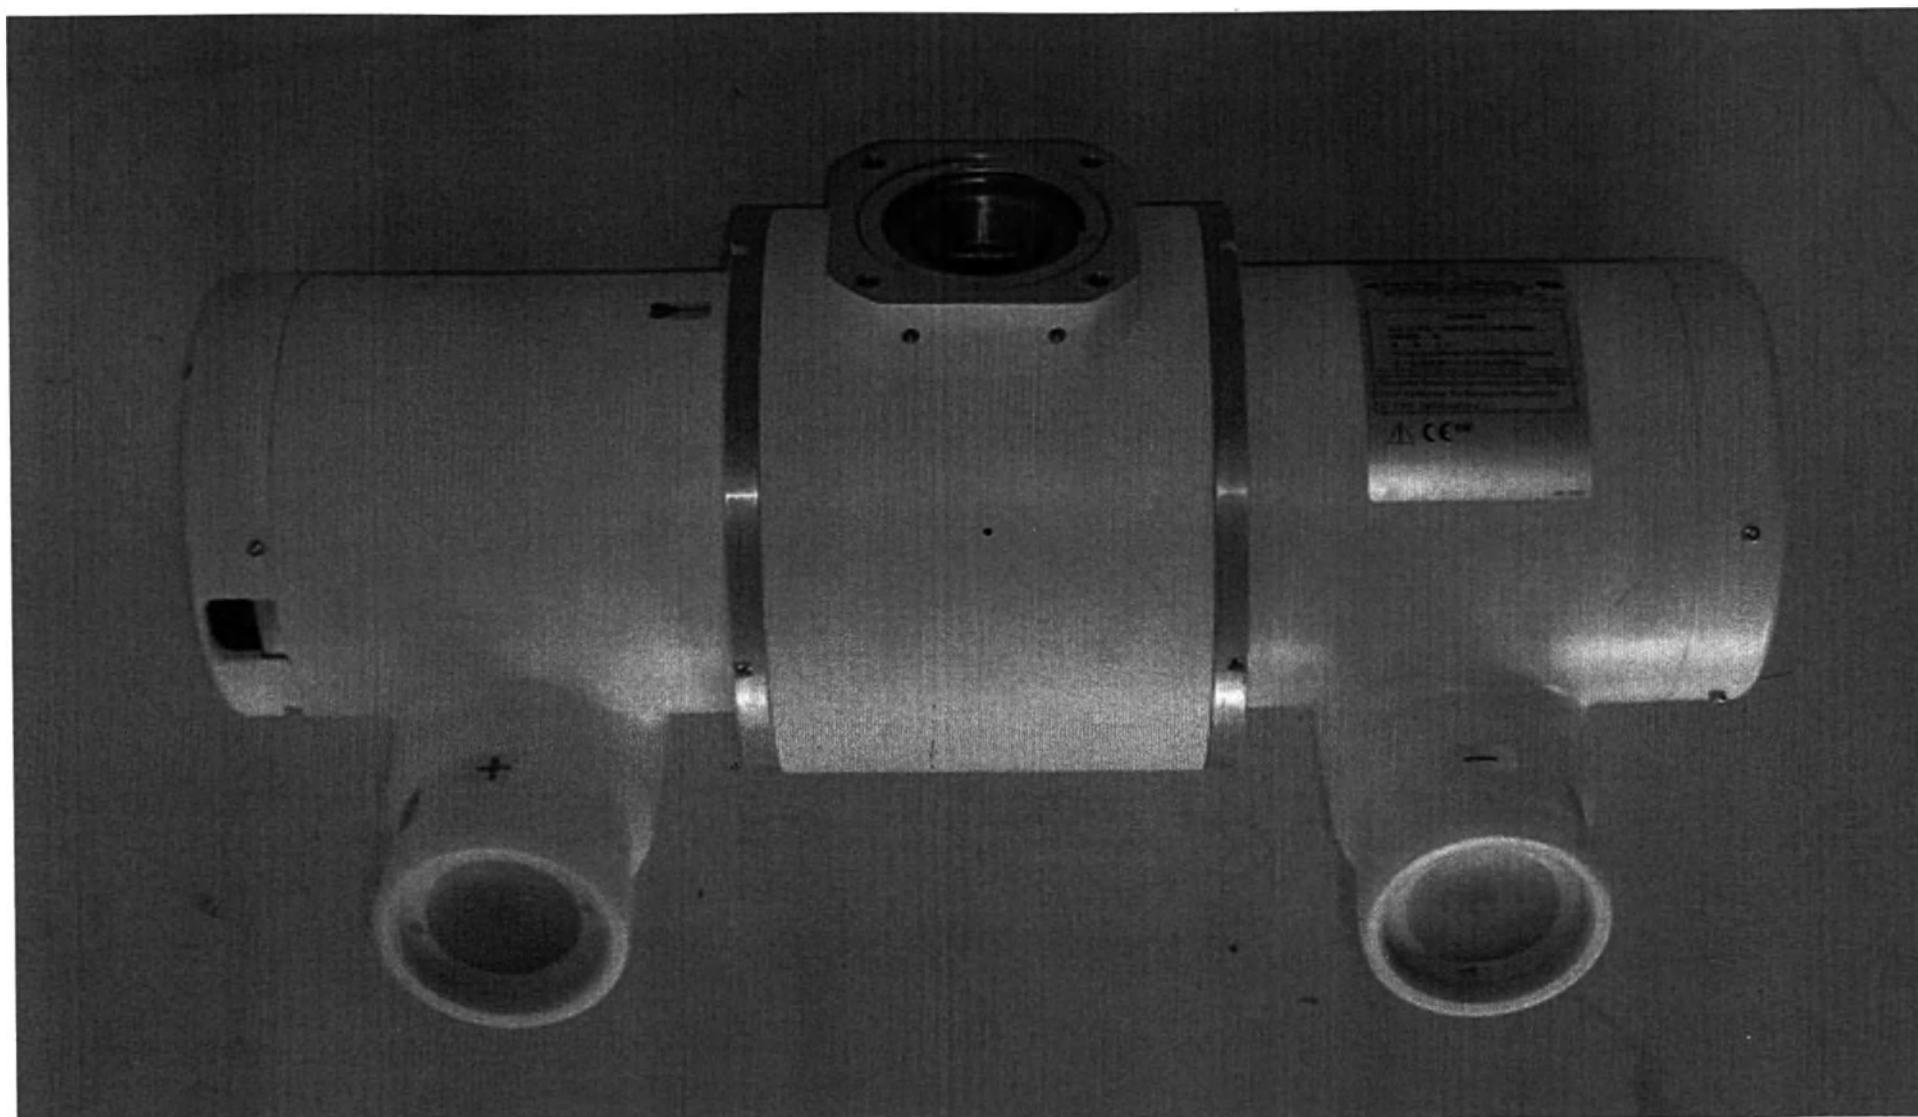

Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой E7242 или E7252 или E7239, производства Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd, Япония

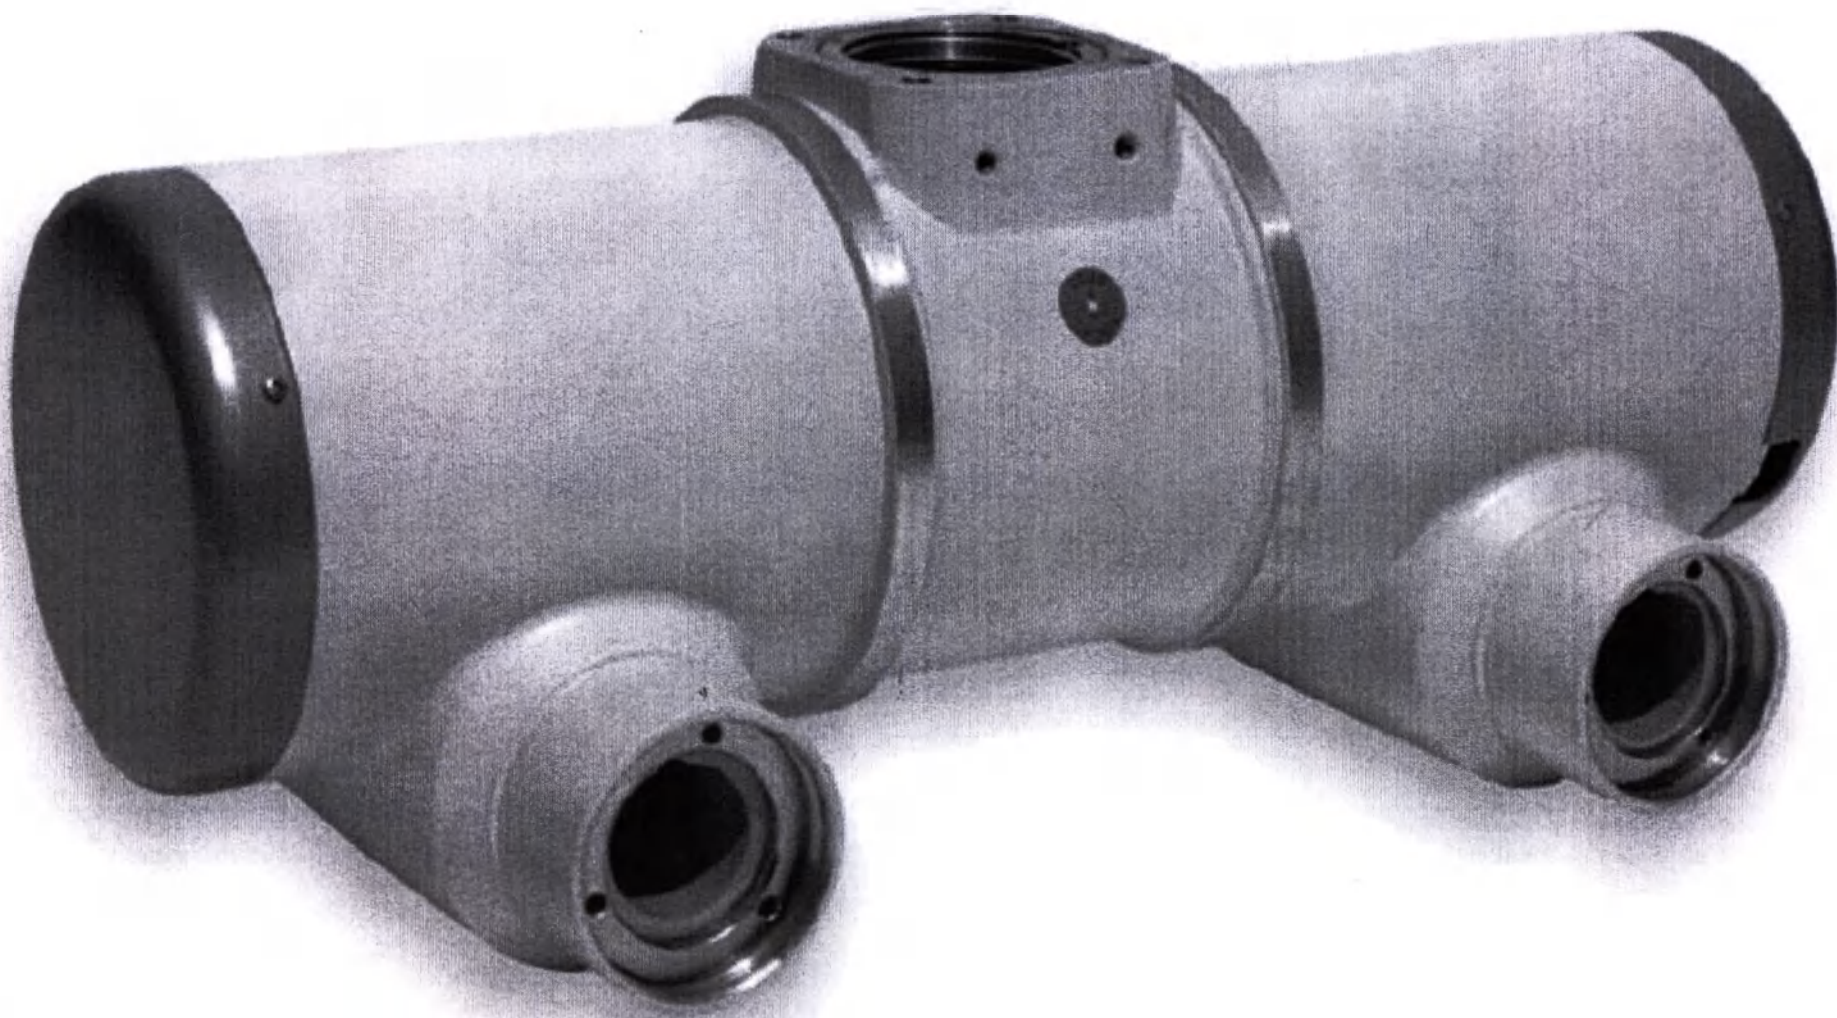


Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой RAD 14/Leo, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины




Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением серии R 221, производства Ralco srl., Италия



Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением серии R 225, производства Ralco srl., Италия

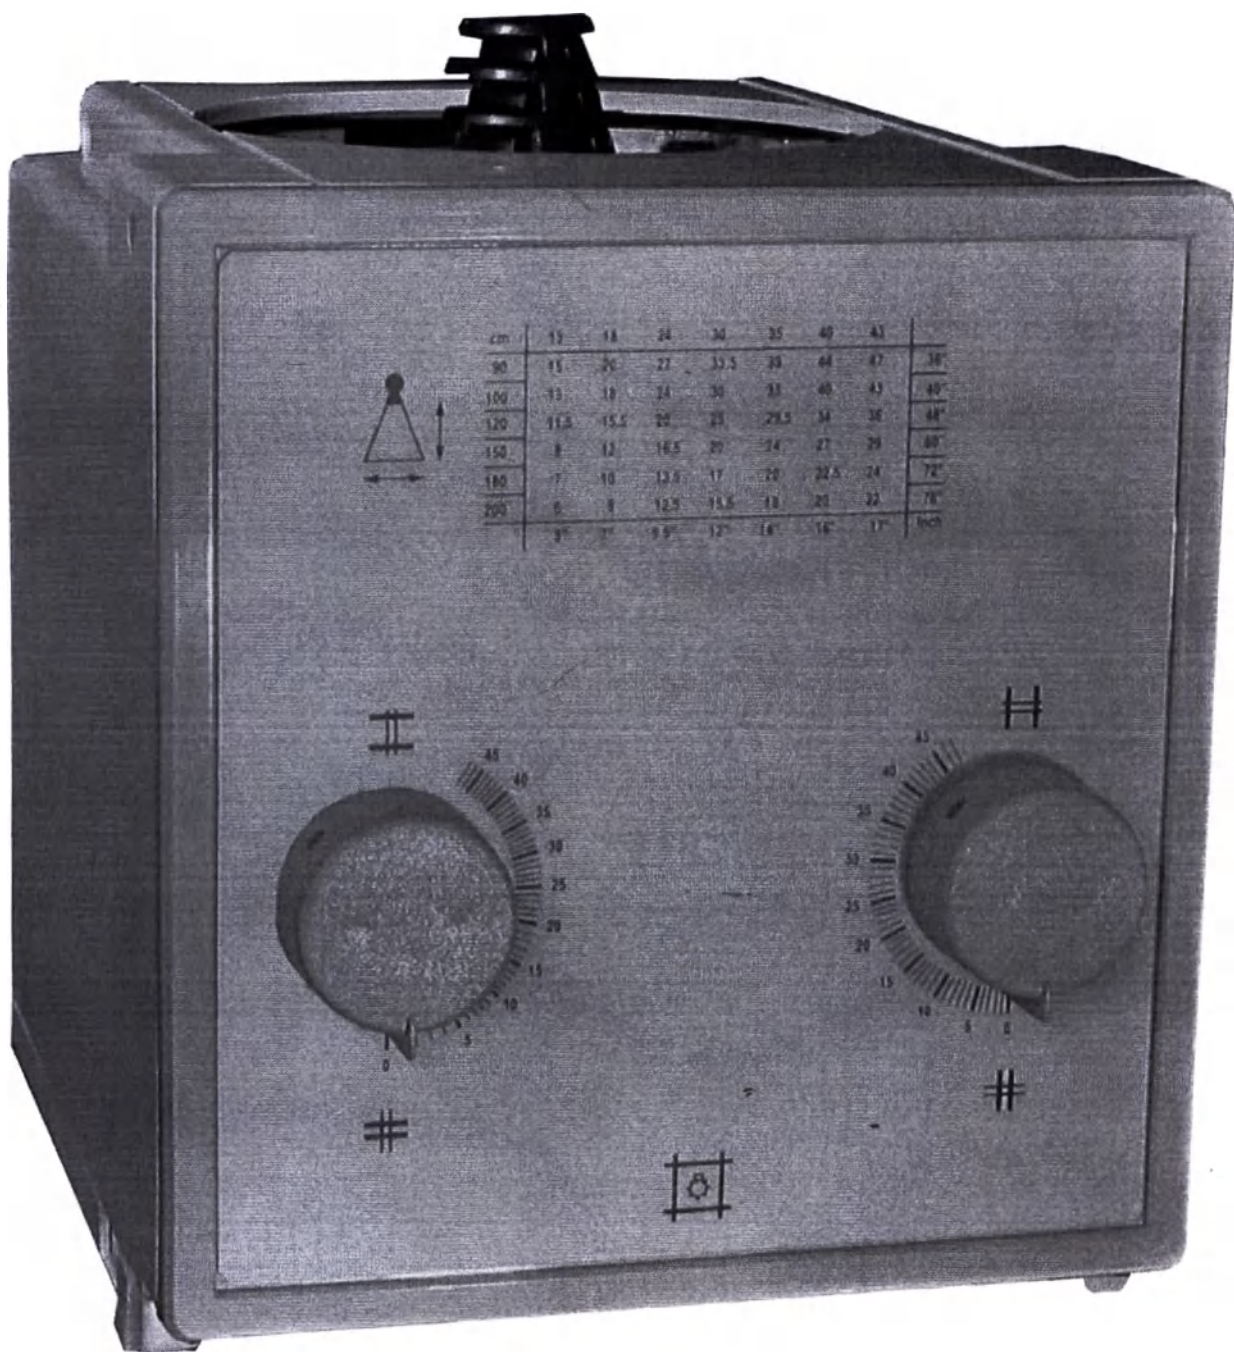


Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением серии R 302, производства Ralco srl., Италия

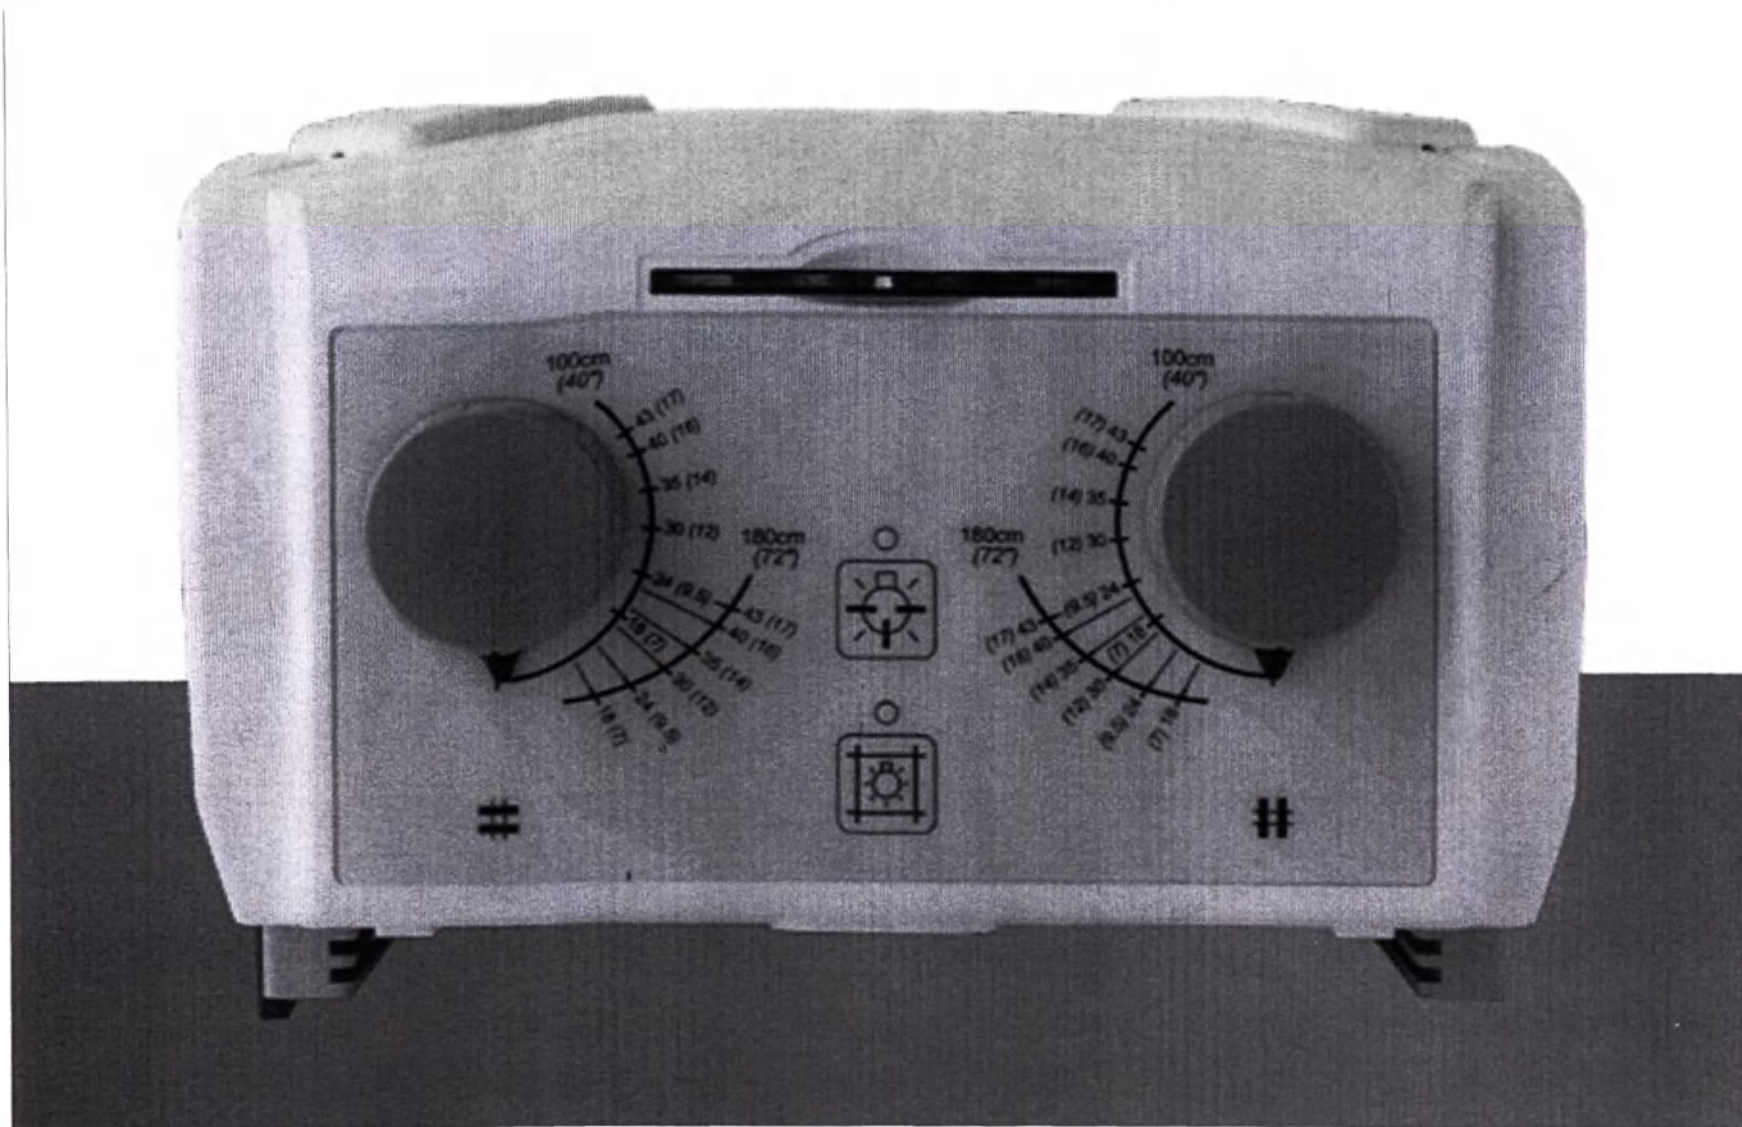

Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением серии Optica 10 или серии Optica 20, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины




Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением серии Optica 30, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины

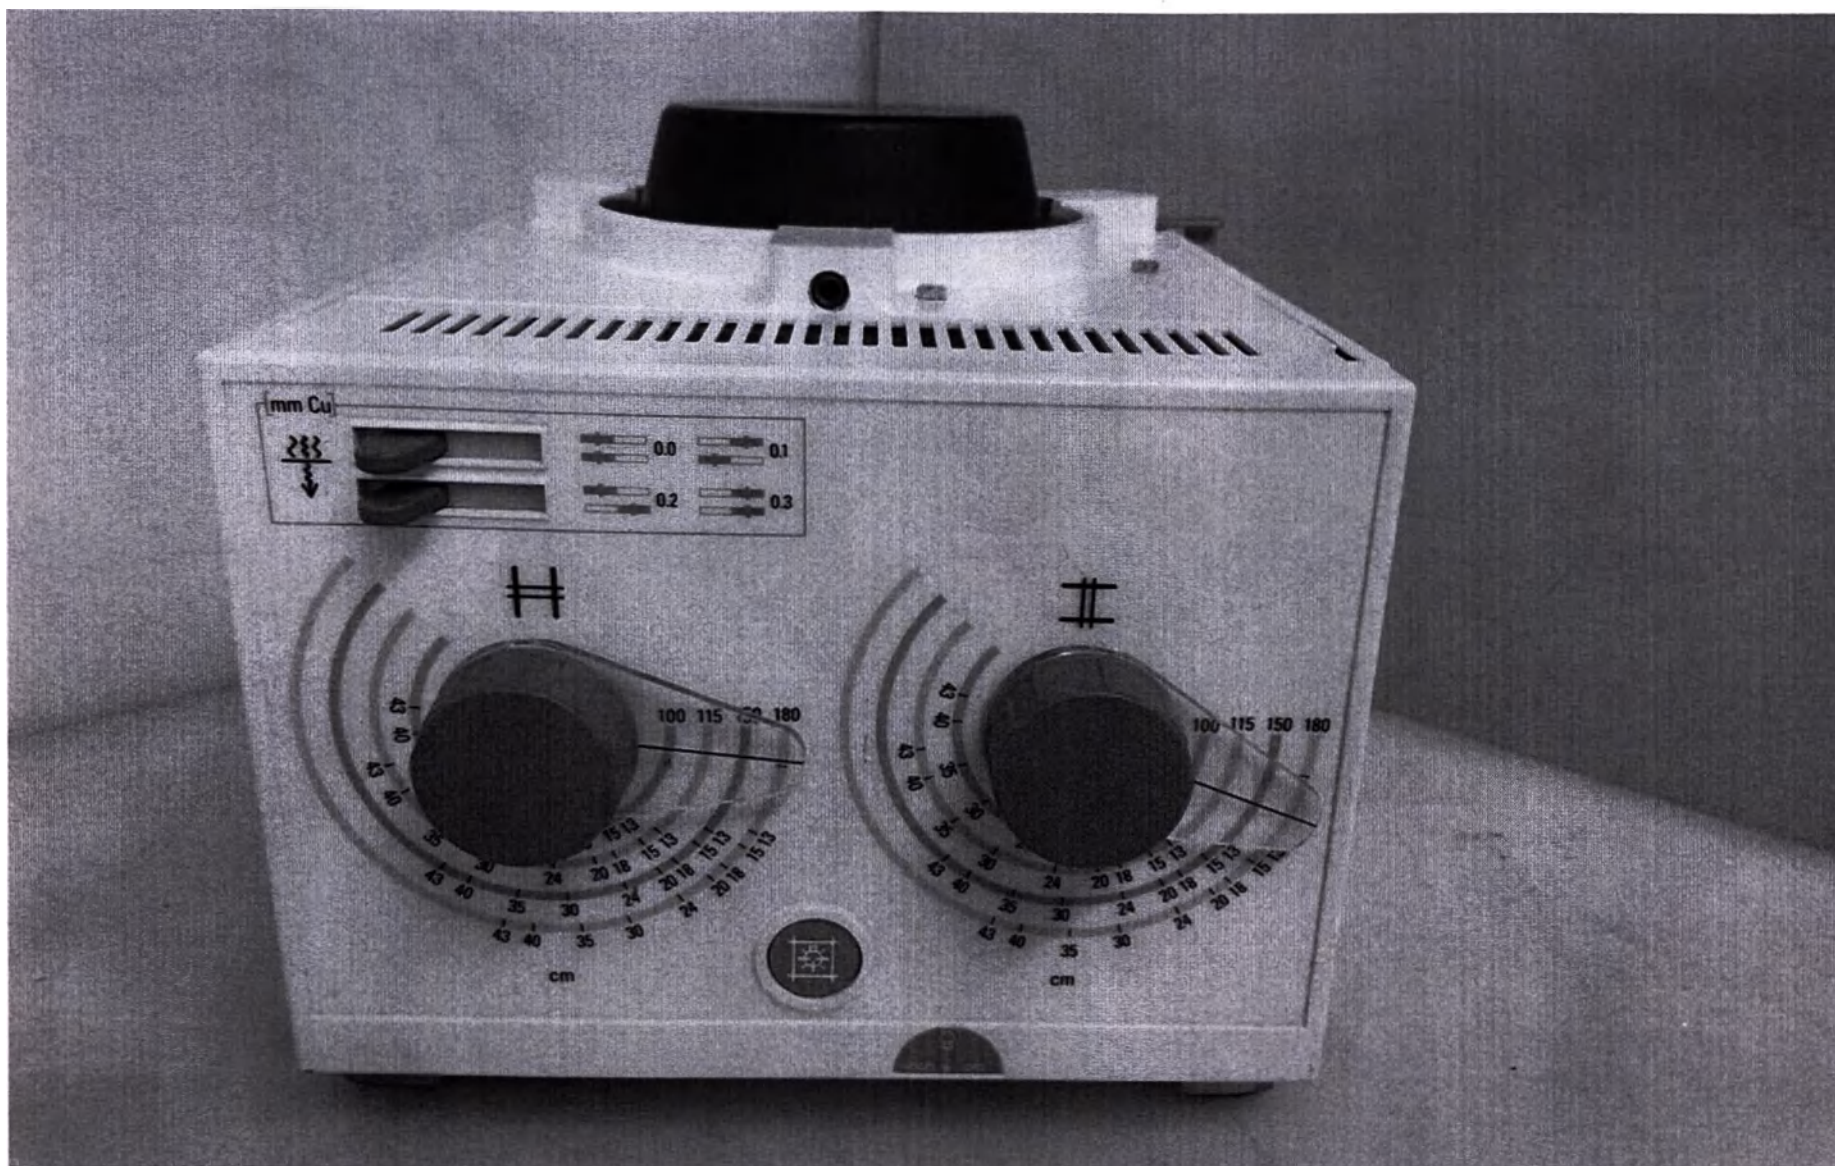


Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением серии ML 01 II, производства Siemens, Германия




Комплекс аппаратно-программный для регистрации и обработки рентгеновских изображений
«СОЛО ДР-МТ», производства АО «МТЛ», Россия

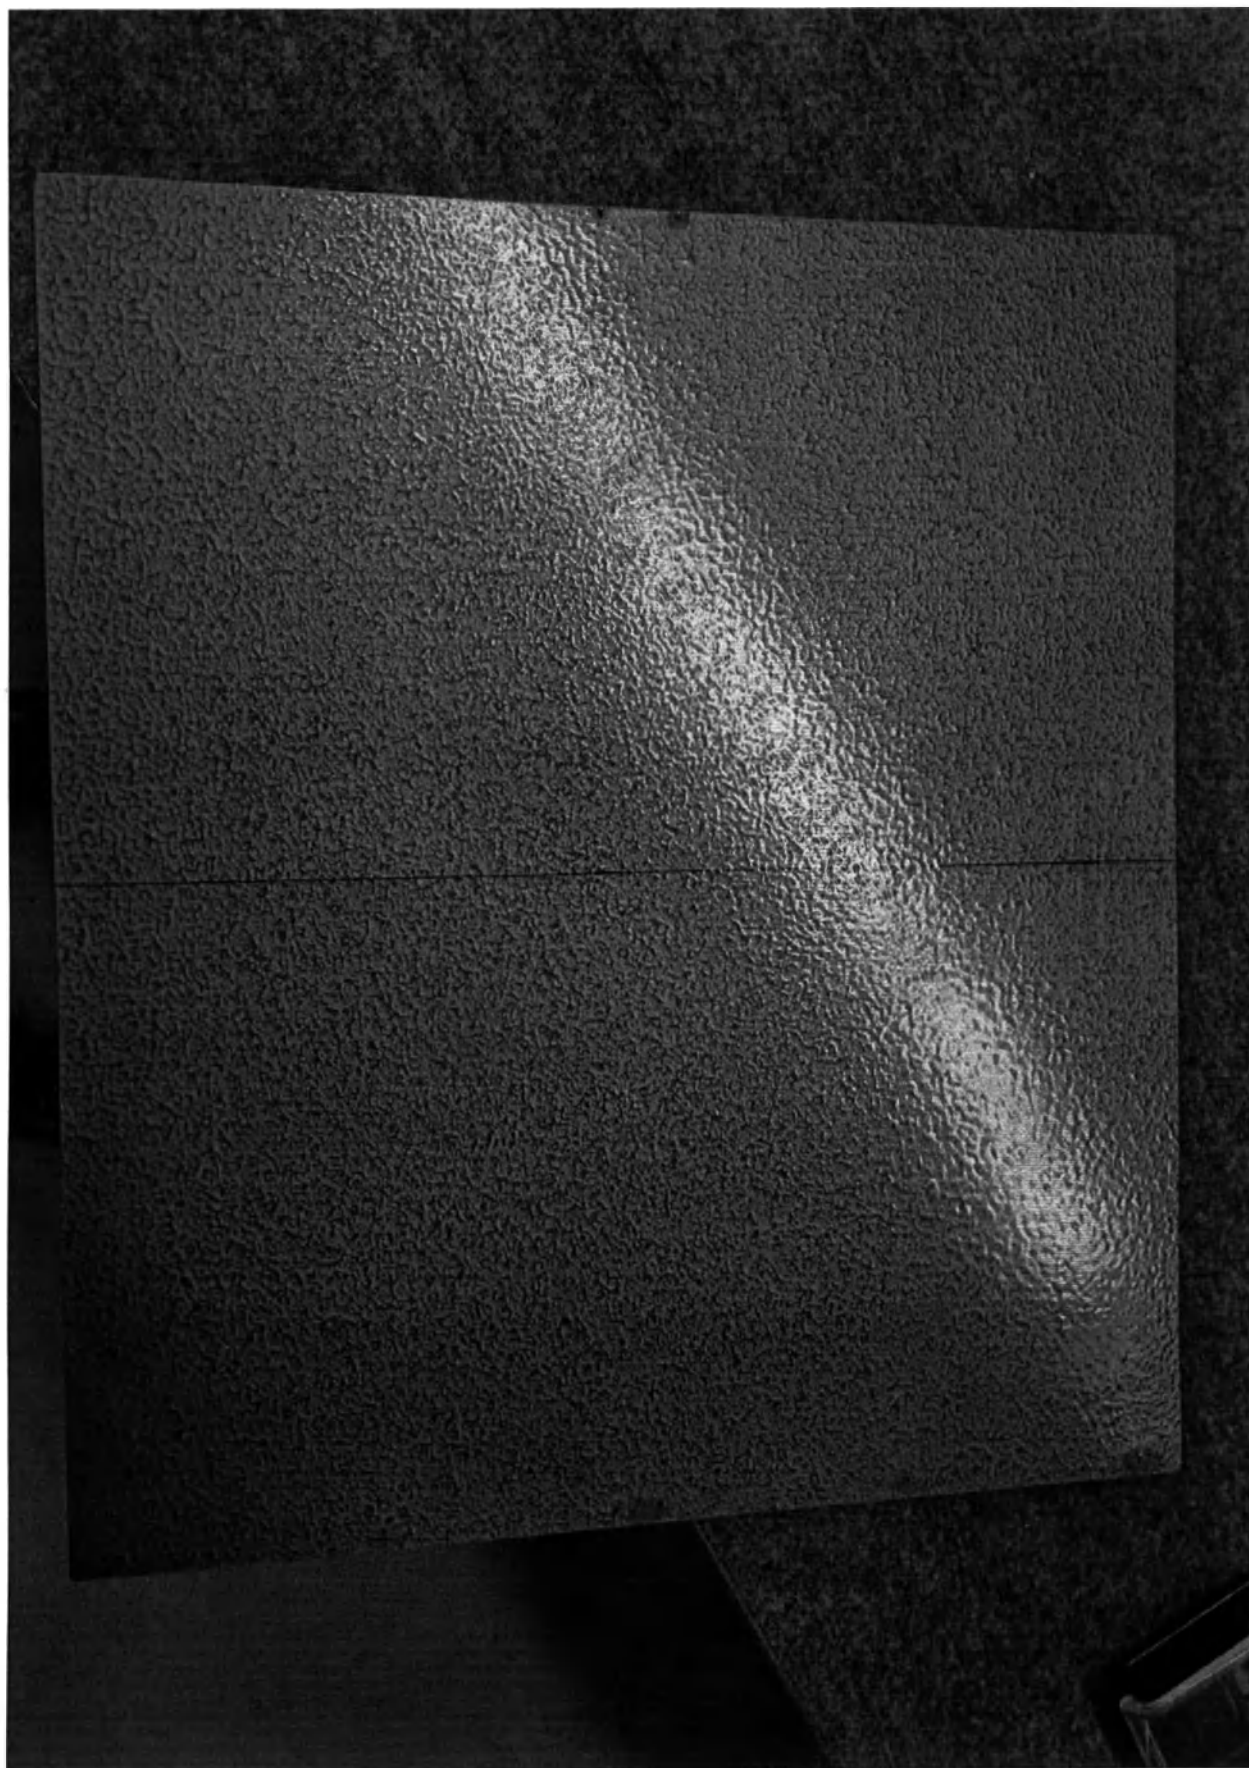


Растр рентгеновский отсеивающий Lysholm, производства Gridline А.В., Швеция

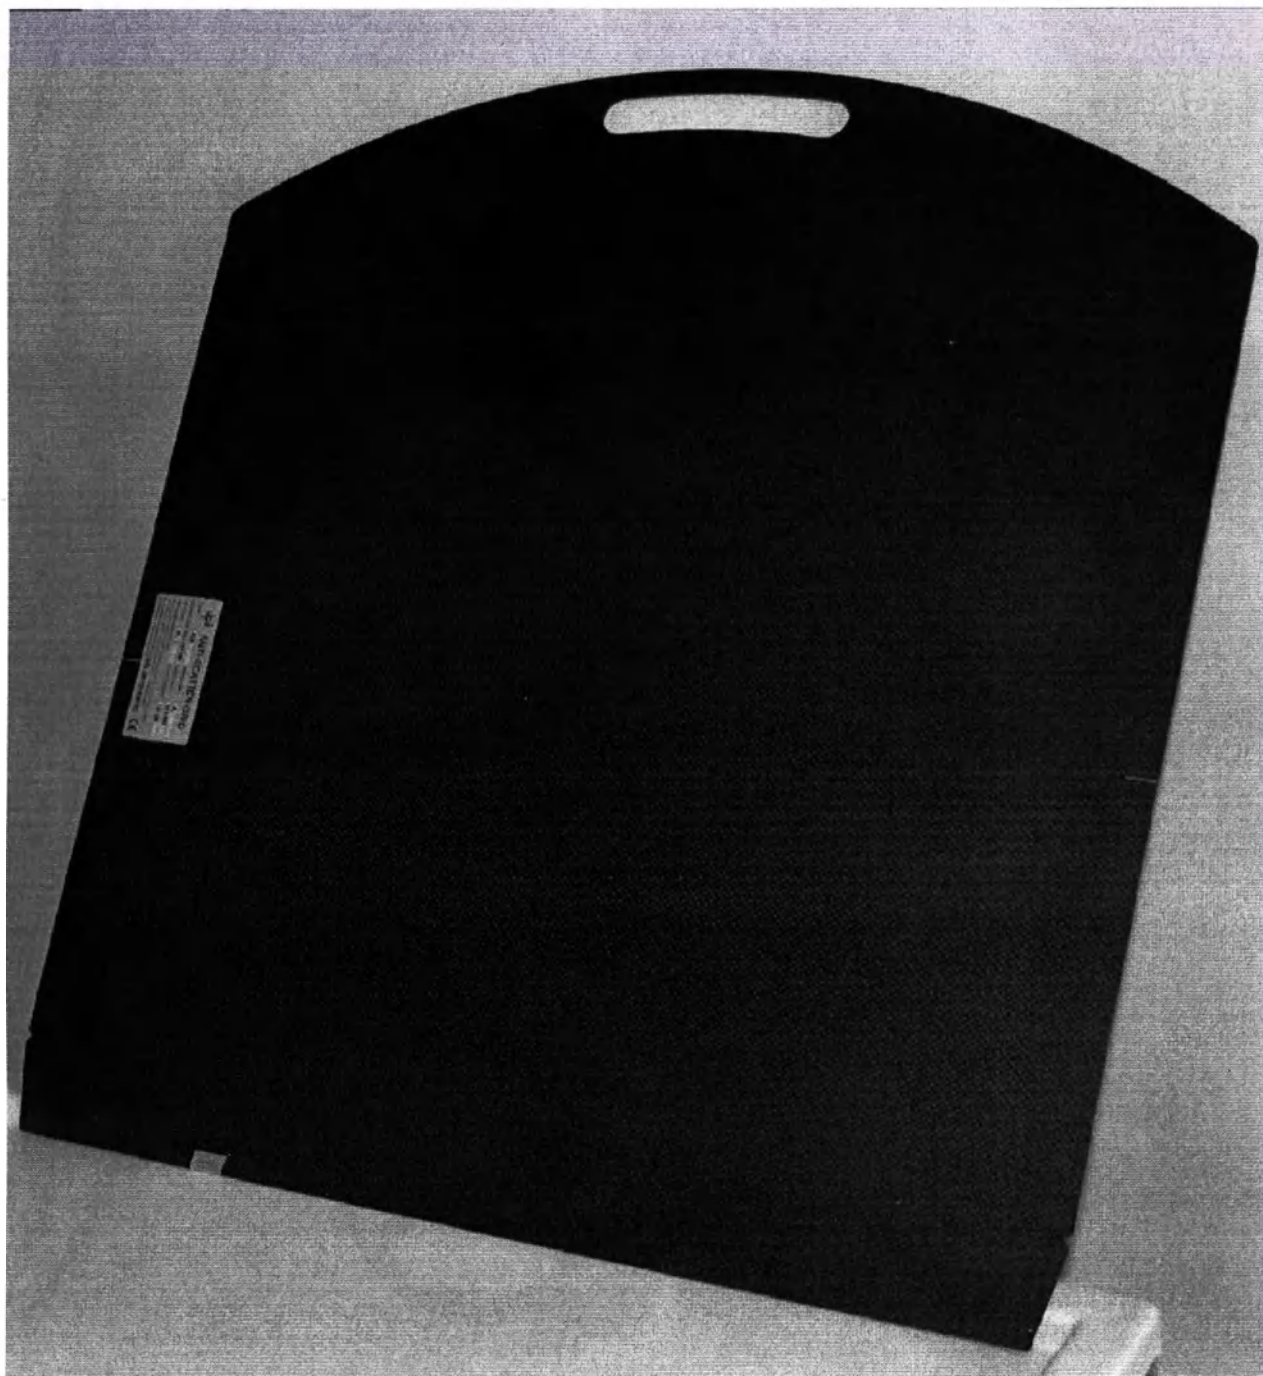


Растр рентгеновский отсеивающий JPI, производства JPI Healthcare Co., Ltd, Республика Корея

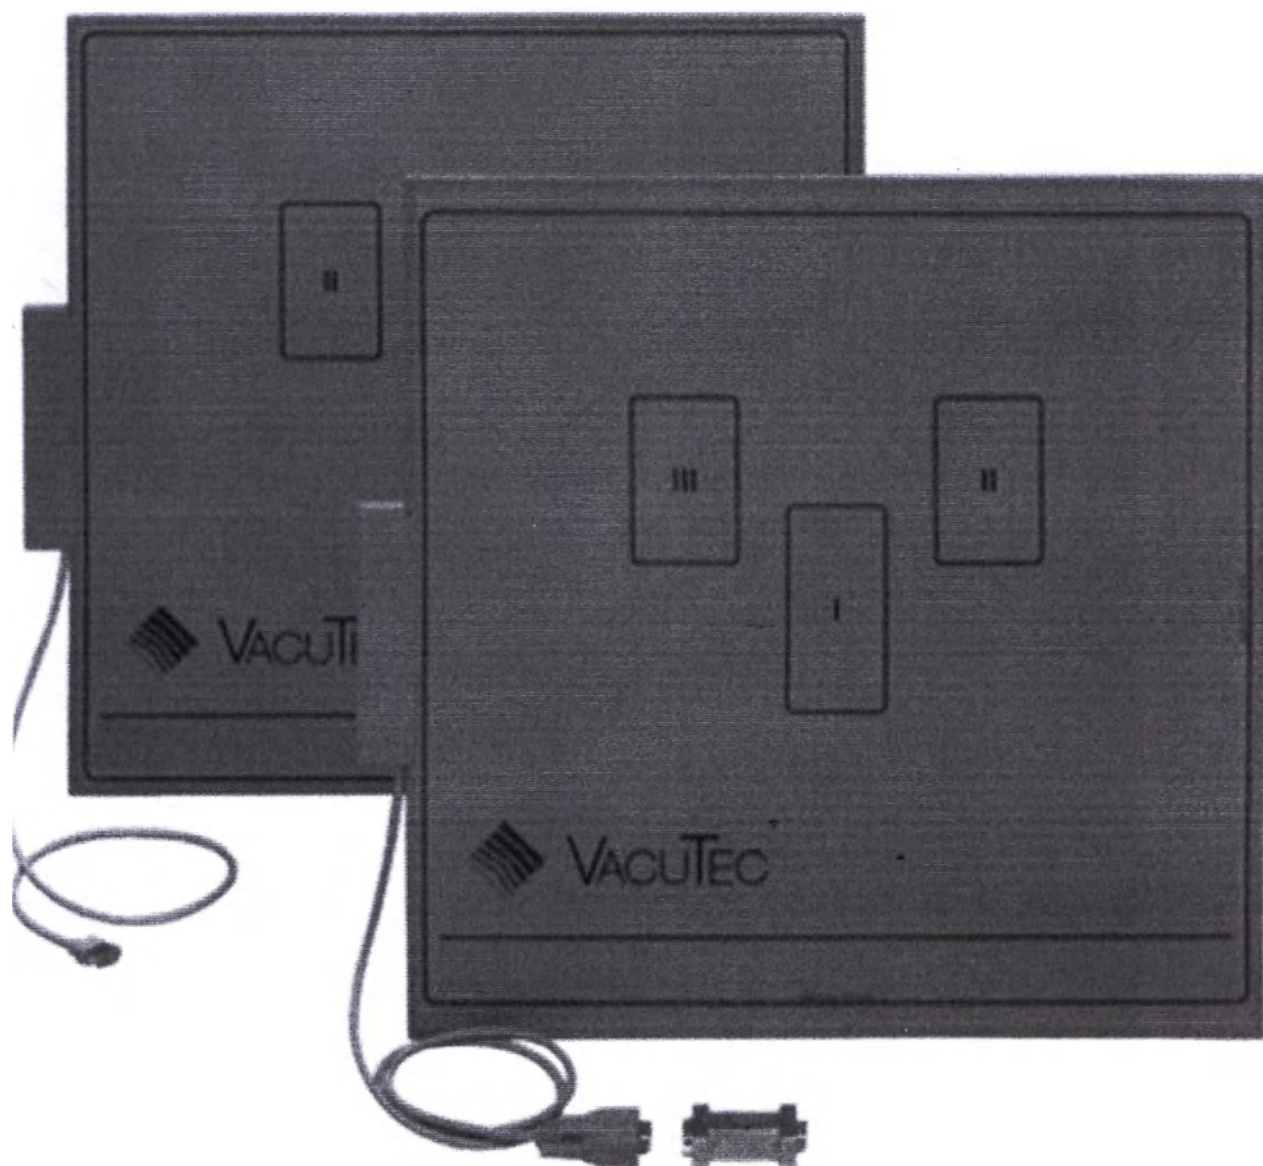

Ионизационная камера серии 70, производства VacuTec, Meßtechnik GmbH, Германия

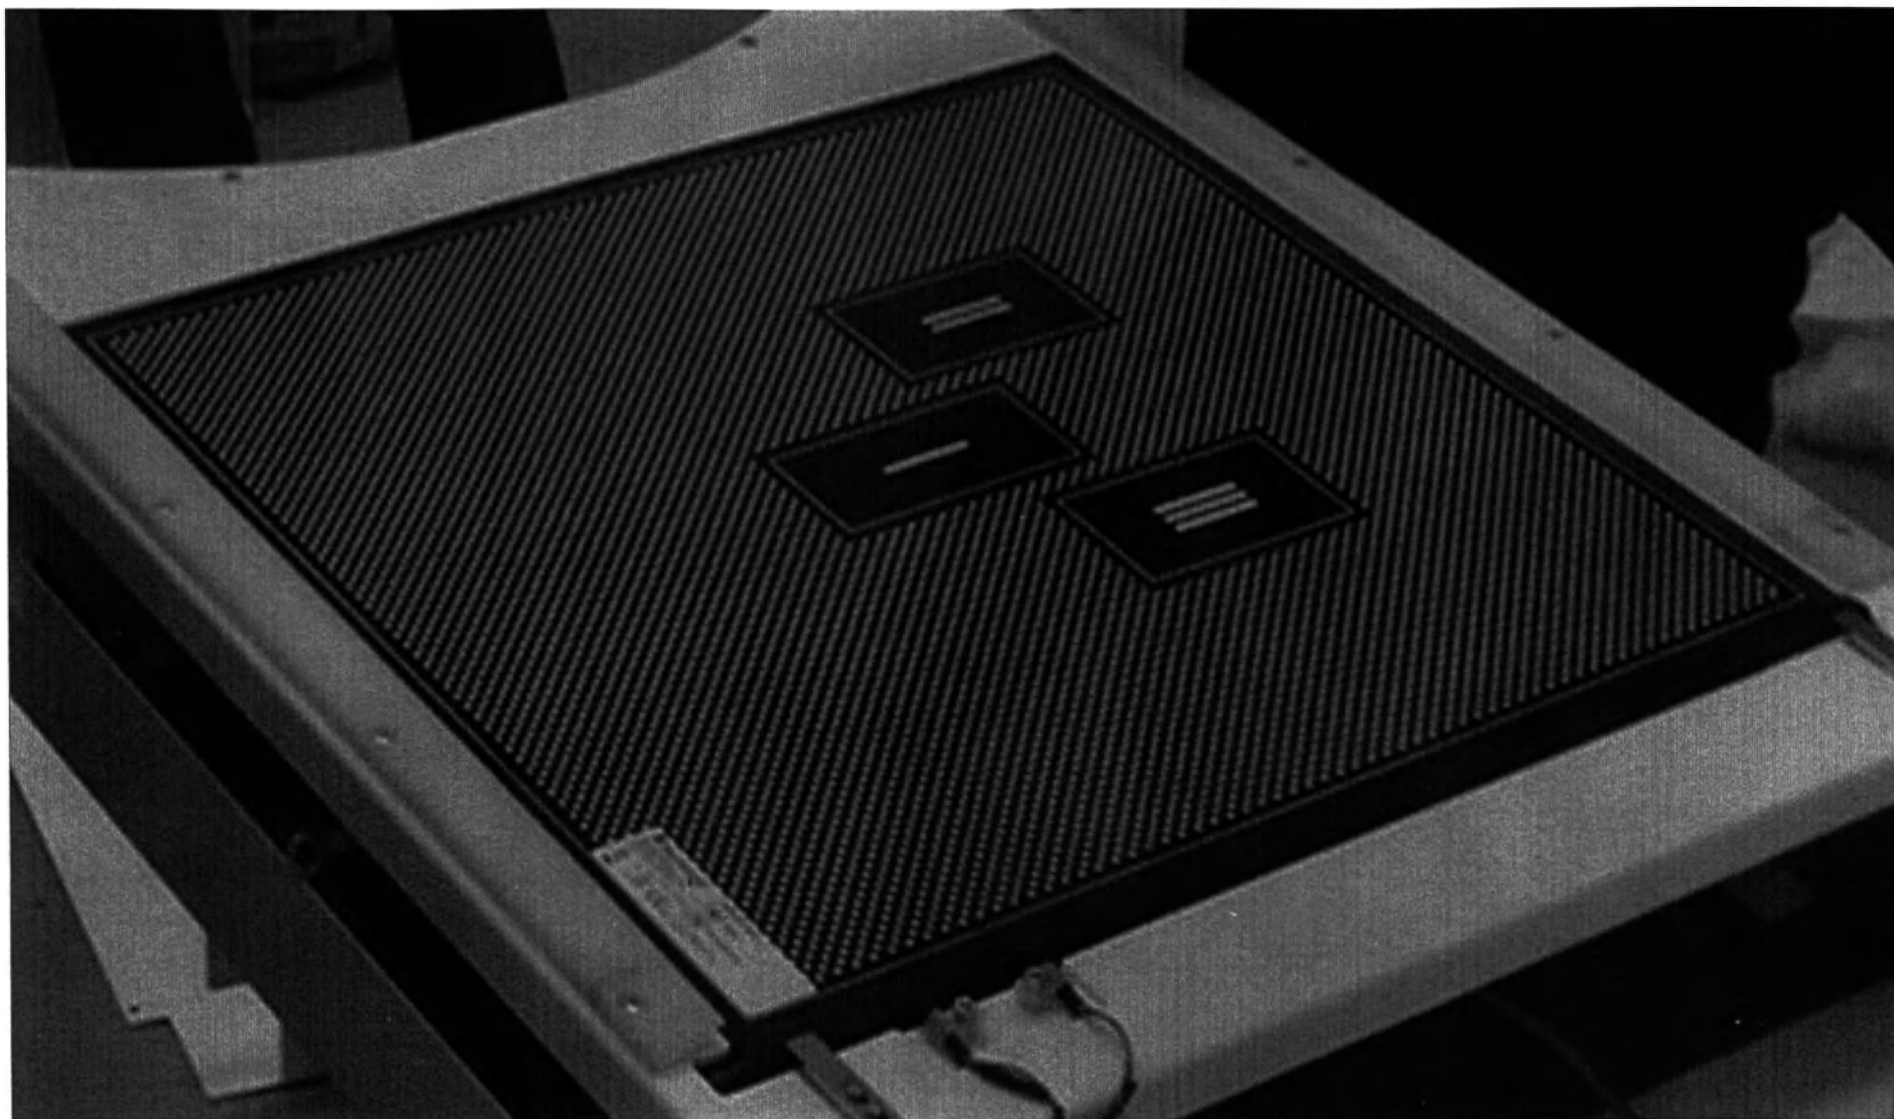


Ионизационная камера серии SSMC, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины

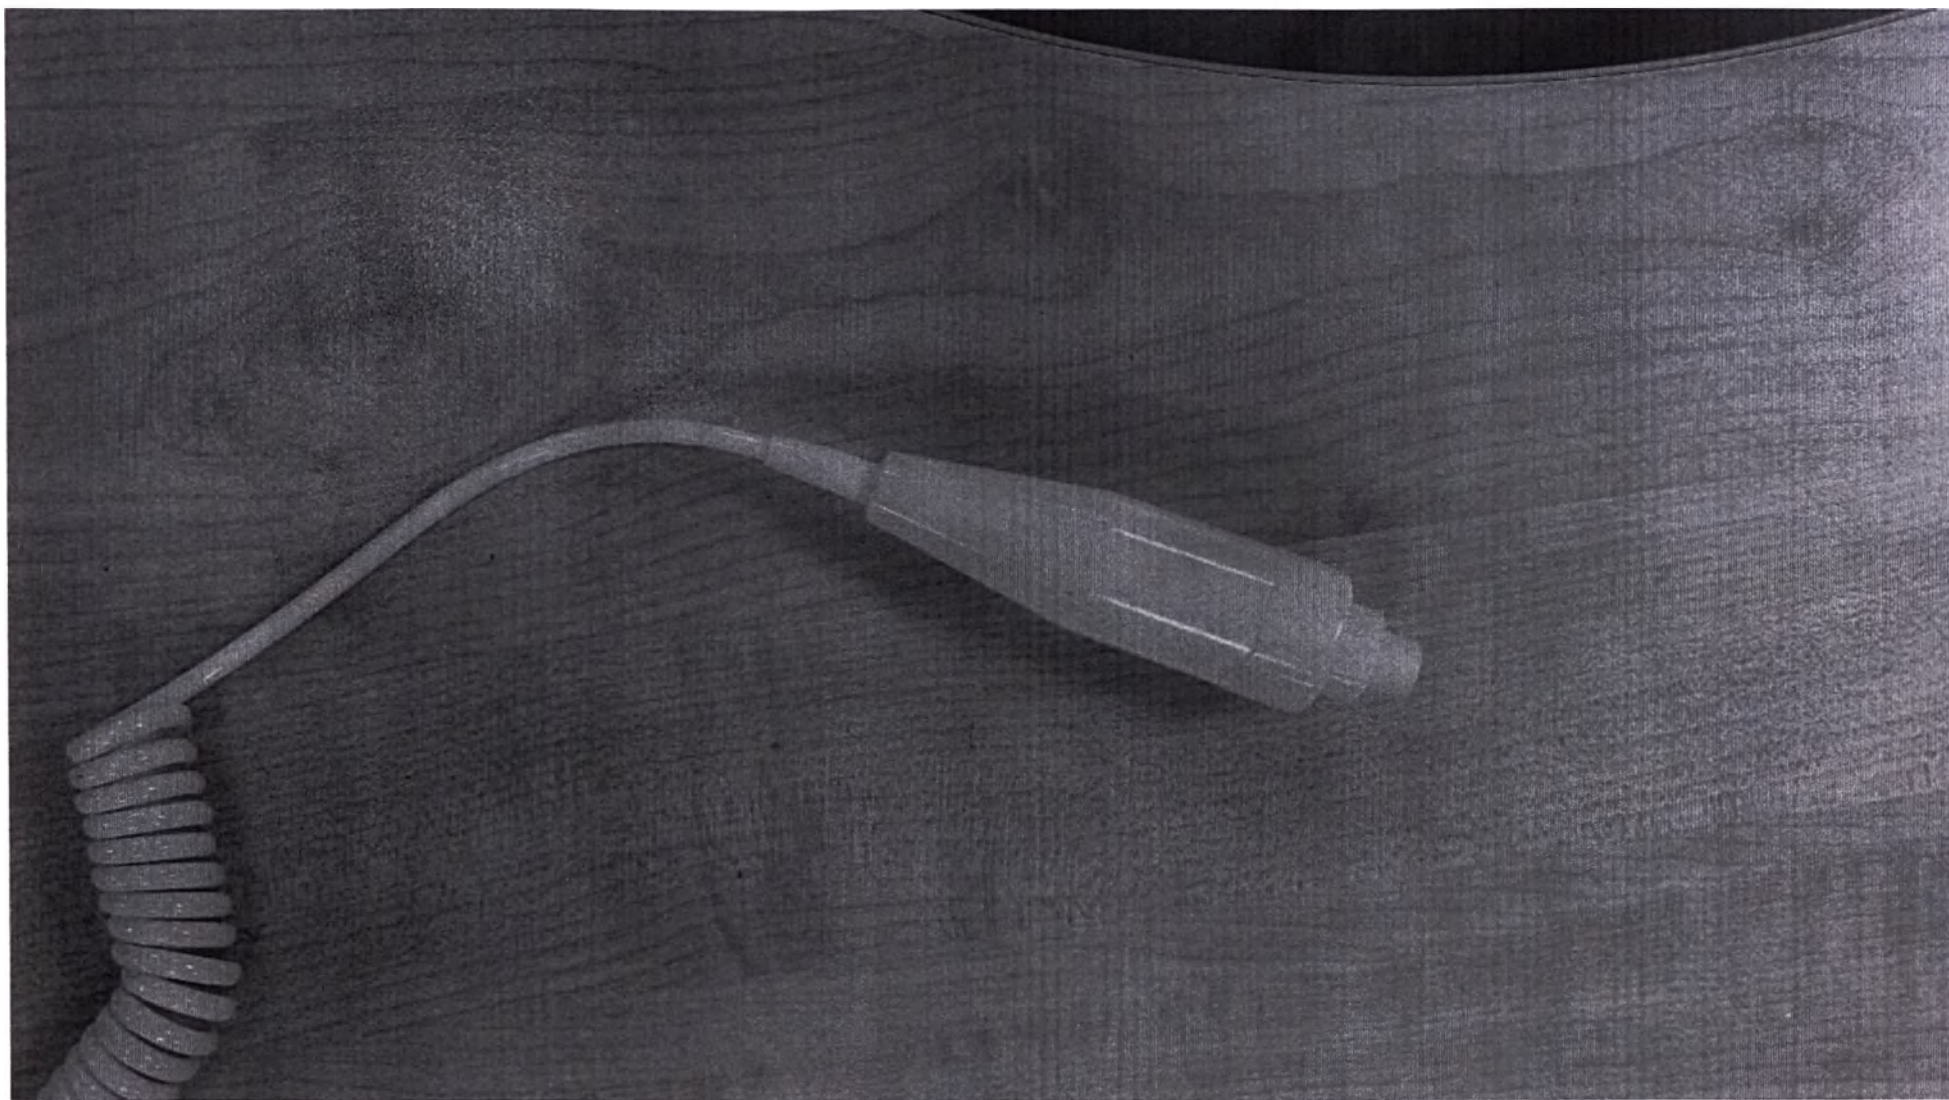

Устройство включения экспозиции, производства Dongzi Medical System Co., Китай или OMRON Corporation, Япония




Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов серии EM,
производства Tecnint HTE s.r.l., Италия

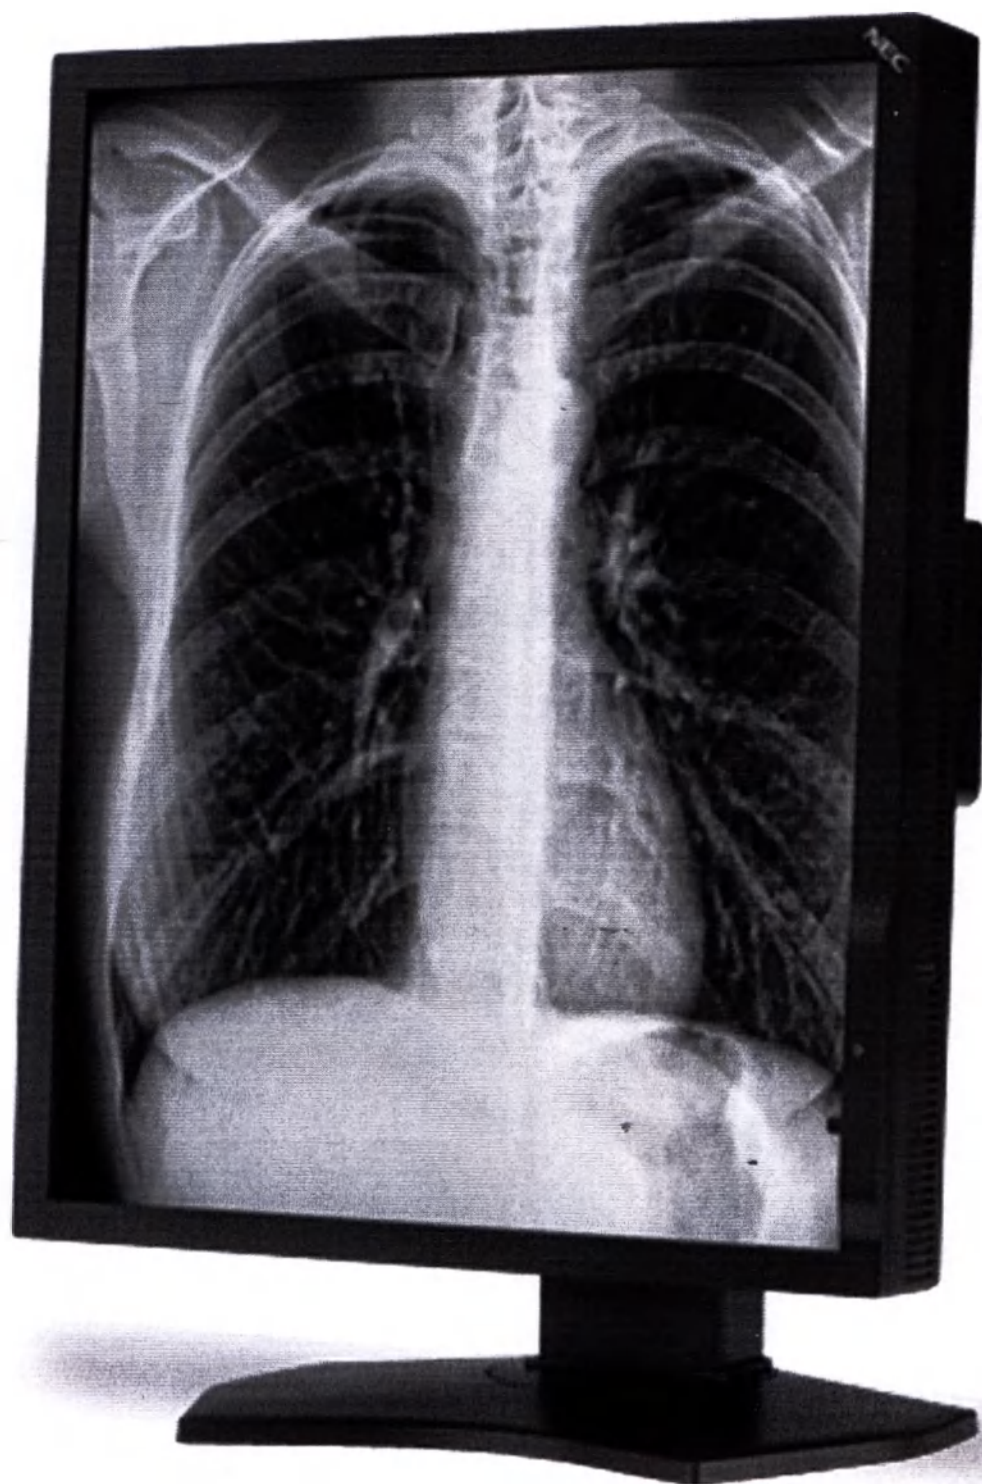


Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов NEC, производства NEC Display Solutions Ltd, Япония или Compal Electronics (China) Co., Ltd, Китай или Compal Display Electronics (Kunshan) Co., Ltd, Китай



Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов серии С или серии М или серии R, производства Nanjing Jusha Display Technology Co., Ltd, Китай

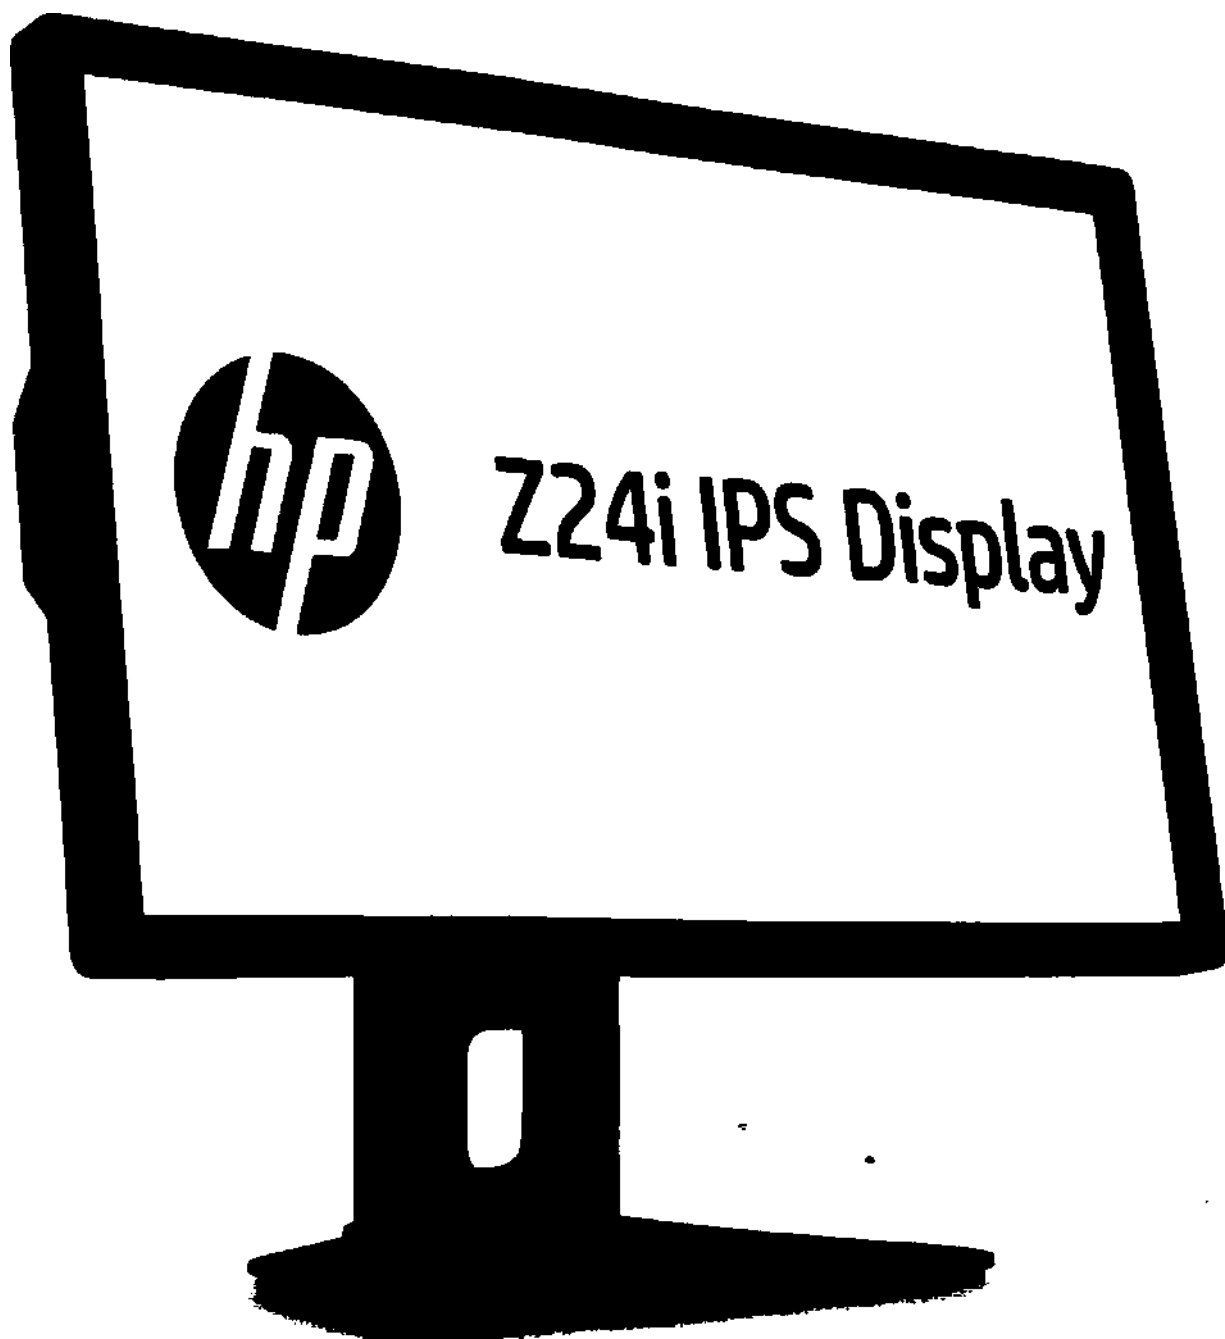


Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов серии Z, производства Hewlett-Packard Co., США или Wistron Corporation, Тайвань или Wistron Mexico S.A. de C.V, Мексика или Wistron InfoComm (Zhongshan) Corporation, Китай или All Technology (Zhongshan) Co. Ltd, Китай или Wistron InfoComm (Czech) s.r.o., Чешская Республика (на фото изображен монитор ЖК с диагональю 24 дюйма серии Z, производства Hewlett-Packard Co., США)

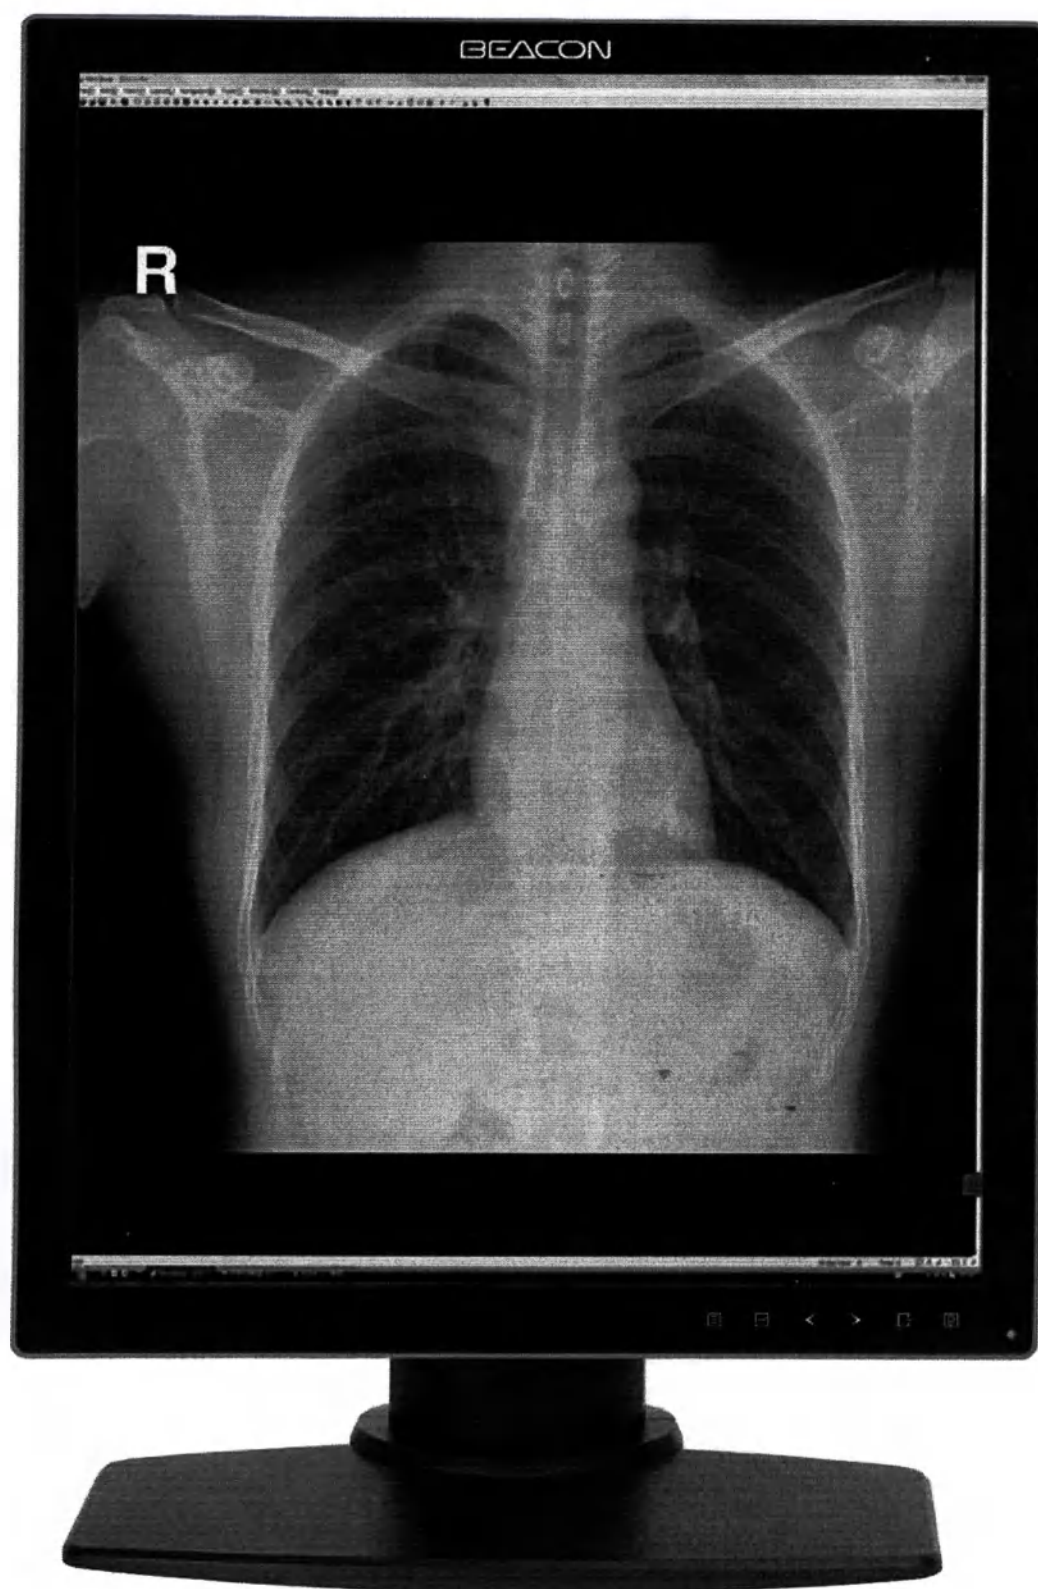

Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов Beacon,
производства Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd, Китай



Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов Barco, производства Barco N.V., Бельгия

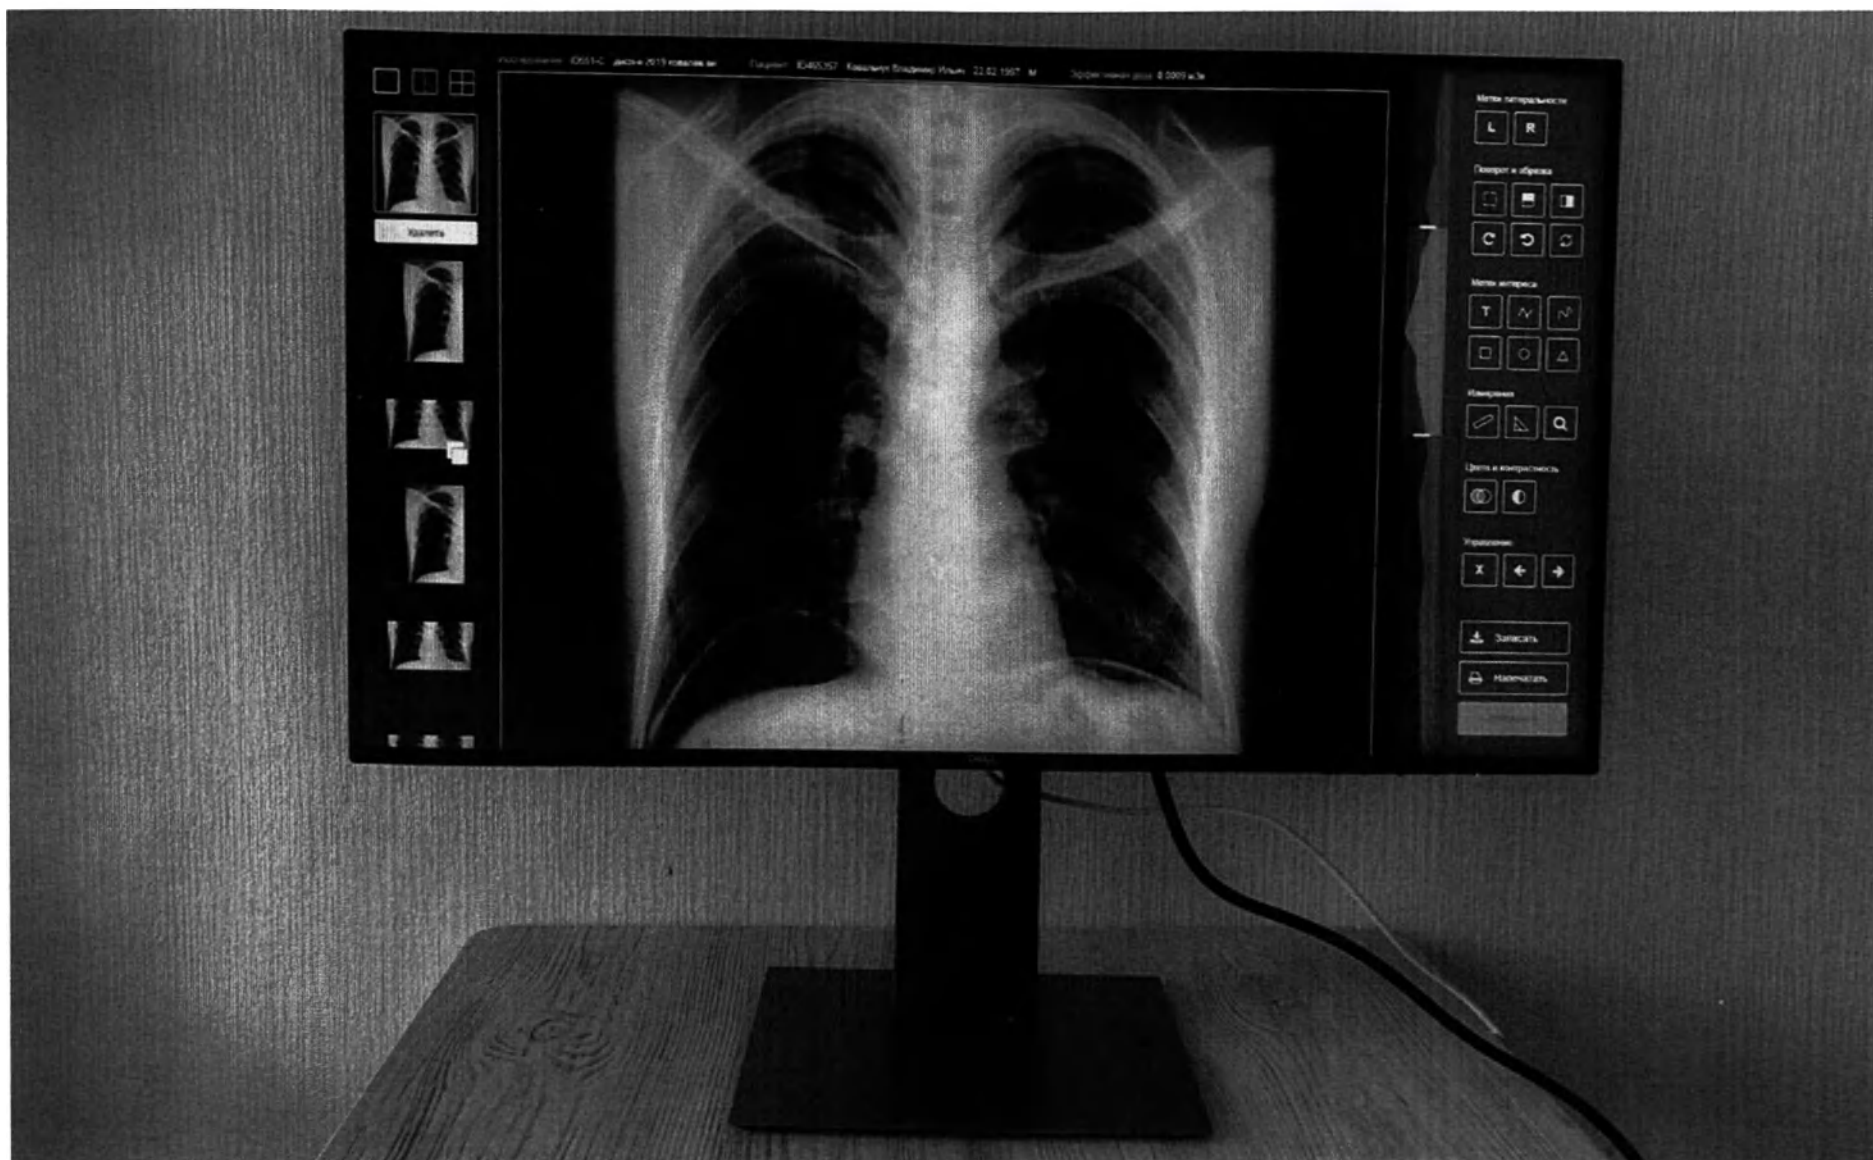

Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов DELL, производства DELL, Китай



**Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов Samsung,
производства Samsung, Республика Корея**



Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога «ДИАРМ-МТ-Плюс», производства АО «МТЛ», Россия



Радиологическая информационная система «ИнтеГРИС-МТ» или радиологическая информационная система «ИнтеГРИС-МТ-Плюс», производства АО «МТЛ», Россия




Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1, производства НПП «Доза», Россия




Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М, производства НПП «Доза», Россия




Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур серии VacuDap System, производства VacuTec, Meßtechnik GmbH, Германия.

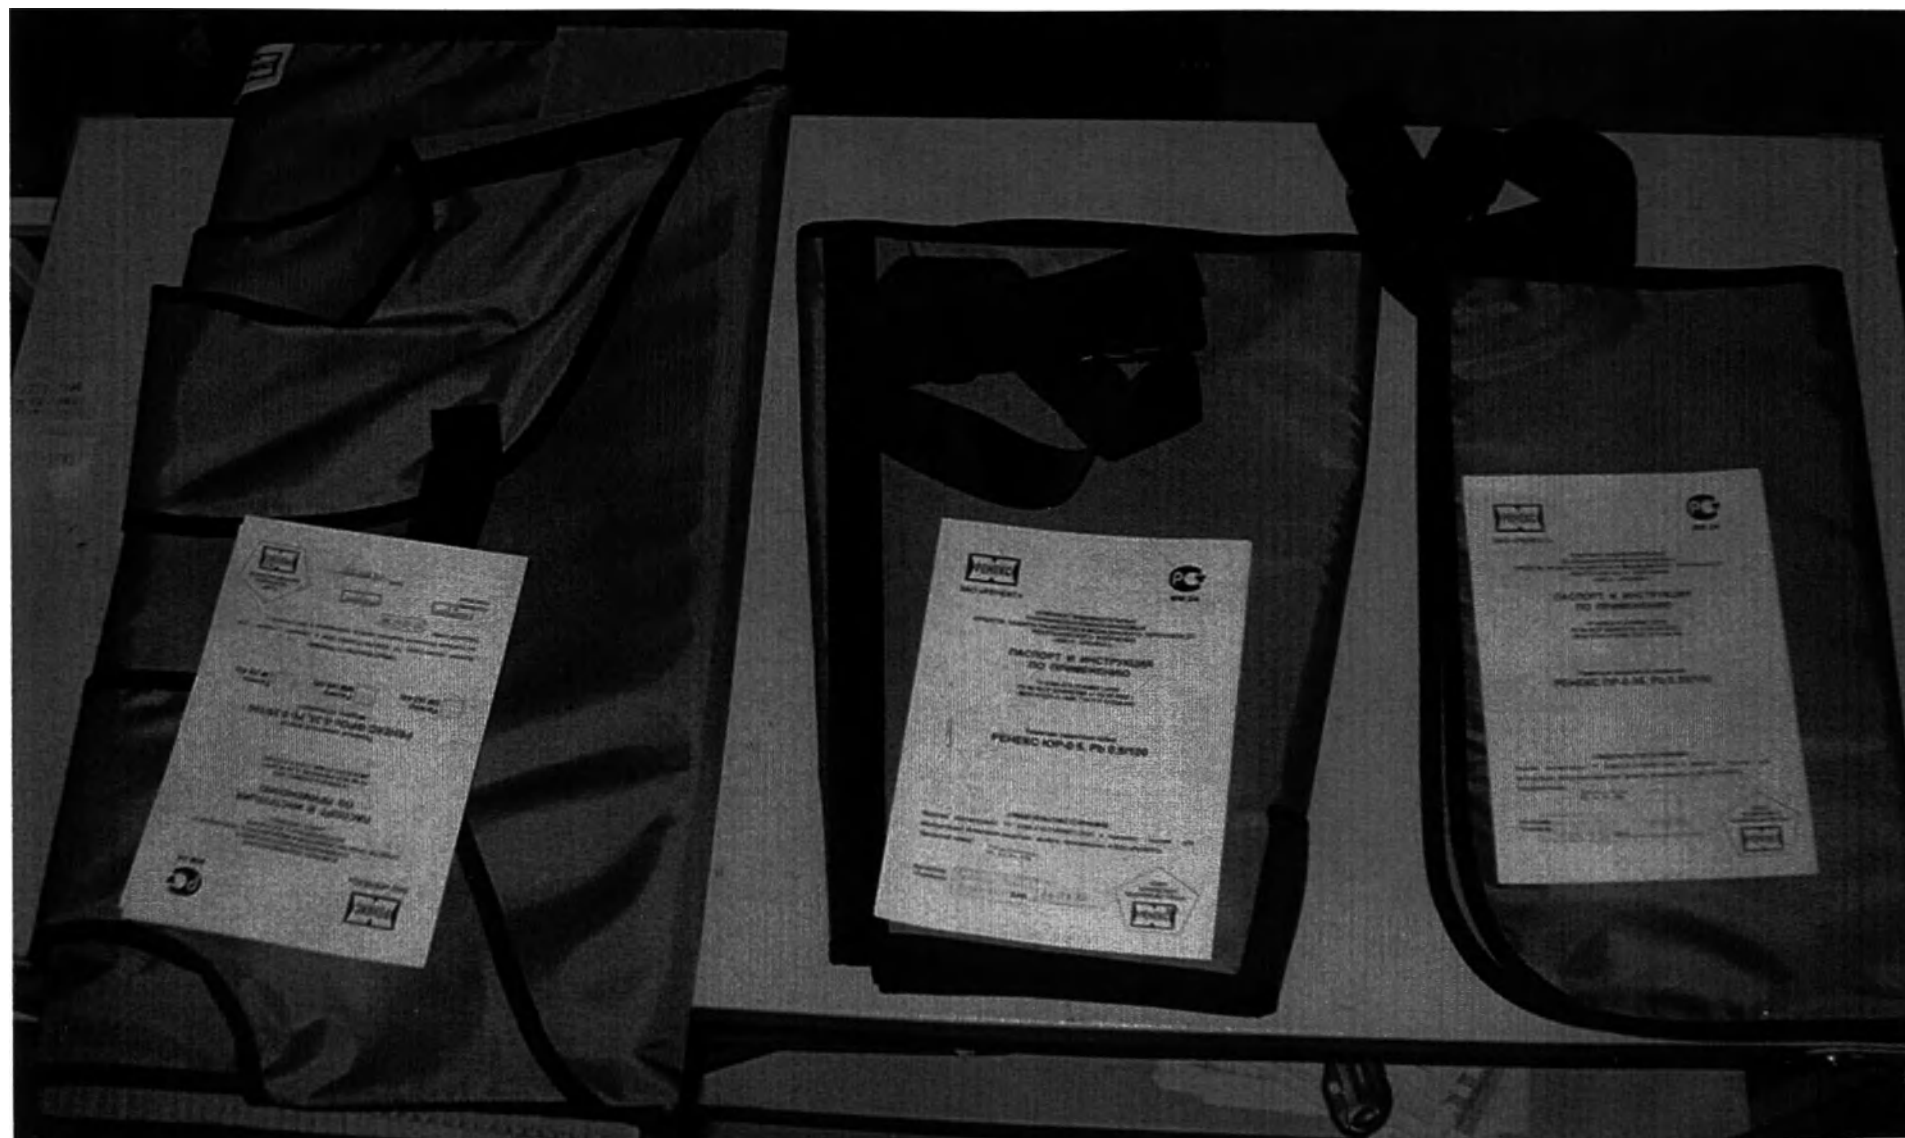

Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС» по ТУ 9398-010-21009821-2004, производства ЗАО «Ренекс», Россия

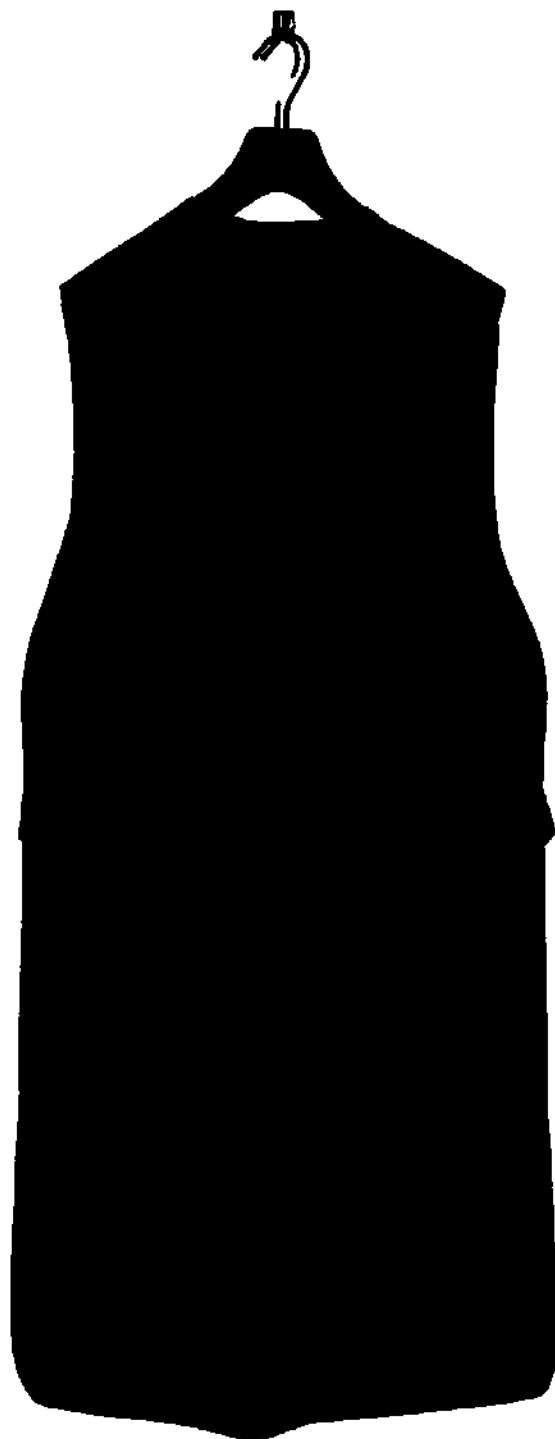

Комплекты рентгенозащитных средств из материала резиносвинцового для индивидуальной защиты врача, пациента и для использования в микропедиатрии при рентгенодиагностических исследованиях КСИЗ-РС и КСИЗмп-РС по ТУ 9452-001-42879986-2006, производства ООО «МП НПФ «Гаммамед-П», Россия

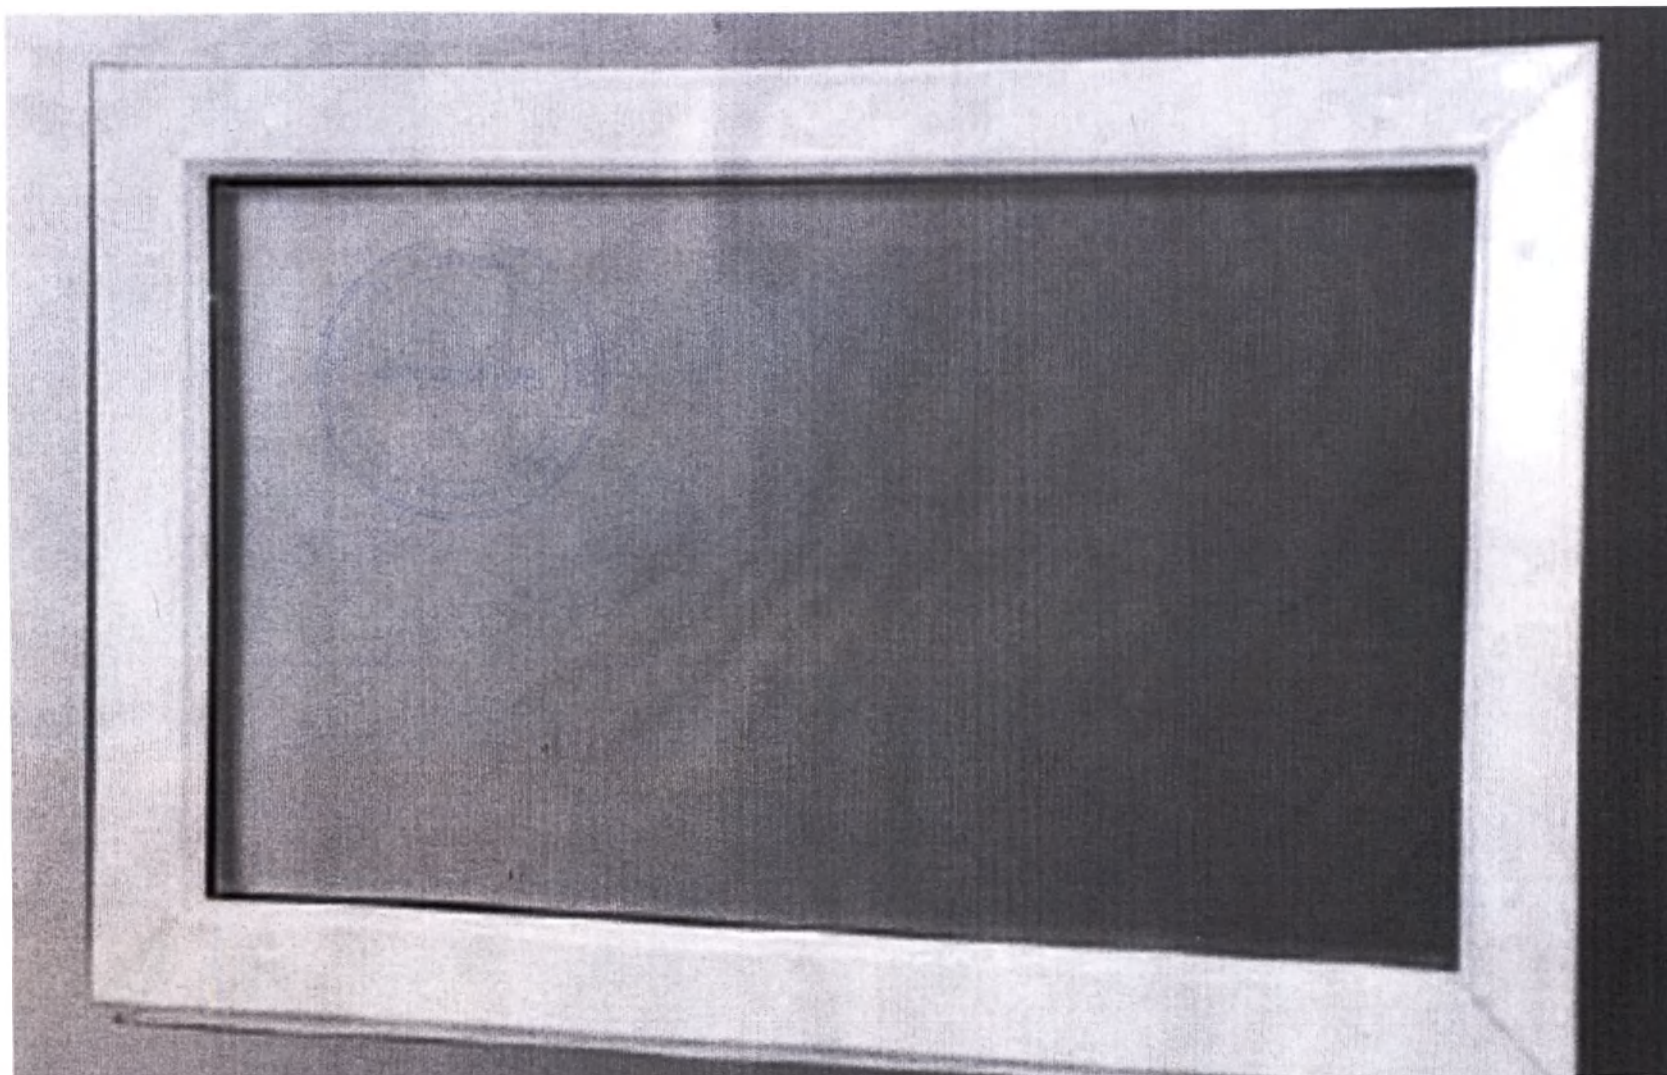

Окно рентгенозащитное серии МАСО, производства Hans O.Mahn & Co. KG, Германия или РЕНЕКС ОСРЗ, производства ЗАО «Ренекс», Россия

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 12


(сорок два) листах

Тек. докл. № 12
О.В. Шенеряков



Фотографии маркировки медицинского изделия
Аппарат флюорографический
Р-600 «Флюоро-Плюс»,
производства ООО «ВКО Медпром», Россия

Маркировка располагается на составных частях, указанных ниже.

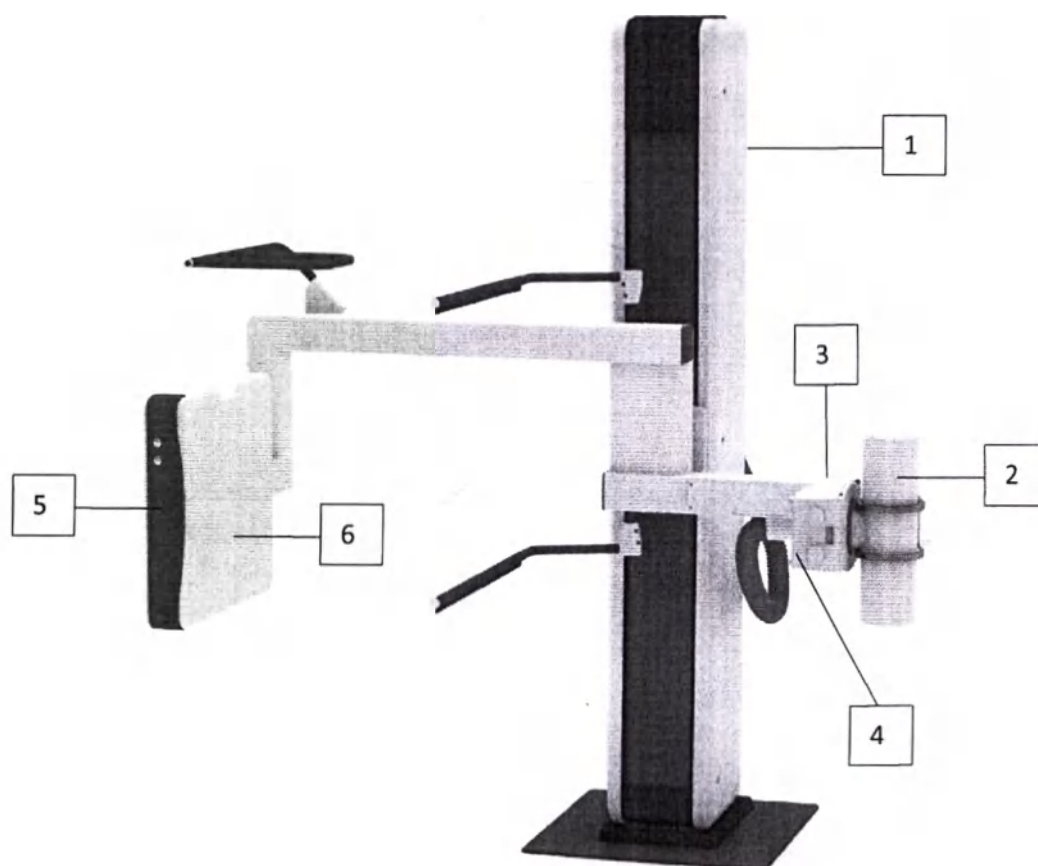


Штатив с кронштейном Y2-B0100, Y2-B0200, производства ООО «ВКО Медпром», Россия

1	Штатив с кронштейном Y2-B0100, Y2-B0200	На кронштейне
2	Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой	На обратной стороне излучателя
3	Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением	На задней панели коллиматора
4	Дозиметр рентгеновского излучения клинический	На обратной стороне дозиметра
5	Растр рентгеновский отсеивающий	На растре
6	Ионизационная камера	На ионизационной камере, если имеется

Кроме того, маркировка располагается на следующих частях, в том числе покупных


7	Рентгеновское питающее устройство (РПУ)	На боковой стороне генератора
8	Комплекс аппаратно-программный для регистрации и обработки рентгеновских изображений «СОЛО ДР-МТ»	На системном блоке
9	Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога «ДИАРМ-МТ-Плюс»	На системном блоке
10	Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов	На обратной стороне монитора
11	Радиологическая информационная система «ИнтегрИС-МТ-Плюс»	На боковой стороне шкафа
12	Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС» по ТУ 9398-010-21009821-2004	На упаковке
13	Комплекты рентгенозащитных средств из материала резиносвинцового для индивидуальной защиты врача, пациента и для использования в микропедиатрии при рентгенодиагностических исследованиях КСИЗ-РС и КСИЗмп-РС по ТУ 9452-001-42879986-2006	На упаковке

1 Штатив с кронштейном Y2-B0100 или Y2-B0200, производства ООО «ВКО Медпром», Россия

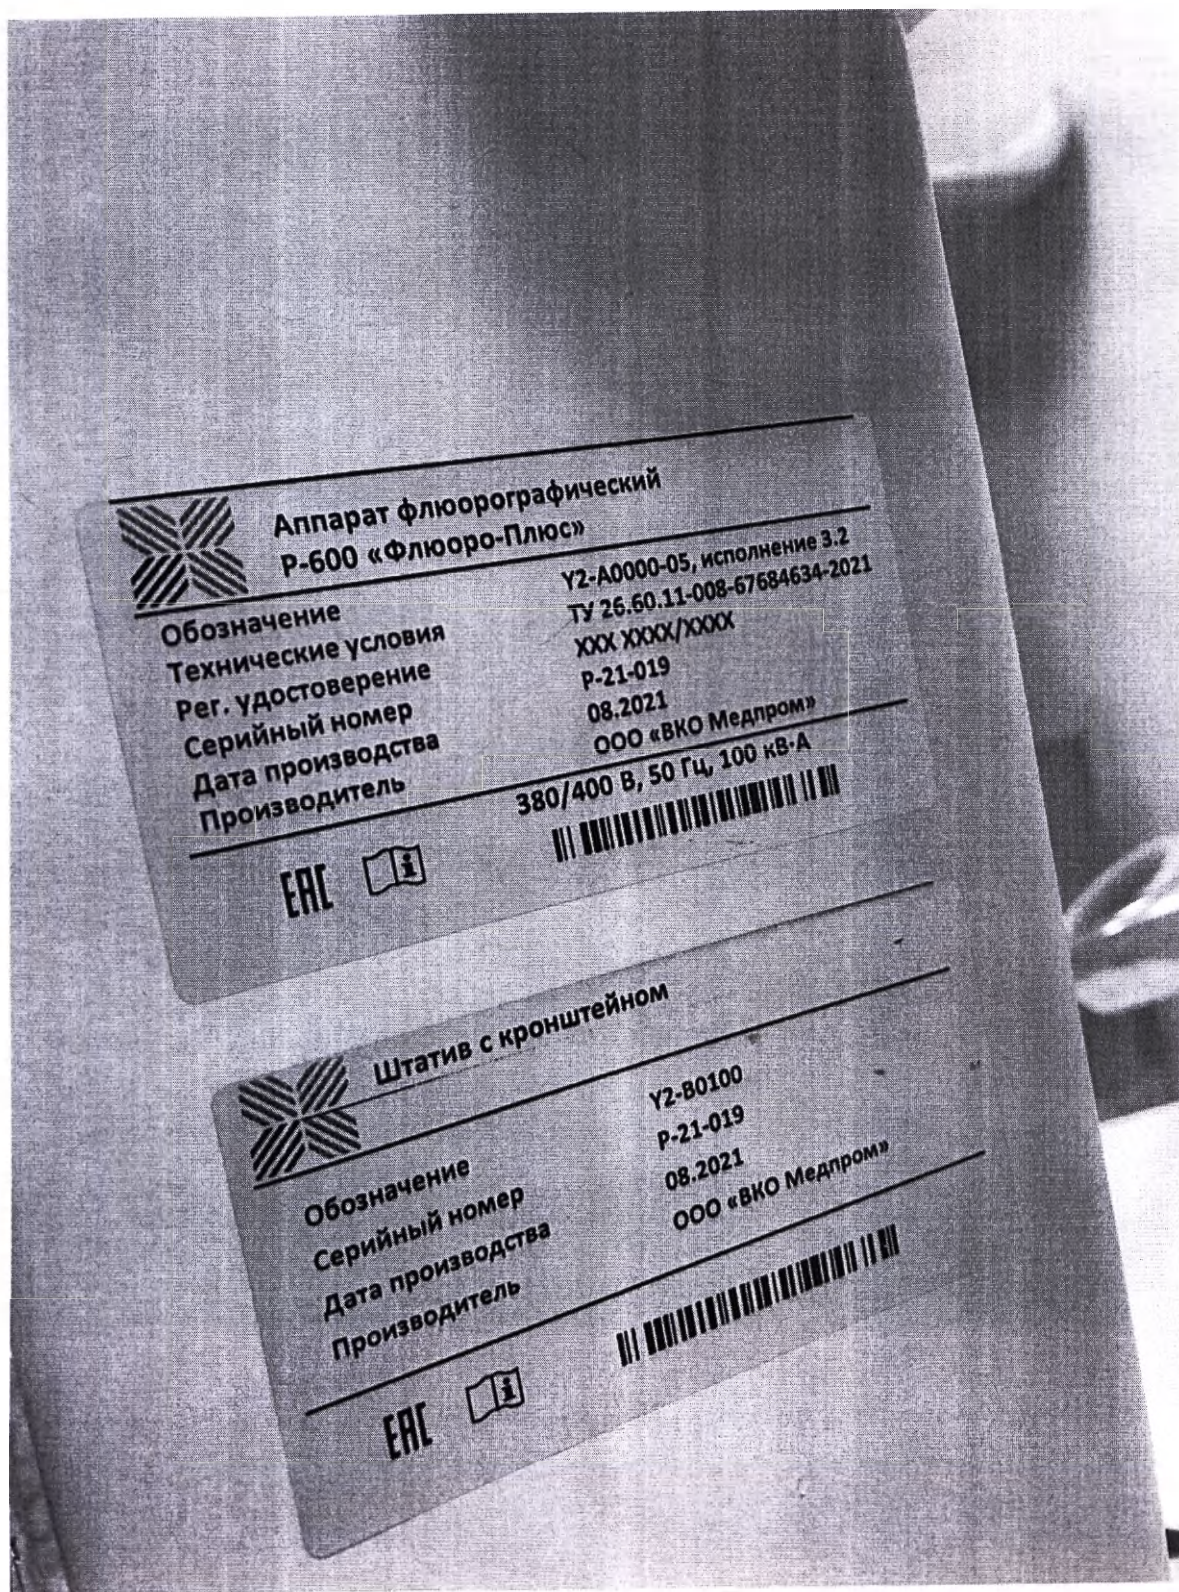


2 Излучатель

- 2.1 Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой E7242 или E7252 или E7239, производства Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd, Япония

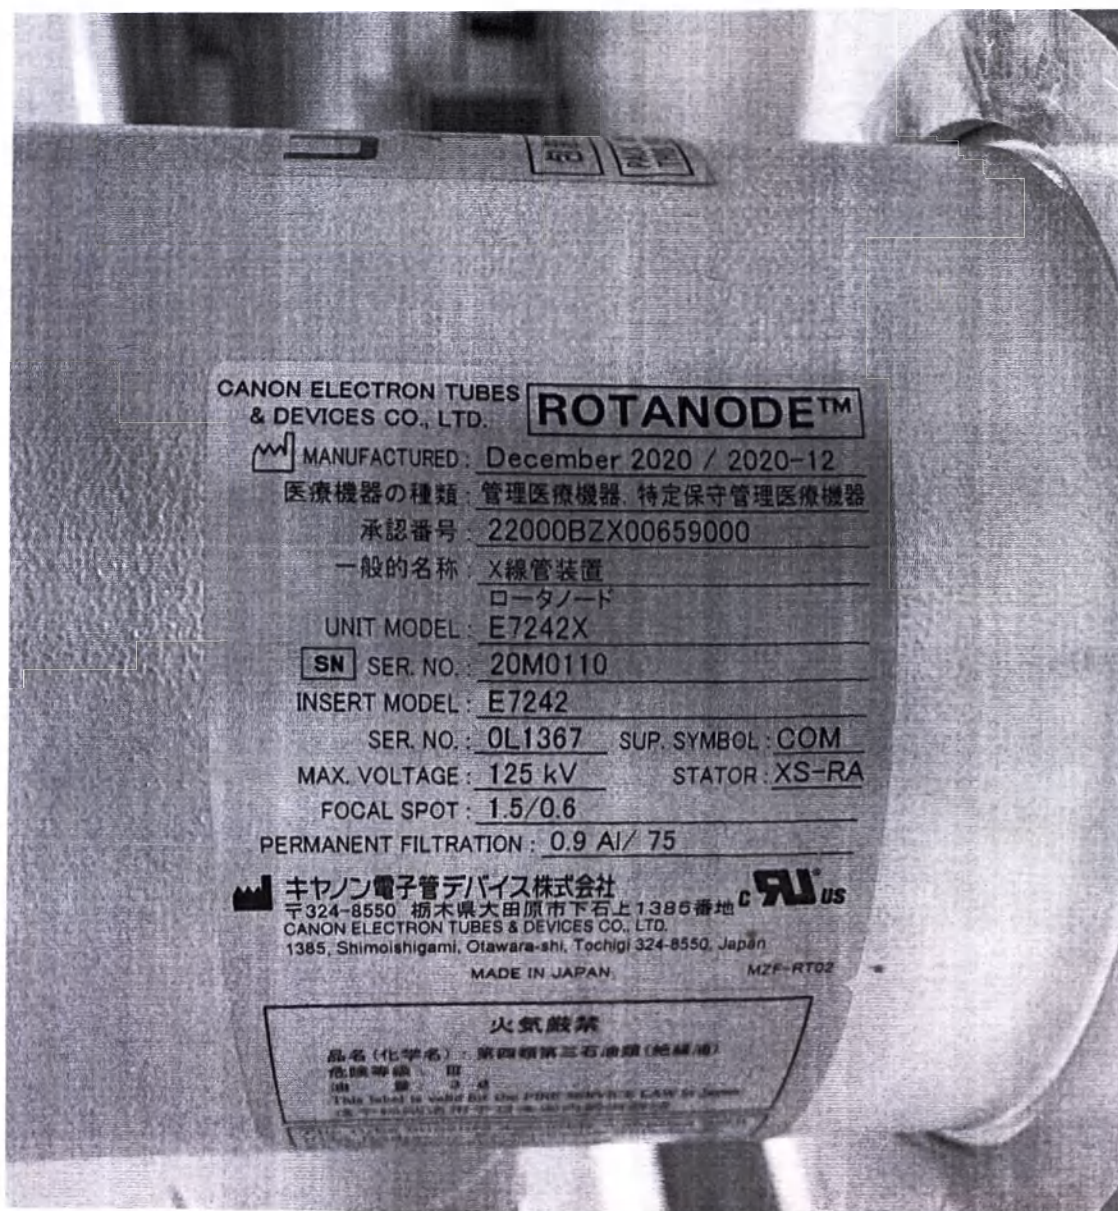


- 2.2 Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой RAD 14/Leo производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины

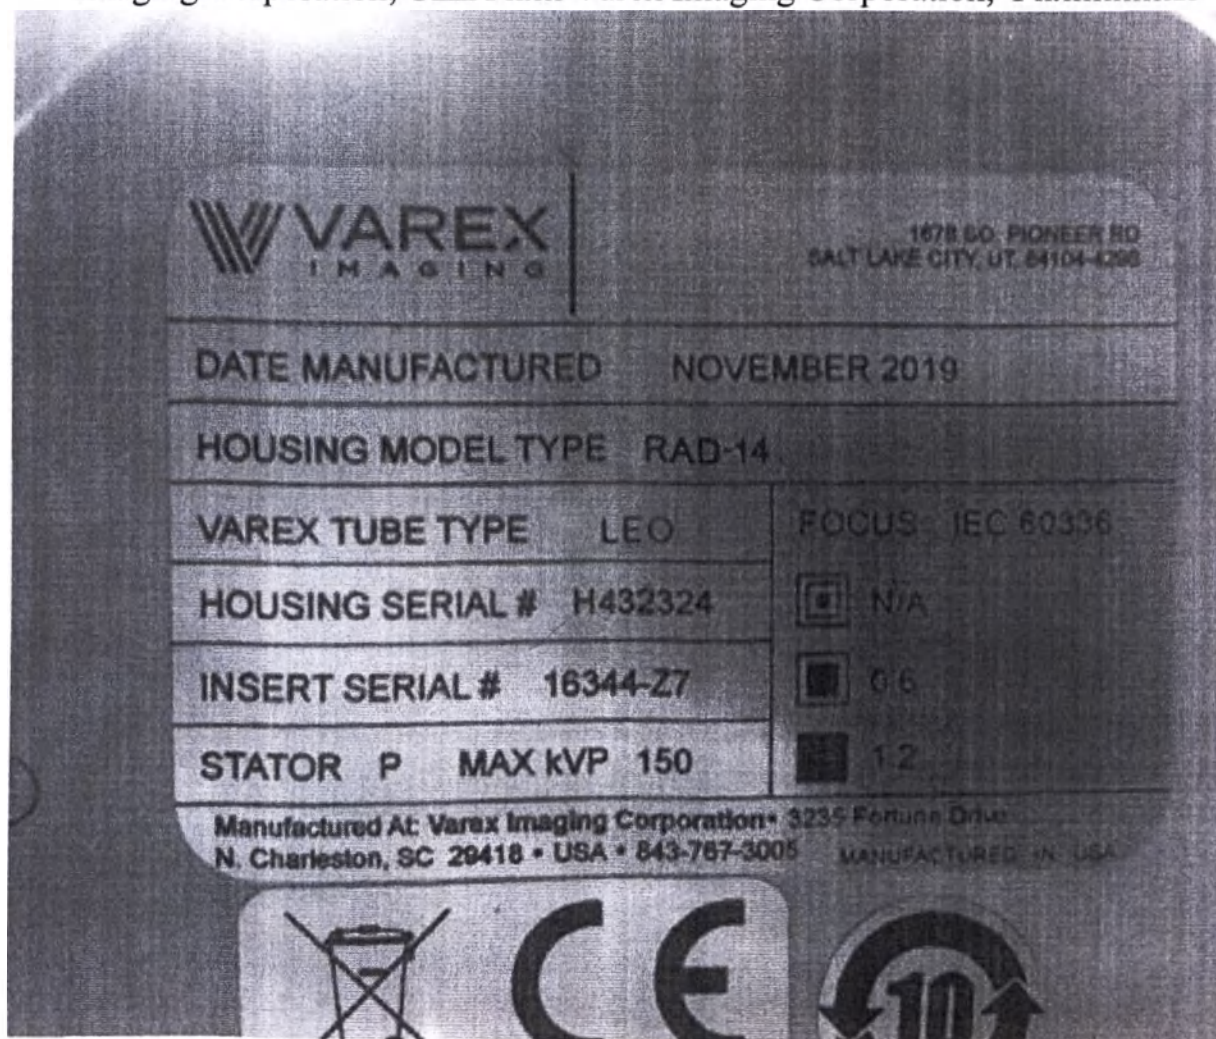

3 Коллиматор


3.1 Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением серии R 221, производства Ralco srl., Италия

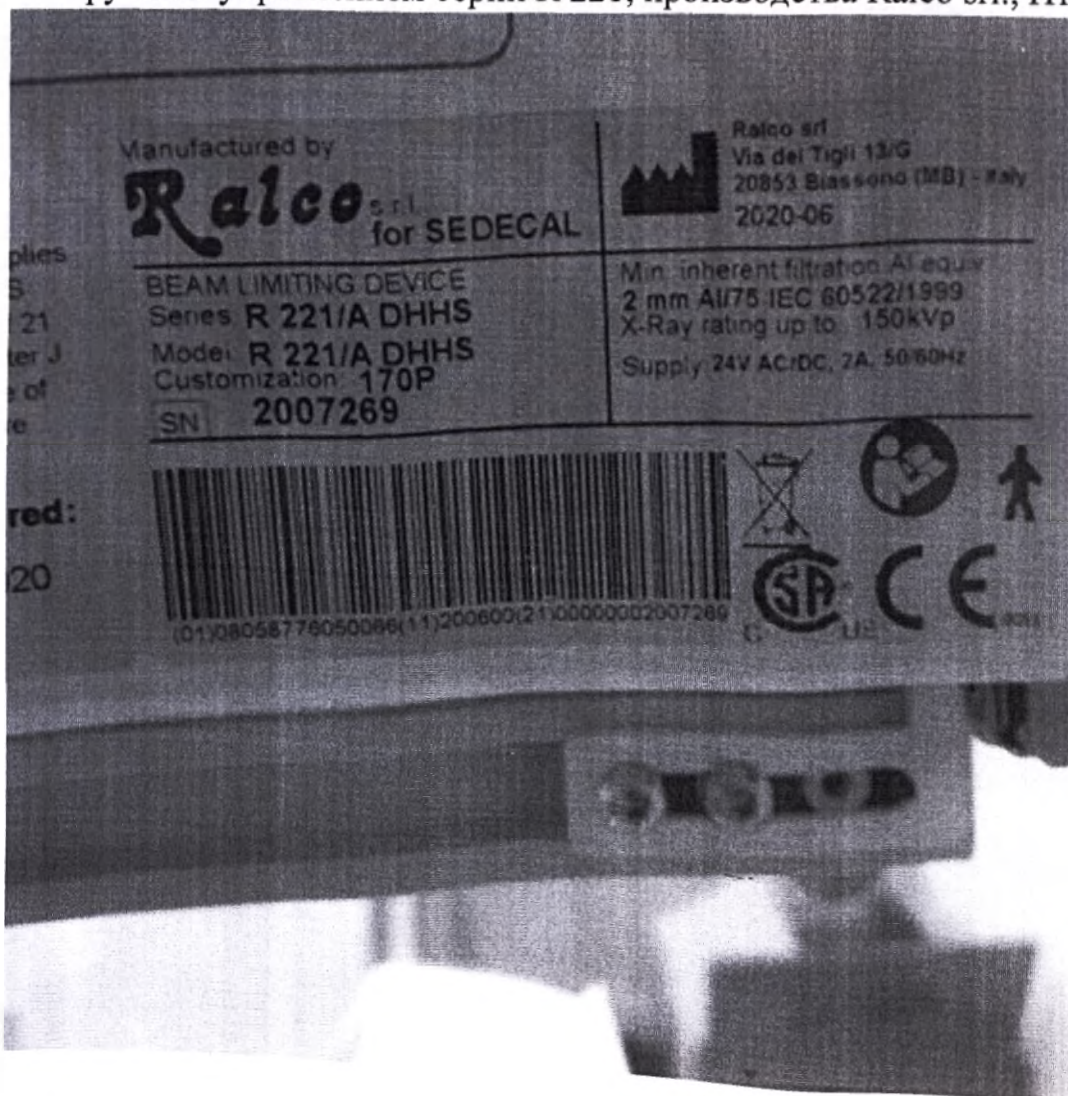


3.2 Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением серии R 225, производства Ralco srl., Италия




3.3 Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением серии R 302, производства Ralco srl., Италия

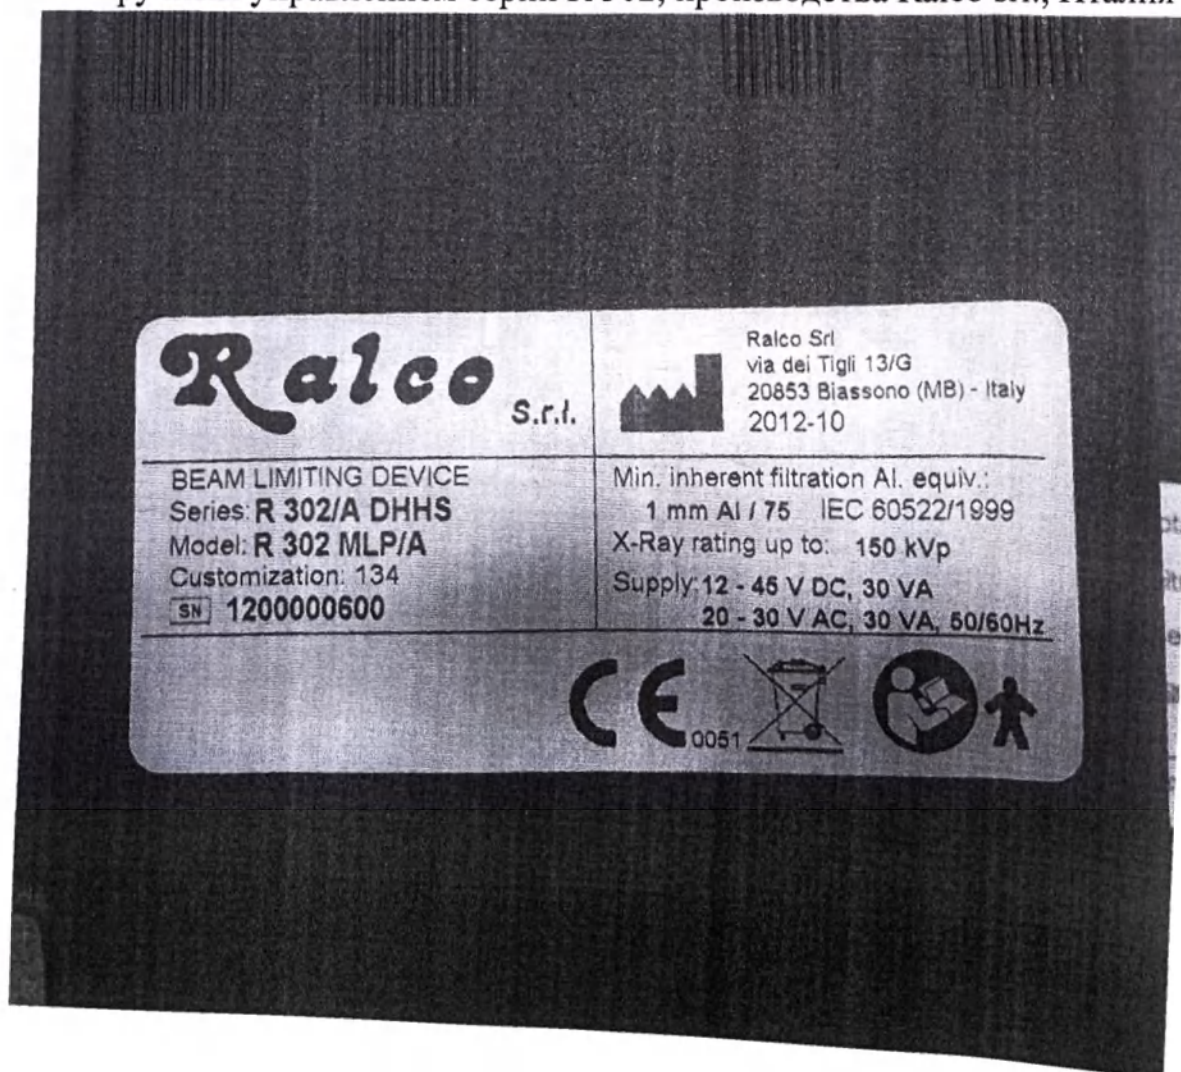

- 3.4 Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением серии Optica 10 или серии Optica 20 или серии Optica 30, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины

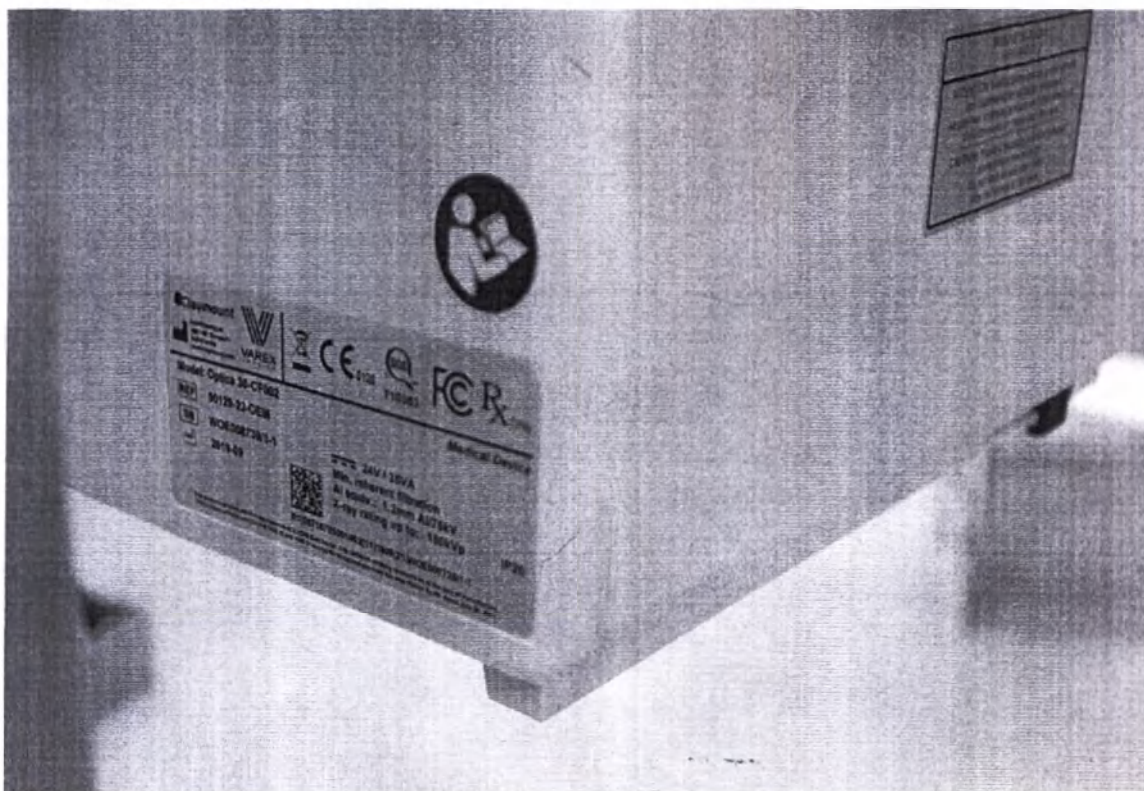

3.5 Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением серии ML 01 II, производства Siemens, Германия

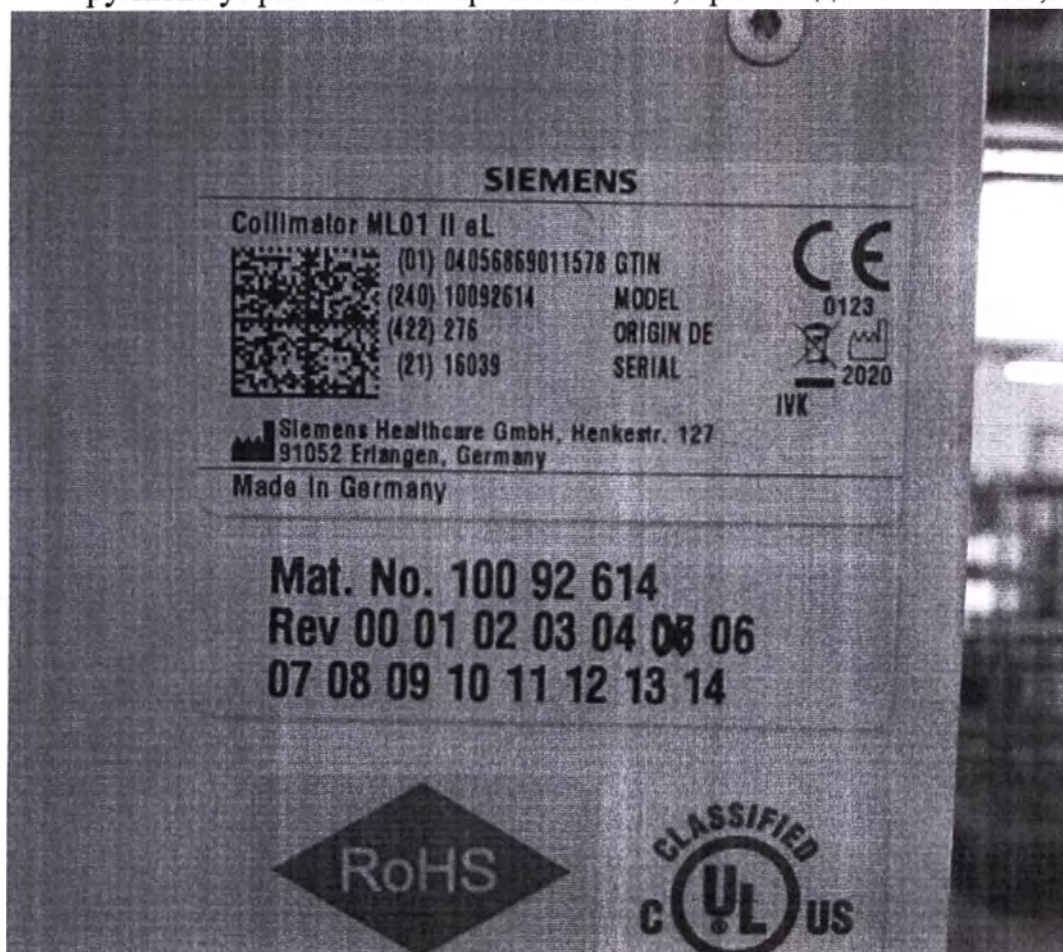


4 Дозиметр

- 4.1 Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М,
производства НПП «Доза», Россия




4.2 Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур серии VacuDap System, производства VacuTec, Meßtechnik GmbH, Германия

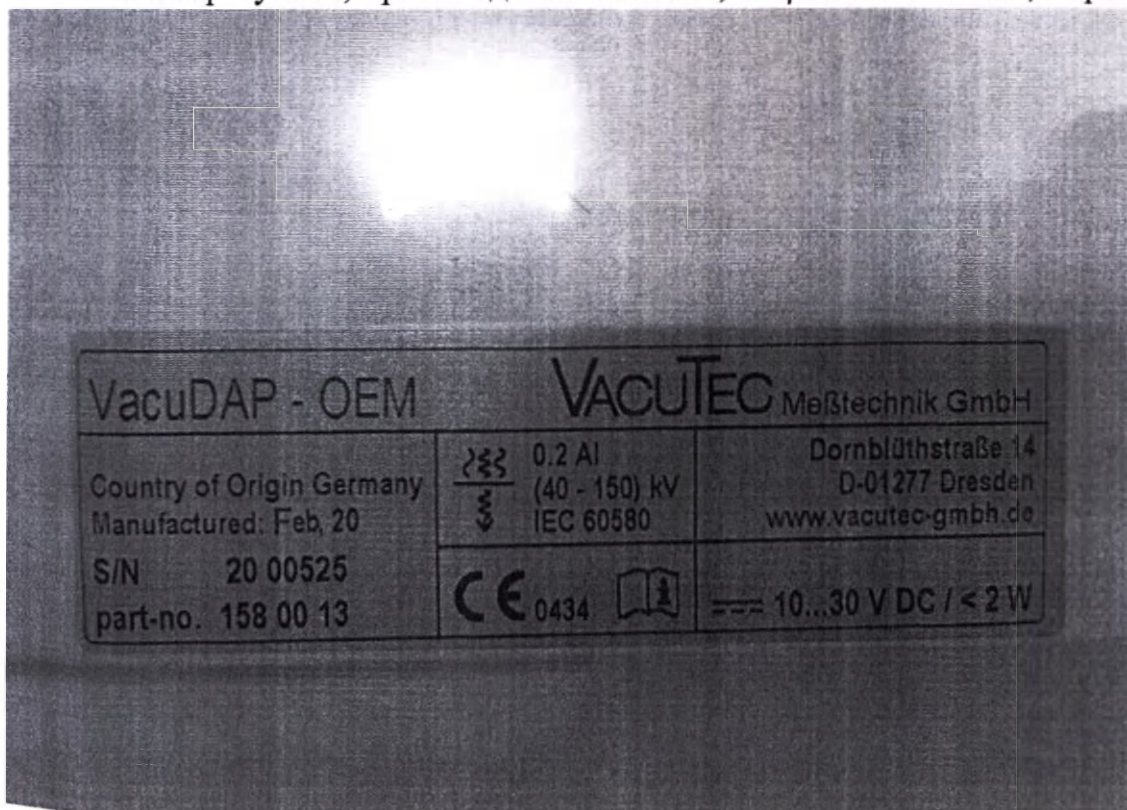


5 Растр

5.1 Растр рентгеновский отсеивающий Lysholm, производства Gridline A.B., Швеция

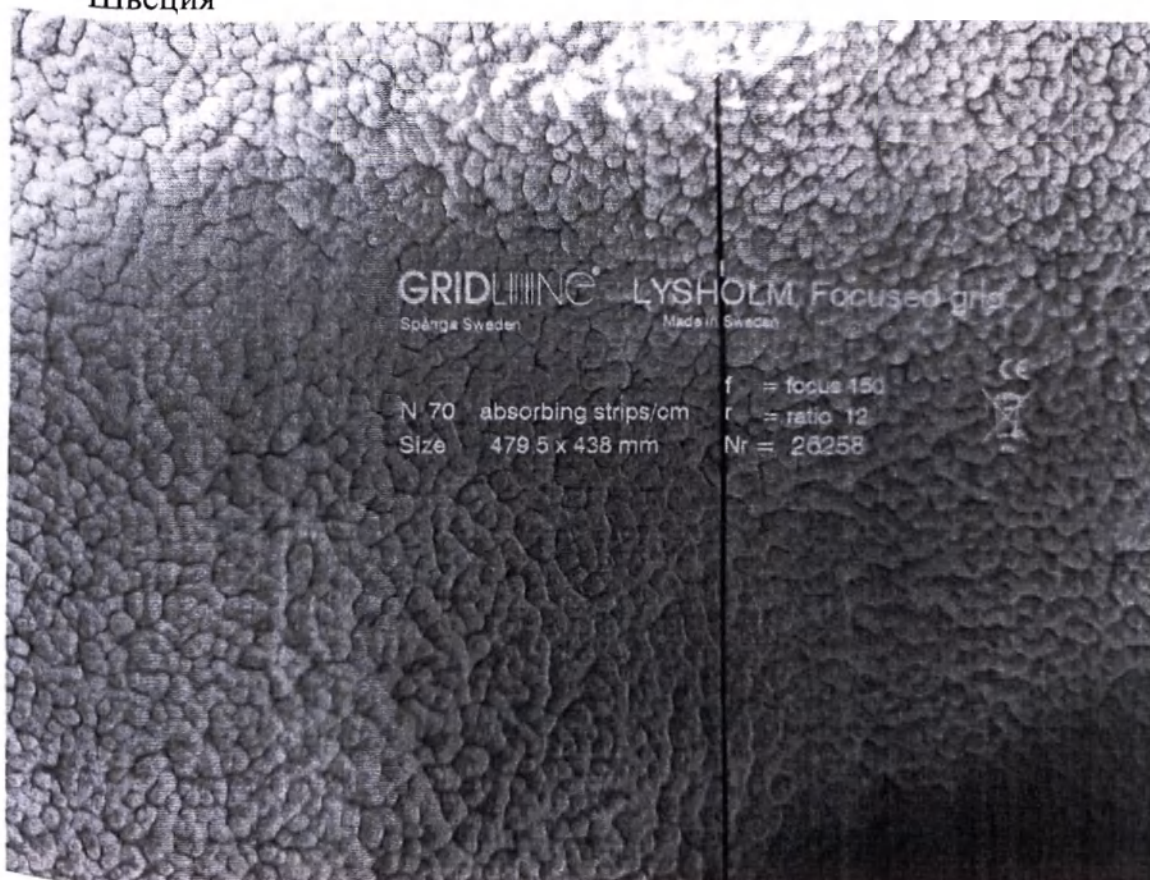


5.2 Растр рентгеновский отсеивающий JPI, производства JPI Healthcare Co., Ltd, Республика Корея

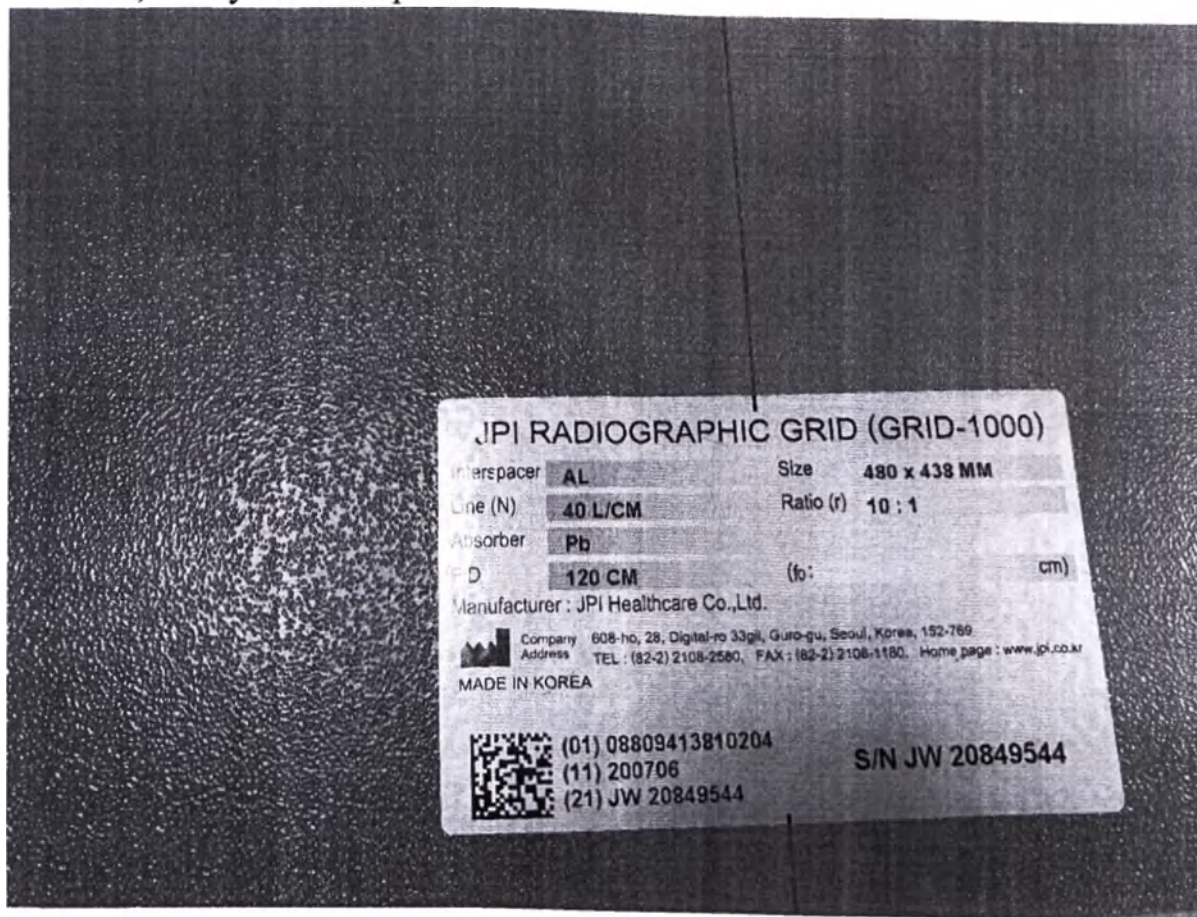


6 Ионизационная камера

6.1 Ионизационная камера серии 70, производства VacuTec, Meßtechnik GmbH, Германия

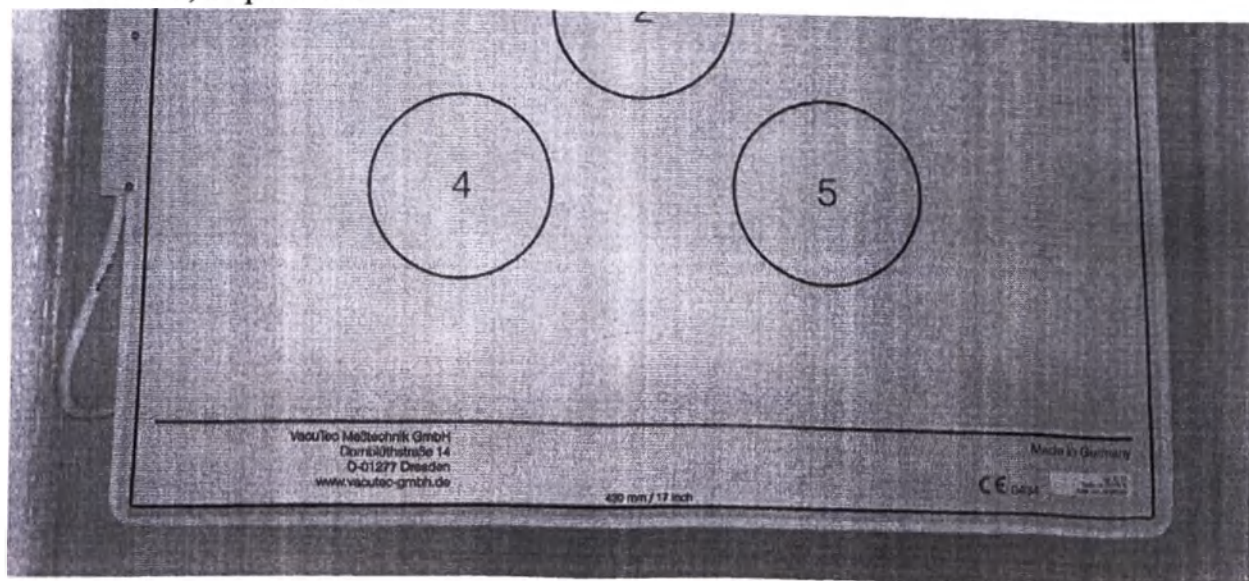


6.2 Ионизационная камера серии SSMC, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины

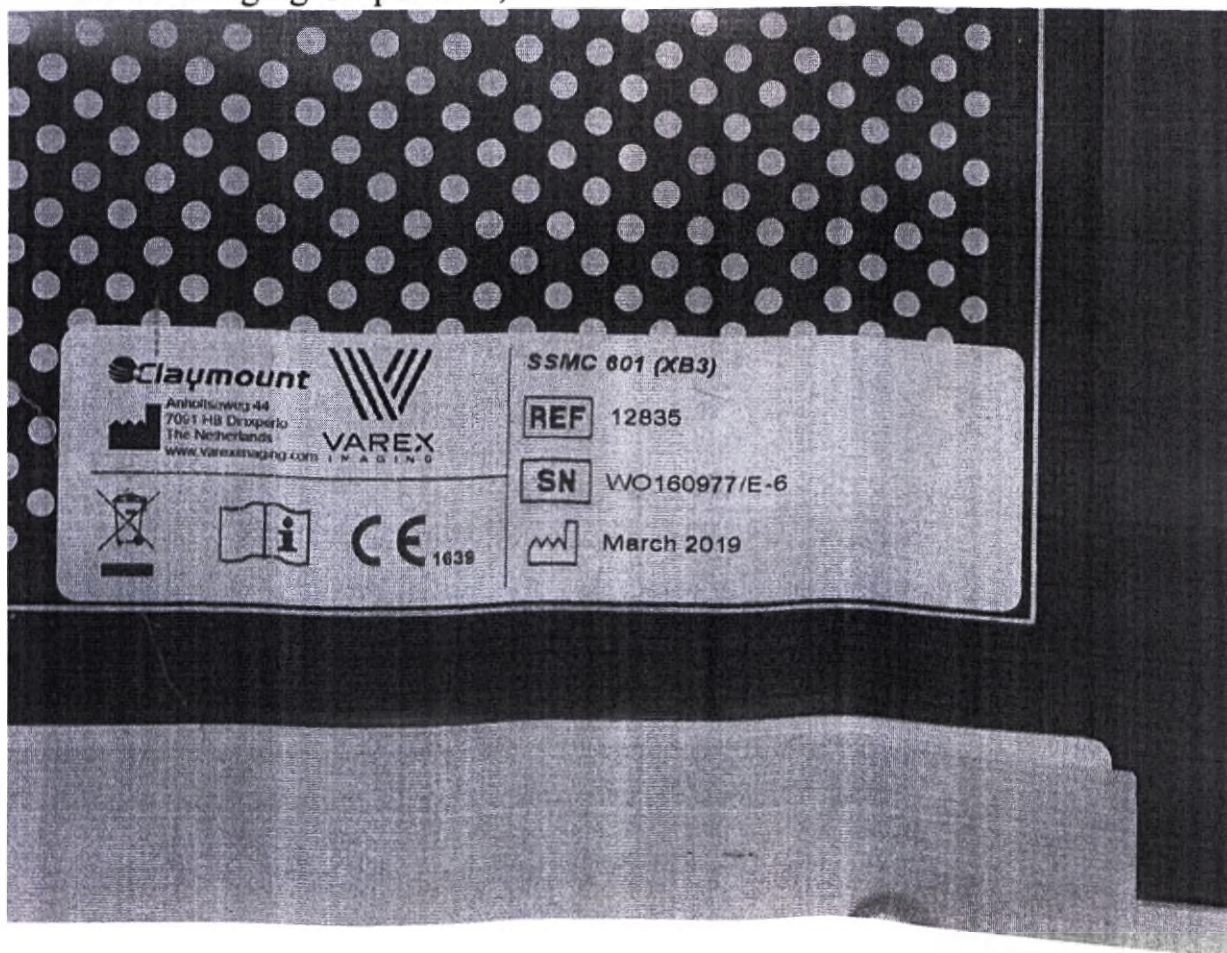

7 Рентгеновское питающее устройство (РПУ)

7.1 Рентгеновское питающее устройство (РПУ) серии ZR75PN40 или серии ZR75PN50 или серии ZR75PN65 или серии ZR75PN80, производства Spellman, США или Spellman High Voltage Electronics GmbH, Германия или Spellman High Voltage Electronics (SIP) Co., Ltd, Китай

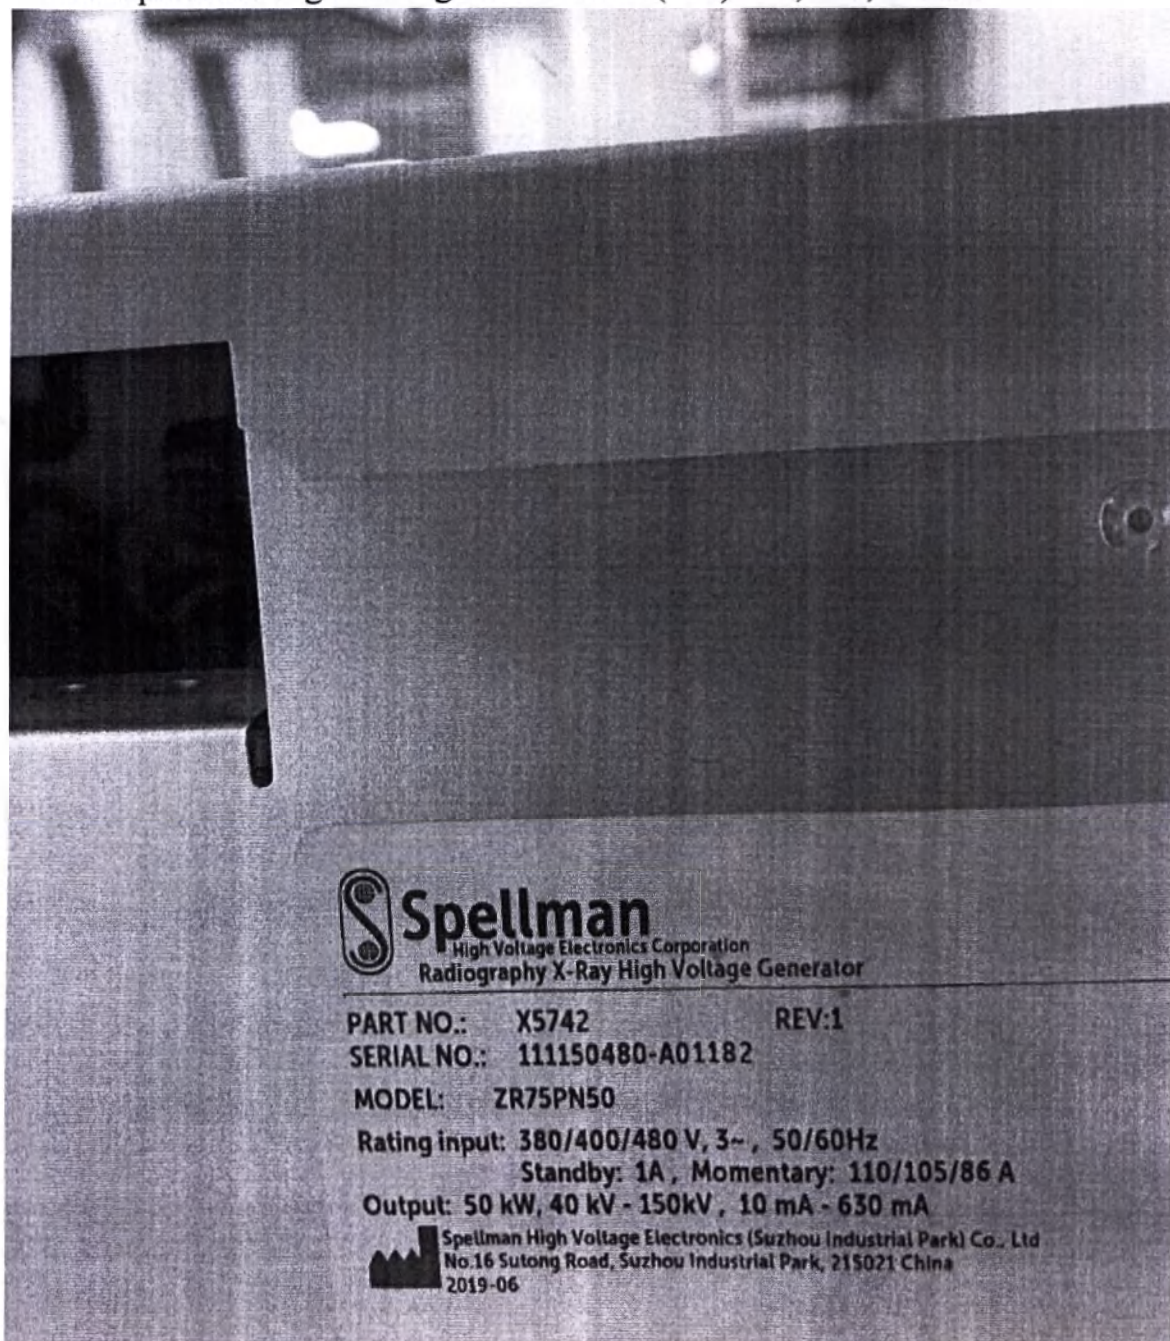

7.2 Рентгеновское питающее устройство (РПУ) серии CMP 200,
производства Communications & Power Industries Canada Inc., Канада


SYSTEM CONTAINS
SOFTWARE
PART NO.:
90623700
REVISION:
AA
COMPATIBLE WITH
SYSTEM MODEL :
VZW2558FB812

RoHS MANUFACTURED FOR
MEDICAL TECHNOLOGIES Ltd.
109052 Moscow, Russia
BY
Communications & Power Industries Canada Inc.
45 River Drive, Georgetown, Ontario, Canada, L7G 2J4
MADE IN CANADA


MODEL NO.:	VZW2558FB812	
CONFIGURATION:	-35	
SERIES:	G200RF-1T-MT-50kW	
PART NO.:	VZW2558FB812-35	
SERIAL NO.:	AMQ01515H19	
MFG. DATE:	August 2019	
VOLTS AC:	400-480	
	MOMENTARY	NOMINAL
AMPS AC:	107-90	3
FREQ:	50/60 Hz	PHASE: 3

COMPLIES WITH IEC 60601-2-54: 2009
& CDRH RADIATION PERFORMANCE
STANDARD 21 CFR, SUBCHAPTER J

7.3 Рентгеновское питающее устройство (РПУ) X1-B0500, X1-B0600 или X1-B0700 или X1-B0800, производства ООО «ВКО Медпром», Россия

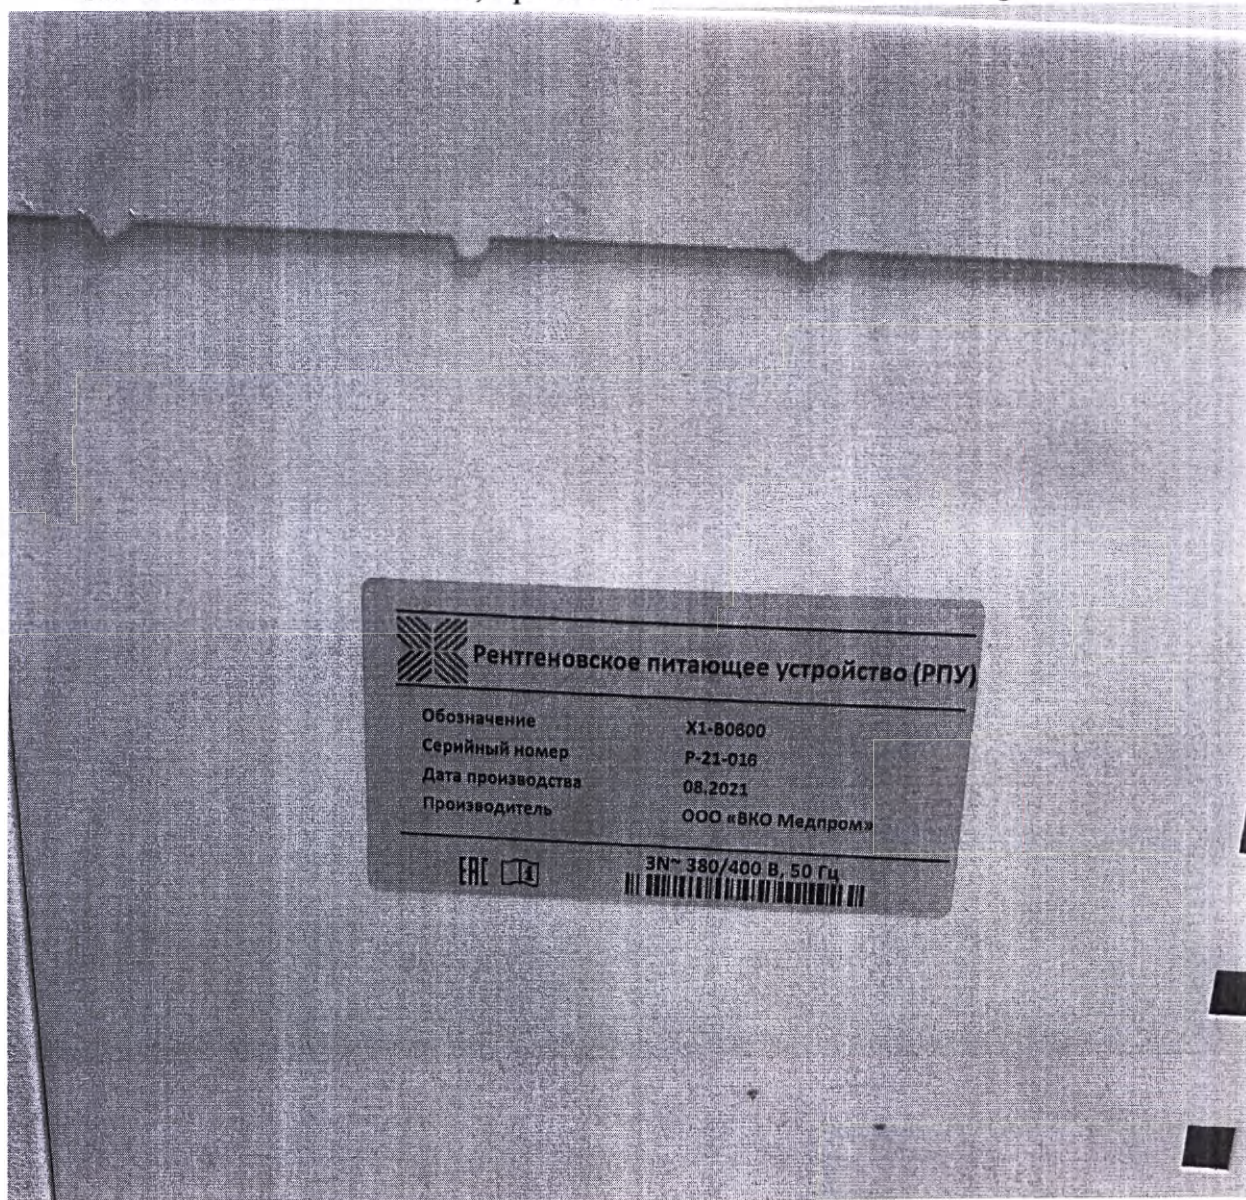

8 Комплекс аппаратно-программный для регистрации и обработки рентгеновских изображений «СОЛО ДР-МТ», производства АО «МТЛ», Россия

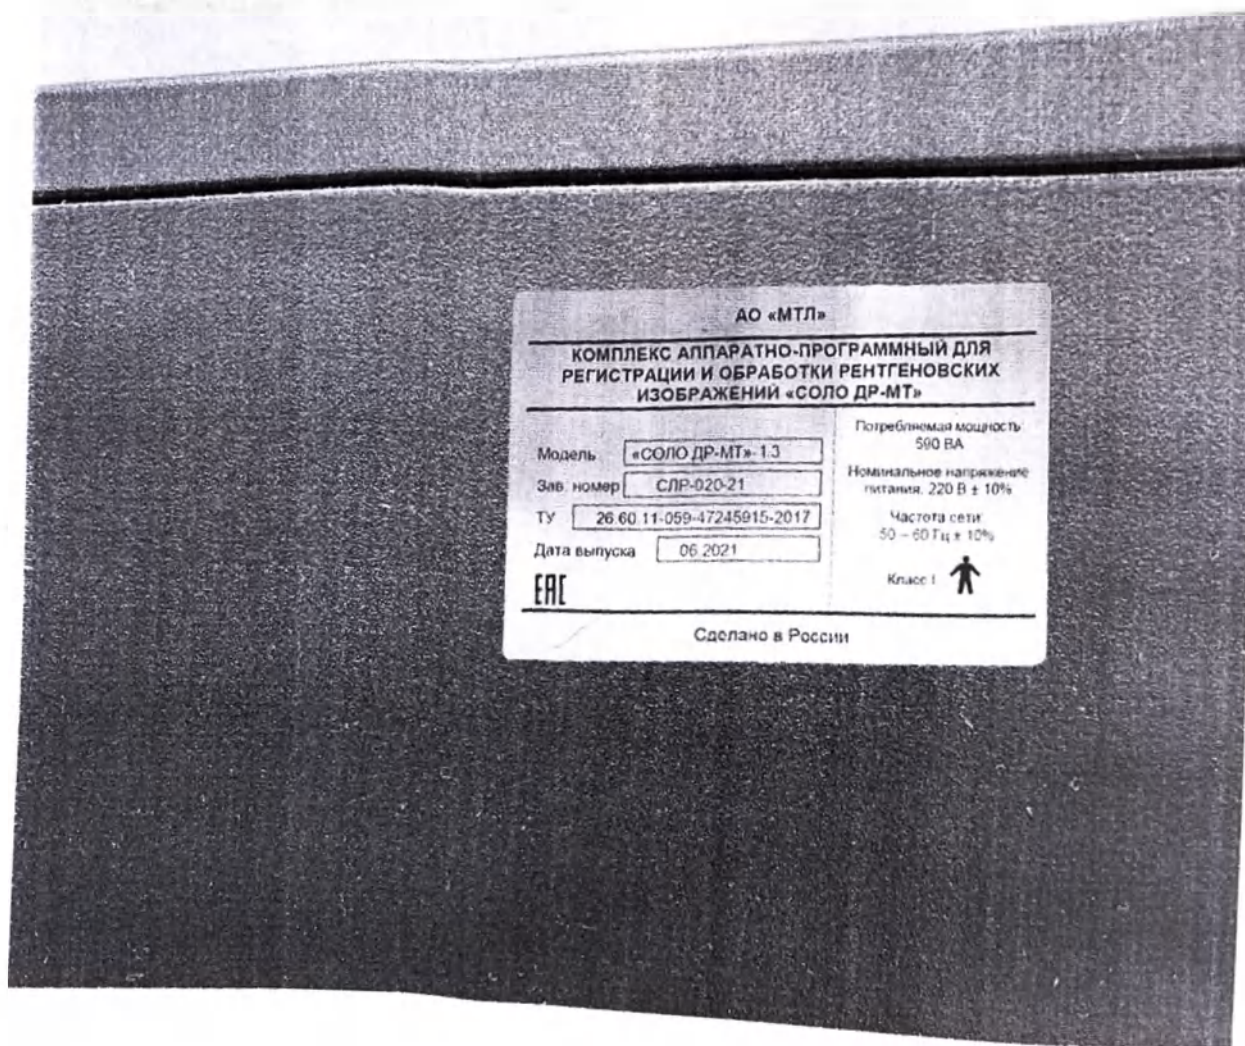

9 Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога «ДИАРМ-МТ-Плюс», производства АО «МТЛ», Россия

№ РЗН 2019/8524 от 20.08.2020 года

АО «МТЛ»

Автоматизированное рабочее место
врача рентгенолога «ДИАРМ-МТ-Плюс»

Исполнение	ДИАРМ-МТ-Плюс-2	Питание: 220В 50/60Гц	
Зав. Номер	АРМВ-1516-21		Макс. мощность: 560ВА
ТУ	26.60.12-064-47245915-2018		
Дата выпуска	10. 2021г.		
EAC		Класс I 	
Сделано в России			
Service Tag : GJ80S		Express	

10 Монитор

10.1 Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов NEC, производства NEC Display Solutions Ltd, Япония или Compal Electronics (China) Co., Ltd, Китай или Compal Display Electronics (Kunshan) Co., Ltd, Китай


Contact address for EMEA
NEC Display Solutions Europe GmbH
Landshuter Allee 12-14
80637 Munich, Germany

MODEL: EA193Mi-BK (L)
SERIAL NO.: 56155232TB




REV.			1	2•	3	4	5
A•	B	C	D	E	F	G	H

10.2 Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов серии С или серии М
или серии R, производства Nanjing Jusha Display Technology Co., Ltd,
Китай

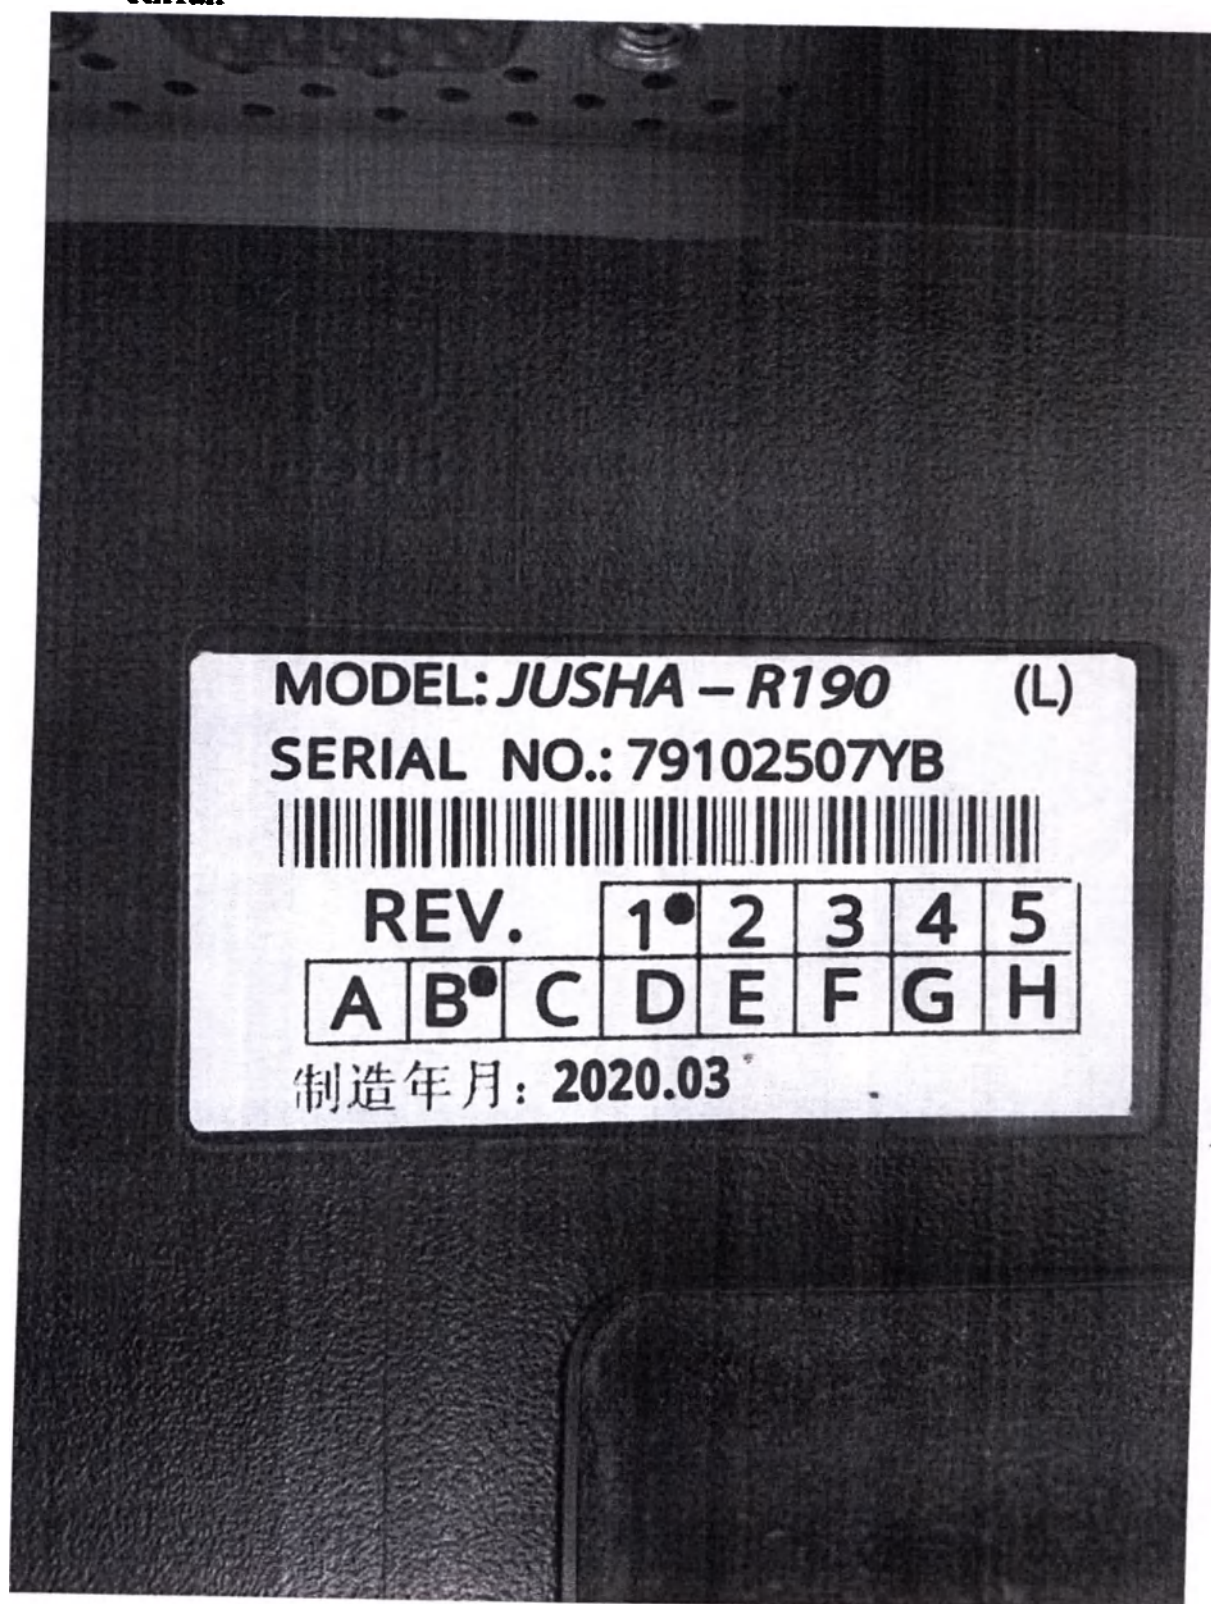

10.3 Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов серии Z, производства Hewlett-Packard Co., США или Wistron Corporation, Тайвань или Wistron Mexico S.A. de C.V, Мексика или Wistron InfoComm (Zhongshan) Corporation, Китай или All Technology (Zhongshan) Co. Ltd, Китай или Wistron InfoComm (Czech) s.r.o., Чешская Республика (на фото изображен монитор ЖК с диагональю 24 дюйма серии Z, производства Hewlett-Packard Co., США)

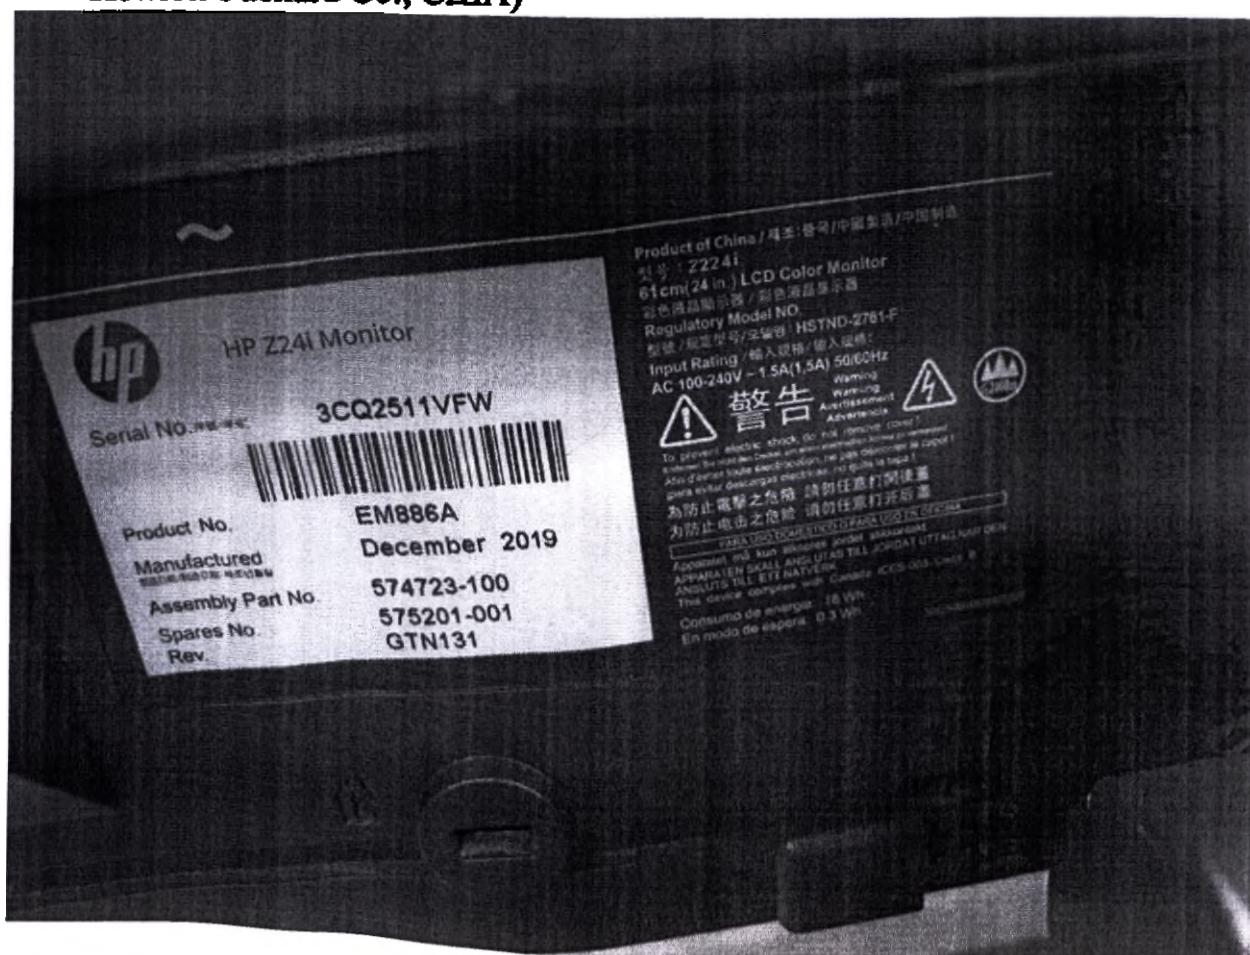


10.4 Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов Beacon, производства Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd, Китай




10.5 Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов DELL, производства
DELL, Китай





10.6 Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов Samsung, производства Samsung, Республика Корея

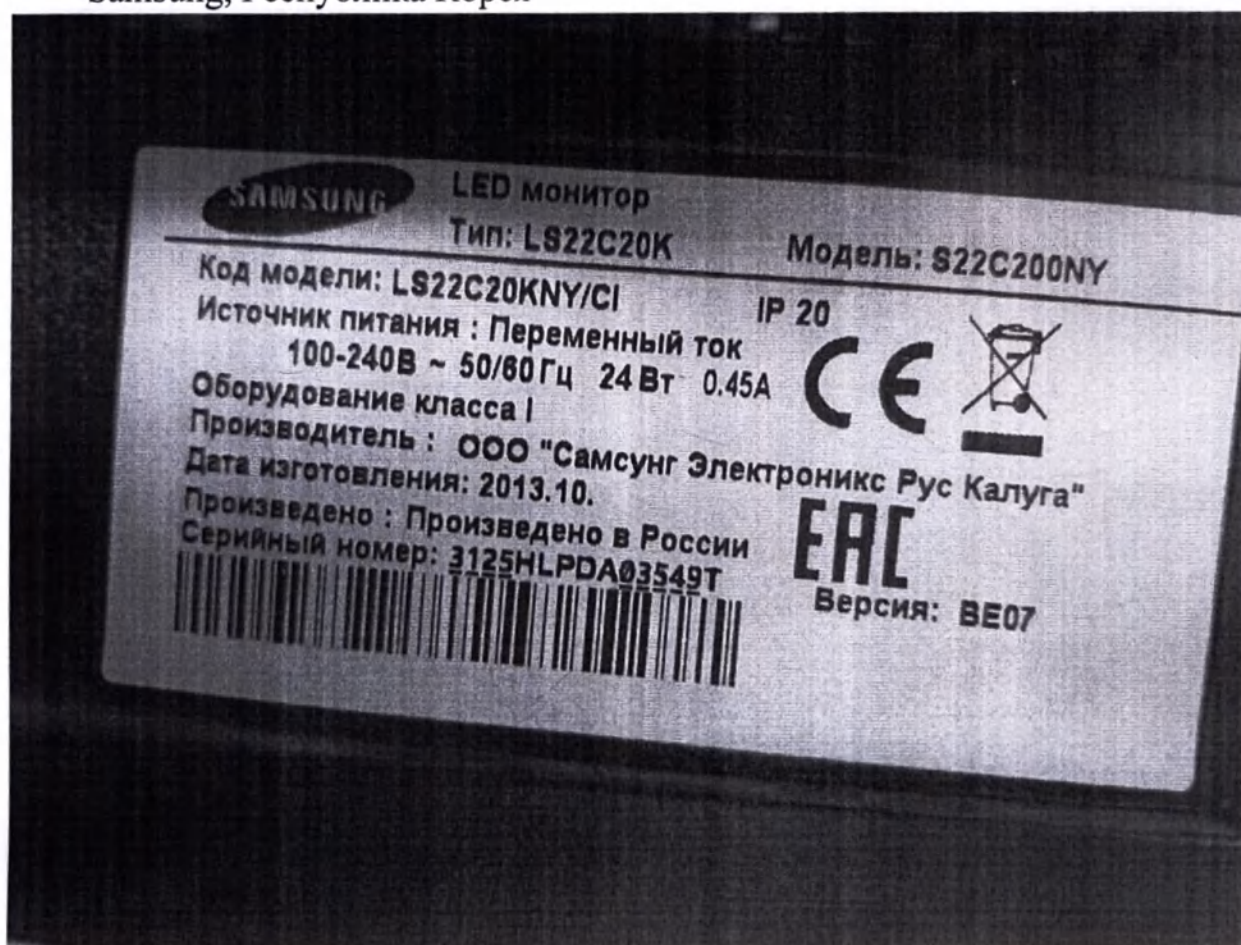


11 Радиологическая информационная система «ИнтеГРИС-МТ-Плюс»,
производства АО «МТЛ», Россия

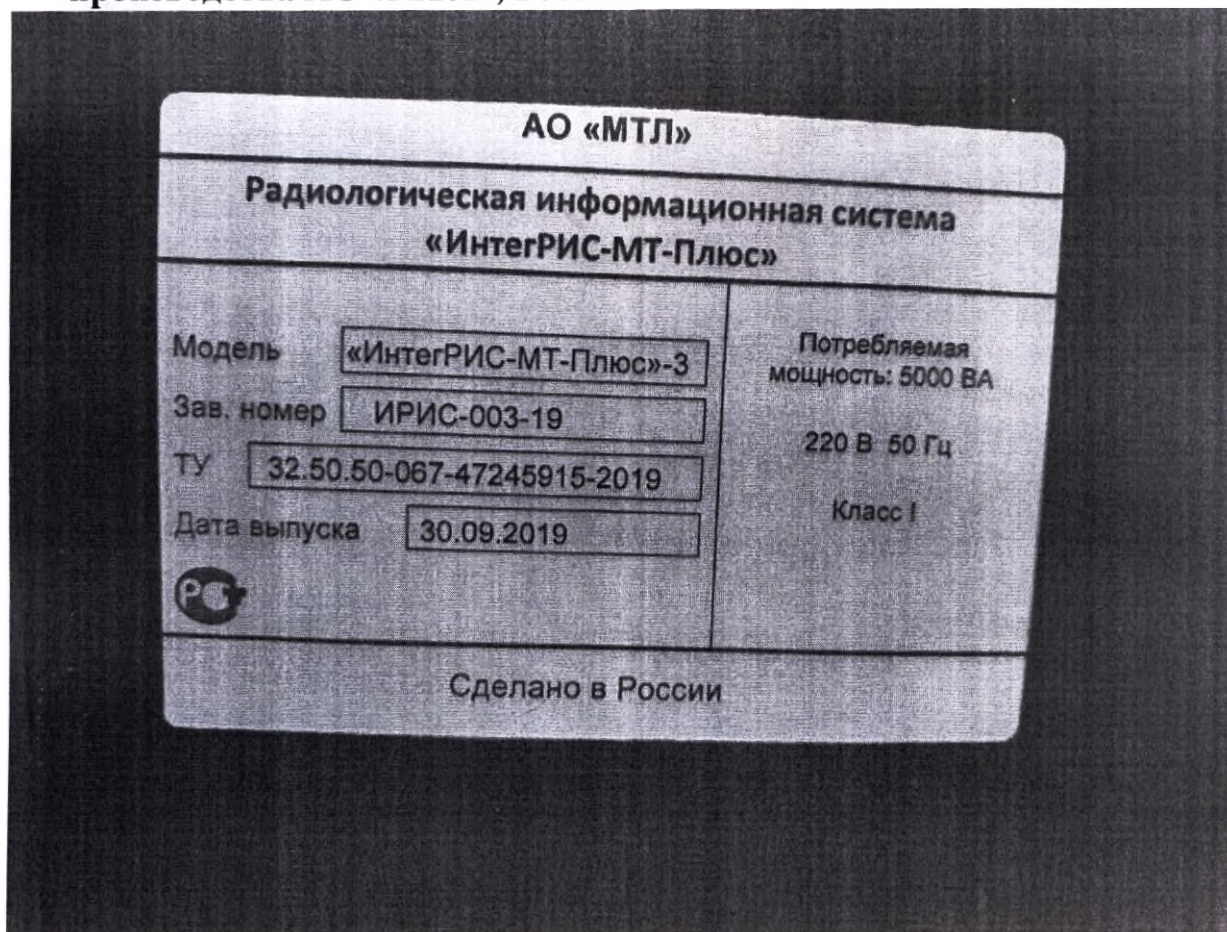

12 Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС» по ТУ 9398-010-21009821-2004, производства ЗАО «Ренекс», Россия

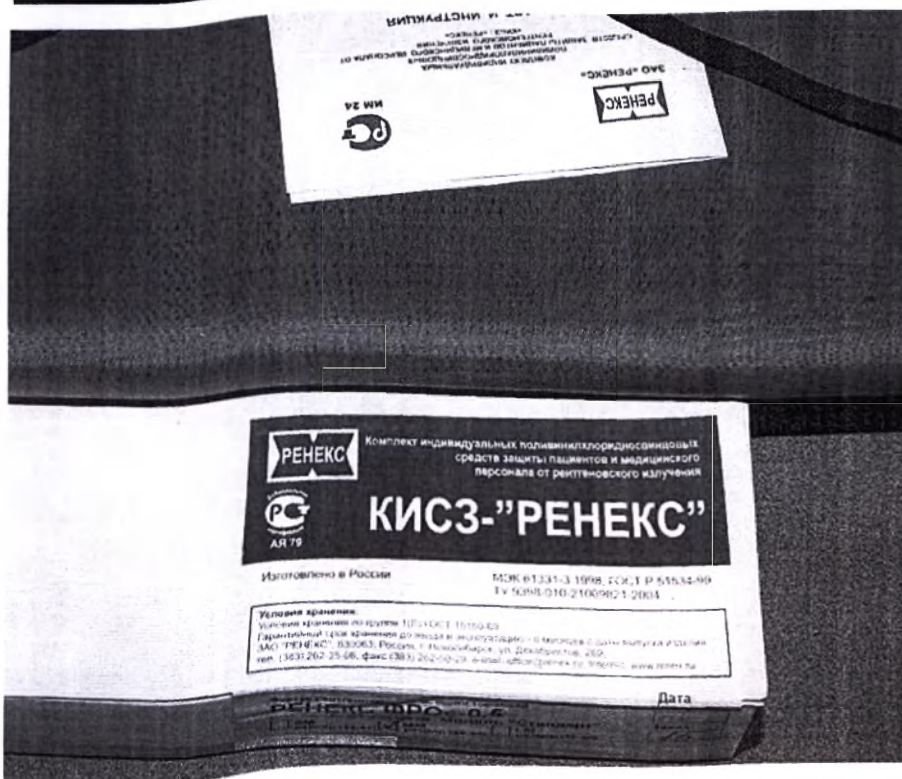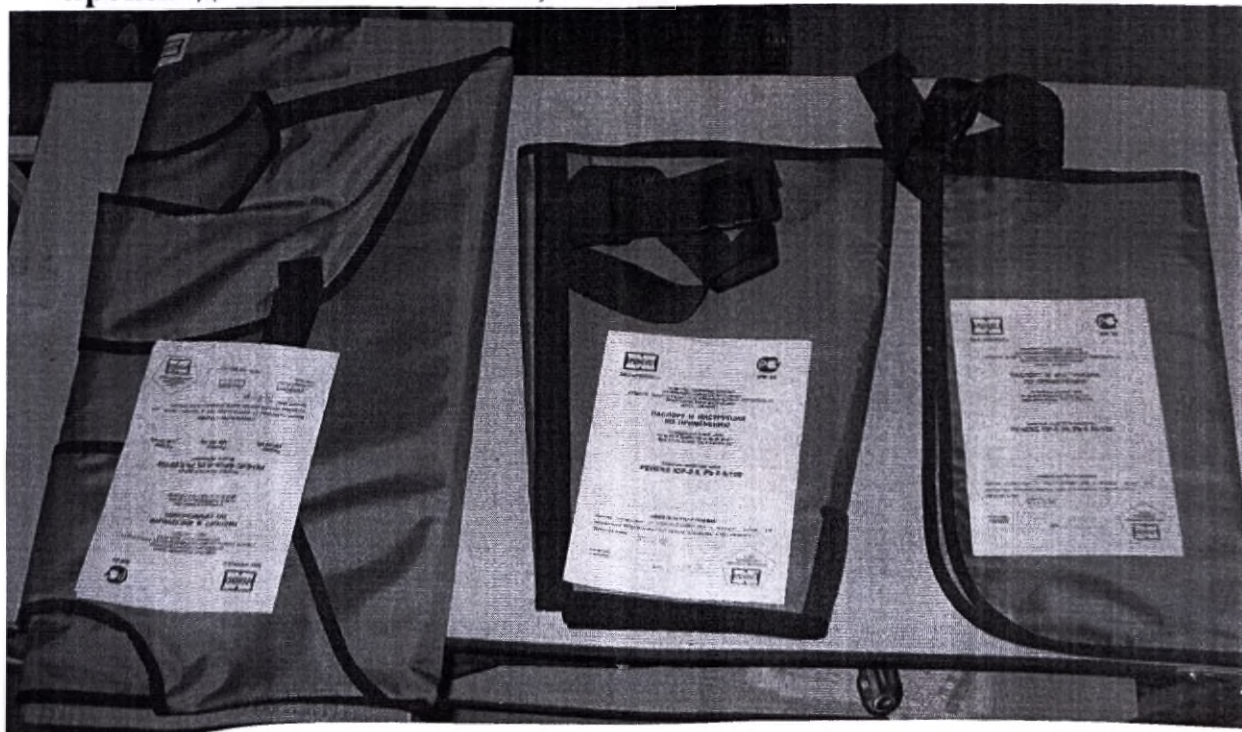

13 Комплекты рентгенозащитных средств из материала резиносвинцового для индивидуальной защиты врача, пациента и для использования в микропедиатрии при рентгенодиагностических исследованиях КСИЗ-РС и КСИЗмп-РС по ТУ 9452-001-42879986-2006, производства ООО «МП НПФ «Гаммамед-П», Россия

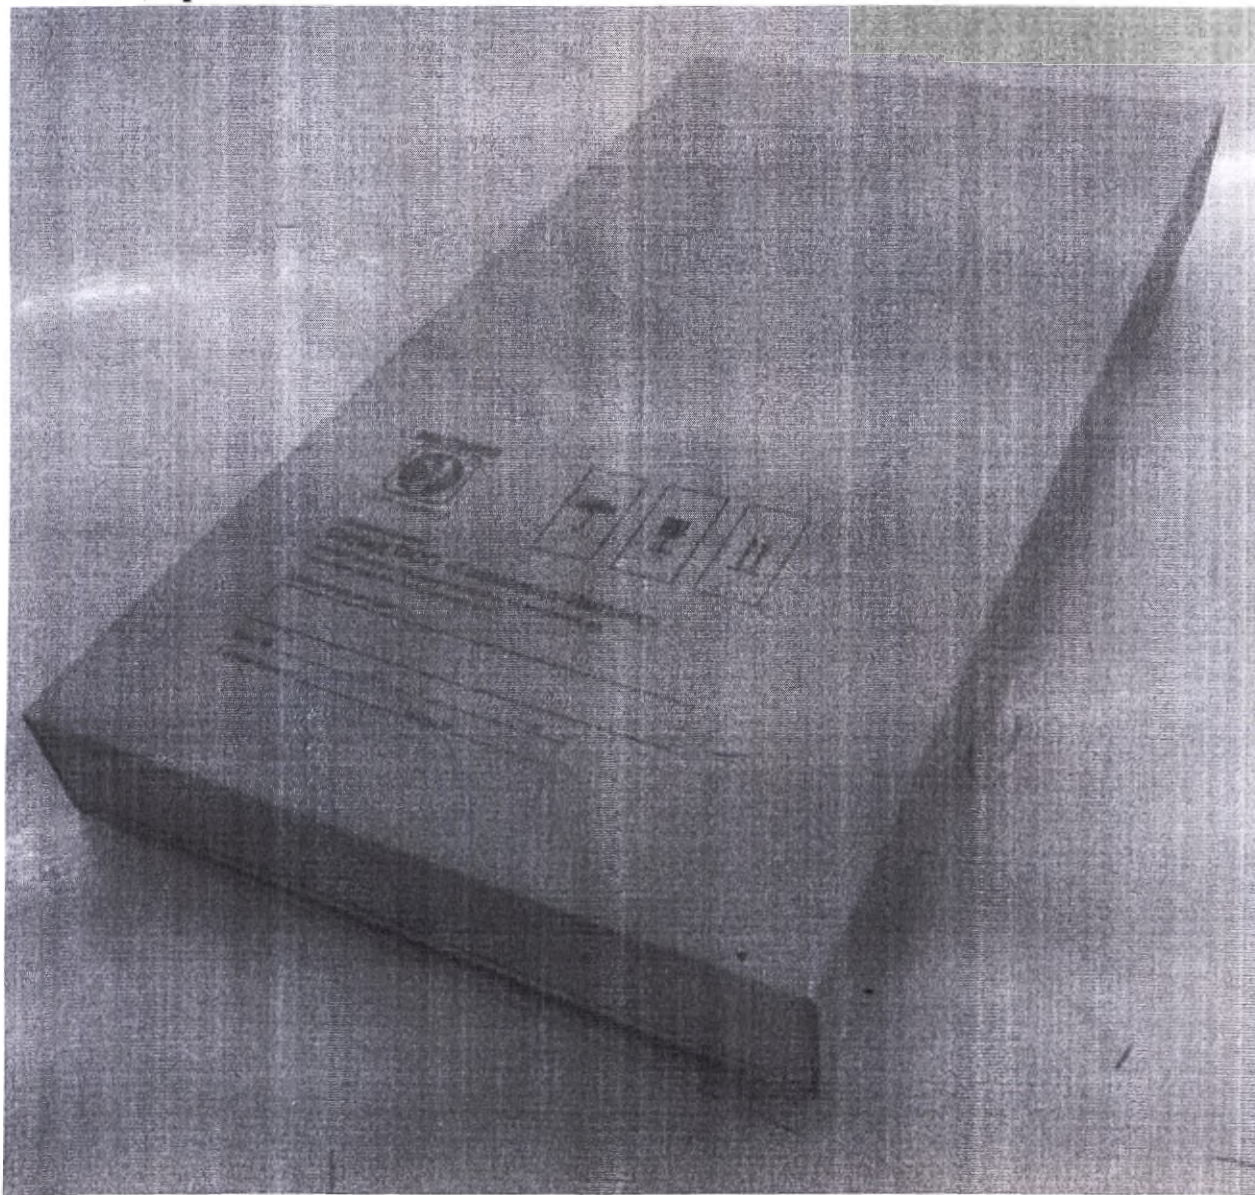

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 29

(двадцать девять) листах

Генеральный директор
ООО «ВКО Медпром» Иванов О.В.

