

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА

медицинского изделия

Штатив лабораторный полимерный для пробирок для диагностики *in vitro* по ТУ 32.50.13-002-27278232-2021

Внешний вид медицинского изделия.

Вариант исполнения 1: Штатив RA-9602 для стрипованных микропробирок 0,2 мл, 96 лунок



Вариант исполнения 2: Штатив RA-7215 для микропробирок 1,5 мл, 72 лунки




Вариант исполнения 3: Штатив RA-5015 для микропробирок 1,5 мл, 50 лунок



Вариант исполнения 4: Штатив RA-5005 для микропробирок 0,5 мл, 50 лунок




Вариант исполнения 5: Штатив RA-30005 для микропробирок 0,5 мл, 300 лунок

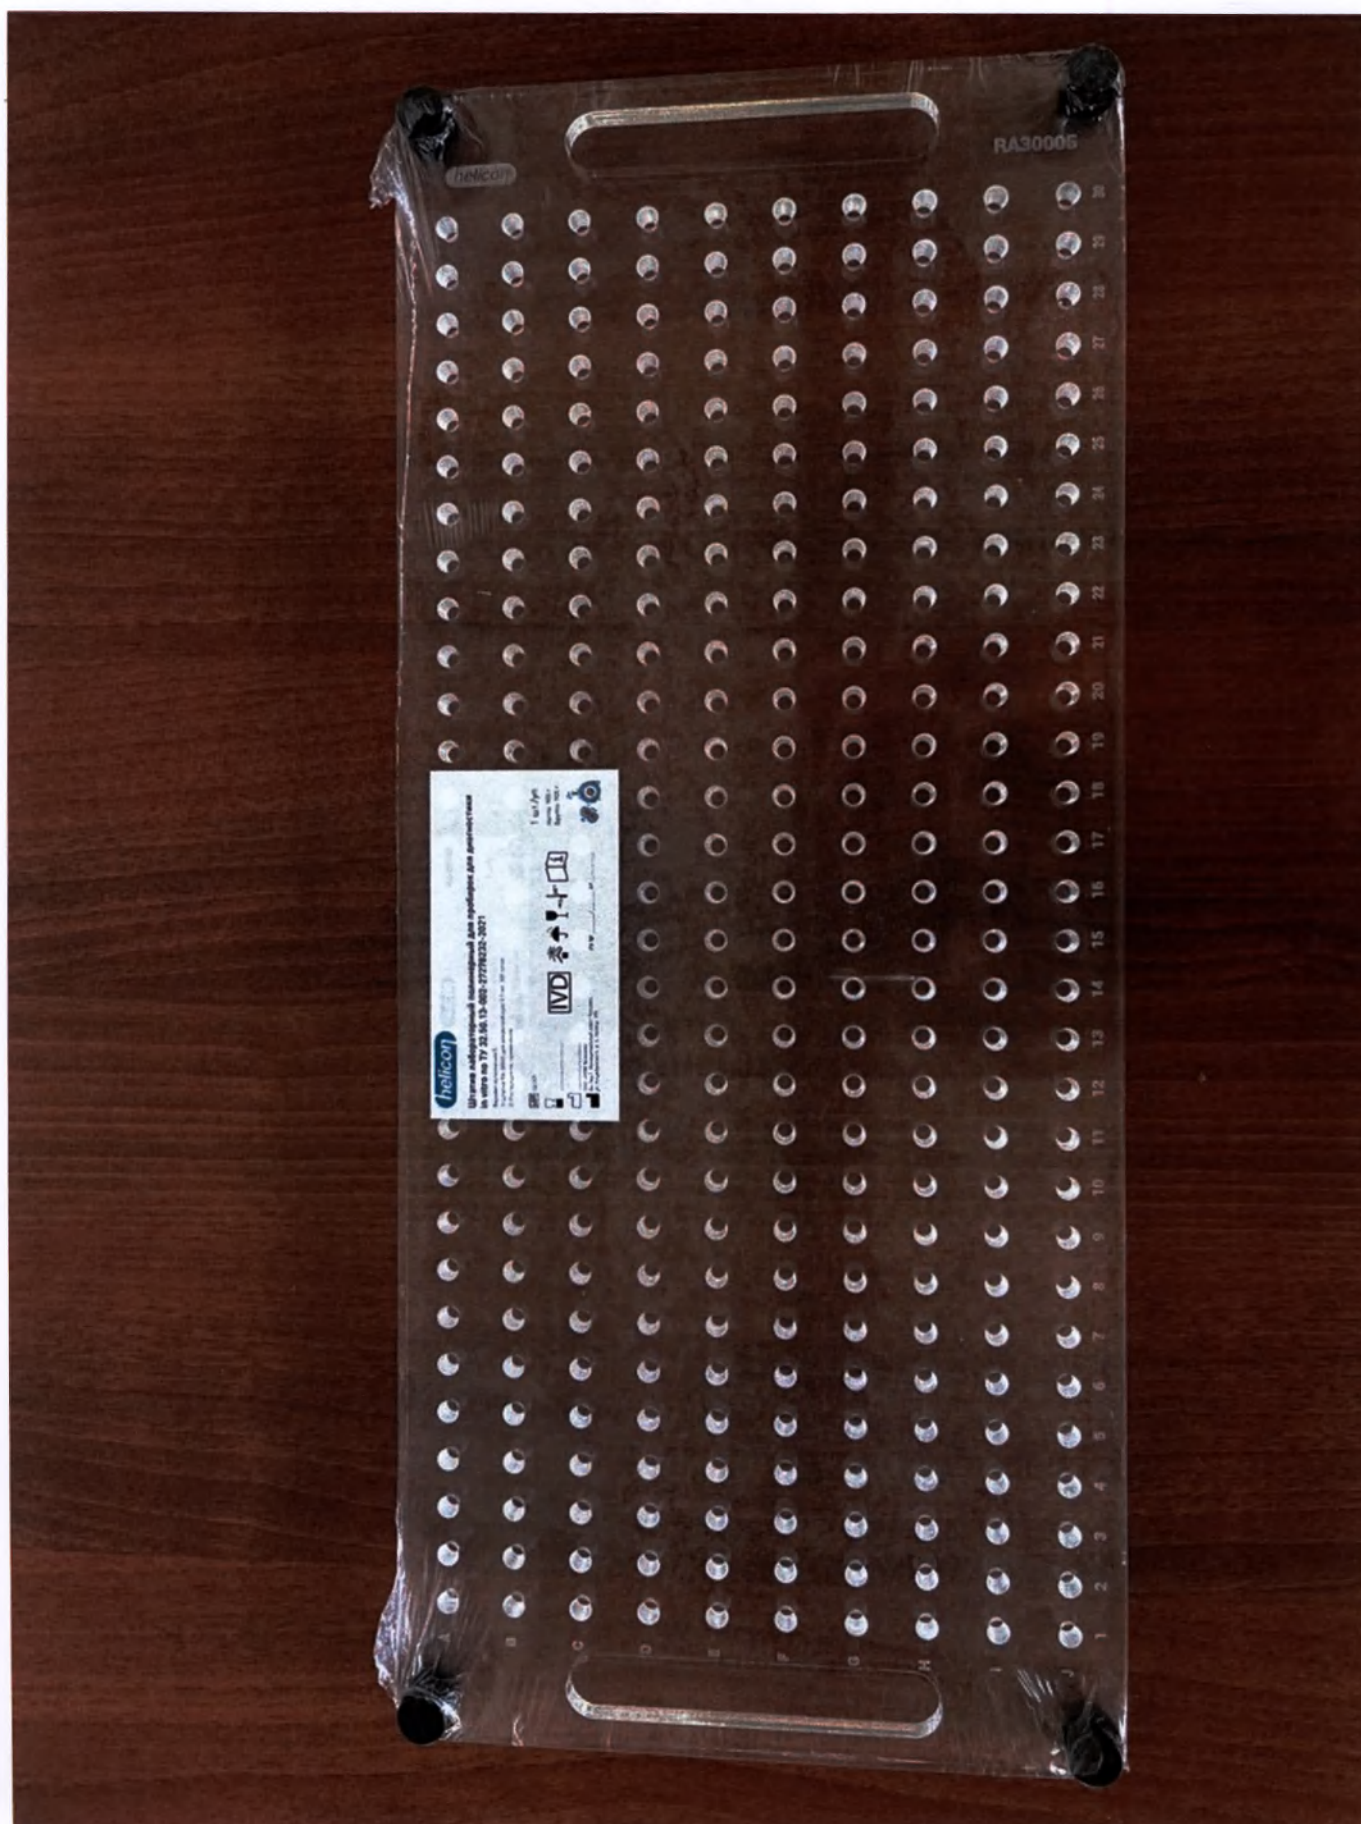

Вариант исполнения 6: Штатив RA-20005 для микропробирок 0,5 мл, 200 лунок



Вариант исполнения 7: Штатив RA-20002 для микропробирок 0,2 мл, 200 лунок

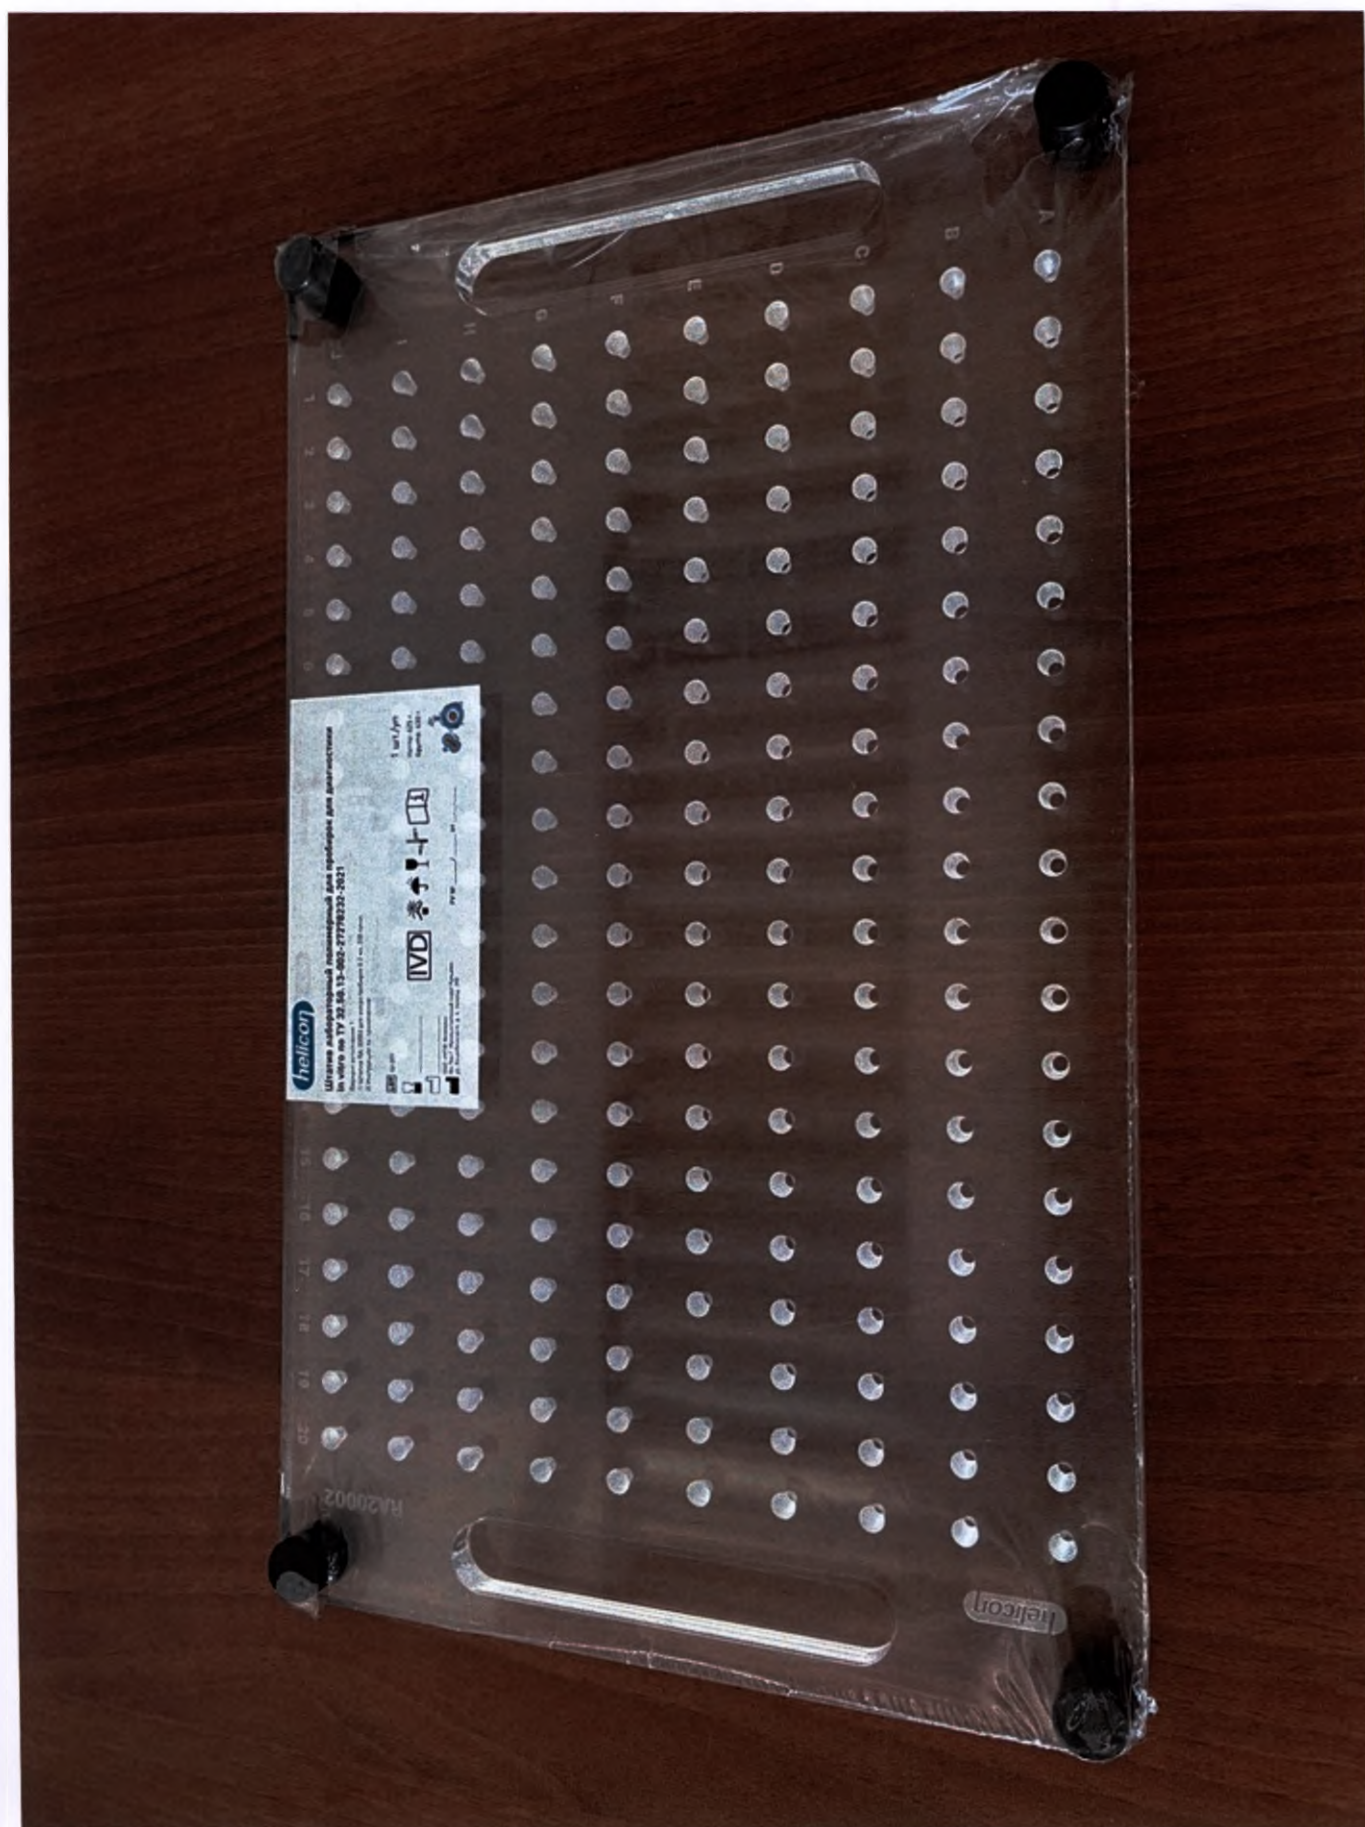


Вариант исполнения 8: Штатив RA-10005 для микропробирок 0,5 мл, 100 лунок



Вариант исполнения 9: Штатив RBA-5015 для микропробирок 1,5 мл, 50 лунок, удлиненный



Вариант исполнения 10: Штатив RBA-20005 для микропробирок 0,5 мл, 200 лунок, удлинненный

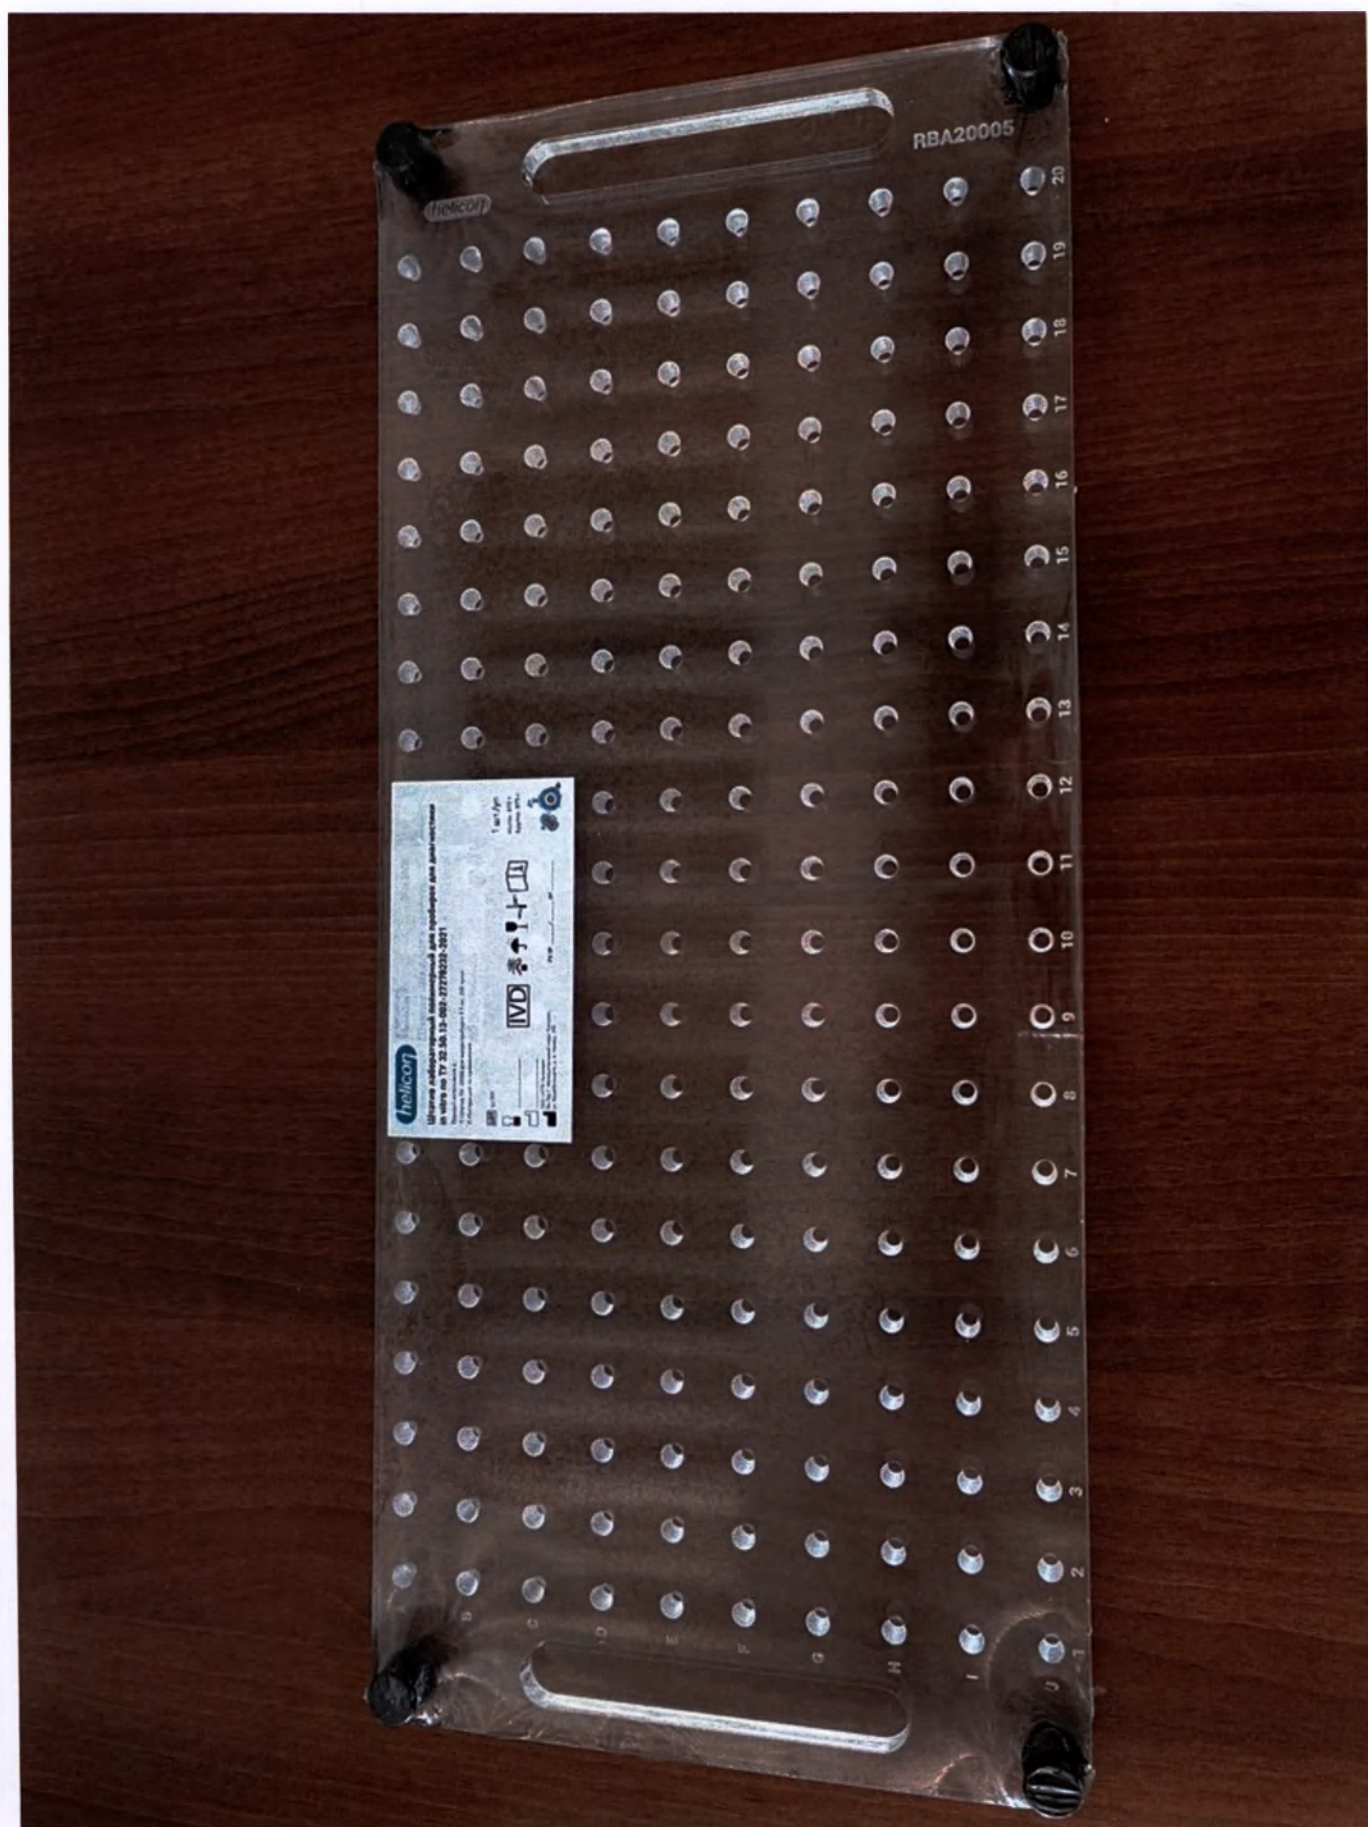


Вариант исполнения 11: Штатив RBA-12015 для микропробирок 1,5 мл, 120 лунок, удлиненный



Вариант исполнения 12: Штатив RA-6420-PVC для микропробирок 1,5-2,0 мл, 64 лунки, химически устойчивый



Вариант исполнения 13: Штатив RA-4020-PVC для микропробирок 1,5-2,0 мл, 40 лунок, химически устойчивый

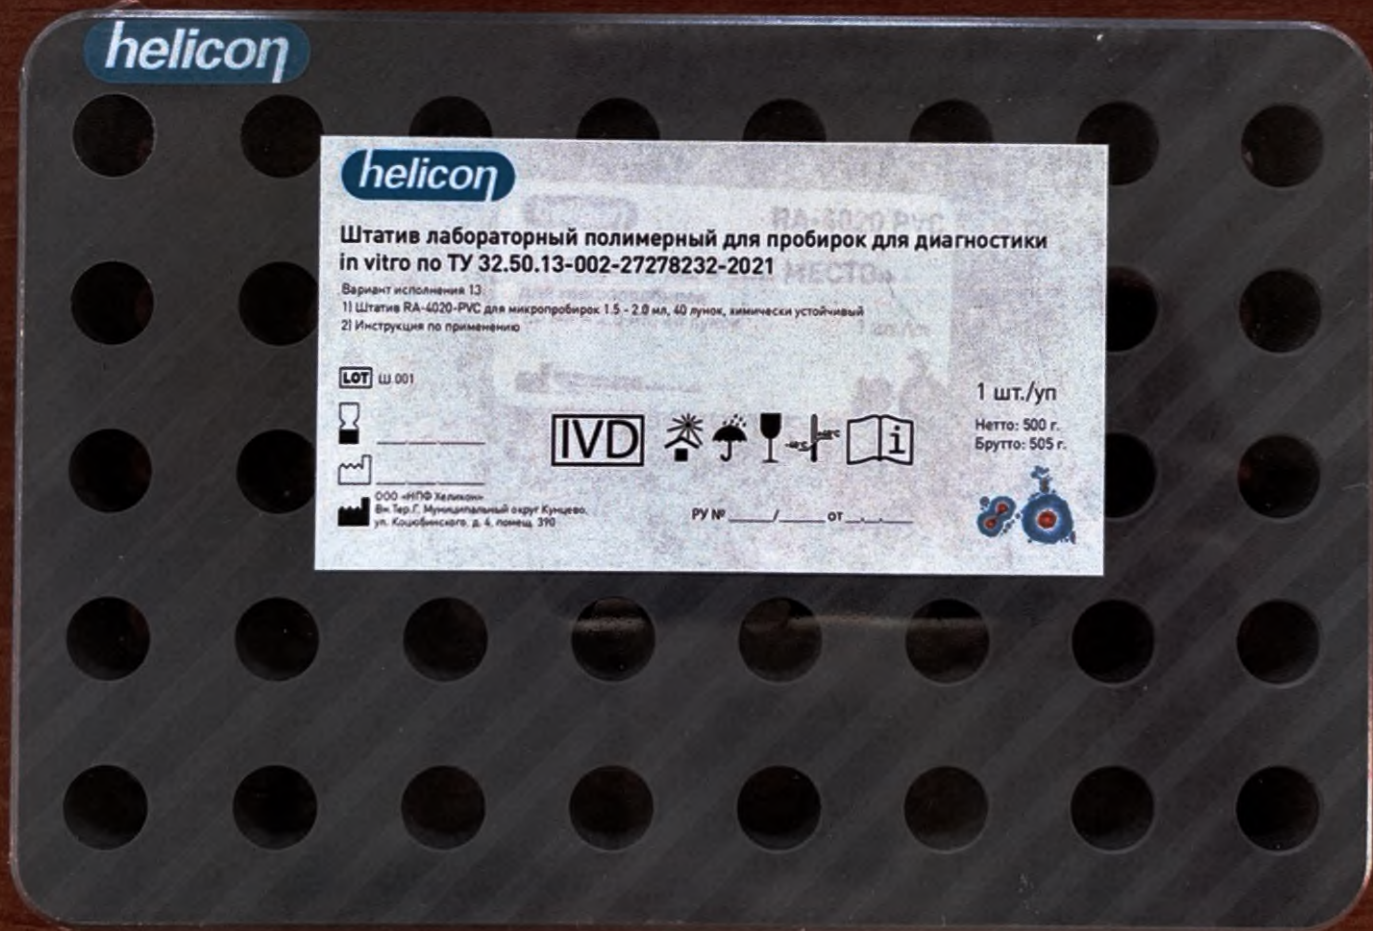

helicon

Штатив лабораторный полимерный для пробирок для диагностики
in vitro по ТУ 32.50.13-002-27278232-2021

Вариант исполнения 13:

1) Штатив RA-4020-PVC для микропробирок 1,5 - 2,0 мл, 40 лунок, химически устойчивый

2) Инструкция по применению

LOT Ш 001



ООО «ИГФ Хеликон»
Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Кунцево,
ул. Колюбинского, д. 4, помещ. 370

IVD



РУ № _____ / _____ ОТ _____

1 шт./уп

Нетто: 500 г.

Брутто: 505 г.



Вариант исполнения 14: Штатив RA-9602-PVC для стрипованных микропробирок 0,2 мл., 96 лунок, химически устойчивый



Вариант исполнения 15: Штатив RA-7215-PVC для микропробирок 1,5 мл, 72 лунки, химически устойчивый



Вариант исполнения 17: Штатив RP-81 с крышкой для микропробирок 1,5-2,0 мл, 81 лунка



Вариант исполнения 18: Штатив RP-81C с крышкой для микропробирок 1,5-2,0 мл, 81 лунка



Вариант исполнения 19: Штатив RP-100 с крышкой для микропробирок 1,5-2,0 мл, 100 лунок



Вариант исполнения 20: Штатив РР-9602 с крышкой для микропробирок 0,2 мл, 96 лунок



Вариант исполнения 21: Штатив RP-1550 для пробирок 15 и 50 мл (18x15 мл, 10x50 мл)



Вариант исполнения 22: Штатив RP-50-1375 для пробирок размером 13x75 мм и объемом 1,8-5,0 мл, 5x10



Вариант исполнения 23: Штатив RP-50-13100 для пробирок размером 13x100 мм и объемом 4,0-9,0 мл, 5x10з



**Инструкция по применению
(вкладыш)**

Наименование медицинского изделия: Штатив лабораторный полимерный для пробирок для диагностики in vitro по ТУ 32.50.13-002-27278232-2021.

Производитель: ООО «НПФ Хеликон», Россия, 121351, г. Москва, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Кунцево, ул. Кошобинского, д. 4, помещ. 390.

Назначение медицинского изделия: Штатив предназначен для удержания пробирок в вертикальном положении, в качестве вспомогательного средства в клинической лабораторной диагностике (in vitro).

Описание целевого анализа: не применимо.

Функциональное назначение: Вспомогательное средство в клинической лабораторной диагностике (in vitro).

Кратность применения: многократного применения.

Специфическая патология, состояние или фактор риска, для обнаружения, определения или дифференцирования которого предназначено медицинское изделие для диагностики in vitro.

Не применимо.

Тип анализируемого образца: не применимо.

Класс потенциального риска применения: класс 2a.

Показания к применению медицинского изделия: Для удержания пробирок в вертикальном положении, в качестве вспомогательного средства в клинической лабораторной диагностике (in vitro).

Противопоказания: отсутствуют.

Область применения медицинского изделия: клиническая лабораторная диагностика (in vitro).

Информация о потенциальных потребителях медицинского изделия: для применения в клинической лабораторной диагностике (in-vitro) квалифицированным персоналом.

Условия применения медицинского изделия: штатив предназначен для эксплуатации в условиях клинико-диагностических лабораторий, больниц и других лечебно-профилактических медицинских учреждений соответствующего профиля.

Стерильность: нестерильно и не подлежит стерилизации перед применением.

Для получения полноразмерной инструкции по применению перейдите на сайт:
<https://npf-helicon.ru/>

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 25 листов
Генеральный директор
ООО «НПО Хеликон»



С.А. Горинов