

Фотографические изображения медицинского изделия

**Стент мочеточниковый внутренний
однопетлевой с нитью JFil® / MiniJFil®,
в вариантах исполнения**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
ЗАО «СЭИДЖ»


Юрова А.В.

2022 г.




***I. Стент мочеточниковый внутренний
однопетлевой с нитью JFil® 8, в составе:***


1. Стент мочеточниковый внутренний однопетлевой с нитью JFil®, диаметром 7 Fr (2,3 мм), рабочей длиной: 8 см – 1 шт.

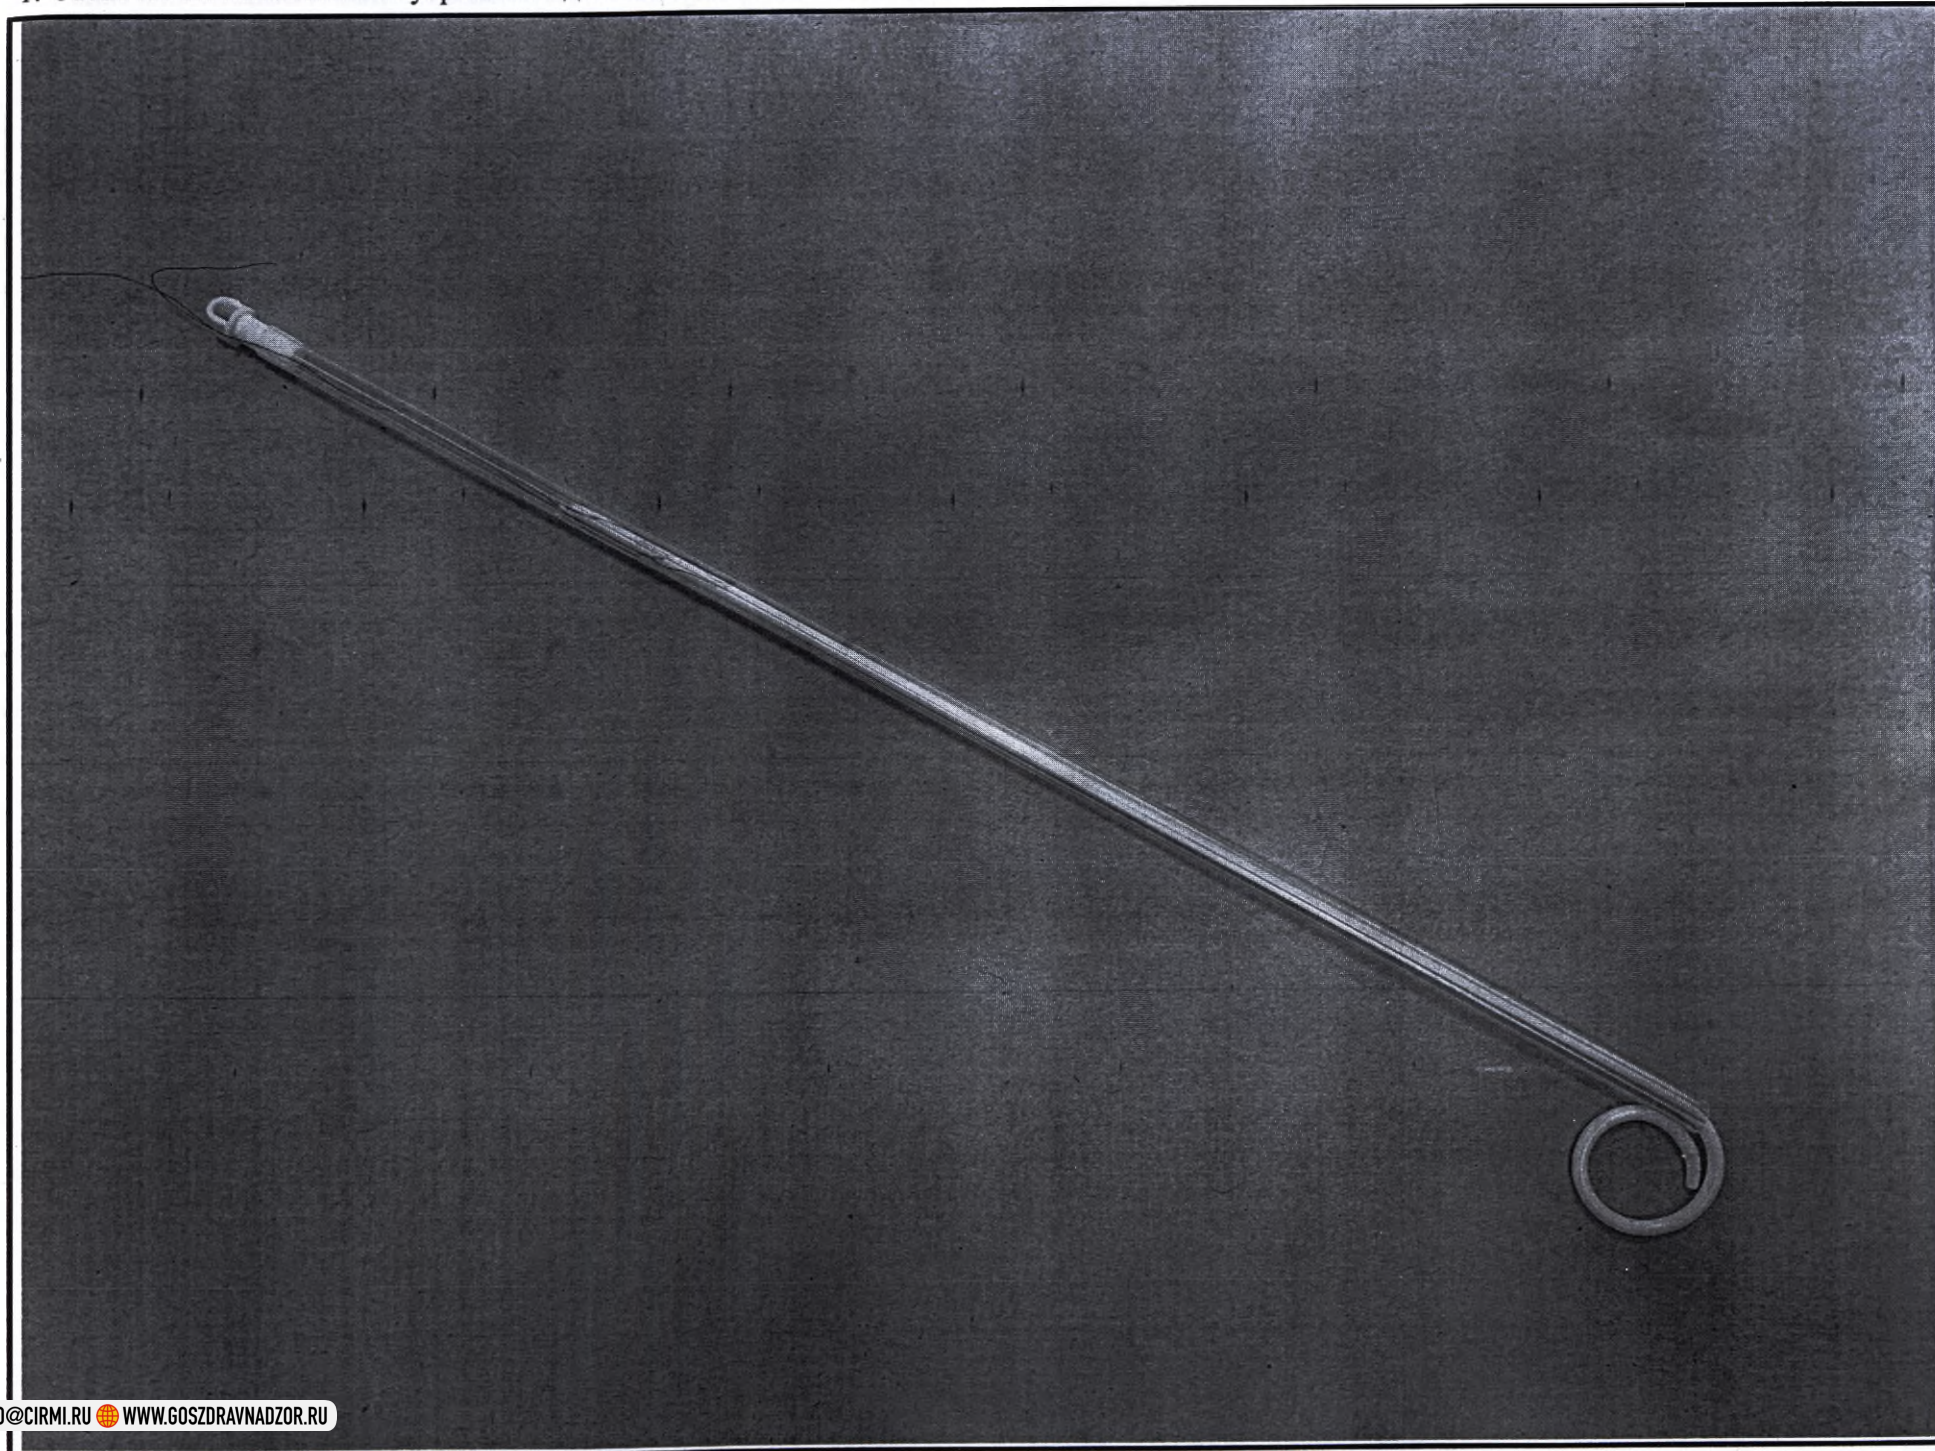

2. Толкатель соединяемый, длиной 63 см – 1 шт.

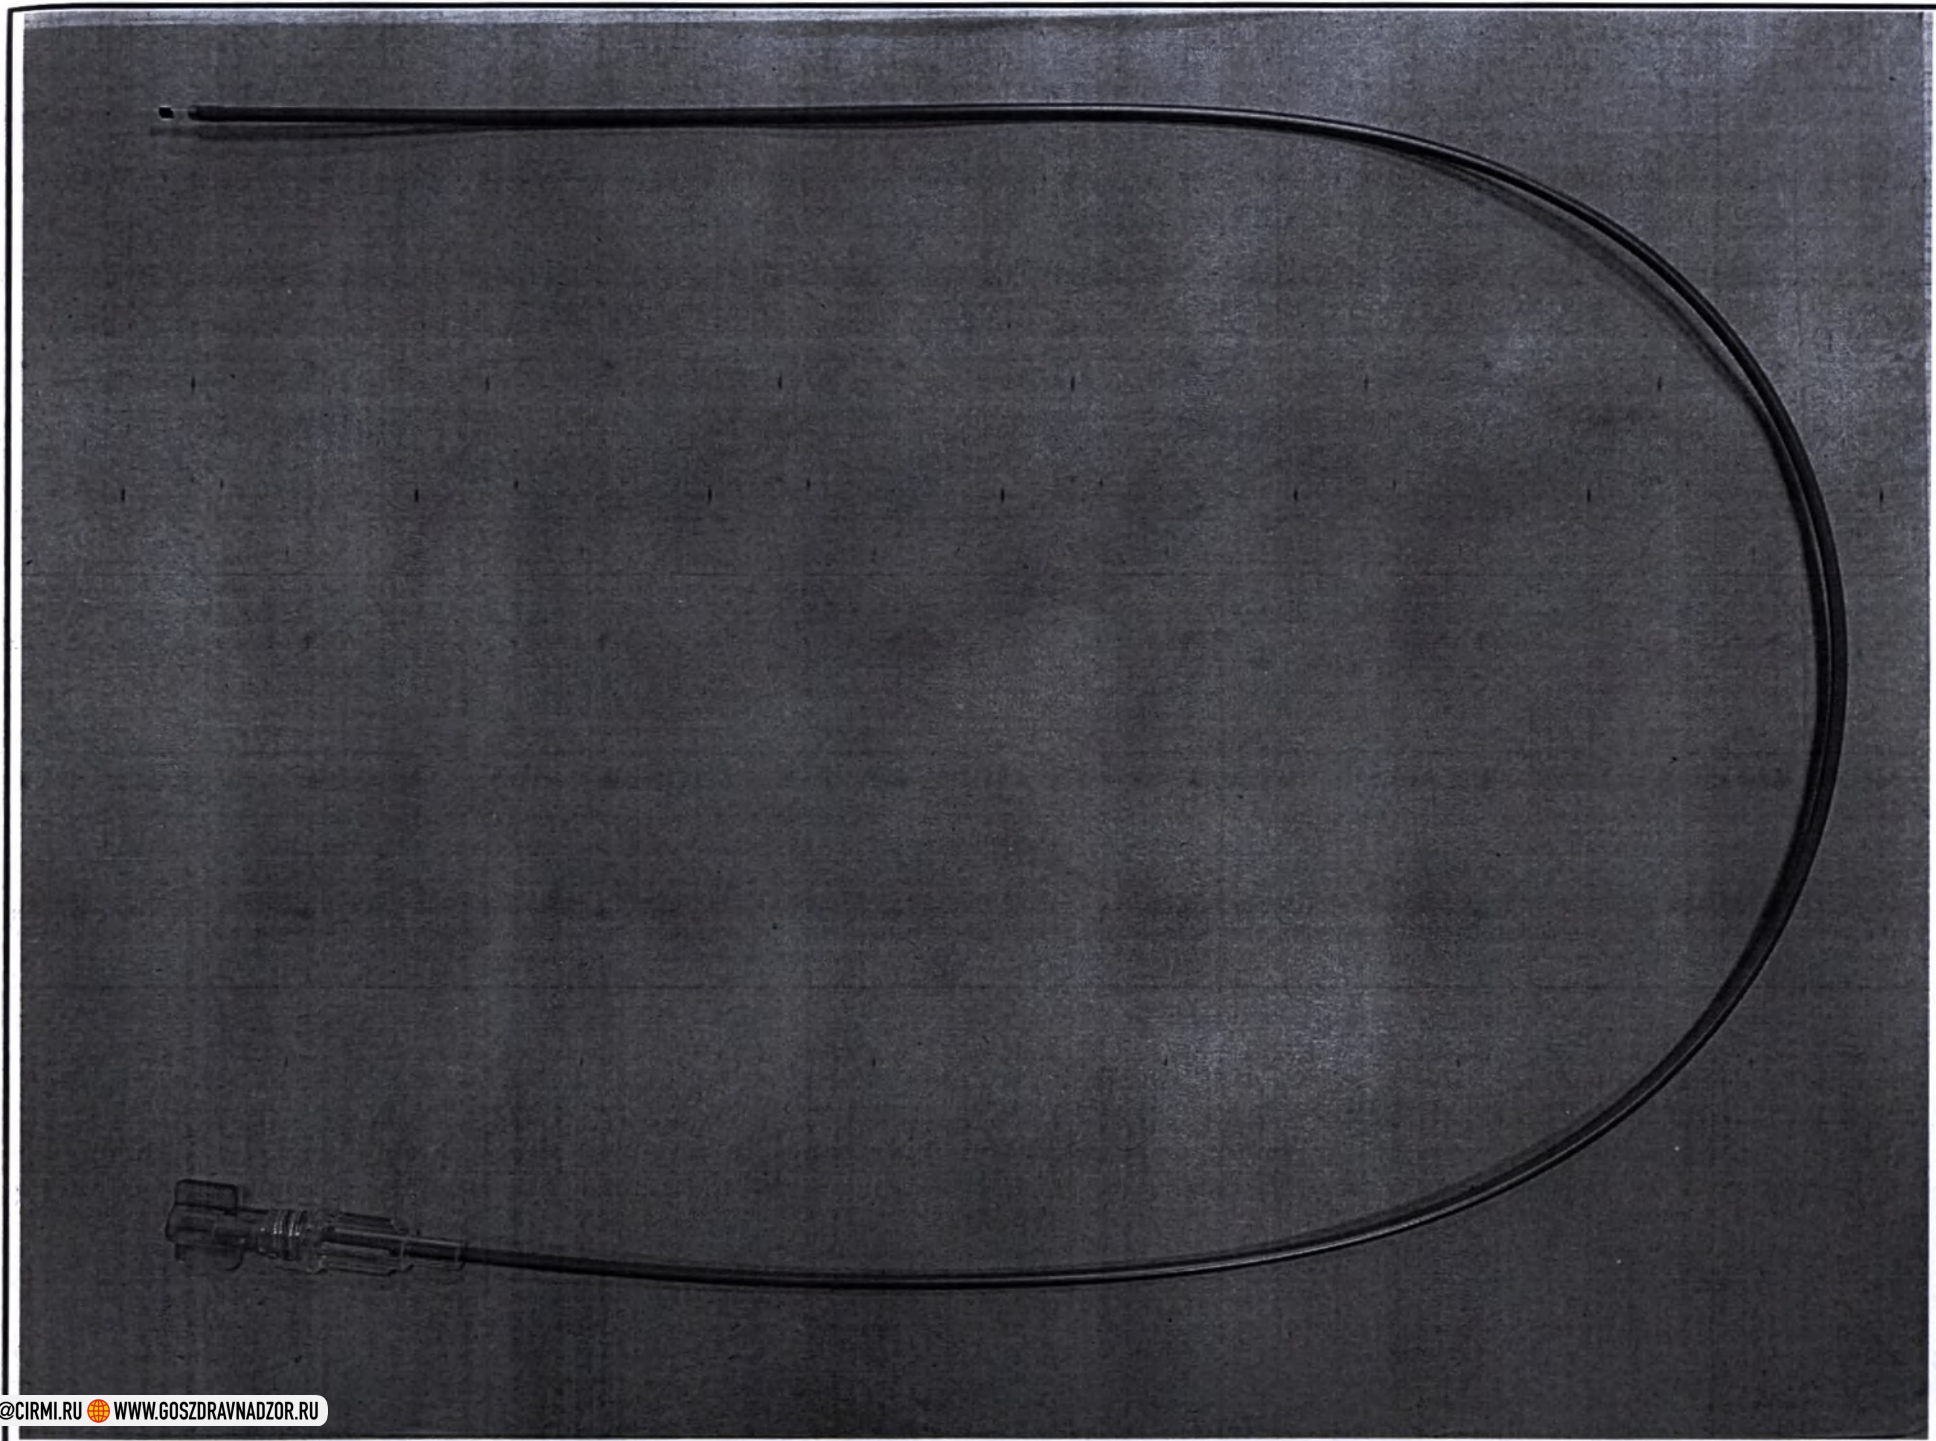

3. Проводник RosaWire нитиноловый с гидрофильным покрытием, диаметром 0,035 дюймов (0,89 мм), длиной 150 см – 1 шт.

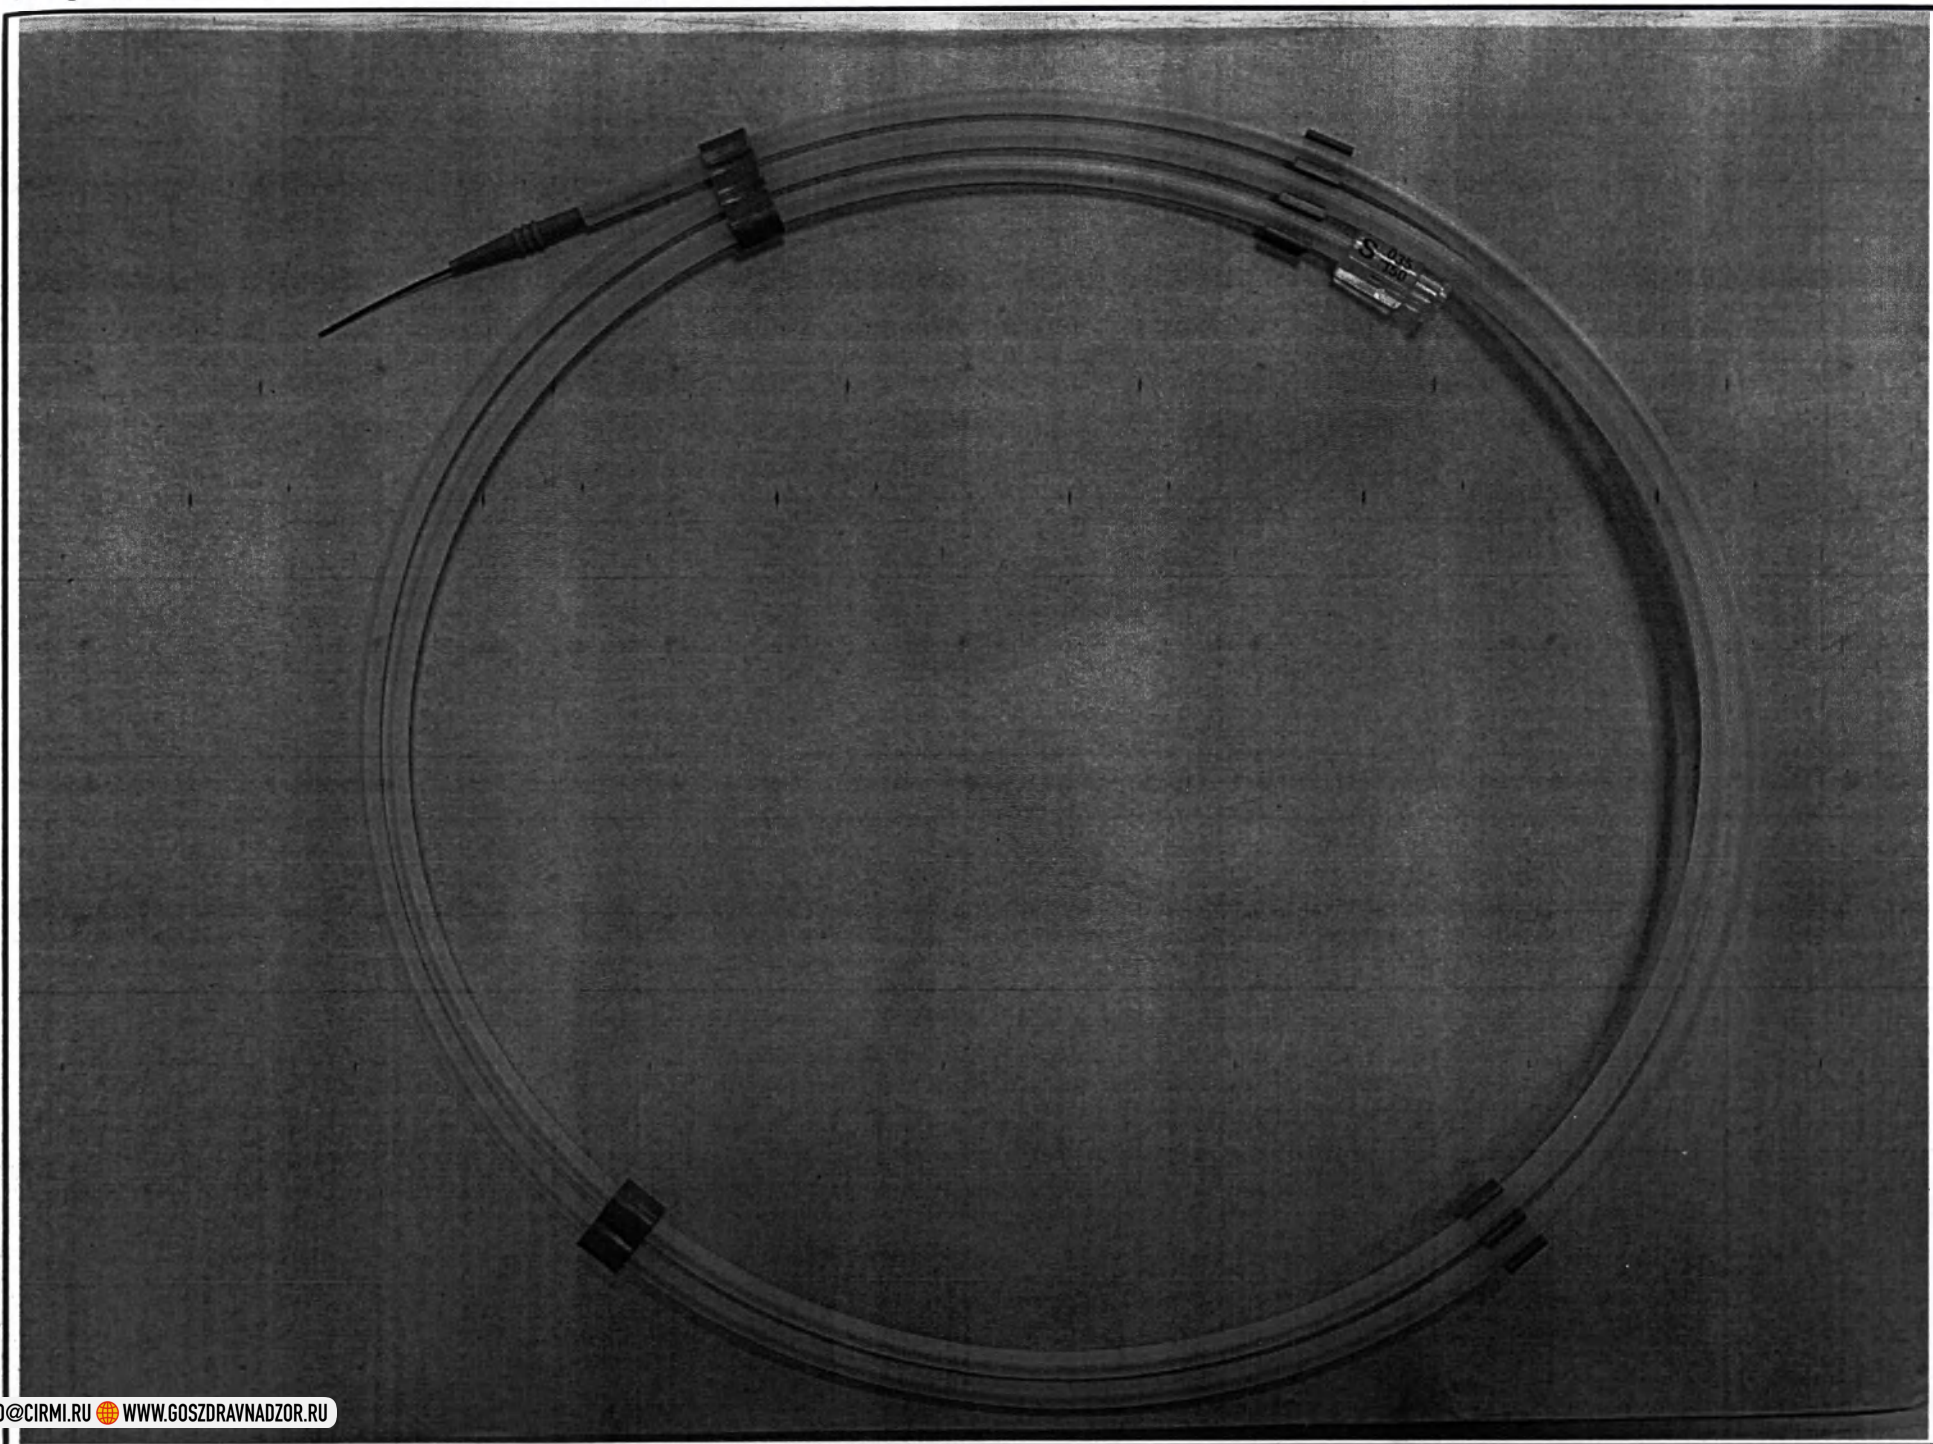

КАРТА ПАЦИЕНТА	
Имя пациента :	
Имя врача :	
Номер телефона врача :	
☐	
Дата размещения :	
Запланированная дата удаления :	
Последняя дата удаления :	
Код продукта :	Сторона : Л / Р
Номер лота :	

ROCAMED

Jfil & MiniJfil Ureteral Suture Stents

EN	INSTRUCTIONS FOR USE
FR	MODE D'EMPLOI
ES	MODO DE EMPLEO
PT	INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
IT	ISTRUZIONI PER L'USO
DE	GEBRAUCHSANWEISUNG
NL	GEbruikSAANWIJZING
SV	BRUKSANVISNING
RU	Инструкция по использованию
AR	طريقة الاستعمال

NOTE-RO JV – Ind. 00
27-06-2019

ROCAMED


RocaWire

EN	INSTRUCTIONS FOR USE
FR	MODE D'EMPLOI
ES	MODO DE EMPLEO
PT	INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
IT	ISTRUZIONI PER L'USO
DE	GEBRAUCHSANWEISUNG
NL	GEbruikSAANWIJZING
SV	BRUKSANVISNING
RU	Инструкция по использованию
AR	طريقة الاستعمال


NOTE-RO W1 – Ind. 07
26-03-2017

***II. Стент мочеточниковый внутренний
однопетлевой с нитью JFil® 16, в составе:***


1. Стент мочеточниковый внутренний однопетлевой с нитью JFil®, диаметром 7 Fr (2,3 мм), рабочей длиной: 16 см – 1 шт.

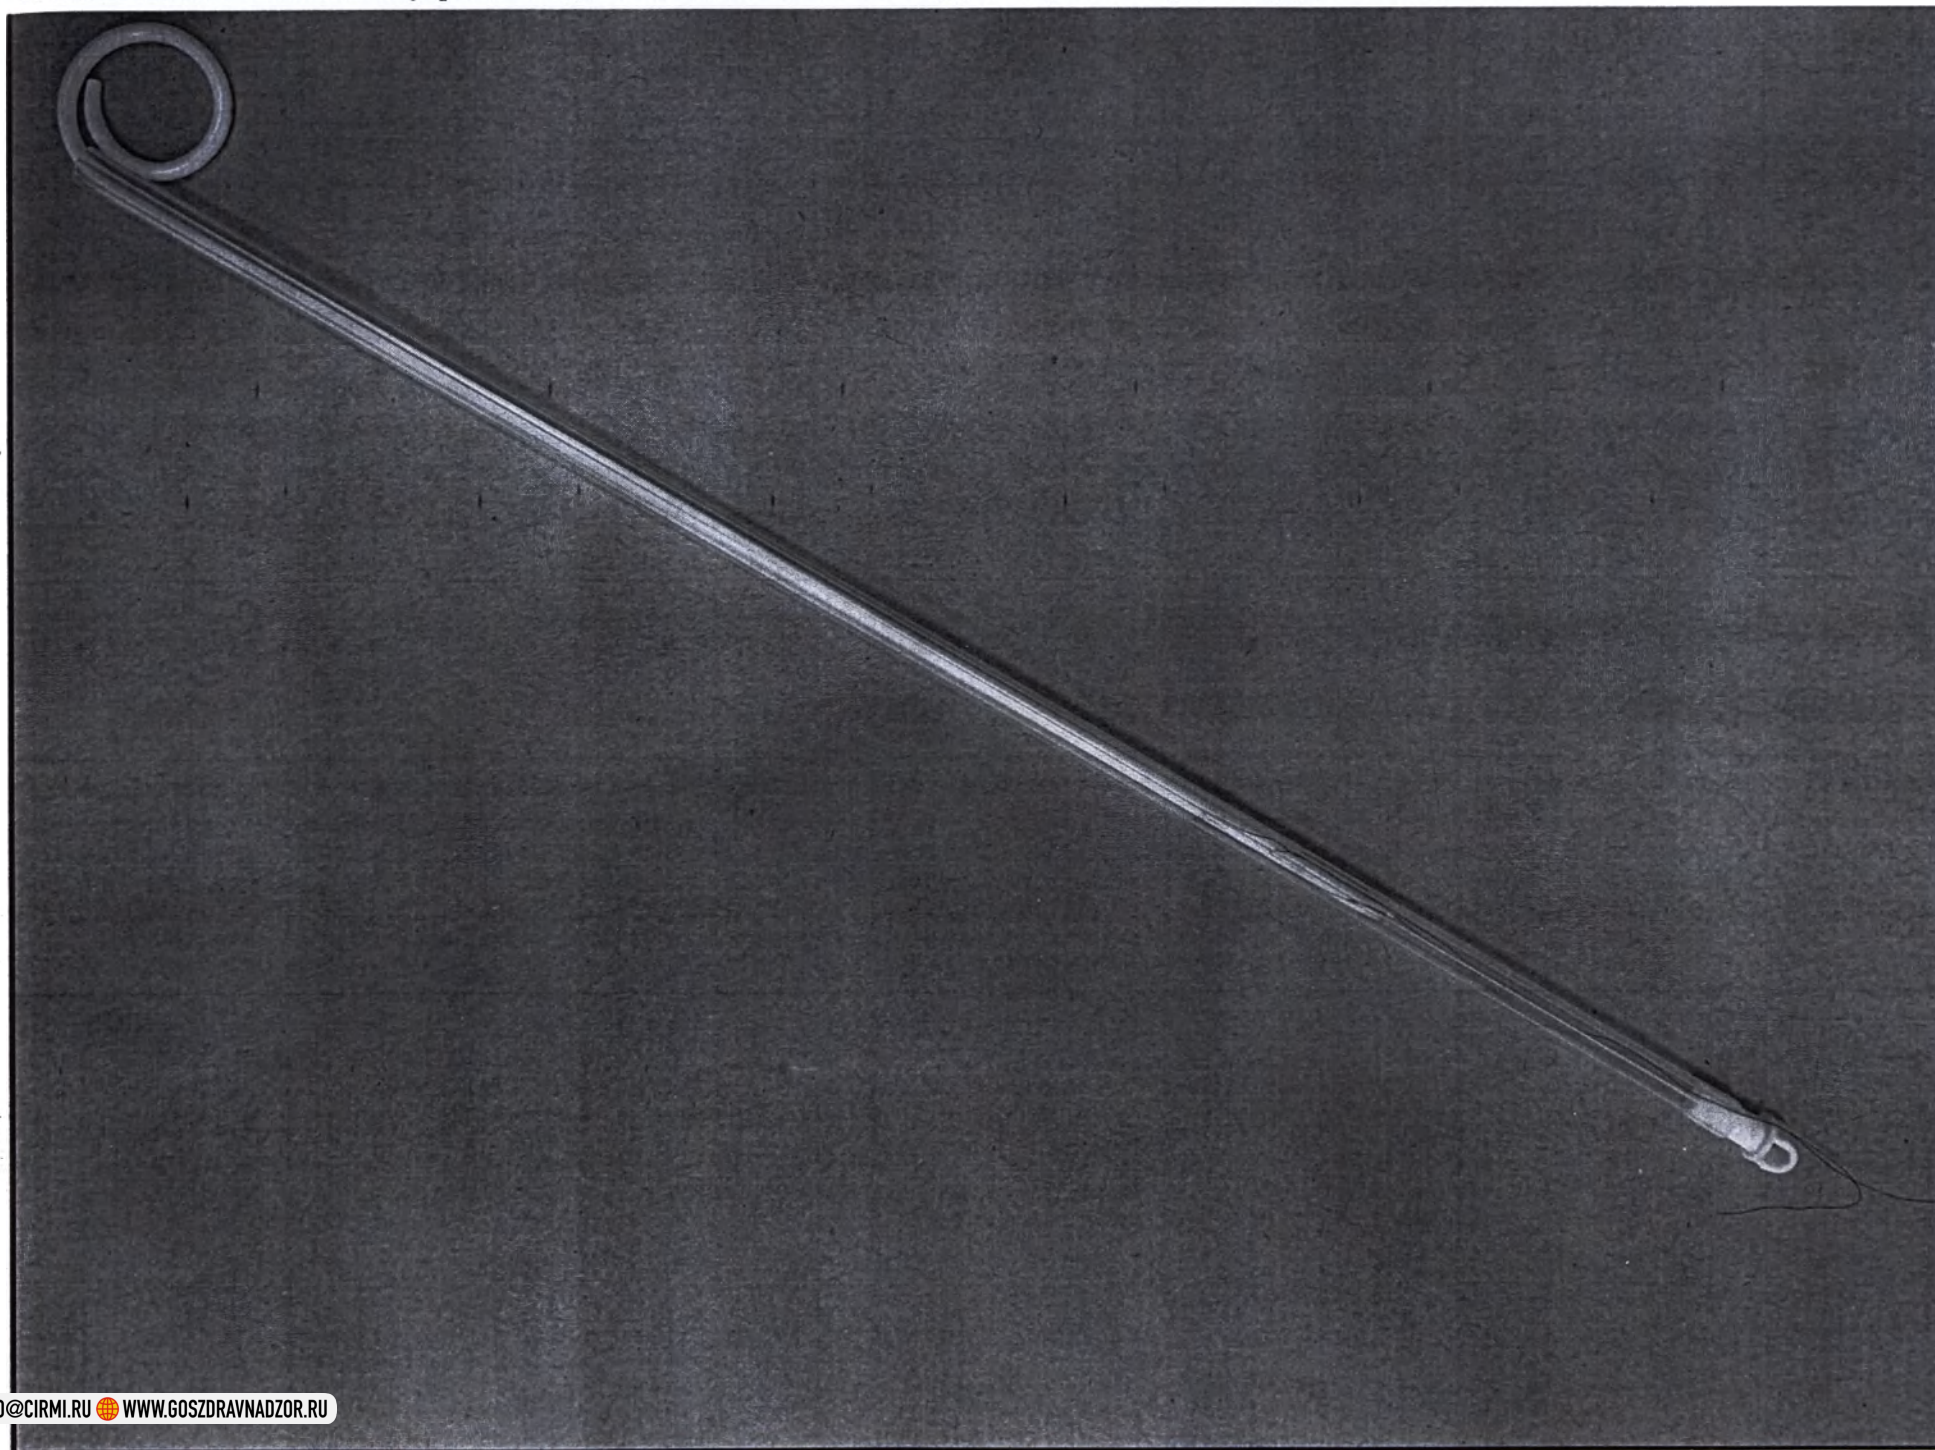

2. Толкатель соединяемый, длиной 63 см – 1 шт.

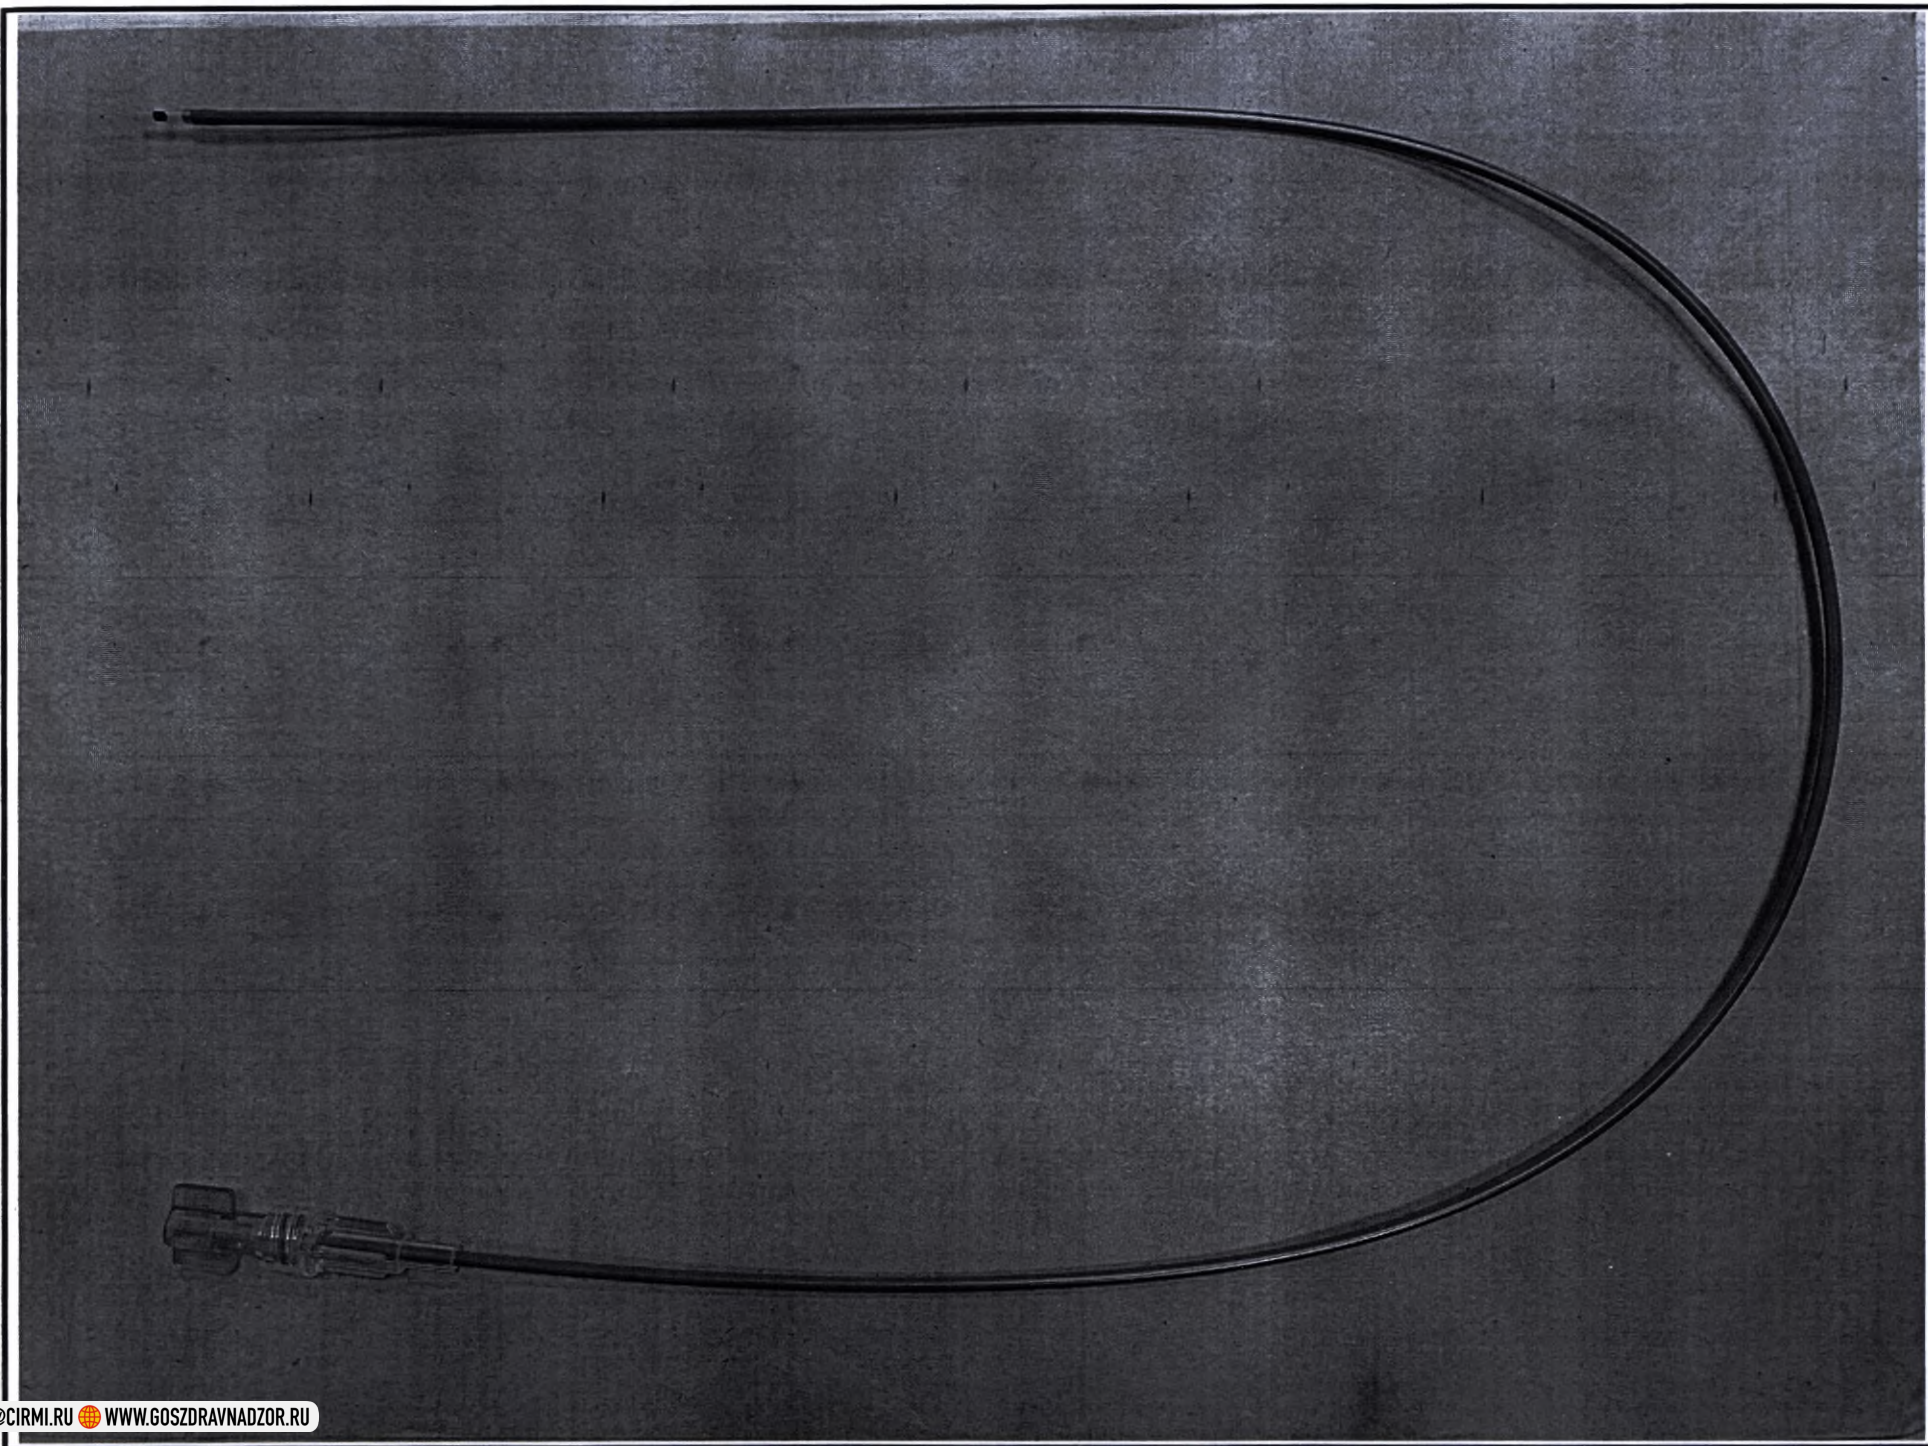

3. Проводник RocaWire нитиноловый с гидрофильным покрытием, диаметром 0,035 дюймов (0,89 мм), длиной 150 см – 1 шт.

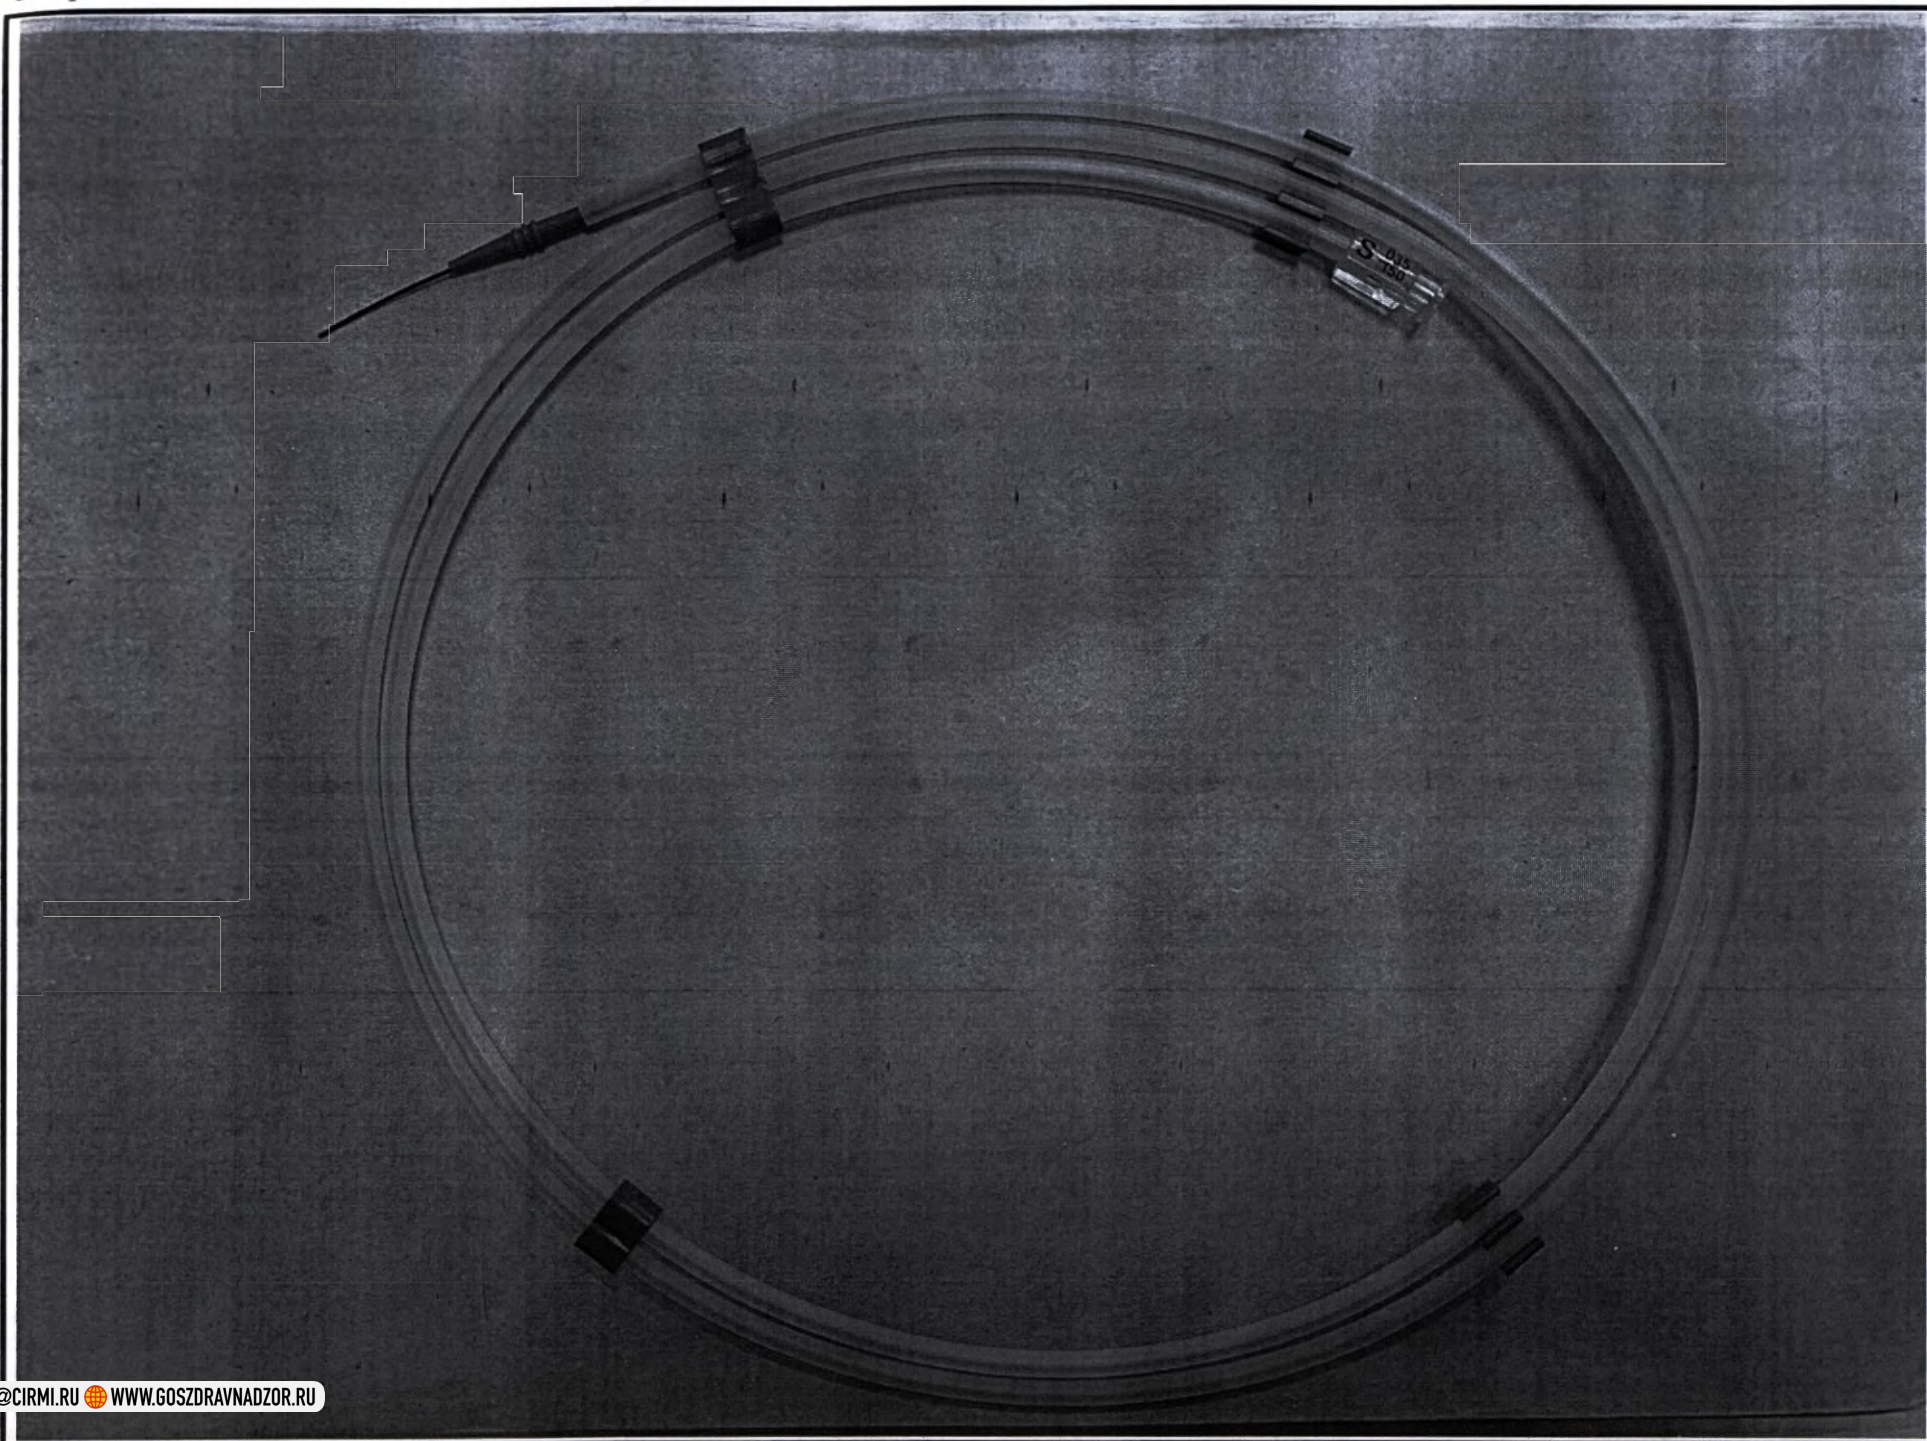

4. Карта пациента – 1 шт.

КАРТА ПАЦИЕНТА

Имя пациента :

Имя врача :

Номер телефона врача :

Дата размещения :

Запланированная дата удаления :

Последняя дата удаления :

Код продукта :

Номер лота :

Сторона :

Л / Р

ROCAMED

Jfil & MiniJfil Ureteral Suture Stents

EN	INSTRUCTIONS FOR USE
FR	MODE D'EMPLOI
ES	MODO DE EMPLEO
PT	INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
IT	ISTRUZIONI PER L'USO
DE	GEBRAUCHSANWEISUNG
NL	GEbruikSAANWIJZING
SV	BRUKSANVISNING
RU	Инструкция по использованию
AR	طريقة الاستعمال

NOTE-ROJV – Ind. 00
27-08-2019

ROCAMED


RocaWire

EN	INSTRUCTIONS FOR USE
FR	MODE D'EMPLOI
ES	MODO DE EMPLEO
PT	INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
IT	ISTRUZIONI PER L'USO
DE	GEBRAUCHSANWEISUNG
NL	GEbruikSAANWIJZING
SV	BRUKSANVISNING
RU	Инструкция по использованию
AR	طريقة الاستعمال


NOTE-ROWI – Ind. 07
28-03-2017

***III. Стент мочеточниковый внутренний однопетлевой с
нитью JFil® 8 ECO KIT, в составе:***

1. Стент мочеточниковый внутренний однопетлевой с нитью JFil®, диаметром 7 Fr (2,3 мм), рабочей длиной: 8 см – 1 шт.

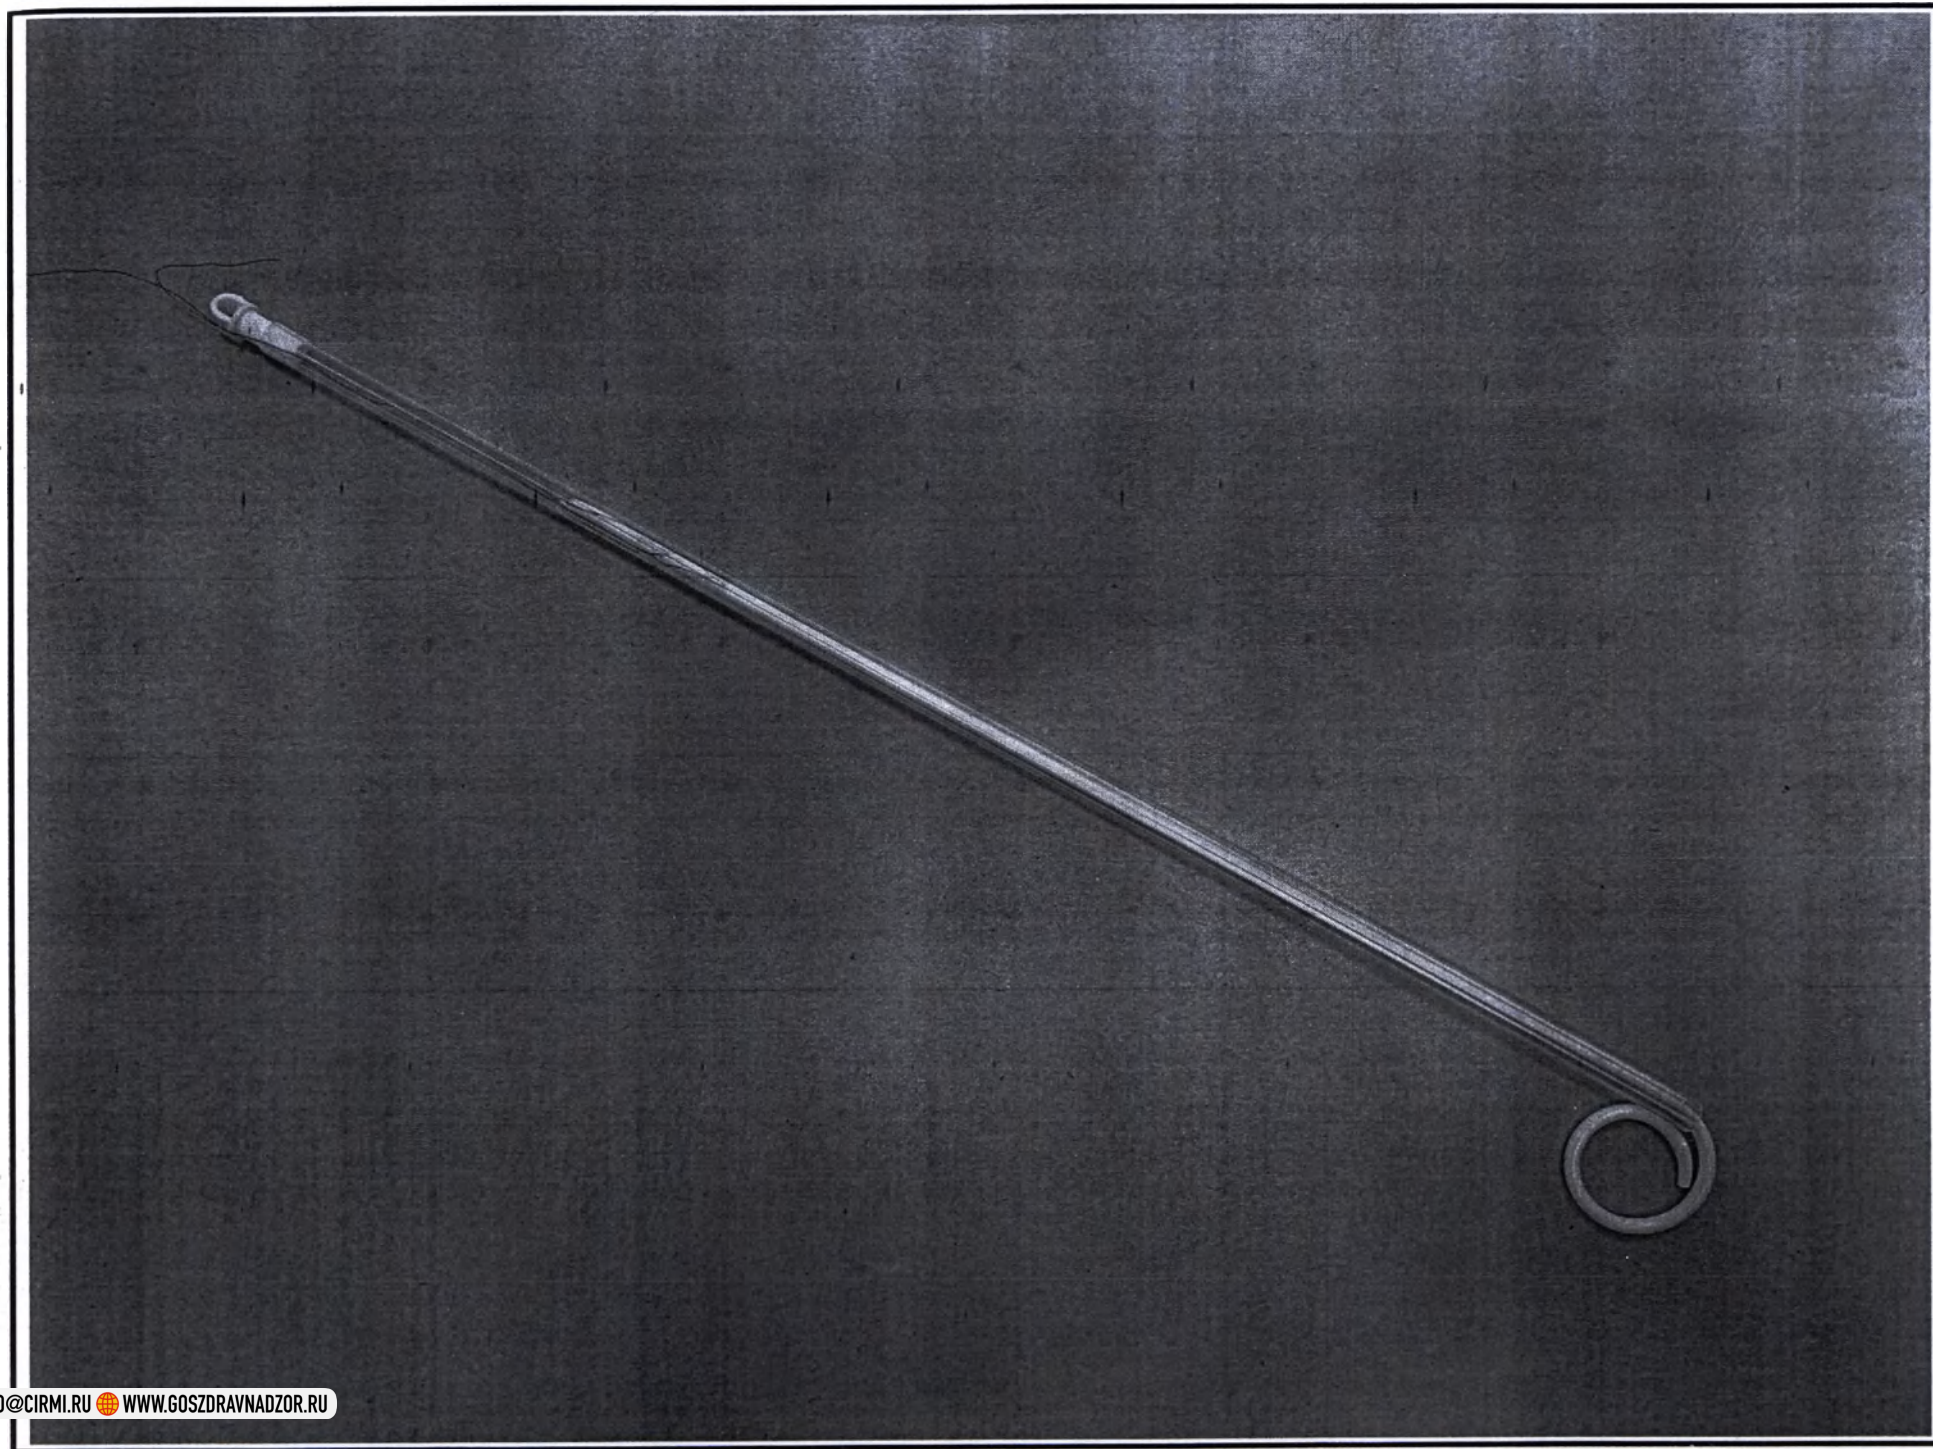

2. Толкатель соединяемый, длиной 63 см – 1 шт.

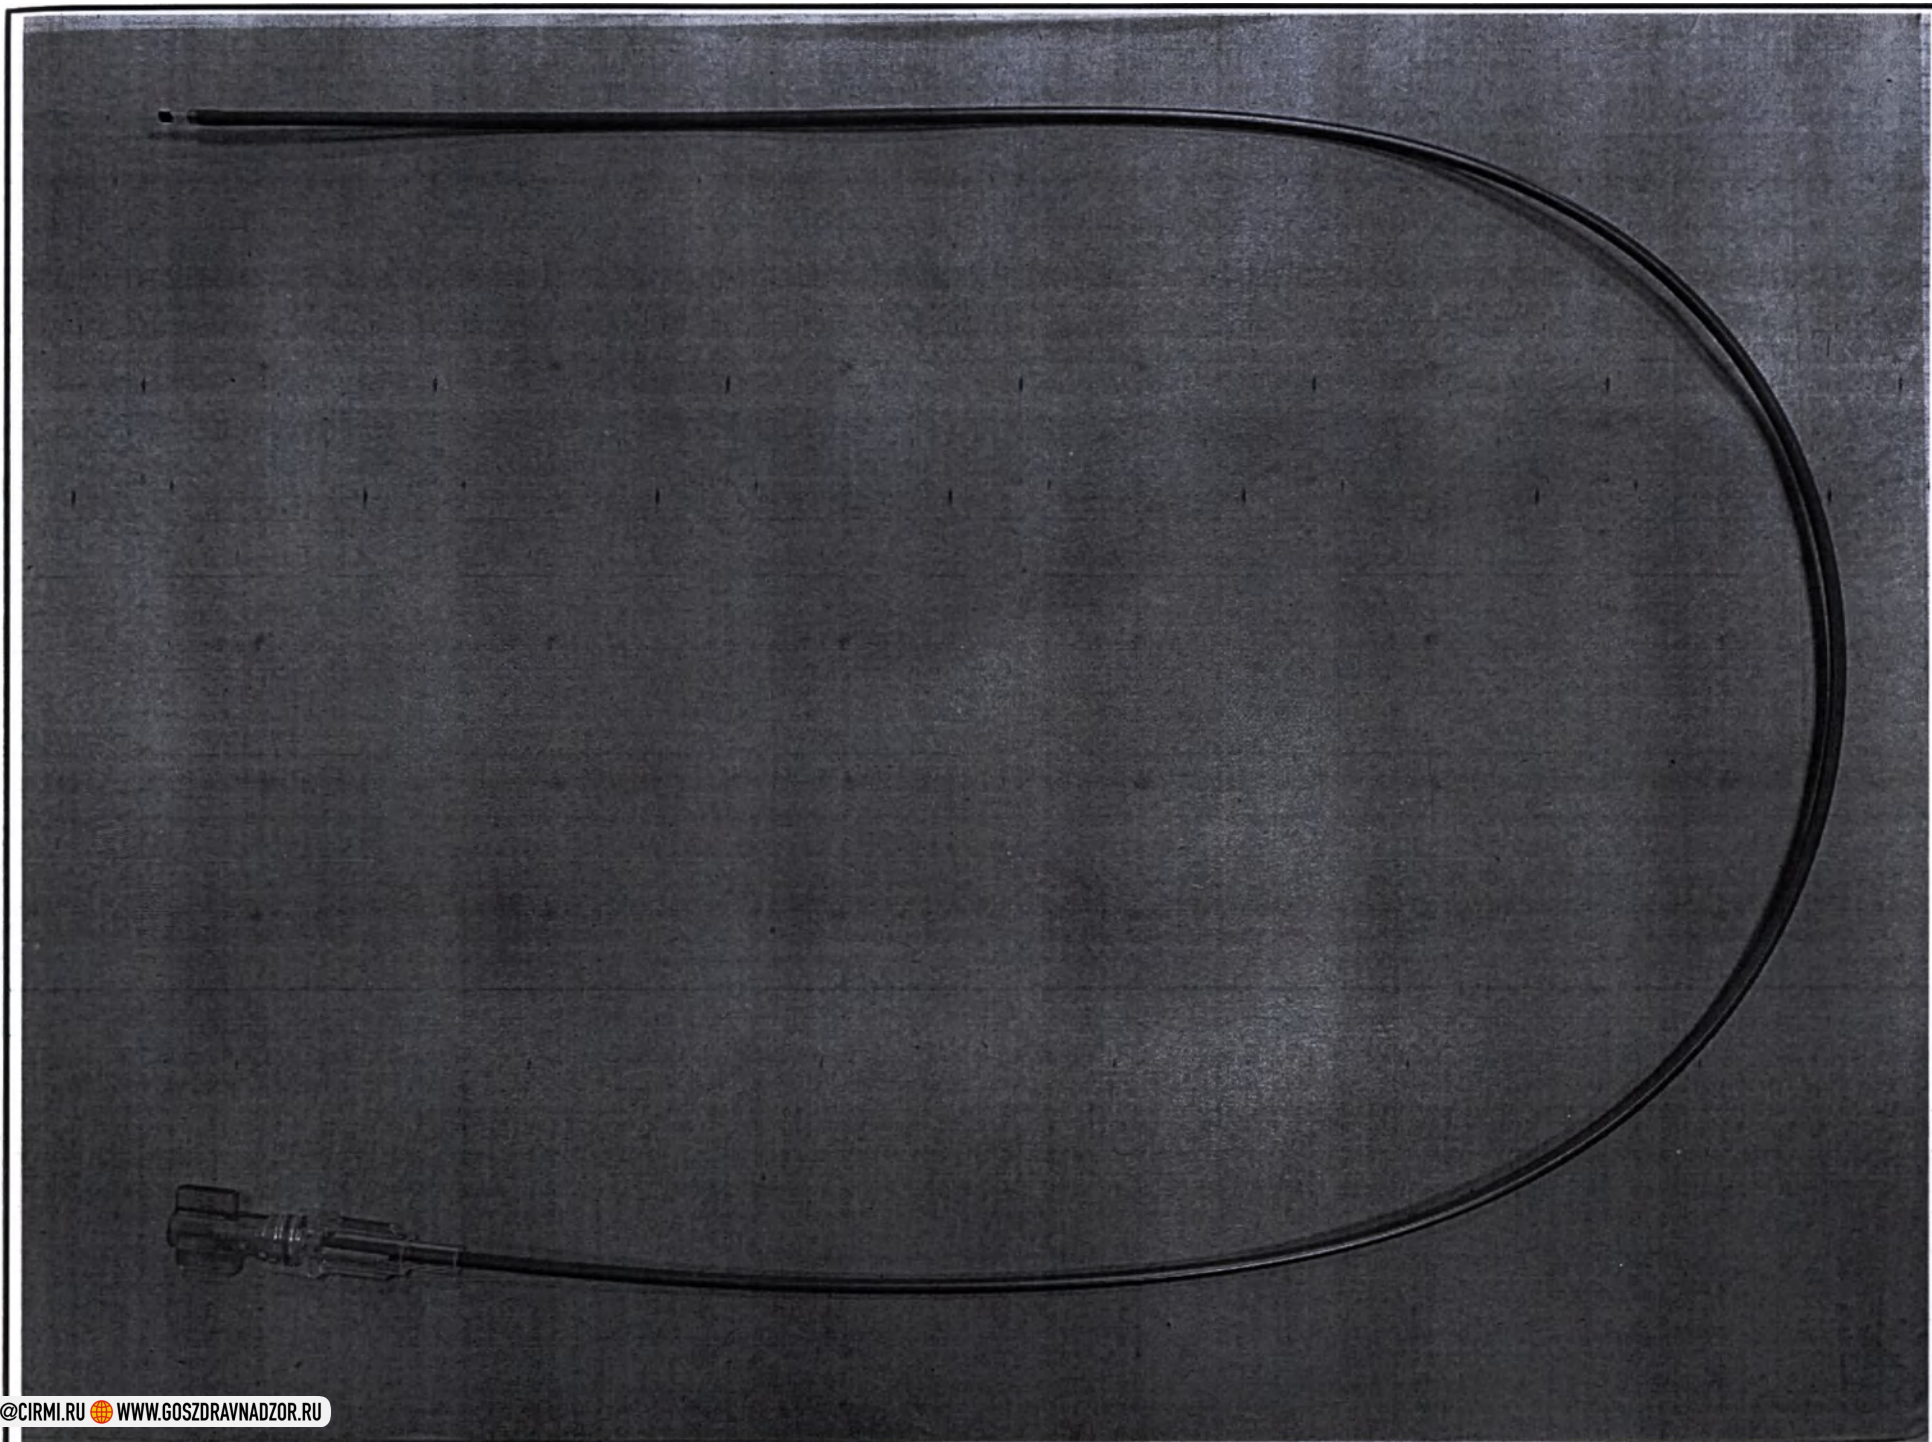

3. Карта пациента – 1 шт.

КАРТА ПАЦИЕНТА	
Имя пациента :	
Имя врача :	
Номер телефона врача :	
	
Дата размещения :	
Запланированная дата удаления :	
Последняя дата удаления :	
Код продукта :	Сторона : Л / Р
Номер лота :	


ROCAMED**Jfil & MiniJfil Ureteral
Suture Stents**

EN	INSTRUCTIONS FOR USE
FR	MODE D'EMPLOI
ES	MODO DE EMPLEO
PT	INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
IT	ISTRUZIONI PER L'USO
DE	GEBRAUCHSANWEISUNG
NL	GEbruikSAANWIJZING
SV	BRUKSANVISNING
RU	Инструкция по использованию
AR	طريقة الاستعمال


NOTE-RO.IV - Ind. 01
15-01-2020

***IV. Стент мочеточниковый внутренний однопетлевой с
нитью JFil® 16 ECO KIT, в составе:***

1. Стент мочеточниковый внутренний однопетлевой с нитью JFil® , диаметром 7 Fr (2,3 мм) , рабочей длиной: 16 см– 1 шт.

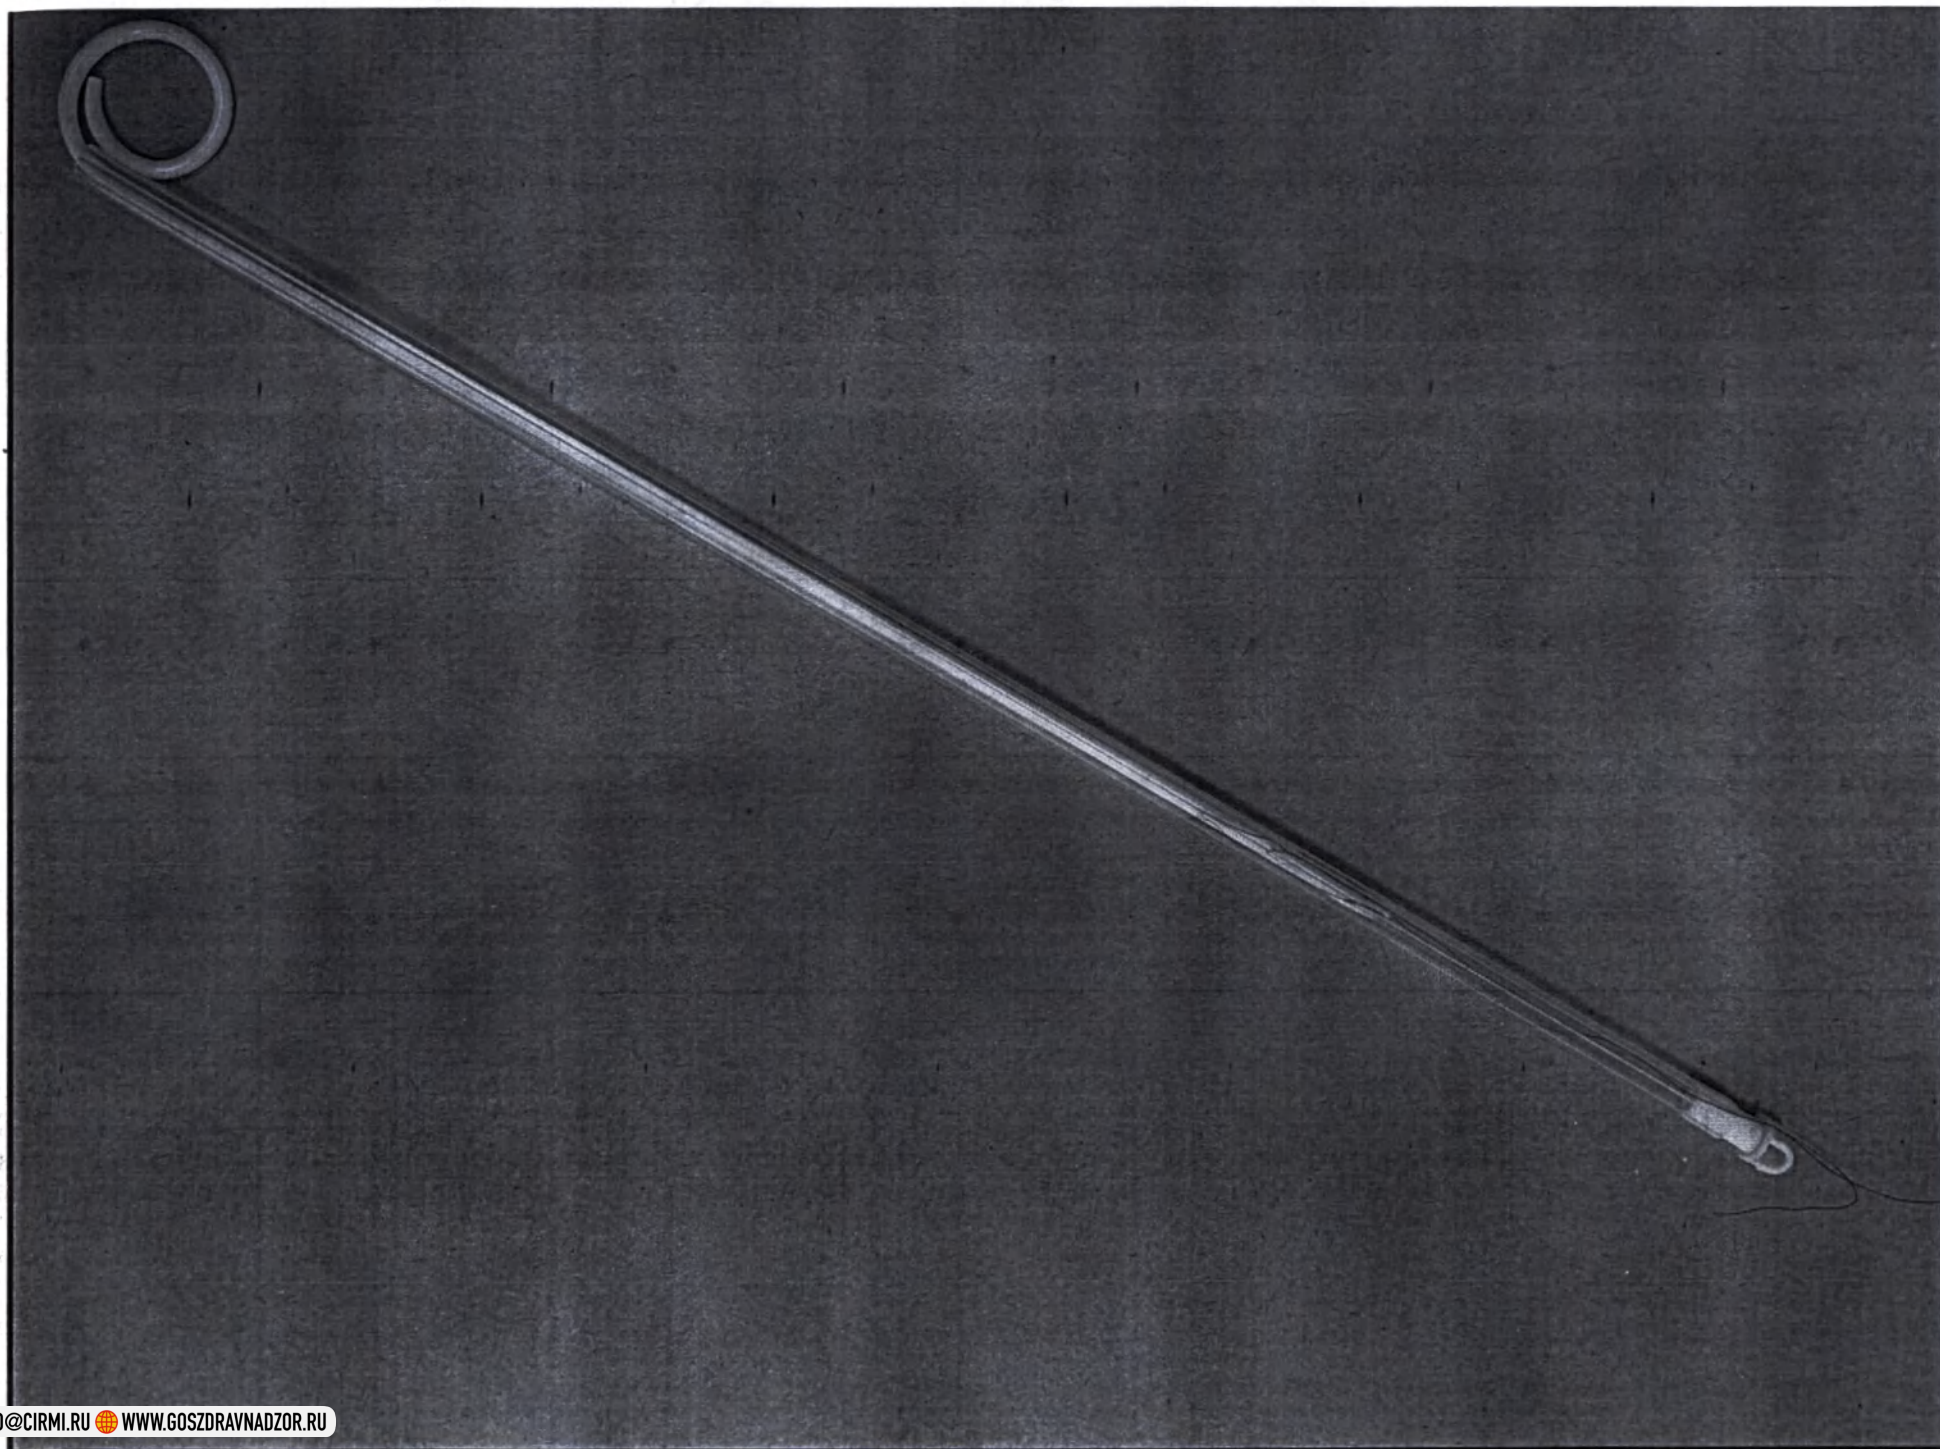

2. Толкатель соединяемый, длиной 63 см – 1 шт.

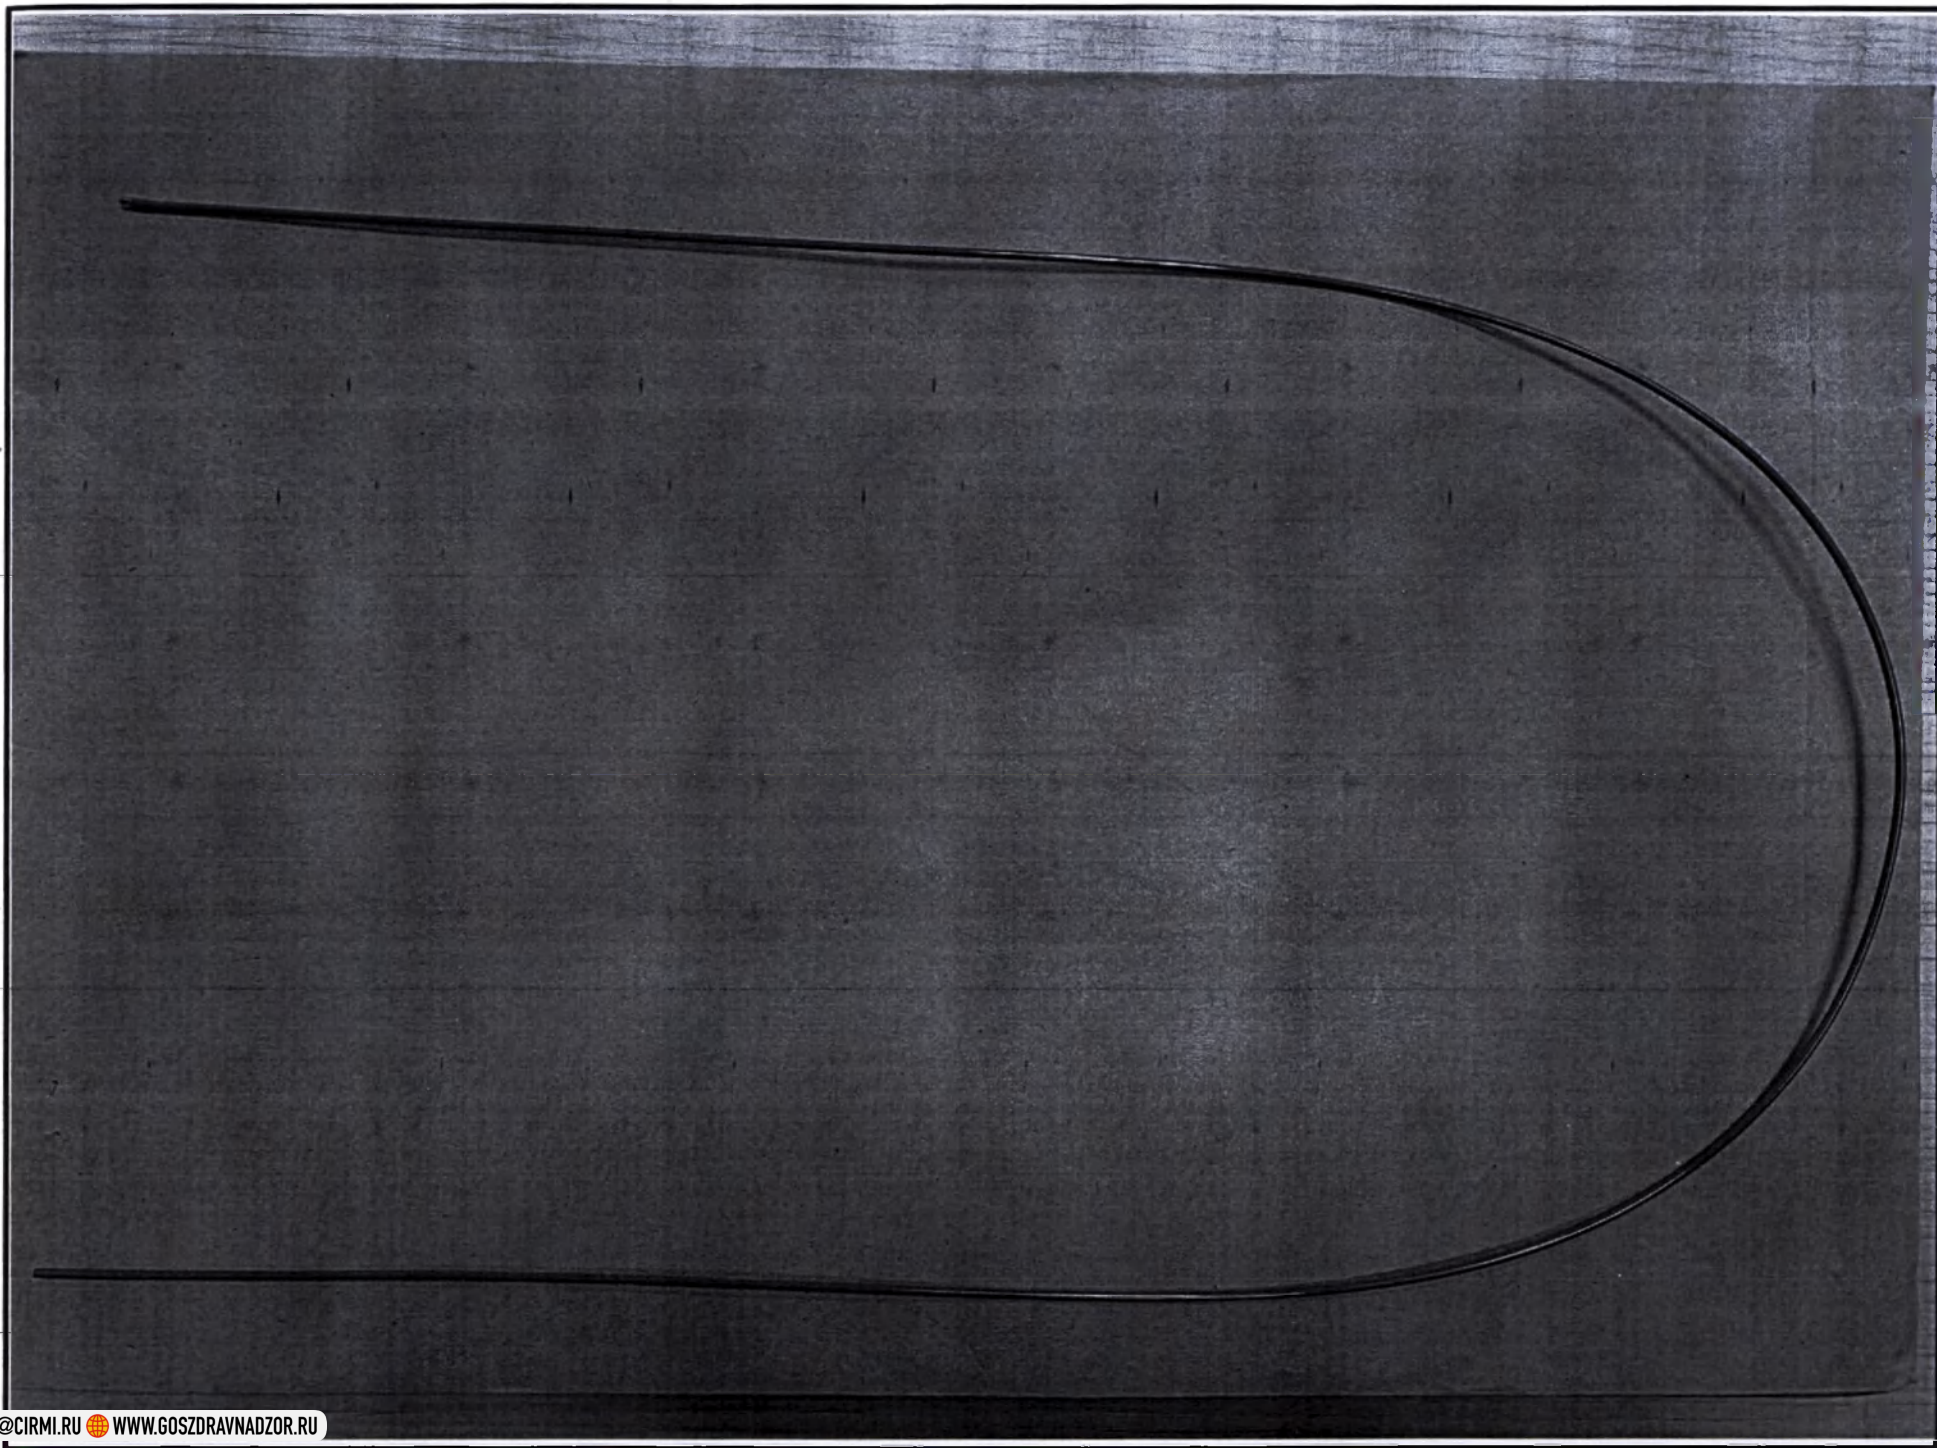

КАРТА ПАЦИЕНТА

Имя пациента :

Имя врача :

Номер телефона врача :

Дата размещения :

Запланированная дата удаления :

Последняя дата удаления :

Код продукта :

Номер лота :

Сторона :

Л / Р


ROCAMED**Jfil & MiniJfil Ureteral
Suture Stents**

EN	INSTRUCTIONS FOR USE
FR	MODE D'EMPLOI
ES	MODO DE EMPLEO
PT	INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
IT	ISTRUZIONI PER L'USO
DE	GEBRAUCHSANWEISUNG
NL	GEBRUIKSAANWIJZING
SV	BRUKSANVISNING
RU	Инструкция по использованию
AR	طريقة الاستعمال


NOTE-ROJ.V – Ind. 01
15-01-2020

***V. Стент мочеточниковый внутренний однопетлевой с
нитью MiniJFil®, в составе:***


1. Стент мочеточниковый внутренний однопетлевой с нитью MiniJFil®, диаметром 4,8 Fr (1,6 мм) – 1 шт.

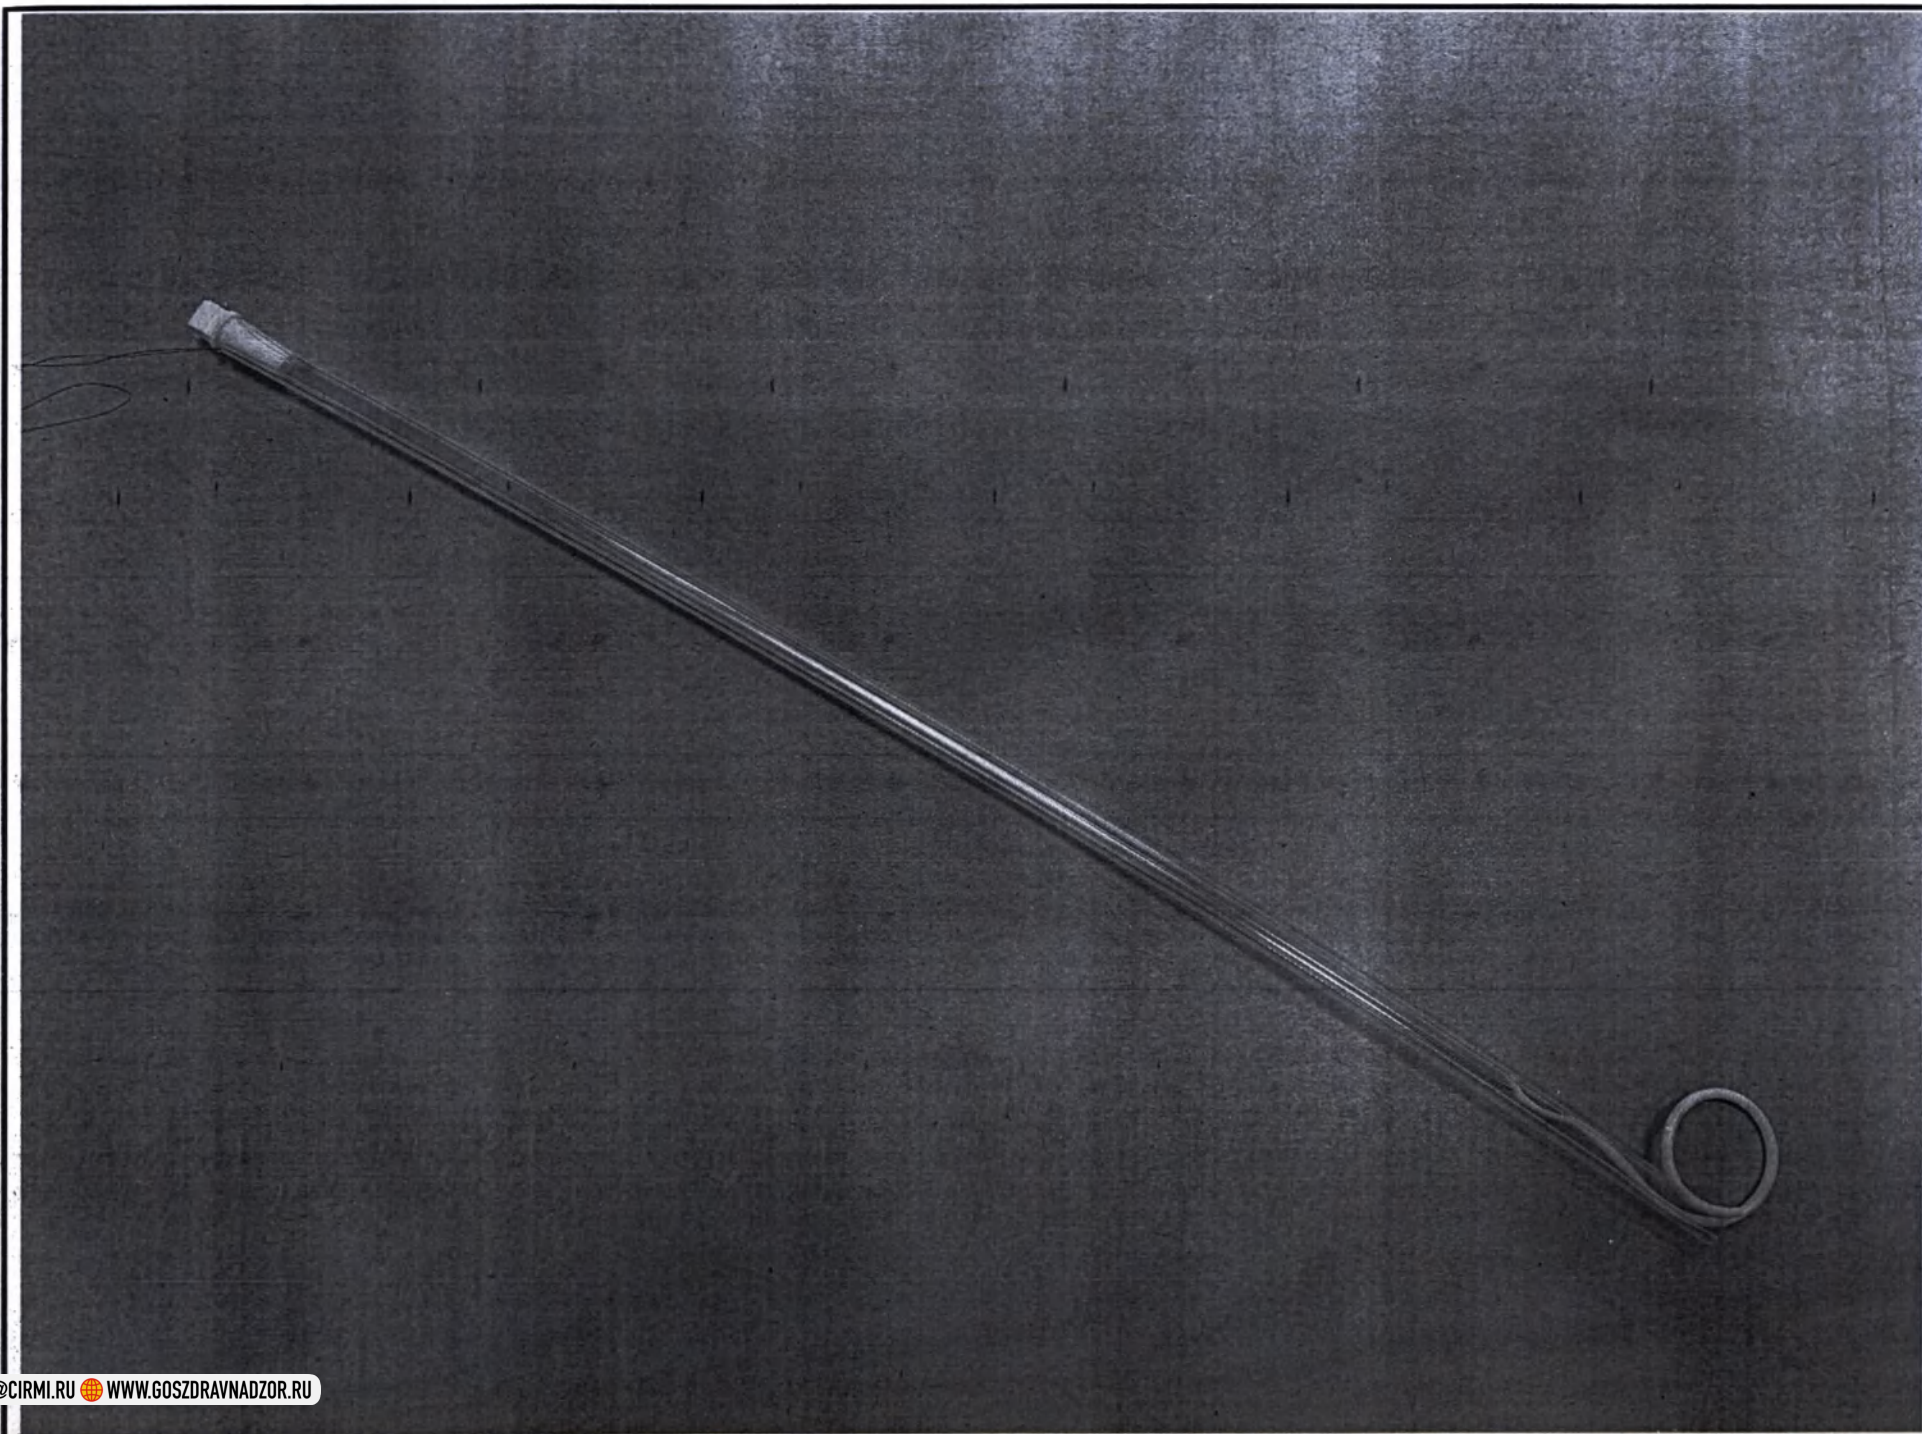

2. Толкатель простой, диаметром 5 Fr (1,67 мм), длиной 70 см – 1 шт.

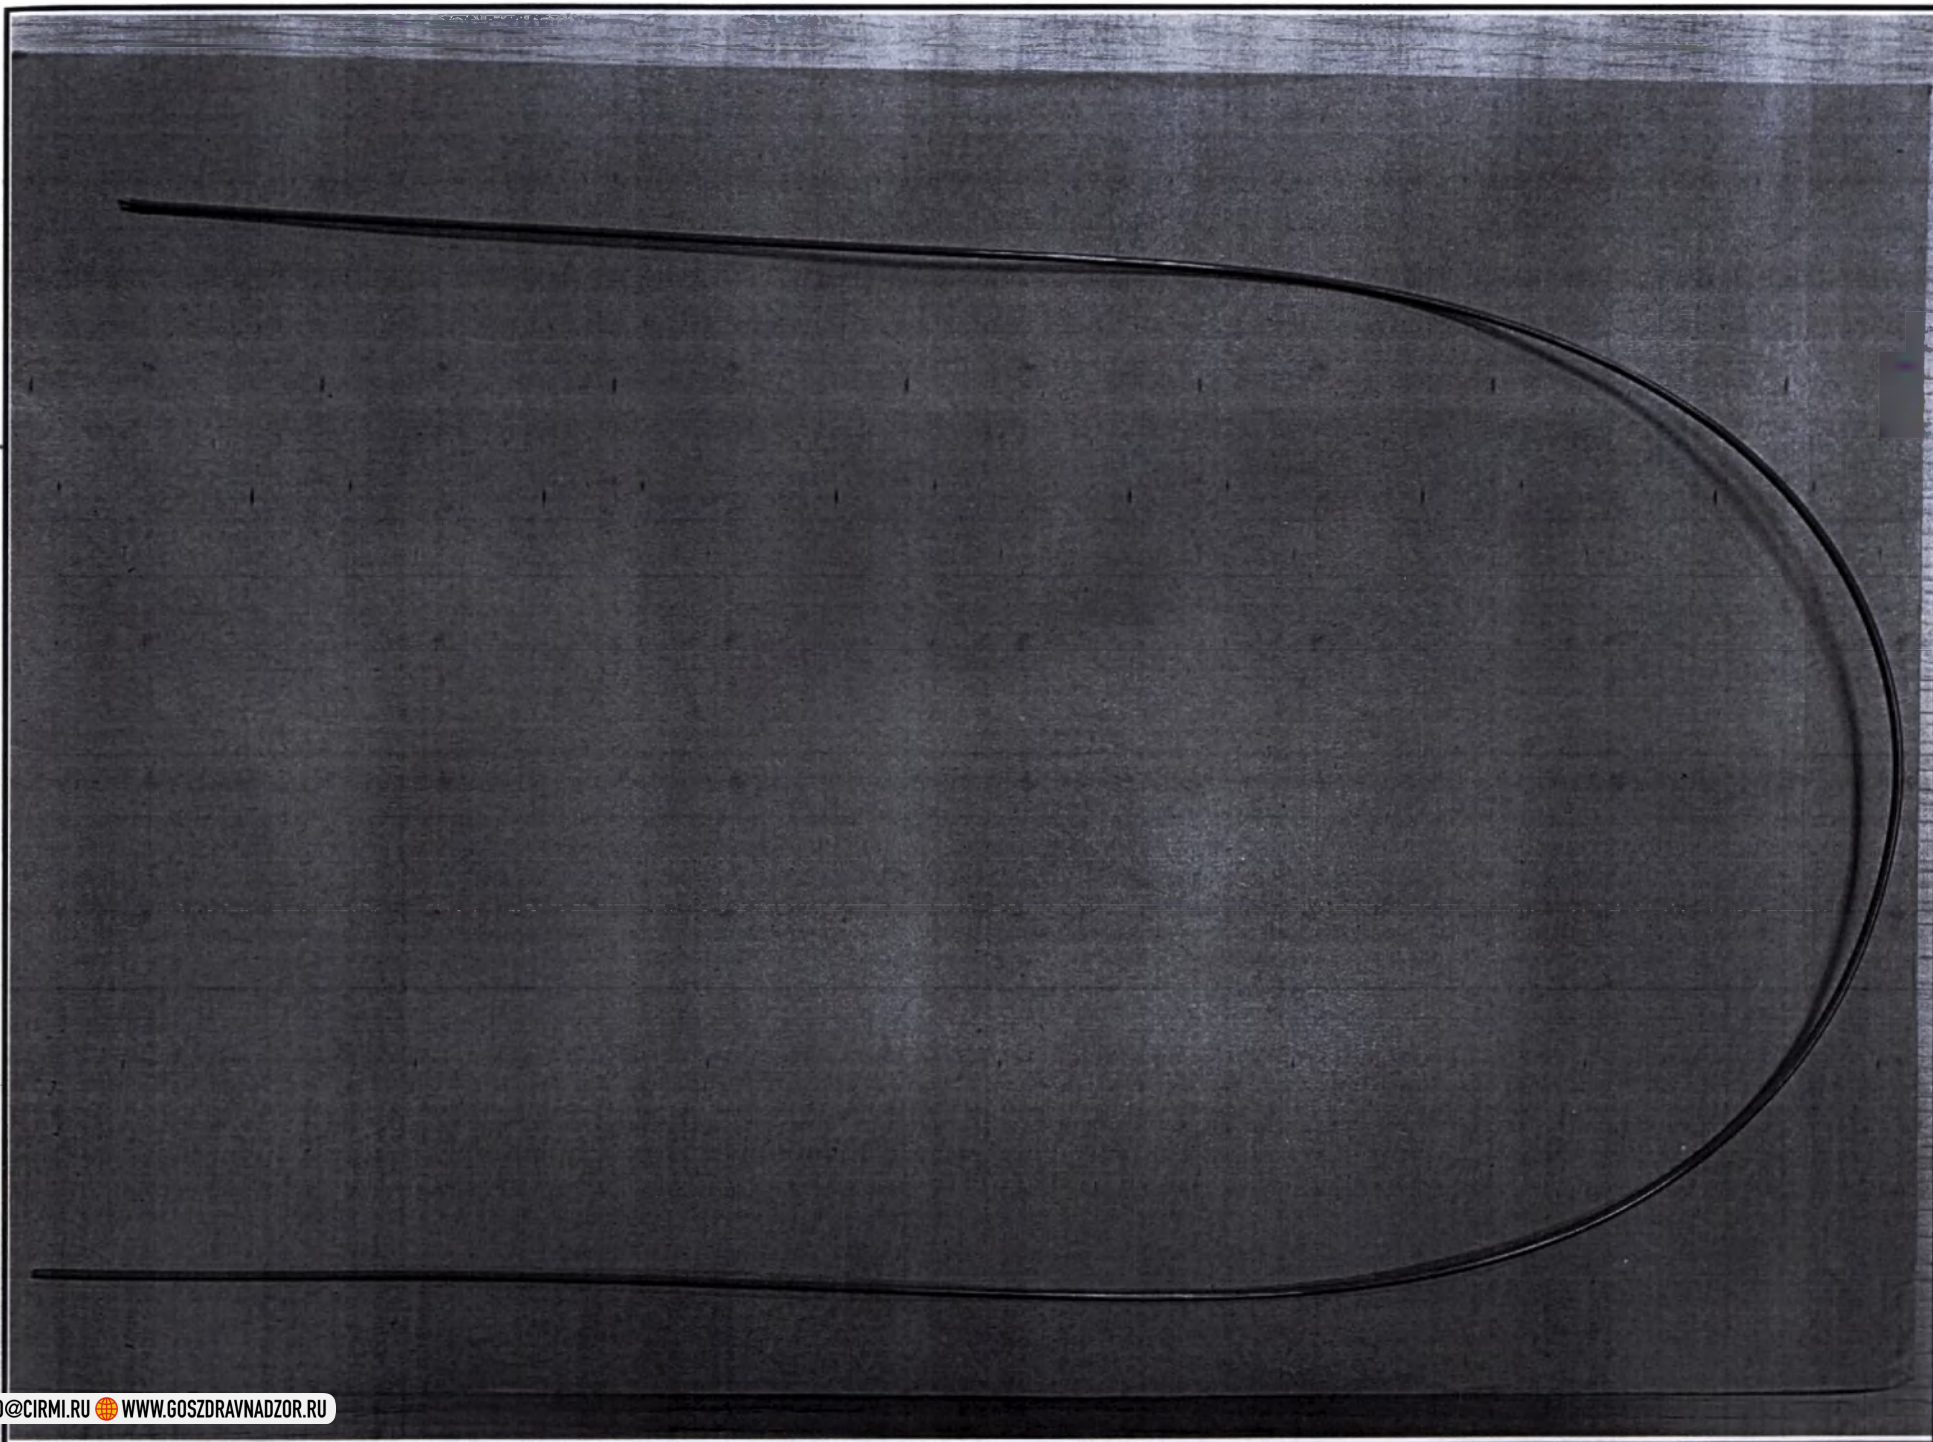

3. Проводник RosaWire нитиноловый с гидрофильным покрытием, диаметром 0,035 дюймов (0,89 мм), длиной 150 см – 1 шт.

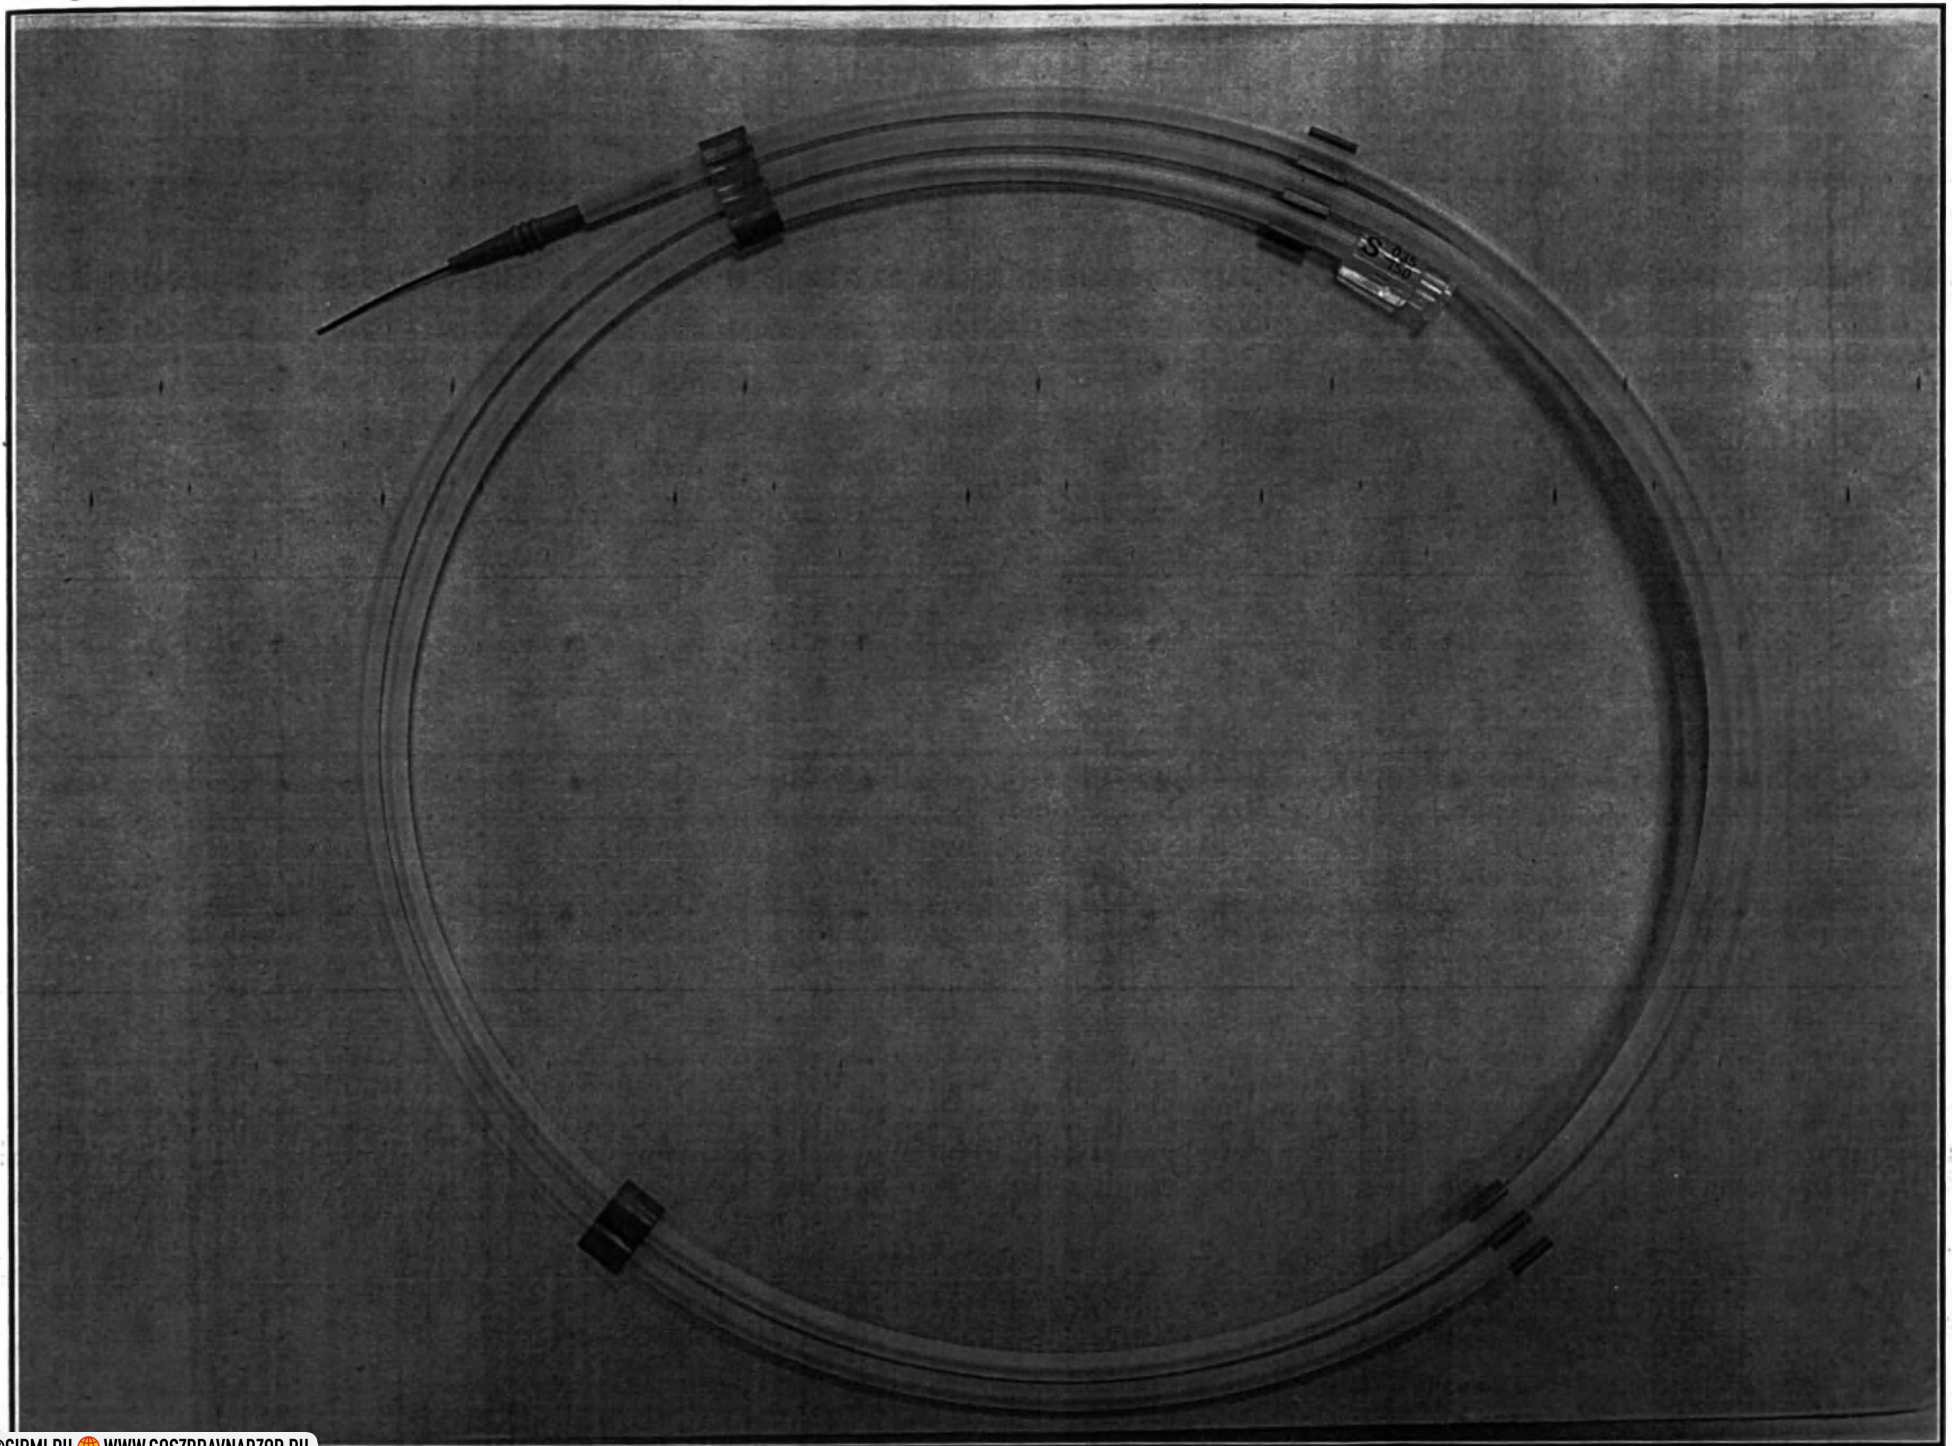

КАРТА ПАЦИЕНТА

Имя пациента :

Имя врача :

Номер телефона врача :

Дата размещения :

Запланированная дата удаления :

Последняя дата удаления :

Код продукта :

Номер лота :

Сторона :

Л / Р

ROCAMED

Jfil & MiniJfil Ureteral Suture Stents

EN	INSTRUCTIONS FOR USE
FR	MODE D'EMPLOI
ES	MODO DE EMPLEO
PT	INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
IT	ISTRUZIONI PER L'USO
DE	GEBRAUCHSANWEISUNG
NL	GEbruikSAANWIJZING
SV	BRUKSANVISNING
RU	Инструкция по использованию
AR	طريقة الاستعمال

NOTE-ROJIV - Ind. 00
27-06-2019

ROCAMED


RocaWire

EN	INSTRUCTIONS FOR USE
FR	MODE D'EMPLOI
ES	MODO DE EMPLEO
PT	INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
IT	ISTRUZIONI PER L'USO
DE	GEBRAUCHSANWEISUNG
NL	GEbruikSAANWIJZING
SV	BRUKSANVISNING
RU	Инструкция по использованию
AR	طريقة الاستعمال


NOTE-ROWI - Ind. 07
26-03-2017

***VI. Стент мочеточниковый внутренний однопетлевой с
нитью MiniJFil® ECO KIT, в составе:***

1. Стент мочеточниковый внутренний однопетлевой с нитью MiniJFil®, диаметром 4,8 Fr (1,6 мм) – 1 шт.

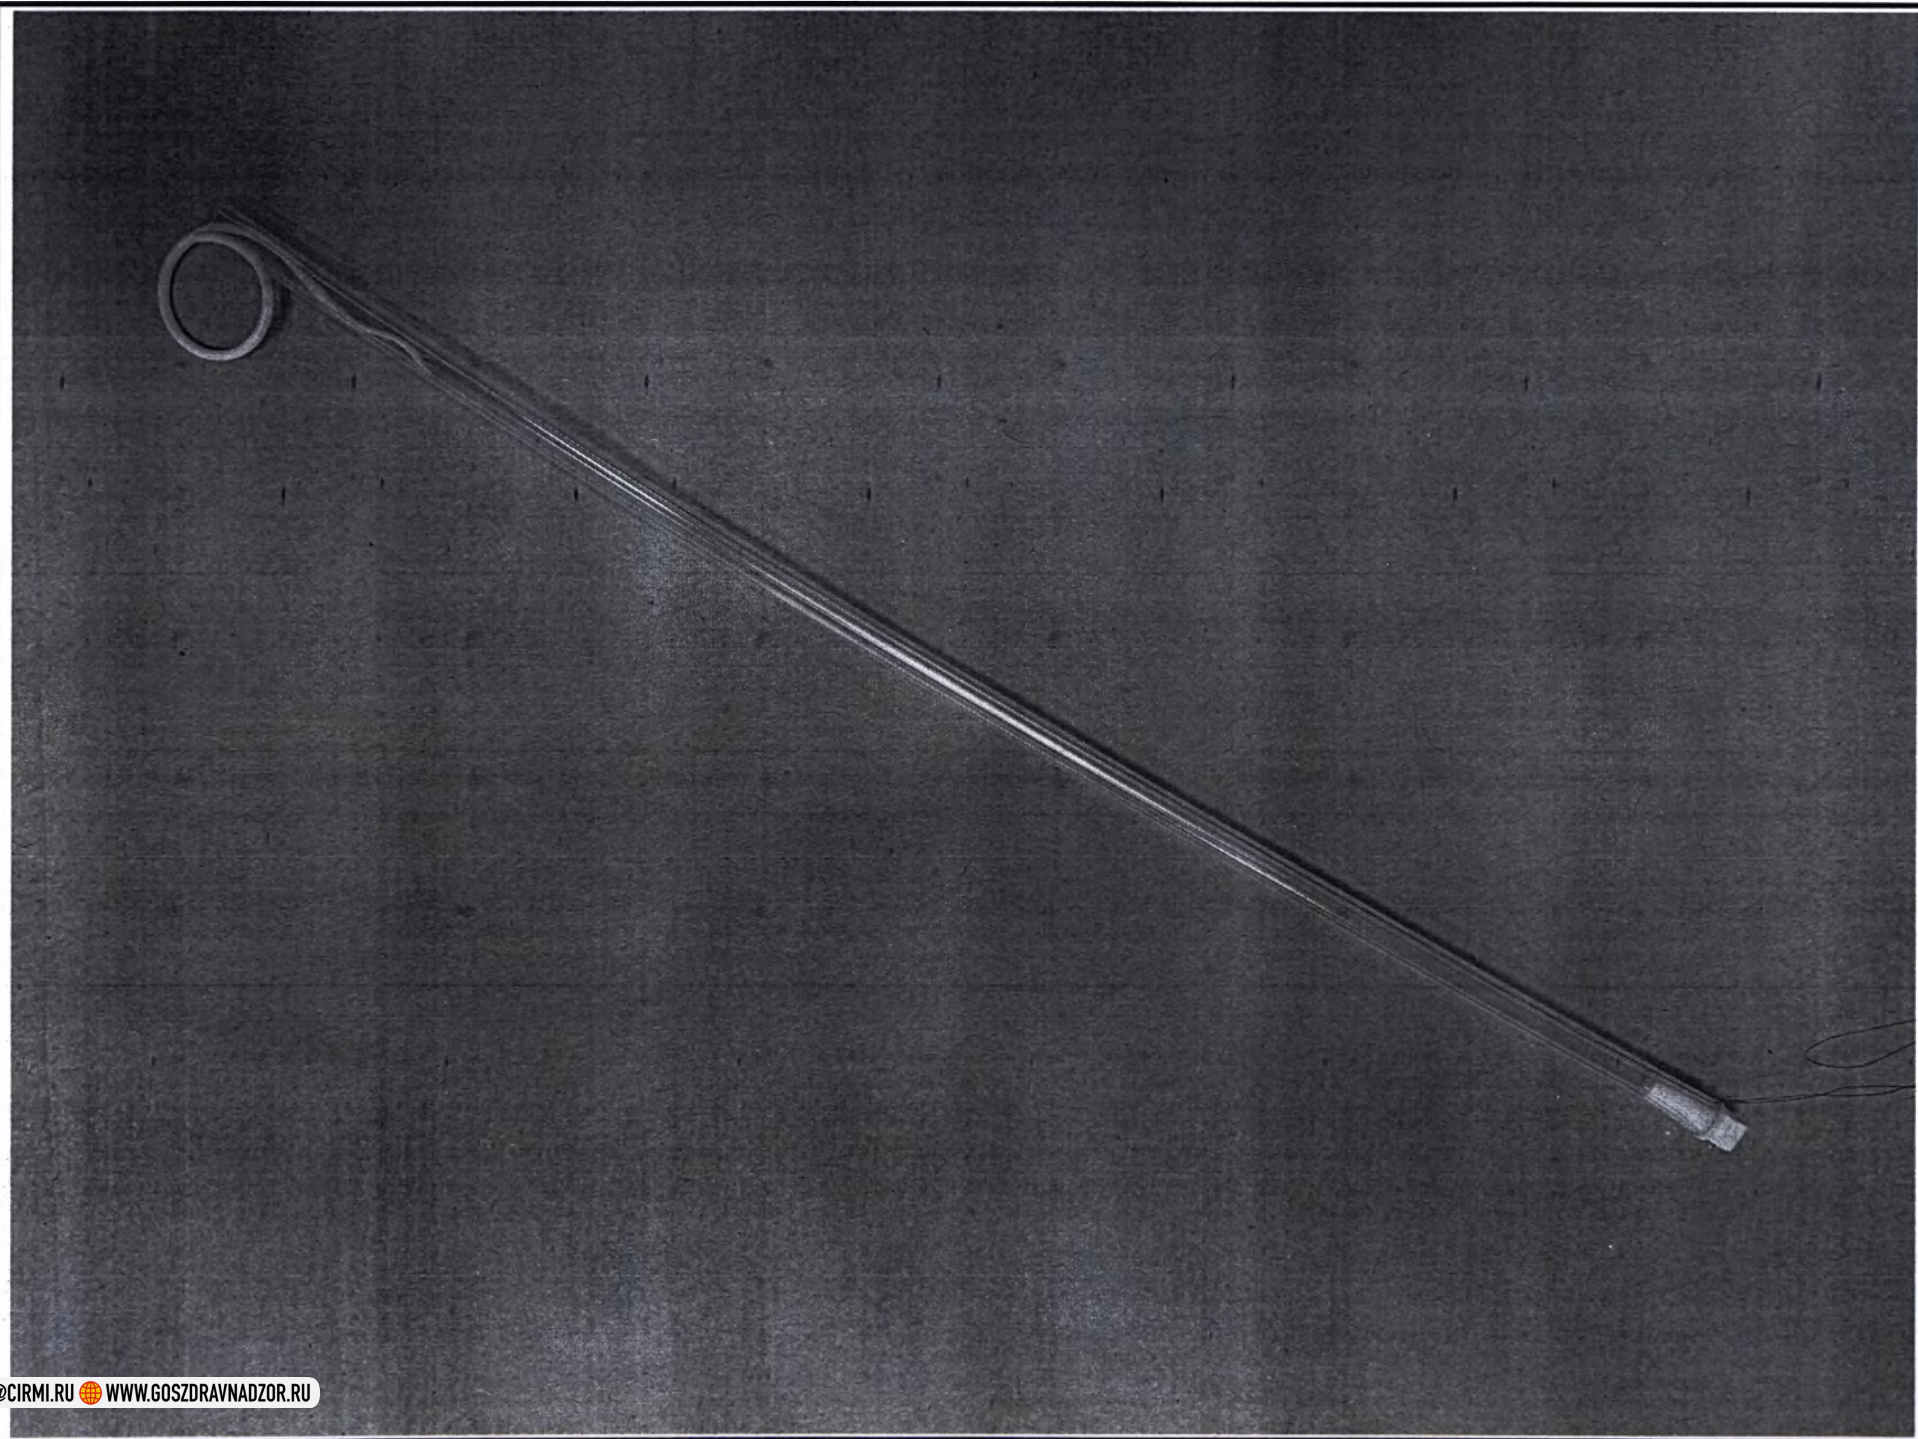

2. Толкатель простой, диаметром 5 Fr (1,67 мм), длиной 70 см – 1 шт.

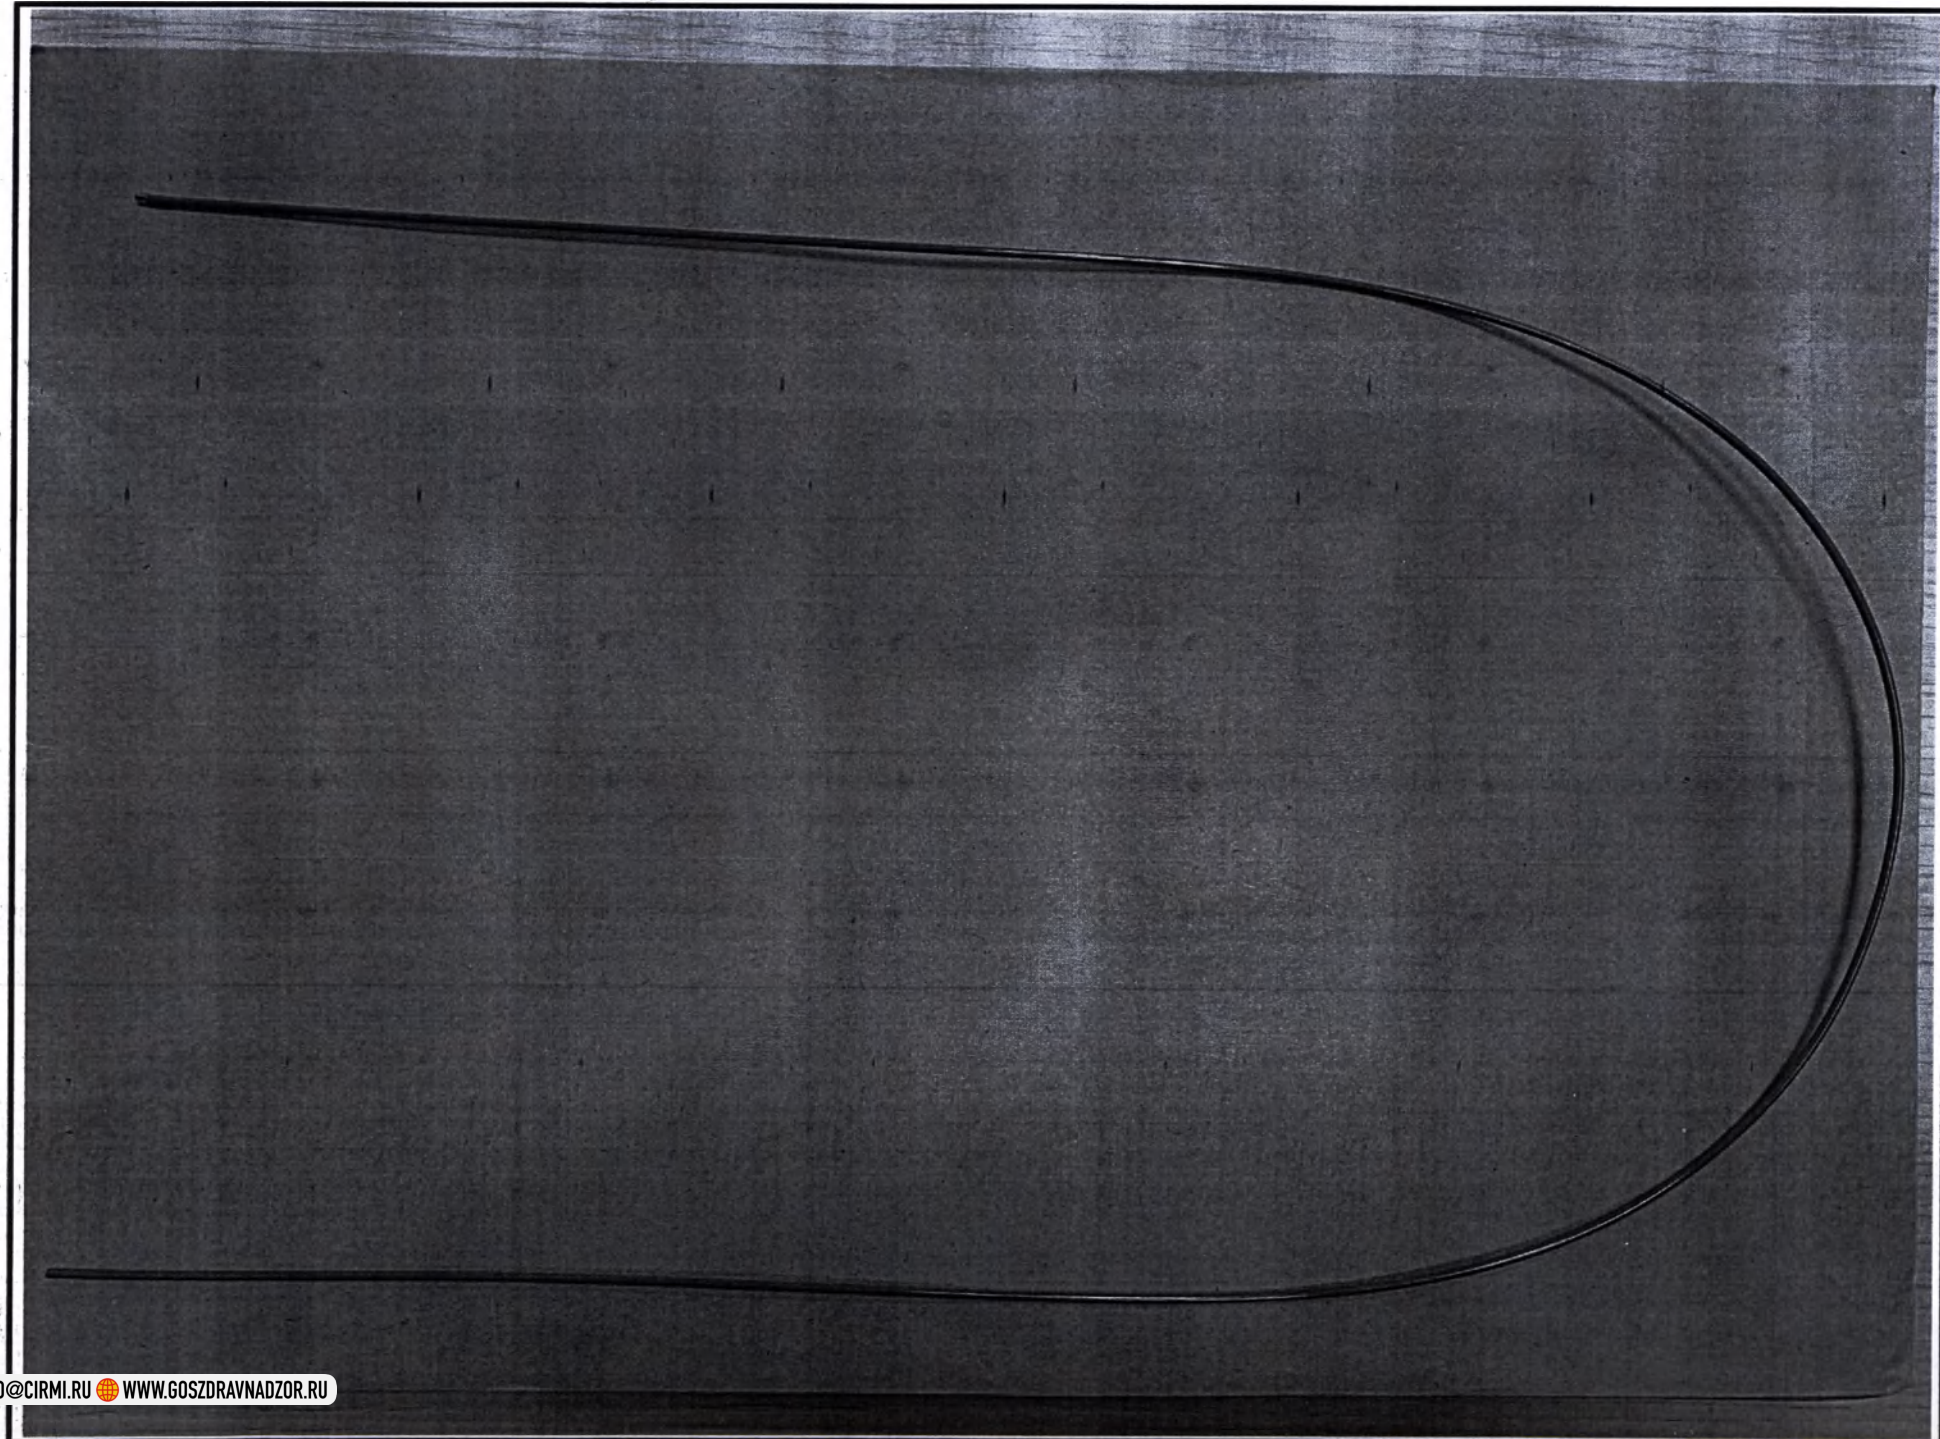

3. Карта пациента – 1 шт.

КАРТА ПАЦИЕНТА	
Имя пациента :	
Имя врача :	
Номер телефона врача :	
☐	
Дата размещения :	
Запланированная дата удаления :	
Последняя дата удаления :	
Код продукта :	Сторона : Л / Р
Номер лота :	

ROCAMED**Jfil & MiniJfil Ureteral
Suture Stents**

EN	INSTRUCTIONS FOR USE
FR	MODE D'EMPLOI
ES	MODO DE EMPLEO
PT	INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
IT	ISTRUZIONI PER L'USO
DE	GEBRAUCHSANWEISUNG
NL	GEbruikSAANWIJZING
SV	BRUKSANVISNING
RU	Инструкция по использованию
AR	طريقة الاستعمال

NOTE-RO.IV – Ind.01
15-01-2020

ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА
ЗАО «СЭИДЖ» А.В. ЮРЬЕВ
ДОВ № 20 от 28.05.2014



Всего прошнуровано
скреплено 34 листа