

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Лаборатория Кузнецова»

И.И. Ахметова



2018 г.

Фотографии упаковки с этикеткой

«МАССАЖЕРЫ МЕДИЦИНСКИЕ ТУ 32.50.13-002-59794024-2018»

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» на мягкой подложке, размерный ряд: 7х8 см (Цветок), в исполнение: красный

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведения об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23



МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ

магнитный на мышечной подложке


**ТИБЕТСКИЙ
АППЛИКАТОР**

подложке 7x8 см (Цветок) красный

4

Хранить при t от +5 до +40°
Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления медицинского изделия,
ТУ 32.50.13-002-99794024-2018
РУ №РЭН 2017 /5774
ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва, набережная Тараса
корпус 2, комнаты 14, 15, 21, часть 21

Дата изготовления:

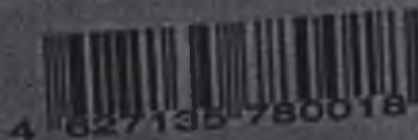

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» на мягкой подложке, размерный ряд: 7х8 см (Цветок), в исполнение: желтый

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23



ЛАБОРАТОРИЯ КУЗНЕЦОВА



МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ
на мягкой подложке

ТИБЕТСКИЙ
АППЛИКАТОР

7x8 см (Цветок)

магнитный желтый

7

Хранить при t от +5 до +40°
Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления медицинского изделия.

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018
РУ №РЭН 2017 /5774

ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121141 Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 4
корпус 2, комнаты 14, 15, 21, часть 23

Дата изготовления:



4 627135 780018

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» на мягкой подложке, размерный ряд: 7х8 см (Цветок), в исполнение: желтый эластичный.

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3,корп.2, комнаты 14,15,21,часть 23



ЛАБОРАТОРИЯ КУЗНЕЦОВА



МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ
мягкой подложке

ТИБЕТСКИЙ АППЛИКАТОР


7x8 см (Цветок)

магнитный желтый эластичный

01

Хранить при t от +5 до +40°
Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления медицинского изделия,
ТУ 32.50.13-002-59794024-2018
РУ №РЭН 2017 /5774
ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 3,
корпус 2, комнаты 14, 15, 21, часть 23

Дата изготовления:

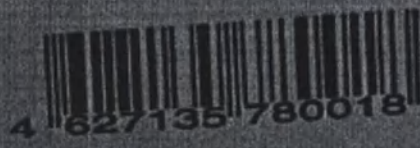

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» на мягкой подложке, размерный ряд: 7х 11 см (Дорожный)

в исполнение: красный

Дата изготовления

_____ « _____ » 20 ____ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведения об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23


ЛАБОРАТОРИЯ КУЗНЕЦОВА

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ
мягкой подложке

**ТИБЕТСКИЙ
АППЛИКАТОР**

7x11 см (Дорожный)
магнитный красный

Хранить при t от +5 до +40°

Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления МИ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ №РЭН 2017 /5774

ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 3,
корпус 2, комнаты 14, 15, 21, часть 23

Дата изготовления:



4 627135 780018

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» на мягкой подложке, размерный ряд: 7х 11 см (Дорожный)

в исполнение: желтый

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведения об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23



ЛАБОРАТОРИЯ КУЗНЕЦОВА



МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ
мягкой подложке

ТИБЕТСКИЙ АППЛИКАТОР

7x11 см (Дорожный)
магнитный желтый

Хранить при t от +5 до +40°

Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления МИ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ №РЭН 2017 /5774

ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 3,
корпус 2, комнаты 14, 15, 21, часть 23

Дата изготовления:



4 627135 780018

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» на мягкой подложке, размерный ряд: 7х 11 см (Дорожный)

в исполнение: желтый эластичный.

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3,корп.2, комнаты 14,15,21,часть 23



МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ
 мягкой подложке

ТИБЕТСКИЙ
АППЛИКАТОР

7x11 см (Дорожный)

магнитный желтый эластичный

Хранить при t от +5 до +40°

Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления МИ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ №РЭН 2017 /5774

ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 3,
корпус 2, комнаты 14, 15, 21, часть 23

Дата изготовления:



4 627135 780018

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

**Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» на мягкой подложке, размерный ряд: 12х22 см,
в исполнение: красный.**

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3,корп.2, комнаты 14,15,21,часть 23

20

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ


ТУБЕТОКСИЙ АППЛИКАТОР

НА МЯГКОЙ ПОДЛОЖКЕ 12 x 22 см

красный



www.kuznecov-lab.ru

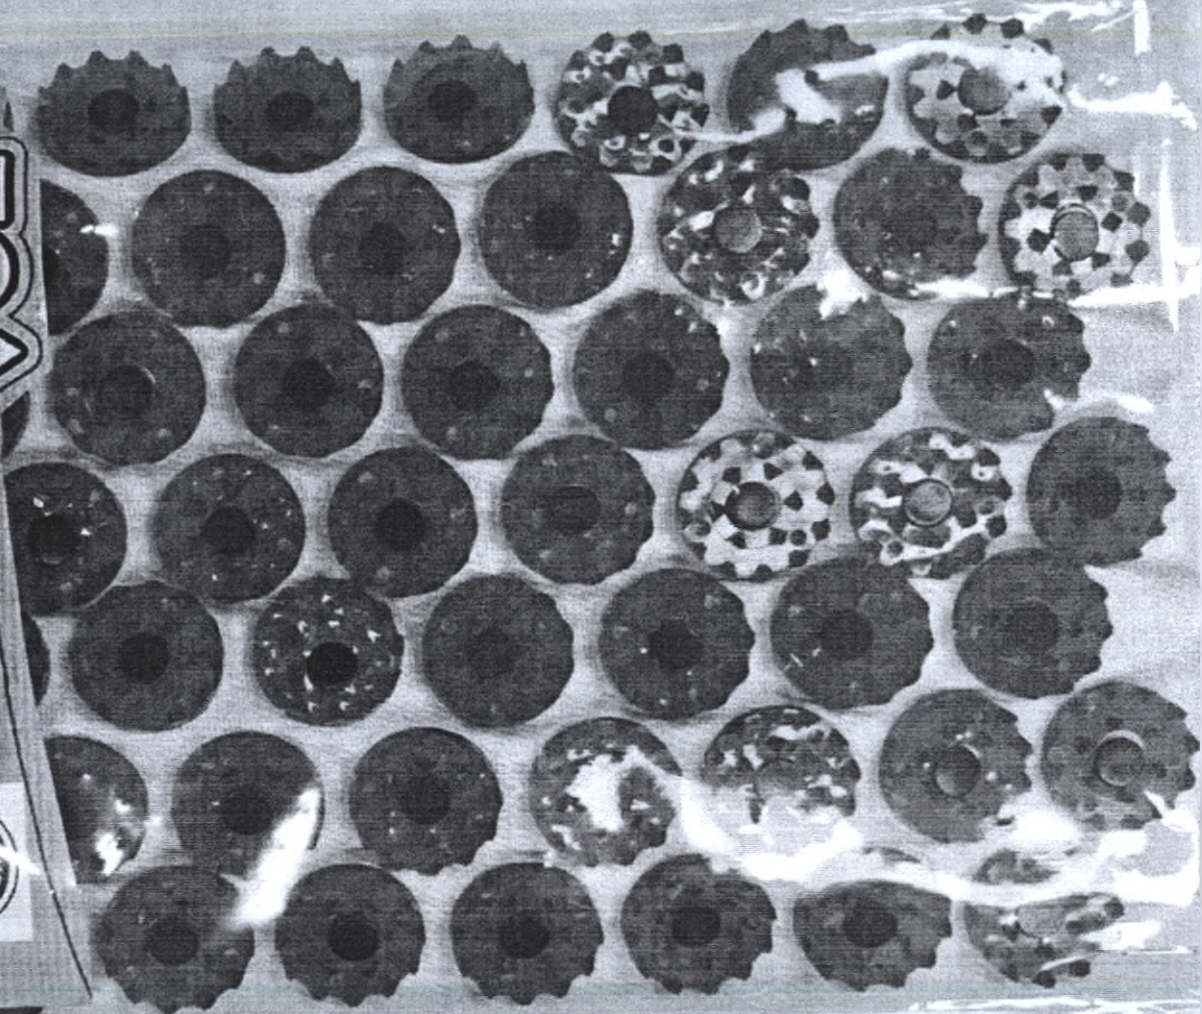

ПРЕИМУЩЕСТВА ТИБЕТСКОГО АППАРАТА:

- В зависимости от остроты игл можно подобрать аппаратор в зависимости от индивидуальной чувствительности и способа (силы) прижатия аппарата к поверхности тела.
- В аппарате двойное острие иглы (соответствие с древонитовой иглой), двойное острие предотвращает соскальзывание иглы с кожи, делает лечебную процедуру более эффективной и эффективной.
- Специальные магнитные элементы усиливают лечебный эффект (благодаря дополнительному воздействию постоянным магнитным полем (иглы) (только в красные и желтые коллоидные элементы)).
- Накладка обеспечивает равномерное прижатие игл и делает аппарат более удобным.
- Каждый элемент изготовлен из качественного полимерного материала и прочно закреплен на ткани с помощью термической накладки.

Внимание! Противопоказания к применению:
Состояние беременности и период лактации в первом и втором триместре и в третьем триместре, гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, заболевания органов пищеварения, заболевания органов мочеполовой системы, заболевания органов движения, заболевания органов зрения, заболевания органов слуха, заболевания органов обоняния, заболевания органов вкуса, заболевания органов осязания, заболевания органов мышечной системы, заболевания органов нервной системы, заболевания органов эндокринной системы, заболевания органов иммунной системы, заболевания органов репродуктивной системы, заболевания органов выделительной системы, заболевания органов опорно-двигательной системы, заболевания органов кровообращения, заболевания органов дыхания, заболевания органов пищеварения, заболевания органов мочеполовой системы, заболевания органов движения, заболевания органов зрения, заболевания органов слуха, заболевания органов обоняния, заболевания органов вкуса, заболевания органов осязания, заболевания органов мышечной системы, заболевания органов нервной системы, заболевания органов эндокринной системы, заболевания органов иммунной системы, заболевания органов репродуктивной системы, заболевания органов выделительной системы, заболевания органов опорно-двигательной системы, заболевания органов кровообращения.

Эффективность иглового массажа зависит от правильного выбора массажера



На мягкой подложке 12 x 22 см



На мягкой подложке 17 x 28 см



На мягкой подложке 41 x 60 см

Наибольшее количество игл находится на мягкой подложке, которая позволяет прижать иглы к различным частям тела (голова, туловище, руки, ноги и т.д.). При этом можно выбрать, сколько игл использовать для этой части тела (41 x 60 см), но эффект будет значительно более выраженным.



Мягкий валик для шеи



Мягкий валик для поясницы

Мягкий валик, не упругость, а тонкая острота игл тщательно подобрана, чтобы обеспечить мягкое давление на кожу и равномерное давление на кожу. В результате иглового массажа, если вы используете особенно эффективные иглы и валики.



На мягкой подложке 12 x 22 см



На мягкой подложке для ступней

Лечебный массажный аппарат имеет форму, которая позволяет использовать его для массажа различных частей тела (голова, туловище, руки, ноги и т.д.). При этом можно выбрать, сколько игл использовать для этой части тела (41 x 60 см), но эффект будет значительно более выраженным.

Игло-массажный аппарат имеет форму, которая позволяет использовать его для массажа различных частей тела (голова, туловище, руки, ноги и т.д.). При этом можно выбрать, сколько игл использовать для этой части тела (41 x 60 см), но эффект будет значительно более выраженным.

Большой современный аппаратный массажер. Способен оказывать мощное лечебное и профилактическое действие. Благодаря большому количеству игл (расположенных на поверхности) и мягкому давлению на кожу, эффективно воздействует на большинство мышц, суставов, связок, сухожилий, бедер, ступней. Он также может использоваться для массажа всего тела (с помощью валика, соединяющего аппарат из нескольких частей). Уникальная накладка обеспечивает максимальный уровень комфорта и равномерное прижатие игл. Отличается уникальным дизайном и качеством изготовления (ткань, АИ/Кроме), поставляется в картонном чехоли.

Зеленые и красные коллоидные элементы имеют менее острые иглы, синие и желтые – более острые. При выборе остроты игл можно учитывать индивидуальную чувствительность, способ (силу) прижатия аппарата к поверхности тела, а также свойства мягкой подложки (упругость, толщину). Красные и желтые коллоидные элементы оказывают дополнительное лечебное воздействие постоянным магнитным полем.

Цвет	●	●	●	●
Форма игл	▲	▲	▲	▲
Напит	нет	да	нет	да

Узнайте больше на www.kuznetsov-lab.ru

Применять при 17°С до +40°С
Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления
Масштабное издание: 19.11.10 31-002-0994024-2018
Регистрационное удостоверение №РЗН 2017/1574
ООО «Лаборатория Кузнецовых», Россия, 121248 Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 3, корпус 2, комнаты 34, 35, 27, часть 23



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» на мягкой подложке, размерный ряд: 12х22 см,

в исполнение:желтый

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет


Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3,корп.2, комнаты 14,15,21,часть 23

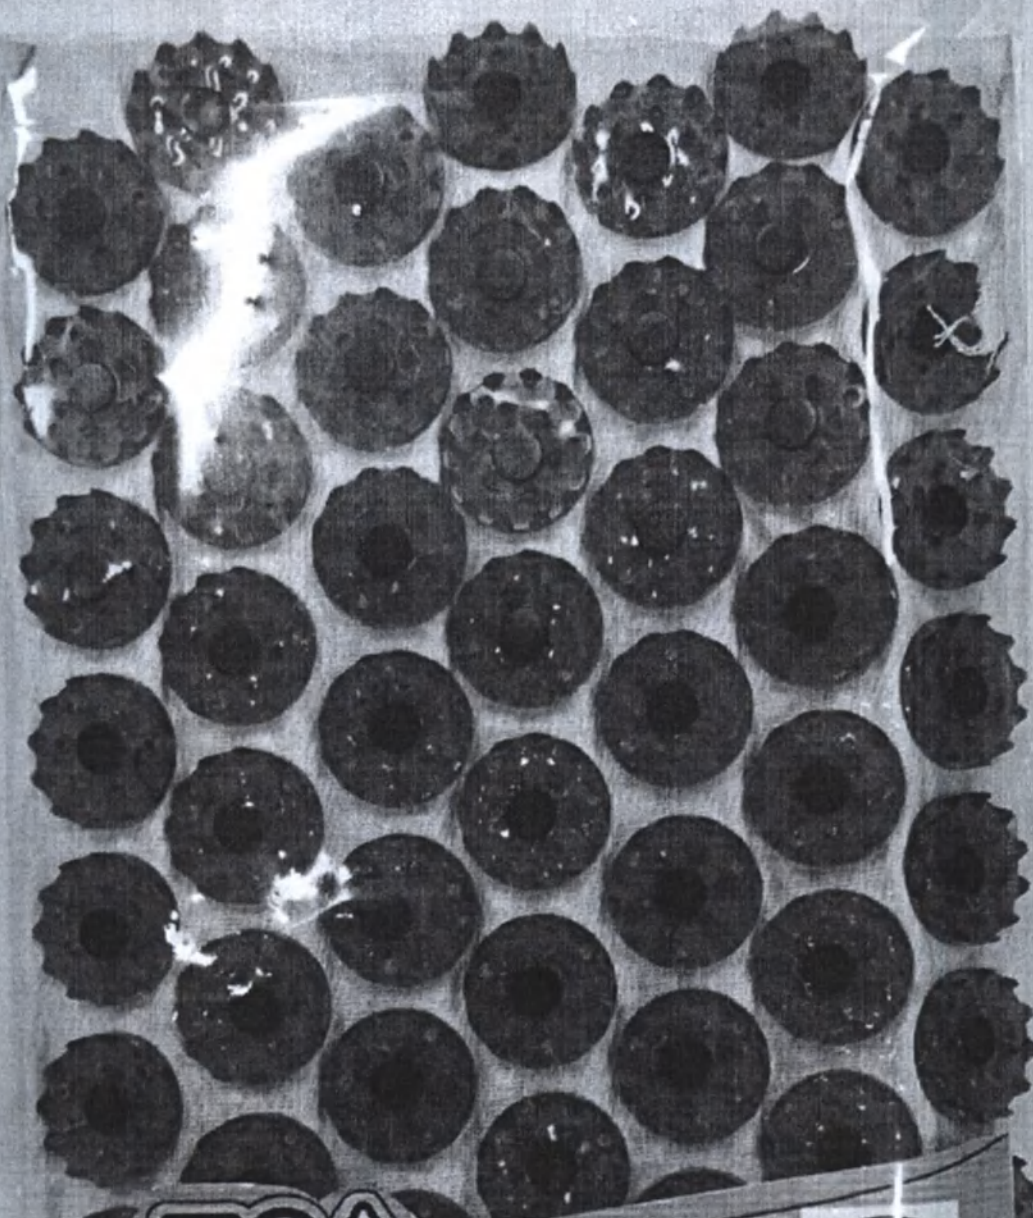

ЛАБОРАТОРИЯ КУЗНЕЦОВА



www.kuznetsov-lab.ru

ТИБЕТСКИЙ АППЛИКАТОР

НА МЯГКОЙ ПОДЛОЖКЕ 12 x 22 см
МАГНИТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ

ИЗВЕЩА ТИШЕТОРИ

[illegible]

ПУНКАТОРА:

можно подобрать значения α и β в зависимости от количества и способа (табл.) применения

а сочетаются с дригунитовыми
кислыми. Давное время явля-
ется в нем, давая значительную

И Сид...
(Сид...)
И Мит...
И Сид...
И Мит...
И Сид...
И Мит...

Department of Chemistry, University of


[illegible]

* *Extrapolation au maximum de la durée*

30. **Эффективность иглоукачивающего массажа зависит от правильного выбора массажера**



Size 8 x 12 cm



На шпигель подложка 17 x 28 см
подложка из картона/дерева



**Control system gets new
measured output**



РАТКИЕ ВАШИ ДАЯ ПОСОНЦЫ
НАПОНАЕ АННОУ



1/2" MARTIN MILLER 42 x 60 cm
 1/2" MARTIN MILLER 42 x 60 cm
 1/2" MARTIN MILLER 42 x 60 cm

[illegible]

в мягкой подложке для ступней
элегантный красный

Важной составляющей комфортабельности является эргономичность. Специалисты считают, что наиболее эффективны в эргономическом отношении изделия, имеющие подлокотники для расслабления (раслабления) или поддержания позы. С этой задачей очень успешно справляется водонепроницаемый материал, который не пропускает влаги, а также обеспечивает эластичность для массажа спины и шеи. Водонепроницаемые материалы, такие как винил, ПВХ, нейлон, износостойки и долговечны. Утолщенные участки обеспечивают максимальный уровень комфорта и равномерное прикрытие шва. Отличается износостойкостью и качеством изготовления (такие как хлопок), поставляется в картонном чехле.

Зеленые и красные волосные элементы имеют менее острые иглы, синие и желтые – более острые. При выборе остроты игл нужно учитывать индивидуальную чувствительность, способ (силу) прижатия аппликатора к поверхности тела, а также свойства мягкой подложки (упругость, толщину). Красные и желтые волосные элементы оказывают дополнительное лечебное воздействие постоянным магнитным полем.

Цвет	●	●	●	●
Форма ир	▲	▲	▲	▲
Магнит	НЕТ	ДА	НЕТ	ДА

Узнайте больше на www.kuznetsov-lab.ru

Партийный срок годности 5 лет со дня изготовления
Медицинское изделие. ТУ 32.50.11-002-59794024-2018
Регистрационное удостоверение №РН 2017/5574
000 «Клиника» Кузнецова, Россия, 121248 Москва, набережная Тараса
Шевченко, дом 3, корпус 2, комнаты 34, 15, 21, часть 23

Дата изготовления



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

**Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» на мягкой подложке, размерный ряд: 12х22 см,
в исполнение: желтый эластичный.**

Дата изготовления

_____ « _____ » 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» на мягкой подложке, размерный ряд 17x28 см

в исполнениях: красный

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23



ЛАБОРАТОРИЯ КУЗНЕЦОВА



ТИБЕТСКИЙ АППЛИКАТОР

НА МЯГКОЙ ПОДЛОЖКЕ 17 x 28 см
магнитный красный

www.kuznetsov-lab.ru

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА ТИПОВЫХ МАССАЖЕРОВ

Для верного эффекта от массажа необходимо подобрать аппарат в зависимости от индивидуальных особенностей организма и состояния (состояния) организма.

В отличие от ручного массажа, аппаратный массаж позволяет воздействовать на организм человека с помощью электрических импульсов, что способствует улучшению кровообращения и лимфодренажа, а также оказывает обезболивающее действие.

В отличие от ручного массажа, аппаратный массаж позволяет воздействовать на организм человека с помощью электрических импульсов, что способствует улучшению кровообращения и лимфодренажа, а также оказывает обезболивающее действие.

После массажа и использования аппарата:

- Снимается нервное напряжение;
- Улучшается кровообращение;
- Улучшается состояние кожи;
- Улучшается состояние суставов;
- Улучшается состояние мышц;
- Улучшается состояние нервной системы;
- Улучшается состояние органов дыхания;
- Улучшается состояние органов пищеварения;
- Улучшается состояние органов мочеполовой системы;
- Улучшается состояние органов репродуктивной системы;
- Улучшается состояние органов чувств;
- Улучшается состояние органов движения;
- Улучшается состояние органов дыхания;
- Улучшается состояние органов пищеварения;
- Улучшается состояние органов мочеполовой системы;
- Улучшается состояние органов репродуктивной системы;
- Улучшается состояние органов чувств;
- Улучшается состояние органов движения;

Эффективность иглоукалывательного массажа зависит от правильного выбора массажера



На иглоукалывательный массаж 12 и 22 см



На иглоукалывательный массаж 12 и 22 см



На иглоукалывательный массаж 12 и 22 см



На иглоукалывательный массаж 12 и 22 см



На иглоукалывательный массаж 12 и 22 см



На иглоукалывательный массаж 12 и 22 см

В отличие от ручного массажа, аппаратный массаж позволяет воздействовать на организм человека с помощью электрических импульсов, что способствует улучшению кровообращения и лимфодренажа, а также оказывает обезболивающее действие.




На иглоукалывательный массаж 12 и 22 см



На иглоукалывательный массаж 12 и 22 см

На иглоукалывательный массаж 12 и 22 см

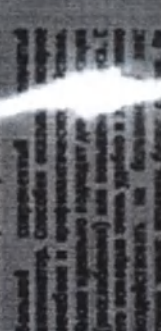

На иглоукалывательный массаж 12 и 22 см

В отличие от ручного массажа, аппаратный массаж позволяет воздействовать на организм человека с помощью электрических импульсов, что способствует улучшению кровообращения и лимфодренажа, а также оказывает обезболивающее действие.

В отличие от ручного массажа, аппаратный массаж позволяет воздействовать на организм человека с помощью электрических импульсов, что способствует улучшению кровообращения и лимфодренажа, а также оказывает обезболивающее действие.


В отличие от ручного массажа, аппаратный массаж позволяет воздействовать на организм человека с помощью электрических импульсов, что способствует улучшению кровообращения и лимфодренажа, а также оказывает обезболивающее действие.

В отличие от ручного массажа, аппаратный массаж позволяет воздействовать на организм человека с помощью электрических импульсов, что способствует улучшению кровообращения и лимфодренажа, а также оказывает обезболивающее действие.

В отличие от ручного массажа, аппаратный массаж позволяет воздействовать на организм человека с помощью электрических импульсов, что способствует улучшению кровообращения и лимфодренажа, а также оказывает обезболивающее действие.

Узнайте больше на www.kupicov-lab.ru

Дистрибуция: ООО «ЦИРМИ»
 Адрес: Москва, ул. Мясницкая, д. 15, стр. 23
 Контакт: +7 (495) 123-45-67
 E-mail: info@cirmi.ru
 Сайт: www.goszdravnadzor.ru

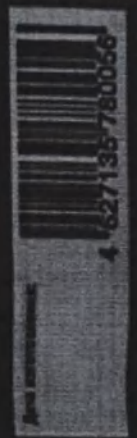

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» на мягкой подложке, размерный ряд 17x28 см

в исполнениях: желтый

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет


Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23

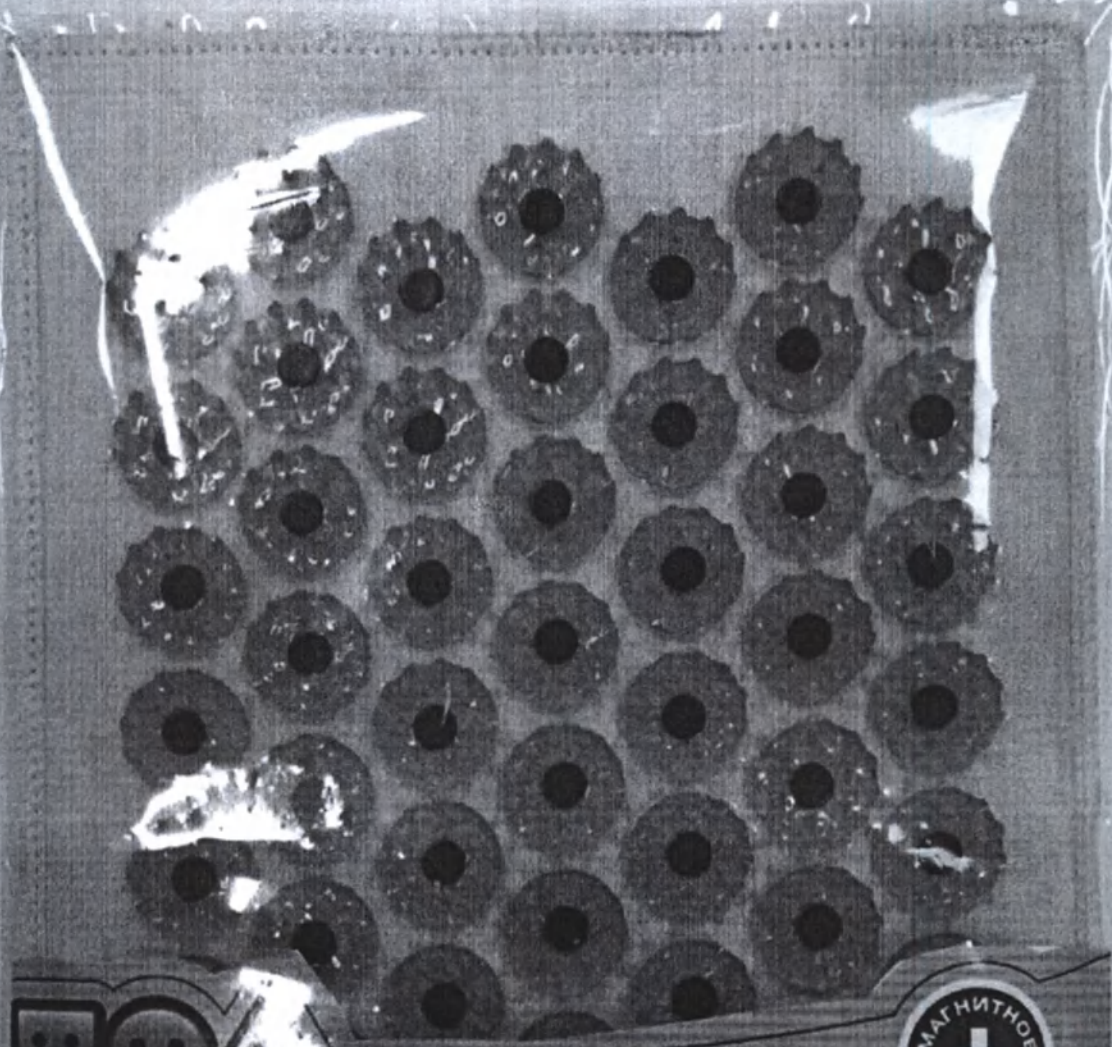

www.kuznetsov-lab.ru

ТИБЕТСКИЙ АППЛИКАТОР

НА МЯГКОЙ ПОДЛОЖКЕ 17 x 28 см
магнитный желтый – более острые иголки

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ

[illegible]

Year	1990	1991	1992	1993	1994
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2

Содержание

HQ L-9 Is the construction program being



...the ...



***www.pitt.edu/~newscenter/**

prezide grammatik



Continued on page 100

on-site and/or remote location, please call 1-800-451-7243



Das zweite Kriterium lautet: „Die
Anzahl der in der Studie
eingeschlossenen Personen
muss groß genug sein, um
die Ergebnisse zu verallgemeinern.“



© 2006 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 260: 105–112

... ..



... (1992) ...

FOR THE RECORD



...и в настоящее время. В настоящее время в нашей стране...

IV-401

[illegible]

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

**Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» на мягкой подложке, размерный ряд 17x28 см
в исполнениях: желтый эластичный.**

Дата изготовления

_____ « _____ » 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведения об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» на мягкой подложке, размерный ряд 31x41 см

в исполнениях: красный

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведения об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23


ТИБЕТСКИЙ АППЛИКАТОР

МАГНИТНЫЙ НА МЯГКОЙ ПОДЛОЖКЕ

31x41 CM

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ

- Снятие болей
- Расслабляющее действие
- Тонизирующее действие
- Улучшение кровообращения

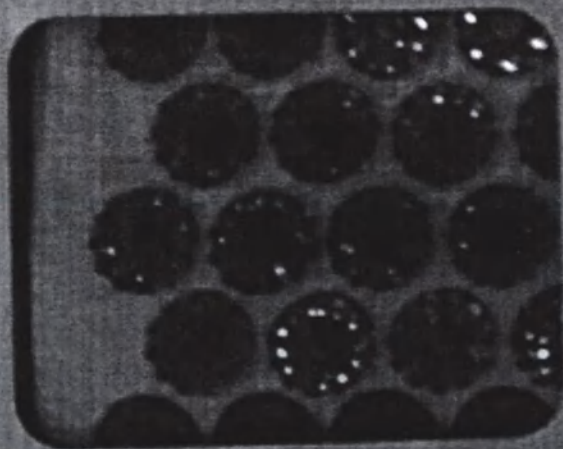


Доказано жизнью!

**МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ
ТИБЕТСКИЙ
АППЛИКАТОР**

**МАГНИТНЫЙ
НА МЯГКОЙ ПОДЛОЖКЕ**

31x41



***Красный – менее
острые иглы***



***Желтый – более
острые иглы***

Хранить при t от +5 до +40°

Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ №РЗН 2017/5774

ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва

набережная Тараса Шевченко, дом 3, корпус 2, комнаты
14, 15, 21, часть 23



4 627135 780117

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» на мягкой подложке, размерный ряд 31x41 см

в исполнениях:желтый

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведения об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3,корп.2, комнаты 14,15,21,часть 23


ТИБЕТСКИЙ АППЛИКАТОР

МАГНИТНЫЙ НА МЯГКОЙ ПОДЛОЖКЕ

31x41 CM

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ

- Снятие болей
- Расслабляющее действие
- Тонизирующее действие
- Улучшение кровообращения

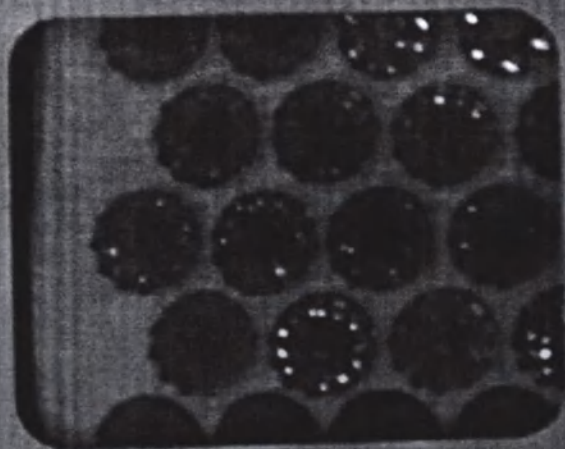


ДОКАЗАНО ЖИЗНЬЮ!

44


**МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ
ТИБЕТСКИЙ
АППЛИКАТОР**

**МАГНИТНЫЙ
НА МЯГКОЙ ПОДЛОЖКЕ**

31x41



***Красный – менее
острые иглы***



***Желтый – более
острые иглы***

Хранить при t от +5 до +40°

Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ №РЗН 2017/5774

ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва
набережная Тараса Шевченко, дом 3, корпус 2, комнаты
14, 15, 21, часть 23



4 627135 780117

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» на мягкой подложке, размерный ряд 31x41 см

в исполнениях: желтый эластичный.

Дата изготовления

_____ « _____ » 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3,корп.2, комнаты 14,15,21,часть 23


ЭЛАСТИЧНЫЙ (+) ТИБЕТСКИЙ АППЛИКАТОР

МАГНИТНЫЙ НА МЯГКОЙ ПОДЛОЖКЕ

31x41 CM

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ

- Снятие боли
- Расслабляющее действие
- Тонизирующее действие
- Улучшение кровообращения

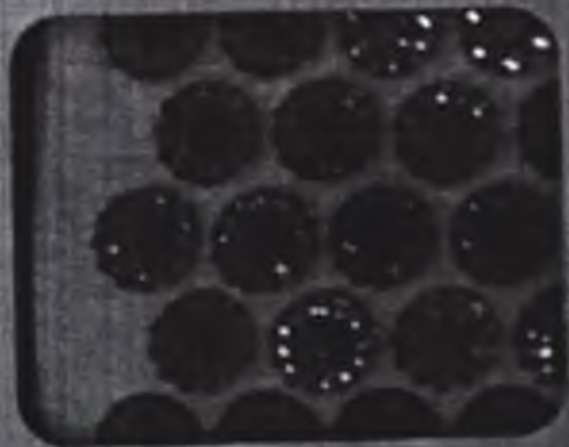

Доказано жизнью!

48

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ
ТИБЕТСКИЙ
АППЛИКАТОР

МАГНИТНЫЙ
НА МЯГКОЙ ПОДЛОЖКЕ

31x41



*Красный – менее
острые иглы*



*Желтый – более
острые иглы*

Хранить при t от +5 до +40°

Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ №РЗН 2017 /5774

ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва
набережная Тараса Шевченко, дом 3, корпус 2, комнаты
14, 15, 21, часть 23



4 627135 780117

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» на мягкой подложке, размерный ряд 41х 60 см

в исполнениях: красный

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведения об изготовителе


121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3,корп.2, комнаты 14,15,21,часть 23

ТИБЕТСКИЙ АППЛИКАТОР

МАГНИТНЫЙ НА МЯГКОЙ ПОДЛОЖКЕ
41 X 60 CM

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ

- Снятие болей
- Расслабляющее действие
- Тонизирующее действие
- Улучшение кровообращения

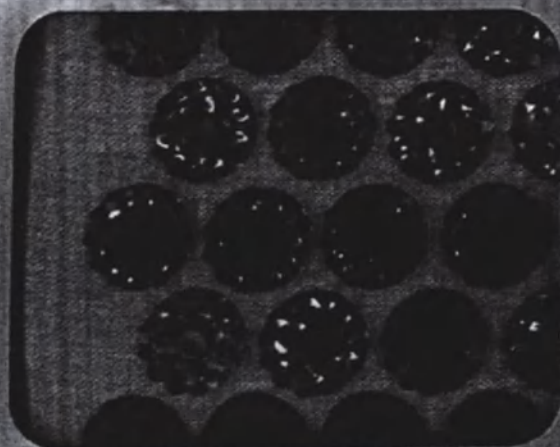

Доказано жизнью!

Иглы с двойным острием

**МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ
ТИБЕТСКИЙ
АППЛИКАТОР**

**МАГНИТНЫЙ
НА МЯГКОЙ ПОДЛОЖКЕ
41 X 60 CM**



**Красный – менее
острые иглы**



**Желтый – более
острые иглы**

Хранить при t от +5 до +40°

Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ №РЗН 2017/5774

ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва
набережная Тараса Шевченко, дом 3, корпус 2, комнаты
14, 15, 21, часть 23



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» на мягкой подложке, размерный ряд 41х60 см

в исполнениях: желтый

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведения об изготовителе


121148, Россия, Москва, набережная Трасса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23

ТИБЕТСКИЙ АППЛИКАТОР

МАГНИТНЫЙ НА МЯГКОЙ ПОДЛОЖКЕ
41 X 60 CM

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ

- Снятие болей
- Расслабляющее действие
- Тонизирующее действие
- Улучшение кровообращения

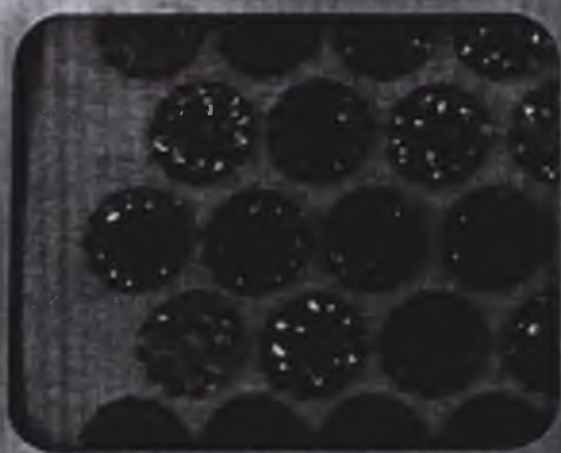

Иглы с двойным острием



Доказано жизнью!

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ
ТИБЕТСКИЙ
АППЛИКАТОР

МАГНИТНЫЙ
НА МЯГКОЙ ПОДЛОЖКЕ
41 X 60 CM



*Красный – менее
острые иглы*



*Желтый – более
острые иглы*

Хранить при t от +5 до +40°

Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления

TU 32.50.13-002-59794024-2018

РУ №РЗН 2017/5774

ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва
набережная Тараса Шевченко, дом 3, корпус 2, комнаты
14, 15, 21, часть 23



4 627135 780117

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

**Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» на мягкой подложке, размерный ряд 41х 60 см
в исполнениях: желтый эластичный.**

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе


121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23

ЭЛАСТИЧНЫЙ ТИБЕТСКИЙ АППЛИКАТОР

МАГНИТНЫЙ НА МЯГКОЙ ПОДЛОЖКЕ
41 X 60 CM

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ

- Снятие болей
- Расслабляющее действие
- Тонизирующее действие
- Улучшение кровообращения

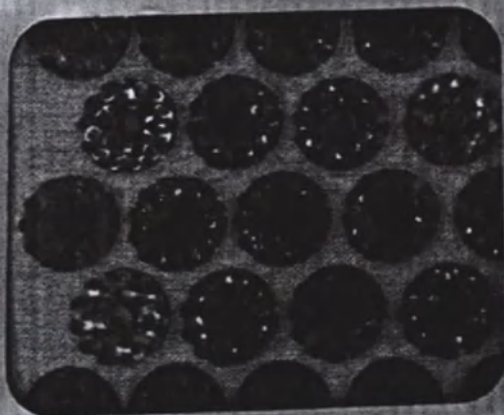

Иглы с двойным острием



Доказано жизнью!

60

**МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ
ТИБЕТСКИЙ
АППЛИКАТОР**

**МАГНИТНЫЙ
НА МЯГКОЙ ПОДЛОЖКЕ
41 X 60 CM**



***Красный – менее
острые иглы***



***Желтый – более
острые иглы***


Хранить при t от +5 до +40°

Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ №РЗН 2017 /5774

ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва
набережная Тараса Шевченко, дом 3, корпус 2, комнаты
14, 15, 21, часть 23

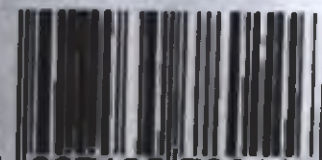

4 627135 780117

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

**Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» на мягкой подложке, размерный ряд 41х 117 см
в исполнениях: красный**

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведения об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3,корп.2, комнаты 14,15,21,часть 23


62

ТИБЕТСКИЙ АППЛИКАТОР

МАГНИТНЫЙ НА МЯГКОЙ ПОДЛОЖКЕ
41x117 CM

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ

- Снятие болей
- Расслабляющее действие
- Тонизирующее действие
- Улучшение кровообращения

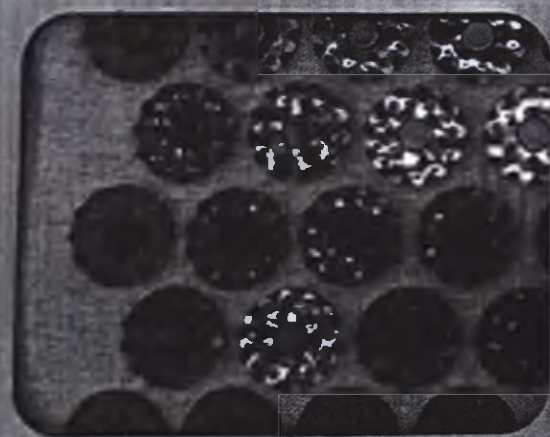

Мат с двойным острием



Доказано жизнью!

84

**МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ
ТИБЕТСКИЙ
АППЛИКАТОР**

**МАГНИТНЫЙ
НА МЯГКОЙ ПОДЛОЖКЕ**

41x117



**Красный – менее
острые иглы**



**Желтый – более
острые иглы**

Хранить при t от +5 до +40°

Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ №РЗН 2017 /5774

ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва
набережная Тараса Шевченко, дом 3, корпус 2, комнаты
14, 15, 21, часть 23



4 627135 780117

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» на мягкой подложке, размерный ряд 41x117 см

в исполнениях: желтый

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе


121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23

ТИБЕТСКИЙ АППЛИКАТОР

МАГНИТНЫЙ НА МЯГКОЙ ПОДЛОЖКЕ
41x117 CM

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ

- Снятие болей
- Расслабляющее действие
- Тонизирующее действие
- Улучшение кровообращения

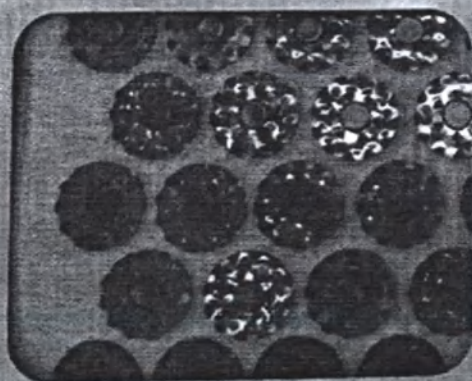

Иглы с двойным острием



Доказано жизнью!

68

**МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ
ТИБЕТСКИЙ
АППЛИКАТОР**

**МАГНИТНЫЙ
НА МЯГКОЙ ПОДЛОЖКЕ**

41x117



***Красный – менее
острые иглы***



***Желтый – более
острые иглы***

Хранить при t от +5 до +40°

Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ №РЗН 2017 /5774

ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва,
набережная Тараса Шевченко, дом 3, корпус 2, комнаты
14, 15, 21, часть 23



4 627135 780117

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» на мягкой подложке, размерный ряд 41х 117 см

в исполнениях: желтый эластичный.

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе


121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3,корп.2, комнаты 14,15,21,часть 23

ЭЛАСТИЧНЫЙ ТИБЕТСКИЙ АППЛИКАТОР

МАГНИТНЫЙ НА МЯГКОЙ ПОДЛОЖКЕ
41x117 CM

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ

- Снятие болей
- Расслабляющее действие
- Тонизирующее действие
- Улучшение кровообращения

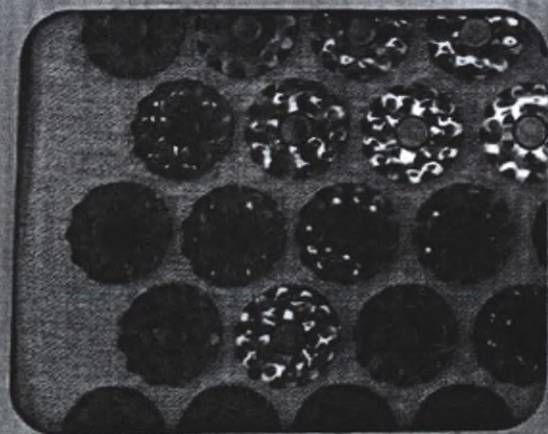

Иглы с двойным острием



Доказано жизнью!

72

**МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ
ТИБЕТСКИЙ
АППЛИКАТОР**

**МАГНИТНЫЙ
НА МЯГКОЙ ПОДЛОЖКЕ**

41x117

**Красный – менее
острые иглы**

**Желтый – более
острые иглы**

Хранить при t от +5 до +40°

Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления

TU 32.50.13-002-59794024-2018

РУ №РЗН 2017 /5774

ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва
набережная Тараса Шевченко, дом 3, корпус 2, комнаты
14, 15, 21, часть 23



4 627135 780117

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» на мягкой подложке для ступней ,в исполнение: красный

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3,корп.2, комнаты 14,15,21,часть 23



97

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАДИЦИОННОГО МАССАЖА

Важными аспектами массажа являются подбор массажера и места его применения. При выборе массажера необходимо учитывать его эффективность и безопасность. Традиционный массаж имеет ряд преимуществ перед аппаратными методами. Во-первых, массаж улучшает кровообращение, что способствует выведению токсинов из организма. Во-вторых, массаж помогает снять мышечное напряжение и улучшить сон. В-третьих, массаж повышает иммунитет и улучшает общее состояние здоровья. Кроме того, массаж имеет приятный запах, который способствует расслаблению и снятию стресса. Традиционный массаж является эффективным средством для улучшения качества жизни и здоровья.

Важными аспектами массажа являются подбор массажера и места его применения. При выборе массажера необходимо учитывать его эффективность и безопасность. Традиционный массаж имеет ряд преимуществ перед аппаратными методами. Во-первых, массаж улучшает кровообращение, что способствует выведению токсинов из организма. Во-вторых, массаж помогает снять мышечное напряжение и улучшить сон. В-третьих, массаж повышает иммунитет и улучшает общее состояние здоровья. Кроме того, массаж имеет приятный запах, который способствует расслаблению и снятию стресса. Традиционный массаж является эффективным средством для улучшения качества жизни и здоровья.

Эффективность массажа зависит от правильного выбора массажера



На массажной поверхности 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см



На массажной поверхности 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см



На массажной поверхности 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см



На массажной поверхности 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см



На массажной поверхности 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см



На массажной поверхности 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см

Массажная поверхность 12 x 22 см



Узнайте больше на www.kunies-lab.ru

Кунес-Лаб, ООО
 Адрес: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 12, стр. 1
 Контакт: +7 (495) 123-45-67
 E-mail: info@kunies-lab.ru

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» на мягкой подложке для ступней в исполнение: желтый

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23



ПРЕИМУЩЕСТВА ТИПЕВСКОГО АППЛИКАТОРА

■ Для быстрого снятия боли аппликатор воздействует на биологически активные точки, расположенные в области (или) проекции болезненного участка.

■ Массаж имеет двойное действие: в сочетании с дренажным действием аппликатора усиливается эффект расслабления мышц, что в свою очередь приводит к более эффективному и эффективному.

■ Специальный материал усиливает лечебный эффект благодаря дренажному воздействию аппликатора на биологически активные точки (акупунктурные точки) и рефлексы (аппликатор Тибетский).

■ Массаж аппликатором усиливает расслабление мышц и способствует их восстановлению (аппликатор Тибетский).

■ Аппликатор усиливает расслабление мышц и способствует их восстановлению (аппликатор Тибетский).

Воздействие аппликатора

Специальный материал усиливает лечебный эффект благодаря дренажному воздействию аппликатора на биологически активные точки (акупунктурные точки) и рефлексы (аппликатор Тибетский).

* Аппликатор не фиксируется на теле

Эффективность иглоукалывательного массажа зависит от правильного выбора аппликатора



Маленький аппликатор 22 x 22 см
аппликатор Тибетский

Маленький аппликатор усиливает эффект воздействия на биологически активные точки (акупунктурные точки) и рефлексы (аппликатор Тибетский).



Средний аппликатор 27 x 27 см
аппликатор Тибетский

Средний аппликатор усиливает эффект воздействия на биологически активные точки (акупунктурные точки) и рефлексы (аппликатор Тибетский).



Большой аппликатор 42 x 42 см
аппликатор Тибетский

Большой аппликатор усиливает эффект воздействия на биологически активные точки (акупунктурные точки) и рефлексы (аппликатор Тибетский).



Маленький аппликатор для головы
аппликатор Тибетский

Маленький аппликатор для головы усиливает эффект воздействия на биологически активные точки (акупунктурные точки) и рефлексы (аппликатор Тибетский).



Средний аппликатор для спины
аппликатор Тибетский

Средний аппликатор для спины усиливает эффект воздействия на биологически активные точки (акупунктурные точки) и рефлексы (аппликатор Тибетский).



Большой аппликатор для спины
аппликатор Тибетский

Большой аппликатор для спины усиливает эффект воздействия на биологически активные точки (акупунктурные точки) и рефлексы (аппликатор Тибетский).



Маленький аппликатор для головы
аппликатор Тибетский

Маленький аппликатор для головы усиливает эффект воздействия на биологически активные точки (акупунктурные точки) и рефлексы (аппликатор Тибетский).



Средний аппликатор для спины
аппликатор Тибетский

Средний аппликатор для спины усиливает эффект воздействия на биологически активные точки (акупунктурные точки) и рефлексы (аппликатор Тибетский).



Большой аппликатор для спины
аппликатор Тибетский

Большой аппликатор для спины усиливает эффект воздействия на биологически активные точки (акупунктурные точки) и рефлексы (аппликатор Тибетский).

Эффективность иглоукалывательного массажа зависит от правильного выбора аппликатора

Узнайте больше на www.kozdres.ru

Коздрес, ООО, 125080, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 27, стр. 1, 2-й этаж.
Тел: (495) 780-0056, факс: (495) 780-0056, e-mail: info@kozdr.ru
Сайт: www.kozdr.ru

Дата выпуска:



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

**Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» на мягкой подложке для ступней в исполнение:
желтый эластичный.**

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведения об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3,корп.2, комнаты 14,15,21,часть 23



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» массажная варежка ,в исполнение: красный

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3,корп.2, комнаты 14,15,21,часть 23



МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ

ТИБЕТСКИЙ
АППЛИКАТОР

Массажная варежка
магнитный красный

85

Хранить при t от +5 до +40°

Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления МН

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ №РЗН 2017 /5774

ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 1,
корпус 2, комнаты 14, 15, 21, часть 23

Дата изготовления



4 627135 780018

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» массажная варежка, в исполнение: желтый

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23



ЛАБОРАТОРИЯ КУЗНЕЦОВА



МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ

ТИБЕТСКИЙ
АППЛИКАТОР

Массажная варежка
магнитный желтый

88

Хранить при t от +5 до +40°

Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления МН

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ №РЗН 2017 /5774

ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва, набережная Тараса Шевченко,
корпус 2, комнаты 14, 15, 21, часть 23

Дата изготовления



4 627138 780018

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

**Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» массажная варежка, в исполнение:
желтый эластичный.**

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведения об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23

90




МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ

**ТИБЕТСКИЙ
АППЛИКАТОР**

Массажная варежка
магнитный желтый эластичный

16

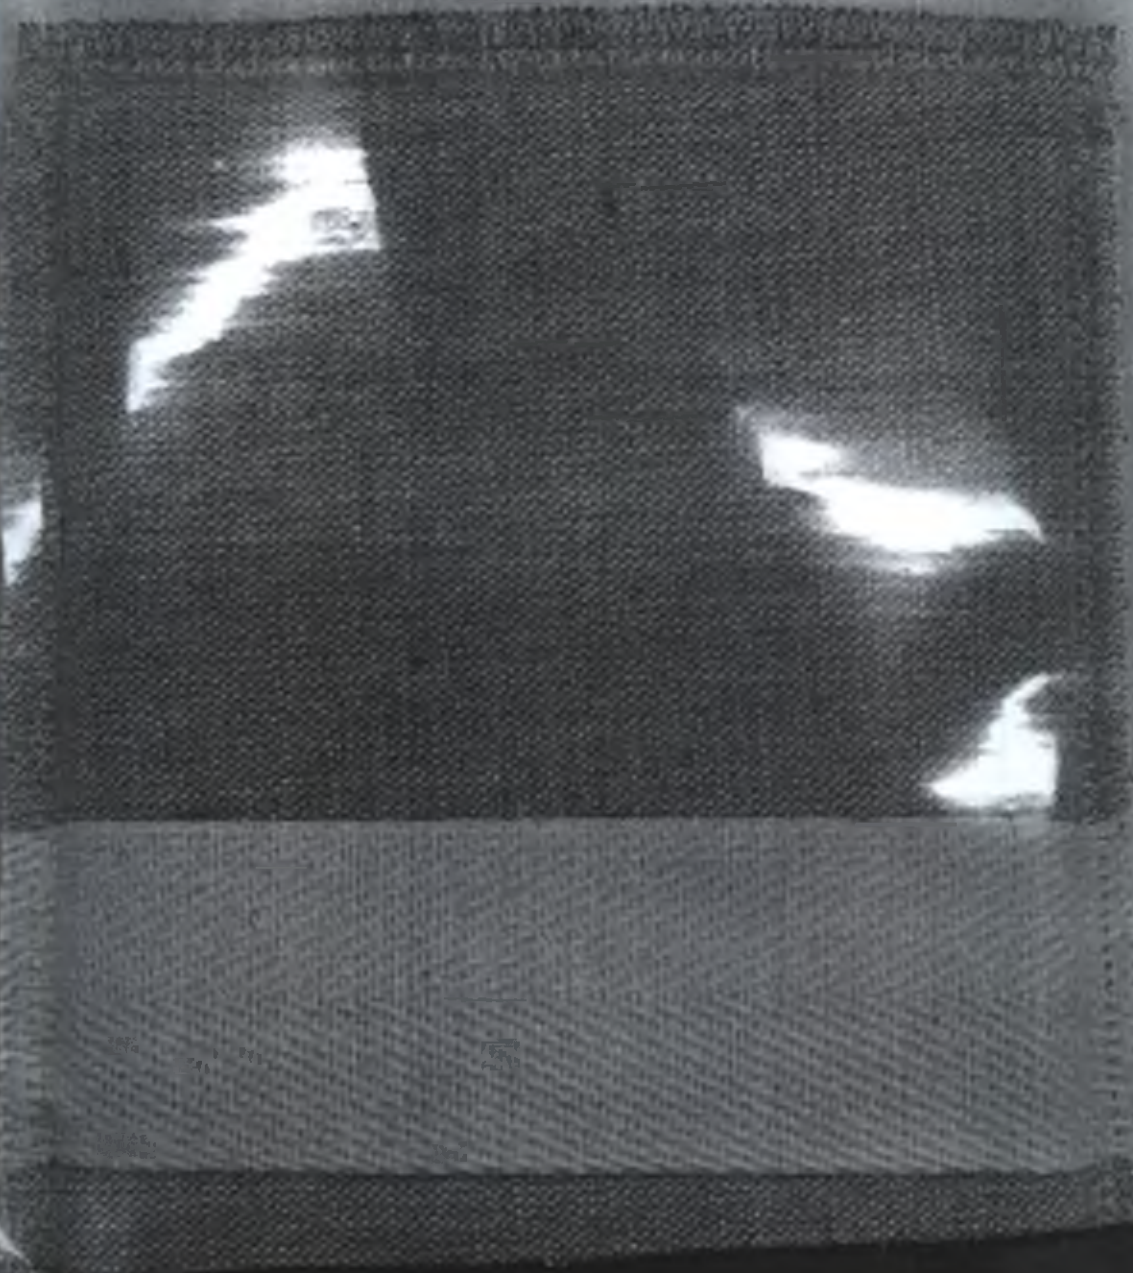

Хранить при t от +5 до +40°

Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления МИ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ №РЗН 2017/5774

ООО «Лаборатория Кулинецова», Россия, 121248 Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 3,

корпус 2, комнаты 14, 15, 21, часть 23

Дата изготовления:



4 827135 780018

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» мягкий валик для шеи, в исполнение: желтый

Дата изготовления

____ «____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23

93




ПРЕИМУЩЕСТВА ТИБЕТСКОГО АКИТОРА

- И Дает моментальное ощущение тепла, улучшает кровообращение и тонизирует мышцы, снимает усталость и стресс (сильно).
- И Улучшает обмен веществ, способствует похудению, улучшает состояние кожи, делает кожу более мягкой и эластичной.
- И Способствует лечению заболеваний суставов, позвоночника, мышц, связок, сухожилий, а также улучшает состояние кожи (отшелушивает омертвевшие клетки).
- И Улучшает обмен веществ, способствует похудению, улучшает состояние кожи, делает кожу более мягкой и эластичной.
- И Улучшает обмен веществ, способствует похудению, улучшает состояние кожи, делает кожу более мягкой и эластичной.

Показания и противопоказания к использованию


Система бани и сауны предназначена для использования в саунах и банях, а также в домашних условиях (в ванной комнате, душевой, туалете). Система бани и сауны предназначена для использования в саунах и банях, а также в домашних условиях (в ванной комнате, душевой, туалете). Система бани и сауны предназначена для использования в саунах и банях, а также в домашних условиях (в ванной комнате, душевой, туалете).

Эффективность иглового массажа зависит от правильного выбора массажера

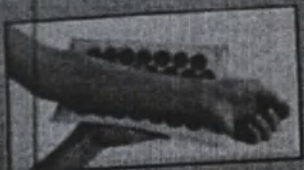

На матовой поверхности 12х22 см

Наиболее эффективный массажный аппарат для ног, который можно использовать в домашних условиях (в ванной комнате, душевой, туалете). На матовой поверхности 12х22 см, то эффект будет значительно больше.

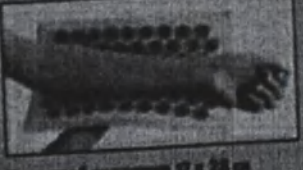

На матовой поверхности 17х25 см

Наиболее эффективный массажный аппарат для ног, который можно использовать в домашних условиях (в ванной комнате, душевой, туалете). На матовой поверхности 17х25 см, то эффект будет значительно больше.



На матовой поверхности 17х25 см

Наиболее эффективный массажный аппарат для ног, который можно использовать в домашних условиях (в ванной комнате, душевой, туалете). На матовой поверхности 17х25 см, то эффект будет значительно больше.



На матовой поверхности 17х25 см

Наиболее эффективный массажный аппарат для ног, который можно использовать в домашних условиях (в ванной комнате, душевой, туалете). На матовой поверхности 17х25 см, то эффект будет значительно больше.



На матовой поверхности 17х25 см

Наиболее эффективный массажный аппарат для ног, который можно использовать в домашних условиях (в ванной комнате, душевой, туалете). На матовой поверхности 17х25 см, то эффект будет значительно больше.



На матовой поверхности 17х25 см

Наиболее эффективный массажный аппарат для ног, который можно использовать в домашних условиях (в ванной комнате, душевой, туалете). На матовой поверхности 17х25 см, то эффект будет значительно больше.



На матовой поверхности 17х25 см

Наиболее эффективный массажный аппарат для ног, который можно использовать в домашних условиях (в ванной комнате, душевой, туалете). На матовой поверхности 17х25 см, то эффект будет значительно больше.



На матовой поверхности 17х25 см

Наиболее эффективный массажный аппарат для ног, который можно использовать в домашних условиях (в ванной комнате, душевой, туалете). На матовой поверхности 17х25 см, то эффект будет значительно больше.



На матовой поверхности 17х25 см

Наиболее эффективный массажный аппарат для ног, который можно использовать в домашних условиях (в ванной комнате, душевой, туалете). На матовой поверхности 17х25 см, то эффект будет значительно больше.


Важно помнить, что массажный аппарат должен использоваться только в соответствии с инструкцией. Не рекомендуется использовать аппарат при наличии заболеваний сердца, сосудов, беременности и т.д.

Цвет	●	●	●	●
Форма	▲	▲	▲	▲
Материал	нет	да	нет	да

Узнайте больше на www.kuznetsov-tab.ru

Артикул: КТ-17-25-140-С
Гарантия: 1 год
Материал: пластик
Производитель: КТ-17-25-140-С
Адрес: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 12, стр. 2
Телефон: +7 (495) 123-45-67

Дата изготовления:



4 627135 780056

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

**Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» мягкий валик для шеи, в исполнение:
желтый эластичный.**

Дата изготовления

____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» мягкий валик для шеи ,в исполнение: красный

Дата изготовления

_____ « _____ » 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3,корп.2, комнаты 14,15,21,часть 23



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

**Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» мягкий валик для
поясницы ,в исполнение: красный**

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3,корп.2, комнаты 14,15,21,часть 23



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» мягкий валик для поясницы, в исполнение: желтый

Дата изготовления

____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23



ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАССАЖА ЗАВИСИТ ОТ ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА МАССАЖИРА

В-третьих, качество материала, из которого изготовлен массажёр, также имеет значение. Массажёр должен быть выполнен из прочного, долговечного материала, который не деформируется под воздействием нагрузки. Кроме того, массажёр должен быть выполнен из гипоаллергенного материала, который не вызывает аллергии. Массажёр должен быть выполнен из материала, который не вызывает раздражения кожи. Массажёр должен быть выполнен из материала, который не вызывает дискомфорта. Массажёр должен быть выполнен из материала, который не вызывает боли. Массажёр должен быть выполнен из материала, который не вызывает жжения. Массажёр должен быть выполнен из материала, который не вызывает зуда. Массажёр должен быть выполнен из материала, который не вызывает отека. Массажёр должен быть выполнен из материала, который не вызывает покраснения. Массажёр должен быть выполнен из материала, который не вызывает сыпи. Массажёр должен быть выполнен из материала, который не вызывает крапивницы. Массажёр должен быть выполнен из материала, который не вызывает ангионевротического отека. Массажёр должен быть выполнен из материала, который не вызывает анафилактического шока. Массажёр должен быть выполнен из материала, который не вызывает смерти.

Польза и эффективность массажа

Самое главное в выборе массажёра — это его эффективность. Массажёр должен быть выполнен из материала, который не вызывает аллергии. Массажёр должен быть выполнен из материала, который не вызывает раздражения кожи. Массажёр должен быть выполнен из материала, который не вызывает дискомфорта. Массажёр должен быть выполнен из материала, который не вызывает боли. Массажёр должен быть выполнен из материала, который не вызывает жжения. Массажёр должен быть выполнен из материала, который не вызывает зуда. Массажёр должен быть выполнен из материала, который не вызывает отека. Массажёр должен быть выполнен из материала, который не вызывает покраснения. Массажёр должен быть выполнен из материала, который не вызывает сыпи. Массажёр должен быть выполнен из материала, который не вызывает крапивницы. Массажёр должен быть выполнен из материала, который не вызывает ангионевротического отека. Массажёр должен быть выполнен из материала, который не вызывает анафилактического шока. Массажёр должен быть выполнен из материала, который не вызывает смерти.



На локтевой подпалке 12 x 22 см
зеленый/синий

Пользуется современным и эффективным массажёром на локтевой подпалке, который удобен для массажа рук и в различных частях тела (голова, острый пояс, ноги и т.д.). На локтевой подпалке, острый пояс, который используется для этой цели, имеет размер 41 x 60 см, то эффект будет значительно более выраженным.



На локтевой подпалке 17 x 28 см
зеленый/синий/желтый

Пользуется современным и эффективным массажёром на локтевой подпалке, который удобен для массажа рук и в различных частях тела (голова, острый пояс, ноги и т.д.). На локтевой подпалке, острый пояс, который используется для этой цели, имеет размер 41 x 60 см, то эффект будет значительно более выраженным.



На локтевой подпалке 41 x 60 см
зеленый/синий
желтый/красный/желтый

Большой современный и эффективный массажёр. Способен оказывать мощное лечебное и профилактическое действие. Также идеально подходит для расслабления (расслабления) или расслабления тела. С его помощью очень удобно и эффективно воздействовать на большинство мышц: спину, плечи, бедра, ступни. Он также может применяться для массажа ног или поясницы (с помощью ролика, спину, плечи, бедра, ступни). Улучшает локтевой подпалку, обеспечивая максимальный уровень комфорта и расслабления при приеме ванны. Оказывает положительное влияние на кровообращение и обмен веществ (также для похудения). Применяется в различных целях.



На локтевой подпалке для шеи
зеленый/синий

Форма валика, из которой, в том числе острый пояс, который используется для этой цели, имеет размер 41 x 60 см, то эффект будет значительно более выраженным.



На локтевой подпалке для поясницы
зеленый/красный

Форма валика, из которой, в том числе острый пояс, который используется для этой цели, имеет размер 41 x 60 см, то эффект будет значительно более выраженным.



На локтевой подпалке для ступней
зеленый/красный

Большой массажёр, который используется для массажа ступней. Он также может применяться для массажа ног или поясницы (с помощью ролика, спину, плечи, бедра, ступни). Улучшает локтевой подпалку, обеспечивая максимальный уровень комфорта и расслабления при приеме ванны. Оказывает положительное влияние на кровообращение и обмен веществ (также для похудения). Применяется в различных целях.



На локтевой подпалке для ступней
зеленый/красный


Большой массажёр, который используется для массажа ступней. Он также может применяться для массажа ног или поясницы (с помощью ролика, спину, плечи, бедра, ступни). Улучшает локтевой подпалку, обеспечивая максимальный уровень комфорта и расслабления при приеме ванны. Оказывает положительное влияние на кровообращение и обмен веществ (также для похудения). Применяется в различных целях.

Удобный и эффективный массажёр, который используется для массажа ступней. Он также может применяться для массажа ног или поясницы (с помощью ролика, спину, плечи, бедра, ступни). Улучшает локтевой подпалку, обеспечивая максимальный уровень комфорта и расслабления при приеме ванны. Оказывает положительное влияние на кровообращение и обмен веществ (также для похудения). Применяется в различных целях.

Цвет	●	●	●	●
Форма вт	▲	▲	▲	▲
Материал	нет	да	нет	да

Узнайте больше на www.kuznetsov-lab.ru

Хранить при t° от +5 до +40°C.
Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления.
Модель: 04-издание. ТУ 32.54.13.002.5474.024.2016.
Регистрационное удостоверение №РЗН.2017.0274.
ООО «Технология Хулинов». Россия, 127448 Москва,
набережная Троица-Щепанко, дом 3, корпус 2,
комнаты 14, 15, 16, часть 23.

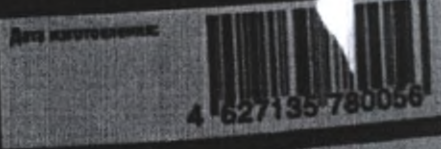

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

**Массажер медицинский «Тибетский аппликатор»» мягкий валик для поясницы, в исполнение:
желтый эластичный.**

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23



ТИБЕТСКИЙ АППЛИКАТОР

МЯГКИЙ ВАЛИК ДЛЯ ПОЯСНИЦЫ магнитный
(желтый эластичный)

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» мягкая игрушка «Собака», в исполнение: желтый

Дата изготовления

____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23



ТИБЕТСКИЙ АППЛИКАТОР


www.kuznetsov-lab.ru

МЯГКАЯ ИГРУШКА "СОБАКА"
магнитный желтый



МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖЕР

- Снятие болей и потери подвижности в области шеи
- Снятие головных болей
- Повышение общего тонуса организма
- Восстановление и повышение работоспособности
- Улучшение кровообращения

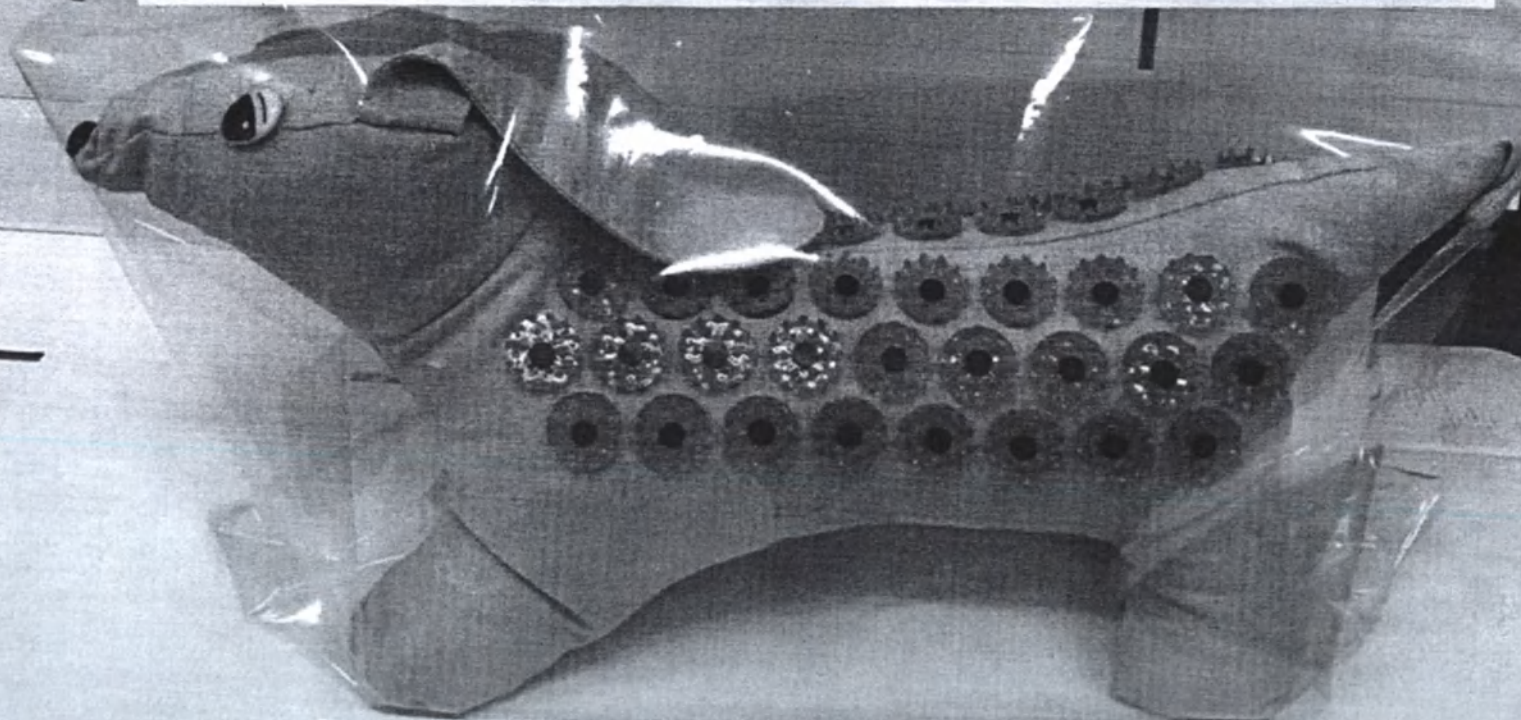

112

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!


ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!

Узнайте больше на www.kuznetsov-lab.ru



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» мягкая игрушка «Собака», в исполнение: красный

Дата изготовления

____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23




ТИБЕТСКИЙ АППЛИКАТОР МЯГКАЯ ИГРУШКА "СОБАКА"

магнитный
красный

МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖЕР

- Снятие болей и потери подвижности в области шеи
- Снятие головных болей
- Повышение общего тонуса организма
- Восстановление и повышение работоспособности
- Улучшение кровообращения

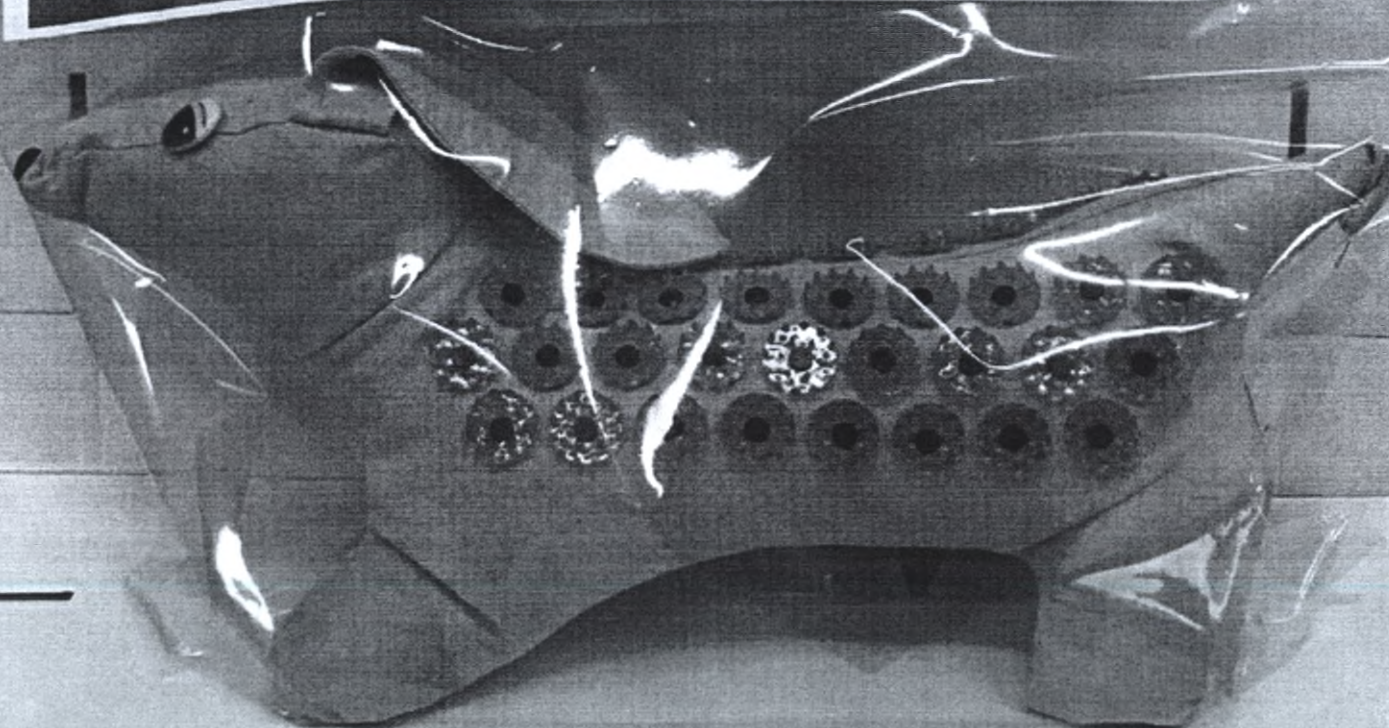

145

ПЛИКАТОРА:

В сочетании с
массажом
пропитывает
кожу, делает
портной и эффек-

твен, усиливает
регенерацию
кожи.

Дополнительно
маска оказывает

на кожу
успокаивающее

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Массажный аппарат «Тибетский аппликатор» предназначен для выполнения процедуры иглоукалывания. Массажный аппарат оказывает лечебное воздействие на отдельные части тела и органы, а также рефлекторно на всю систему организма. Особенностью Тибетского аппликатора является разделение острия иглы, которое вызывает лечебный эффект и снижает риск травмирования кожи.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

• Болевые синдромы и спазмы мышц в области шеи и плеч;
• Головные боли и головокружения;
• Повышенное артериальное давление;
• Нарушения сна;
• Стрессовые состояния;
• Заболевания органов дыхания;
• Заболевания органов пищеварения;
• Заболевания органов мочеполовой системы;
• Заболевания органов кровообращения;
• Заболевания органов эндокринной системы;
• Заболевания органов нервной системы;
• Заболевания органов иммунной системы;
• Заболевания органов репродуктивной системы;
• Заболевания органов чувств;
• Заболевания органов опорно-двигательного аппарата;
• Заболевания органов дыхания;
• Заболевания органов пищеварения;
• Заболевания органов мочеполовой системы;
• Заболевания органов кровообращения;
• Заболевания органов эндокринной системы;
• Заболевания органов нервной системы;
• Заболевания органов иммунной системы;
• Заболевания органов репродуктивной системы;
• Заболевания органов чувств;
• Заболевания органов опорно-двигательного аппарата;

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Наличие и острое течение вирусных заболеваний (грипп, ветряная оспа, корь и др.), хронических заболеваний, дерматитов, онкологических заболеваний любой локализации.

Важно! При использовании аппарата необходимо соблюдать следующие правила: аппарат должен использоваться только для лечения, а не для профилактики; аппарат должен использоваться только для лечения, а не для профилактики; аппарат должен использоваться только для лечения, а не для профилактики;

ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Перед использованием аппарата необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. Аппарат должен использоваться только для лечения, а не для профилактики. Аппарат должен использоваться только для лечения, а не для профилактики. Аппарат должен использоваться только для лечения, а не для профилактики.

Маска массажная аппаратная, ТУ 32.80.13-002-09794024-2018
Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/0774

Текст, описывающий применение аппарата, его функции, показания к применению, противопоказания, общие инструкции по использованию. Текст, описывающий применение аппарата, его функции, показания к применению, противопоказания, общие инструкции по использованию.

УПАКОВКА

Аппарат упакован в картонную коробку. В коробке находится аппарат, инструкция по применению, гарантийный талон. Аппарат упакован в картонную коробку. В коробке находится аппарат, инструкция по применению, гарантийный талон. Аппарат упакован в картонную коробку. В коробке находится аппарат, инструкция по применению, гарантийный талон.

узнайте больше на www.kuznecov-lab.ru

Дата изготовления
Май 2018



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

**Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» мягкая игрушка «Собака», в исполнение:
желтый эластичный.**

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3,корп.2, комнаты 14,15,21,часть 23




МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖЕР

ТИБЕТСКИЙ АППЛИКАТОР

МЯГКАЯ ИГРУШКА "СОБАКА"

МАГНИТНЫЙ
ЖЕЛТЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ

- Снятие болей и потери подвижности в области шеи
- Снятие головных болей
- Повышение общего тонуса организма
- Восстановление и повышение работоспособности
- Улучшение кровообращения

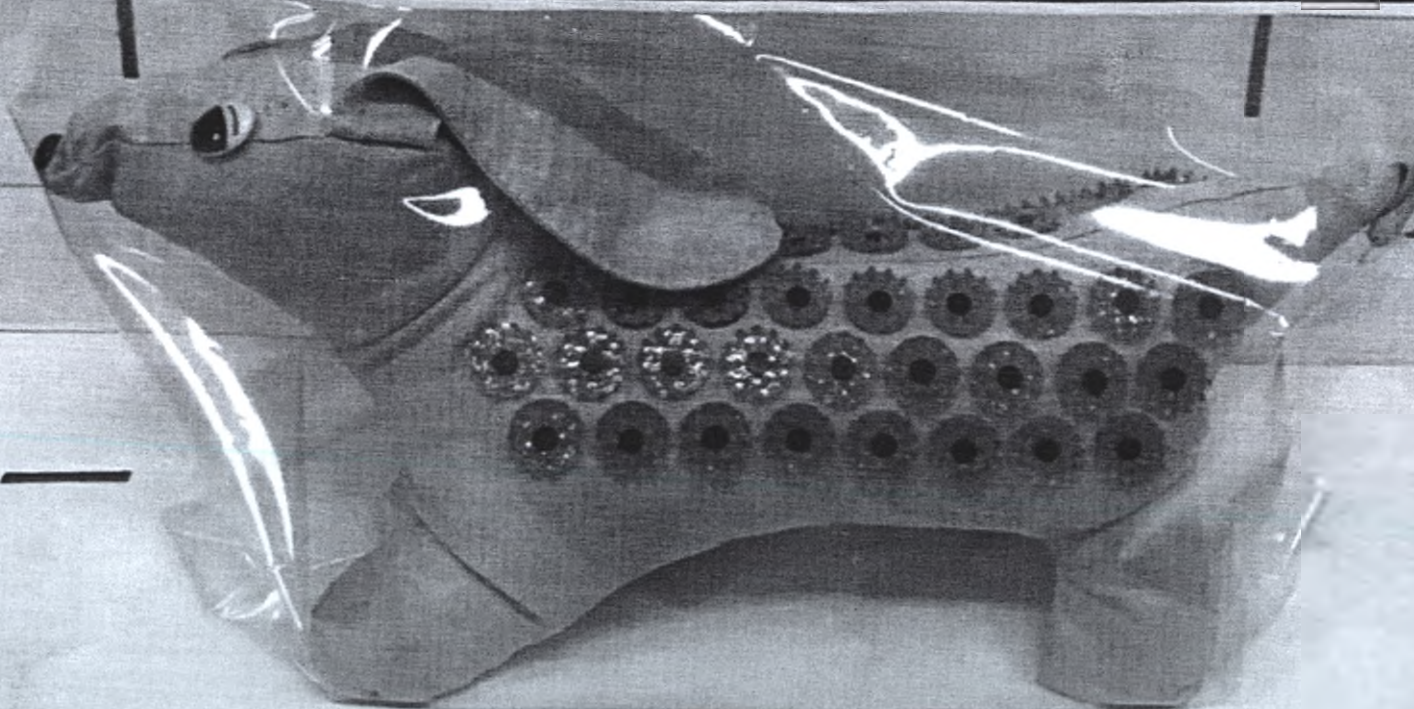

811

Исходные данные: наименование, ТУ 32.36.13-000-00760004-0019
Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/0774

ИНСТРУКТОРА:
в соответствии с
инструкцией к
массажу
происходит
в кожу. Делает
энергичной и эффек-
тивной
усиливает
иммунитет
и тонизирует
организм
разнообразно
массажера
из качествен-
но закрепле-

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нидерландский массажер «Тибетский аппликатор» предназна-
чен для выполнения процедуры тибетского массажа.
Массажный массаж оказывает лечебное воздействие на
отдельные части тела и органы, а также рефлекторно на
все системы организма. Особностью Тибетского апплика-
тора является разделение острия иглы, которое позволяет
получить эффект и снижает риск травмирования кожи.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

• Снятие боли в области подвижности в области шеи • Снятие
головных болей • Улучшение кровообращения • Повышение
общего тонуса организма, восстановление и повышение
работоспособности, восстановление после физических
нагрузок • По назначению врача возможны иные показания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Наличие в зоне воздействия открытых ранений (ноздрей),
ожогов, дерматитов и других заболеваний. Дерматиты.
Осложненные заболевания любой этиологии.

Важно! При использовании массажера необходимо соблюдать
правила гигиены. Массажер должен быть чистым и сухим.
После использования массажера необходимо обработать
места воздействия антисептиком.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Массажный массажер для шеи (закрепить устройство) приложить
к шее и обеспечить контакт с кожей. Для усиления интенсивности
массажа можно использовать дополнительные средства.
Важно! Необходимо обеспечить контакт с кожей. Если
больше переносимость, которая обычно сопровождается ощущением

жжения. Ограничение массажа осуществляется с высокой эффективностью
в области шеи. Вред и риск воздействия является индивидуальным
для каждого человека и определяется его состоянием. Перед
использованием массажера необходимо ознакомиться с инструкцией.
Важно! При использовании массажера необходимо соблюдать
правила гигиены. Массажер должен быть чистым и сухим.
После использования массажера необходимо обработать
места воздействия антисептиком.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от -4 до +40°C. Гарантийный срок
использования 5 лет со дня изготовления.

Важно! Гибридный массажер является средством лич-
ного пользования. При использовании массажера необходимо соблюдать
инструкции по применению и правила гигиены.

Узнайте больше на www.kuznecov-lab.ru



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» мягкая игрушка, в исполнение: красный

Дата изготовления

____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23




ТУБЕТОСКИЙ АППЛИКАТОР

МЯГКАЯ ИГРУШКА
магнитный
красный

www.kaltesov-lab.ru

- Снятие боли и потери подвижности в области шеи
- Снятие головных болей
- Повышение общего тонуса организма
- Восстановление и повышение работоспособности
- Улучшение кровообращения

МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖЕР

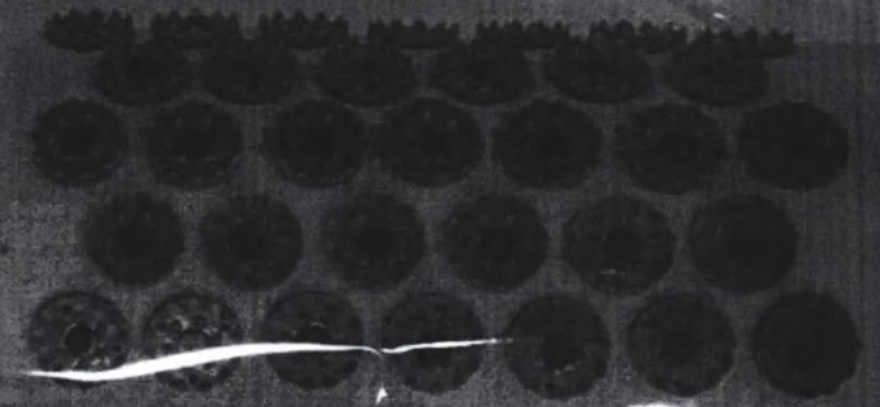

221

СВОЙСТВА ТИБЕТСКОГО АЛМАНАХА

имеет двойное действие и комплексно воздействует на организм человека. Двойное действие проявляется в том, что при применении его в пищу человек чувствует себя более комфортно и эффективно.

Важное преимущество состоит в том, что при применении его в пищу человек чувствует себя более комфортно и эффективно.

Важное преимущество состоит в том, что при применении его в пищу человек чувствует себя более комфортно и эффективно.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медикаментозный препарат «Тибетский Алмахан» предназначен для комплексной профилактики и лечения заболеваний. Препарат имеет двойное действие: он улучшает состояние организма и повышает иммунитет.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

• Слабость и потеря аппетита в области шеи и головы
• Головные боли
• Улучшение кровообращения и повышение работоспособности
• Восстановление роста волос
• Показан при лечении заболеваний кожи

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат принимают по 1 таблетке 3-4 раза в день. При приеме препарата необходимо соблюдать диету. Важно! При приеме препарата необходимо соблюдать диету. Важно! При приеме препарата необходимо соблюдать диету.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат принимают по 1 таблетке 3-4 раза в день. При приеме препарата необходимо соблюдать диету. Важно! При приеме препарата необходимо соблюдать диету.

Важное преимущество состоит в том, что при применении его в пищу человек чувствует себя более комфортно и эффективно.

УПАКОВКА И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Упаковка: 10 таблеток. Срок хранения: 3 года. Важно! При приеме препарата необходимо соблюдать диету.

Узнайте больше на www.kuznecov-lab.ru

Дата изготовления:

Май 2018



4627195427195

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» мягкая игрушка, в исполнение: желтый

Дата изготовления

____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведения об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23



ТИБЕТСКИЙ АППЛИКАТОР

МЯГКАЯ ИГРУШКА

массажный
желтый



МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖЕР

- Снятие болей и потери подвижности в области шеи
- Снятие головных болей
- Повышение общего тонуса организма
- Восстановление и повышение работоспособности
- Улучшение кровообращения



123

UNITED STATES AIR FORCE

[illegible]

...the ... of ...

...the ... of ...

THE

© 2000 by Pearson Education, Inc. All rights reserved.

Важнейшим источником информации о состоянии экономики предприятия является анализ его финансово-экономических показателей. Для выполнения программы исследования необходимо иметь представление о структуре и содержании системы показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия. В настоящее время в литературе по этому вопросу имеется много работ, в которых приводятся различные классификации показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия. Однако, несмотря на то, что в этих работах приводятся различные классификации, они не дают полного представления о структуре и содержании системы показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия. В настоящей работе приводятся результаты исследования структуры и содержания системы показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия. В работе приводятся результаты исследования структуры и содержания системы показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия. В работе приводятся результаты исследования структуры и содержания системы показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия.

[illegible][illegible]

PIRGES ON KALAMAZOO

Планеты в этот период, так или иначе связанные с Юпитером (Сатурном), Марсом, Меркурием и Венерой, оказывают и другие влияния на жизнь человека. Венера, Меркурий, Юпитер и Сатурн оказывают влияние на судьбу человека, Марс — на его характер.

Важнейшим условием успешности работы является наличие квалифицированных кадров. В настоящее время в стране наблюдается дефицит специалистов в области экономики, управления, инженерии и других специальностей. Поэтому необходимо уделять большое внимание подготовке кадров, повышению их квалификации и созданию условий для их творческой деятельности.

Способ применения

[illegible][illegible][illegible]

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Business Publications Mail Agent

Environ Monit Assess (2008) 142:111–120
DOI 10.1007/s10661-008-9400-2
© Springer 2008
Published online: 12 November 2008

Узнайте больше на www.kuznecov-lab.ru



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

**Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» мягкая игрушка, в исполнение:
желтый эластичный.**

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23

126

ТИБЕТСКИЙ АППЛИКАТОР

МЯГКАЯ ИГРУШКА
магнитный
жесткий эластичный

МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖЕР

- Снятие боли и потерю подвижности в области шеи
- Снятие головных болей
- Повышение общего тонуса организма
- Восстановление и повышение работоспособности
- Улучшение кровообращения

...иные материалы активно используются
на объектах для повышения долговечности
и качества работ.

...иные материалы равномерно
распределены по территории объекта.

...иные материалы из качествен-
ных материалов в соответствии с требова-

[illegible]

1. **Содержание**
 2. **Введение**
 3. **Глава I. Общие положения**
 4. **Глава II. Организация и структура**
 5. **Глава III. Основные задачи и функции**
 6. **Глава IV. Методы и средства**
 7. **Глава V. Заключение**
 8. **Приложение**
 9. **Список литературы**
 10. **Индекс**

[illegible][illegible]

национального единства, единства интересов и волеизъявления граждан. Проведение реформ в соответствии с принципами демократии и рыночной экономики, обеспечение стабильности и безопасности государства, укрепление законности и правопорядка, повышение эффективности государственного управления, улучшение качества жизни населения, развитие культуры, науки, образования, здравоохранения, спорта, физической культуры и туризма, совершенствование системы социальной защиты населения, повышение уровня жизни и благосостояния граждан, обеспечение устойчивого экономического роста и развития страны, укрепление международного сотрудничества и партнерства, обеспечение безопасности и стабильности в мире, обеспечение единства и целостности территории, обеспечение единства и целостности государства, обеспечение единства и целостности народа, обеспечение единства и целостности нации, обеспечение единства и целостности человечества.

Вопрос: Сделайте доклад о развитии культуры в древности и средневековье. Для этого нужно найти информацию о культуре в древности и средневековье. Также нужно найти информацию о культуре в древности и средневековье.

узнайте больше на www.kuznetsov-lab.ru

Дата изготовления
Май 2018



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» мягкий валик универсальный, в исполнение: красный

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» мягкий валик универсальный, в исполнение: желтый

Дата изготовления

____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23



ОСОБЕННОСТИ ТИБЕТСКОГО АППАРАТА

1. Для быстрого остриения иголок аппарат позволяет использовать в качестве инструмента и твердости стали.

2. Игла имеет двойное острие в соответствии с принципом действия иглоукалывающего аппарата. Благодаря этому игла имеет двойное острие, которое позволяет использовать иглу в воде. Благодаря этому игла имеет двойное острие и эффективна.

3. Специальная конструкция иглы усиливает лечебный эффект. Благодаря этому игла имеет двойное острие, которое позволяет использовать иглу в воде. Благодаря этому игла имеет двойное острие и эффективна.

4. Игла имеет двойное острие, которое позволяет использовать иглу в воде. Благодаря этому игла имеет двойное острие и эффективна.

5. Благодаря своей конструкции игла имеет двойное острие, которое позволяет использовать иглу в воде. Благодаря этому игла имеет двойное острие и эффективна.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИГОЛЧАТОГО МАССАЖА ЗАВЯЗНО ОТ РАДИКАЛЬНЫХ



Иглоукалывание 22 и 23 см (средний эффект)



Иглоукалывание 27 и 28 см (максимальный эффект/длинно)

Благодаря своей конструкции иглоукалыватель не только позволяет, но и позволяет использовать иглу в воде. Благодаря этому игла имеет двойное острие и эффективна.



Иглоукалывание для спины (средний эффект)



Иглоукалывание для спины (максимальный эффект)

Благодаря своей конструкции иглоукалыватель не только позволяет, но и позволяет использовать иглу в воде. Благодаря этому игла имеет двойное острие и эффективна.



Иглоукалывание для спины (средний эффект)




Иглоукалывание для спины (максимальный эффект)

Благодаря своей конструкции иглоукалыватель не только позволяет, но и позволяет использовать иглу в воде. Благодаря этому игла имеет двойное острие и эффективна.



Иглоукалывание для спины (средний эффект)



Иглоукалывание для спины (максимальный эффект)

Благодаря своей конструкции иглоукалыватель не только позволяет, но и позволяет использовать иглу в воде. Благодаря этому игла имеет двойное острие и эффективна.

Благодаря своей конструкции иглоукалыватель не только позволяет, но и позволяет использовать иглу в воде. Благодаря этому игла имеет двойное острие и эффективна.

Благодаря своей конструкции иглоукалыватель не только позволяет, но и позволяет использовать иглу в воде. Благодаря этому игла имеет двойное острие и эффективна.

Благодаря своей конструкции иглоукалыватель не только позволяет, но и позволяет использовать иглу в воде. Благодаря этому игла имеет двойное острие и эффективна.

Благодаря своей конструкции иглоукалыватель не только позволяет, но и позволяет использовать иглу в воде. Благодаря этому игла имеет двойное острие и эффективна.

Благодаря своей конструкции иглоукалыватель не только позволяет, но и позволяет использовать иглу в воде. Благодаря этому игла имеет двойное острие и эффективна.

Благодаря своей конструкции иглоукалыватель не только позволяет, но и позволяет использовать иглу в воде. Благодаря этому игла имеет двойное острие и эффективна.

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» мягкий валик универсальный, в исполнение: желтый эластичный.

Дата изготовления

____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведения об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23



В два десятка строк мы получили модель, которую можно использовать для индивидуальной чувствительности в отношении цены, качества и популярности товара.

и тем самым добился успеха в сотрудничестве с различными
иными институтами высшего образования (Университет, Академия наук,
специальную подготовку и т.д.). Кроме того, он
был и эффективным

и востановились на прежнем уровне. В настоящее время в области здравоохранения наблюдается тенденция к снижению заболеваемости и смертности от инфекционных заболеваний, что свидетельствует о повышении уровня санитарно-гигиенической культуры населения.

[illegible]

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ИТОГОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Measured against 12 x 22 cm conventional

наличие порочащих сведений относительно их личной репутации, интересов, чести и достоинства граждан (полном, частичном, даже если нет и в принципе не может, однако, если можно считать для каждого гражданина фактом, что [12] 10 то, что факт будет считаться более порочащим.



и вы не можете справиться с этими проблемами, то вы должны обратиться к врачу.



1. The first step is to identify the problem.
 2. The second step is to define the problem.
 3. The third step is to analyze the problem.
 4. The fourth step is to develop a solution.
 5. The fifth step is to implement the solution.
 6. The sixth step is to evaluate the solution.
 7. The seventh step is to monitor the solution.
 8. The eighth step is to maintain the solution.
 9. The ninth step is to improve the solution.
 10. The tenth step is to document the solution.

[illegible]

1000

... ..

Узнайте больше на www.august.com

Тел. 112, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849,

A close-up photograph of a metal rim, likely from a vehicle wheel, showing a bolt and the curved surface of the rim.



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» мягкий валик универсальный малый, в исполнение: красный

Дата изготовления

____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведения об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» мягкий валик универсальный малый, в исполнение: желтый

Дата изготовления

____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведения об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23

141



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» мягкий валик универсальный малый, в исполнение: желтый эластичный.

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет


Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23

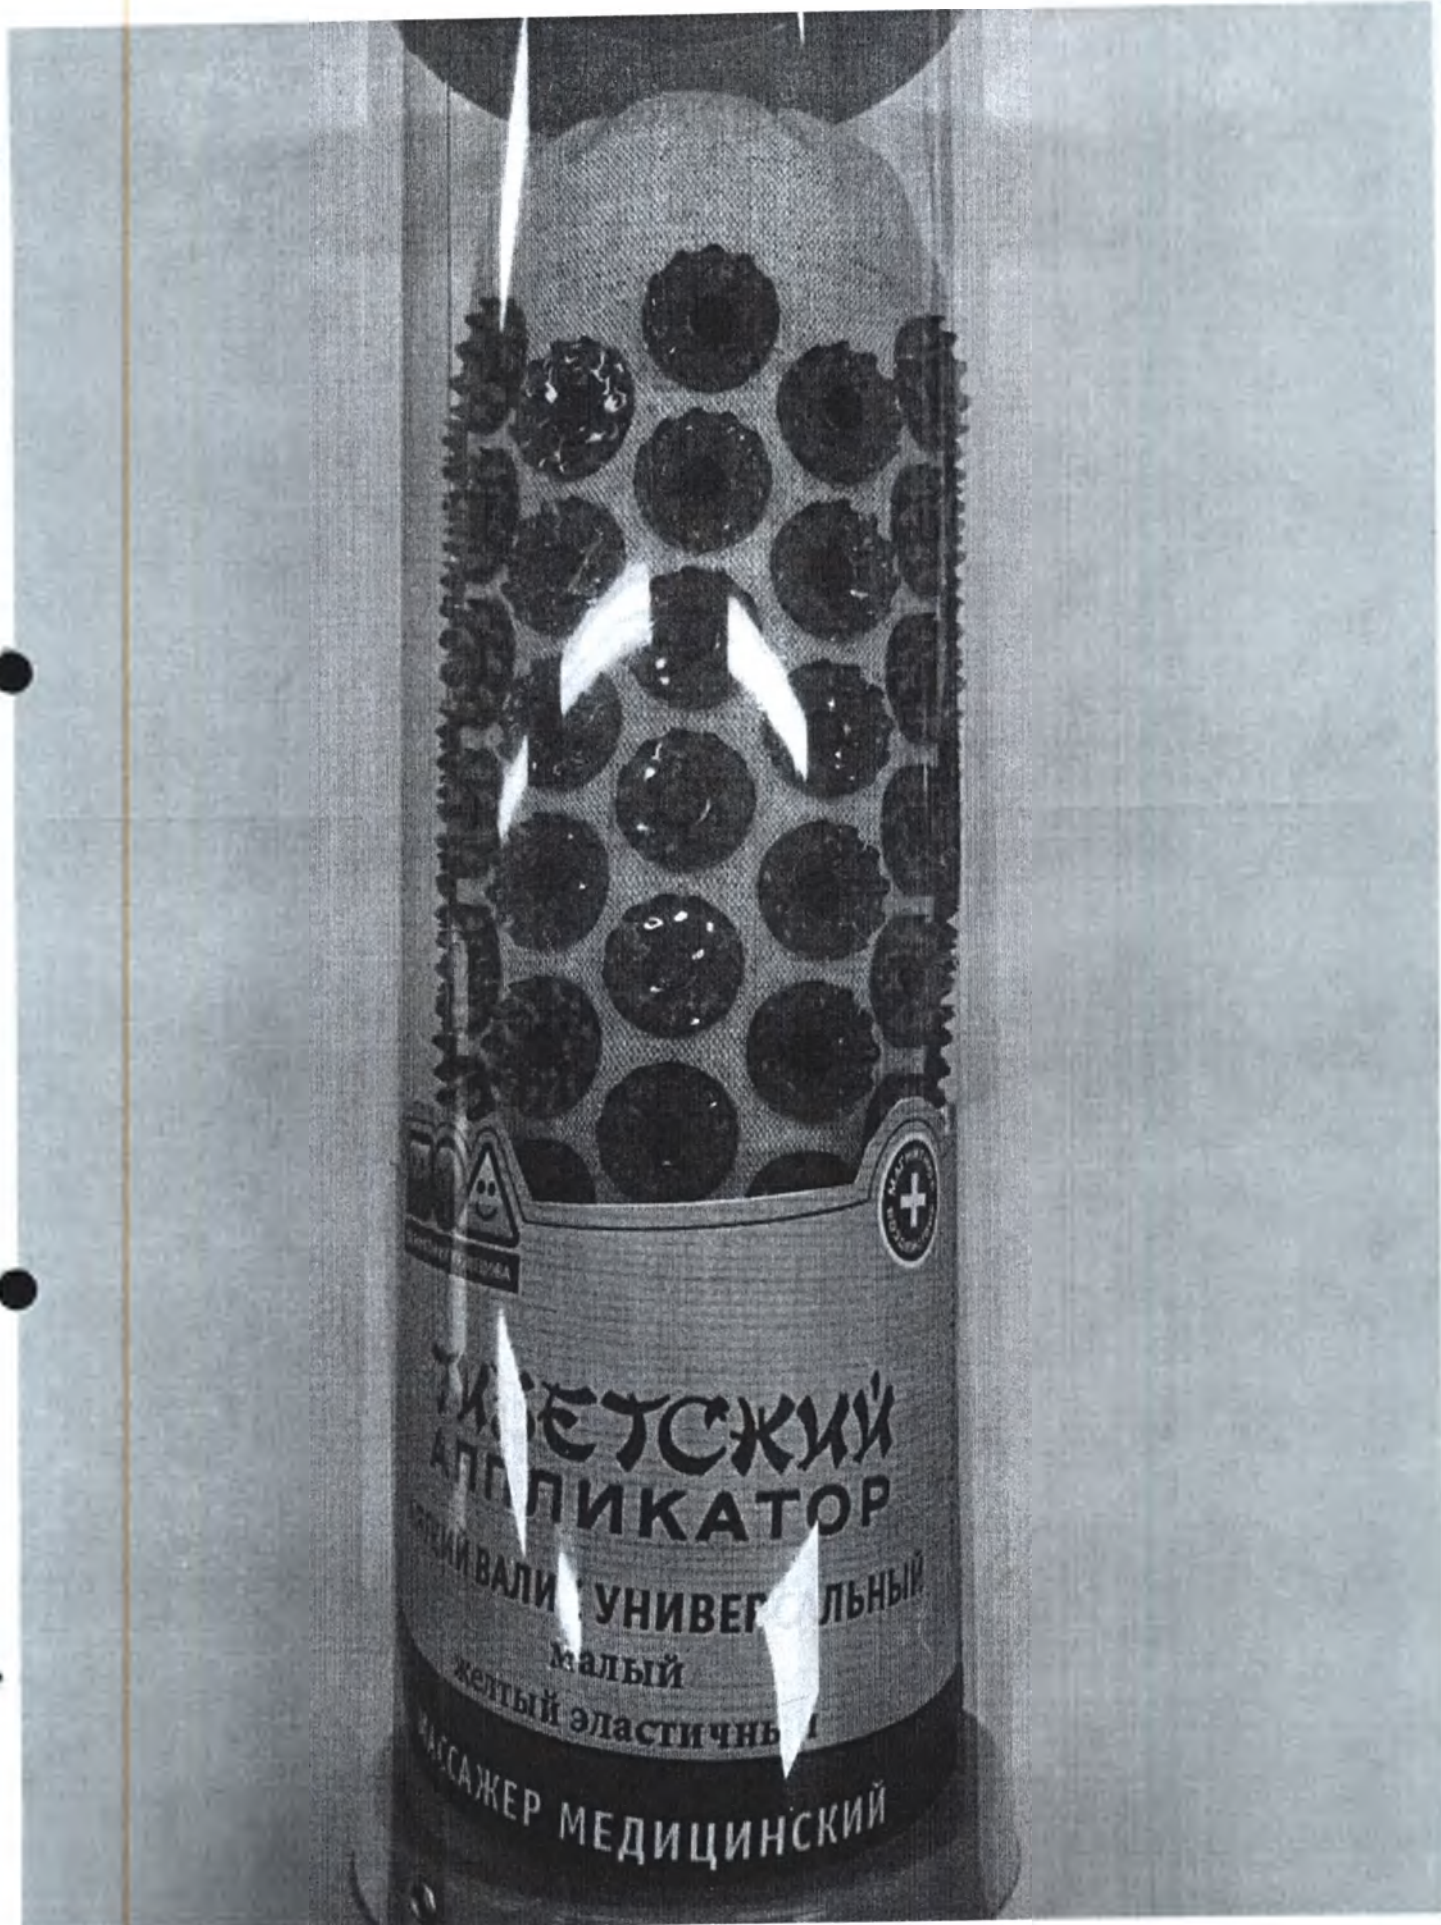



445

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» массажный мешочек, в исполнение: красный

Дата изготовления

___ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ


ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23

147

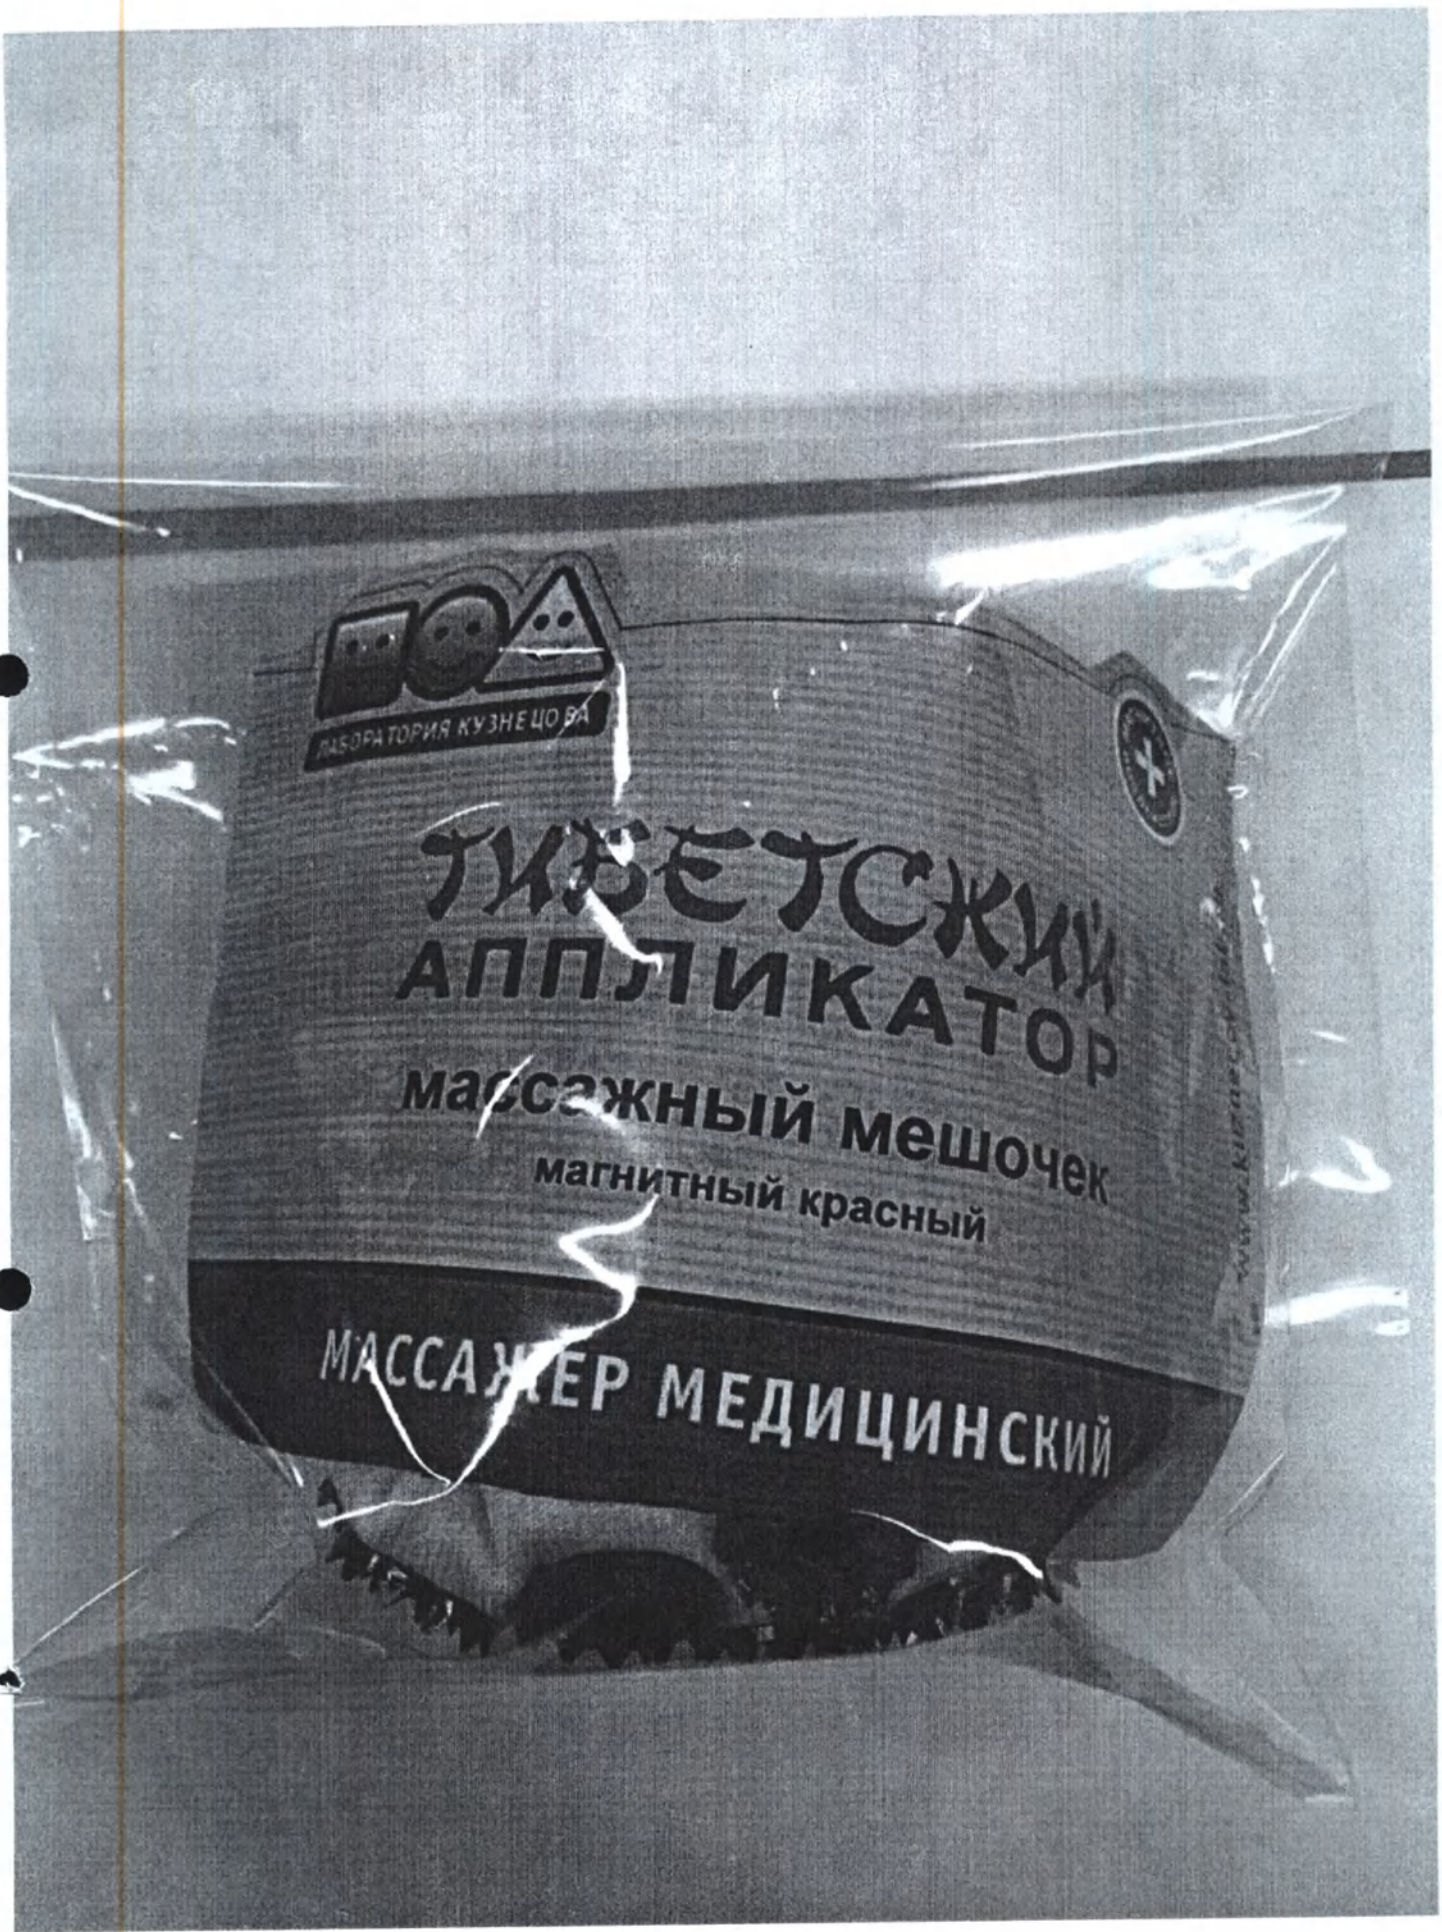



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» массажный мешочек, в исполнение: желтый

Дата изготовления

____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ


ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23



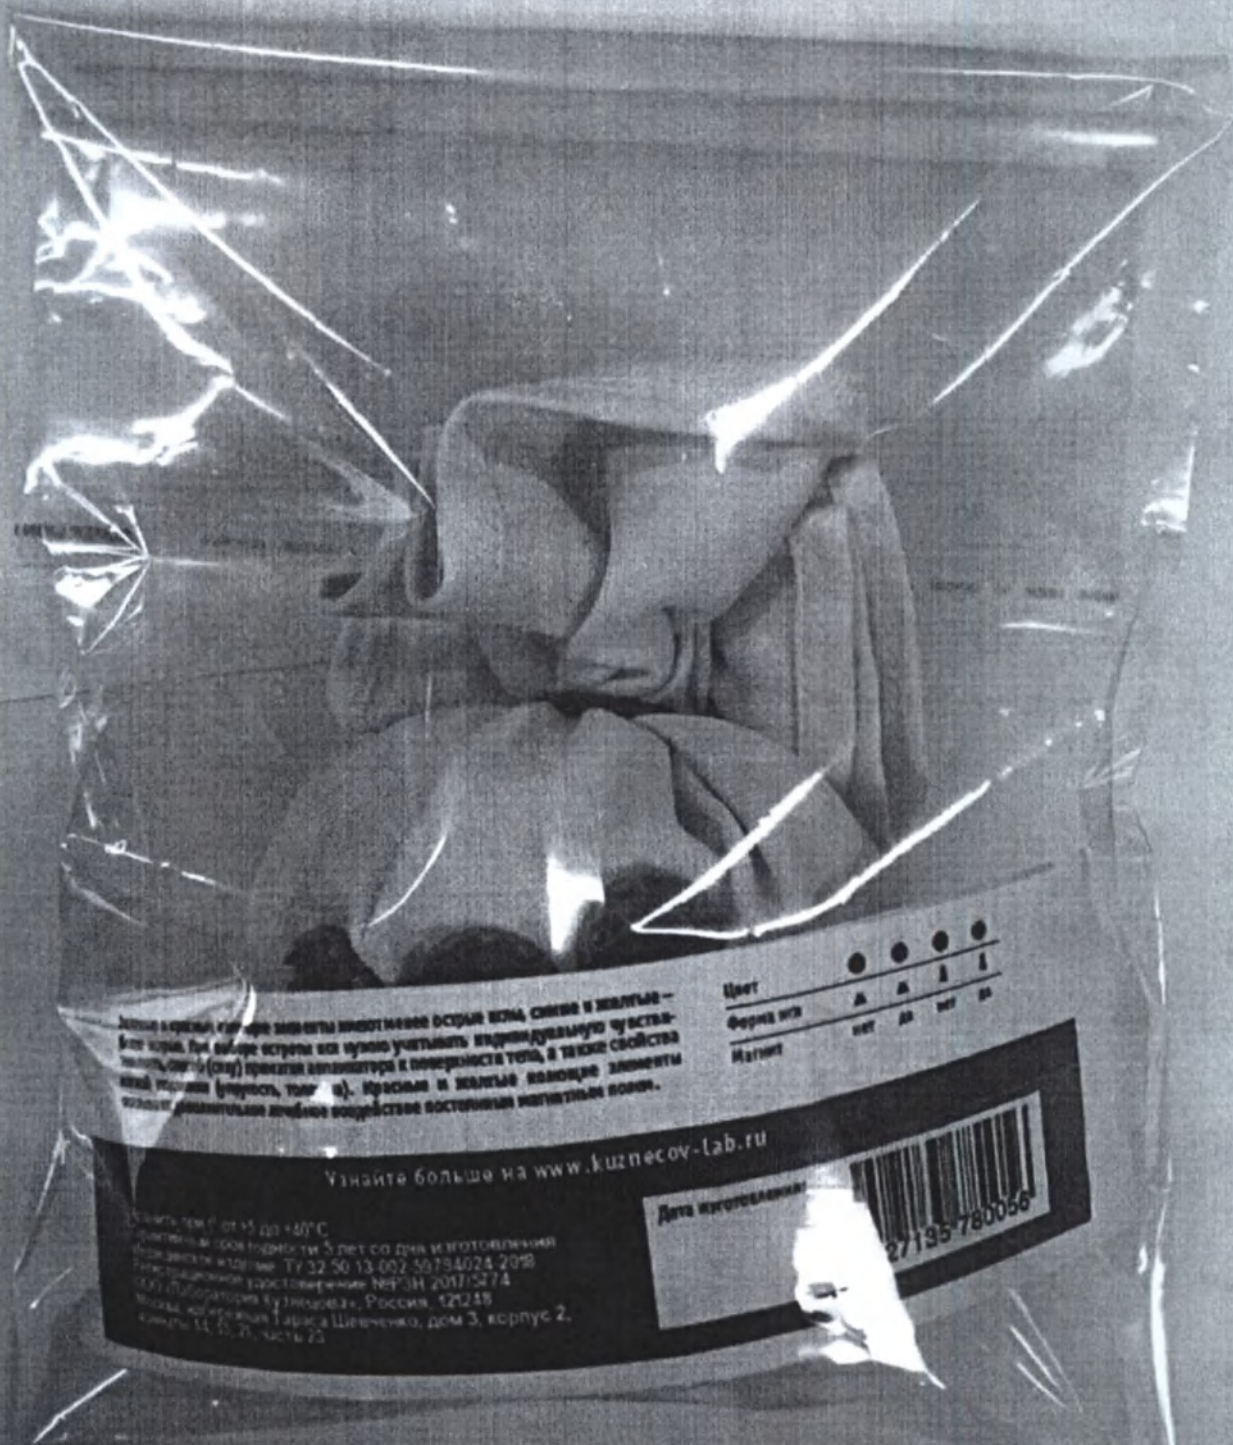

Зеленые и красные элементы имеют менее острую окраску, синие и желтые — более острую. Для оценки остроты все нужно учитывать, учитывая давящую чувствительность, степень (силу) прижатия аппликатора к поверхности тела, а также свойства кожи, состояние (сухость, толи и). Красные и желтые волокна элементы являются дополнительным средством восстановления и питания кожи.

Цвет	☒	☒	☒	☒
Форма и/или	А	А	А	А
Материал	нет	да	нет	да

Узнайте больше на www.kuznetsov-lab.ru

Хранить при t от +5 до +40°C
 Срок годности 5 лет со дня изготовления
 Регистрационное удостоверение: Ту 32.50.13.002.58794024.2018
 Регистрационное удостоверение: ИРЭИИ 2017/5474
 ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248
 Москва, район Юго-Восточный, Гари, д. Шелестенко, дом 3, корпус 2,
 квартира 14, 15, 21, часть 2/2

Дата изготовления



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» массажный мешочек, в исполнение: желтый эластичный.

Дата изготовления

____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет


Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведения об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23

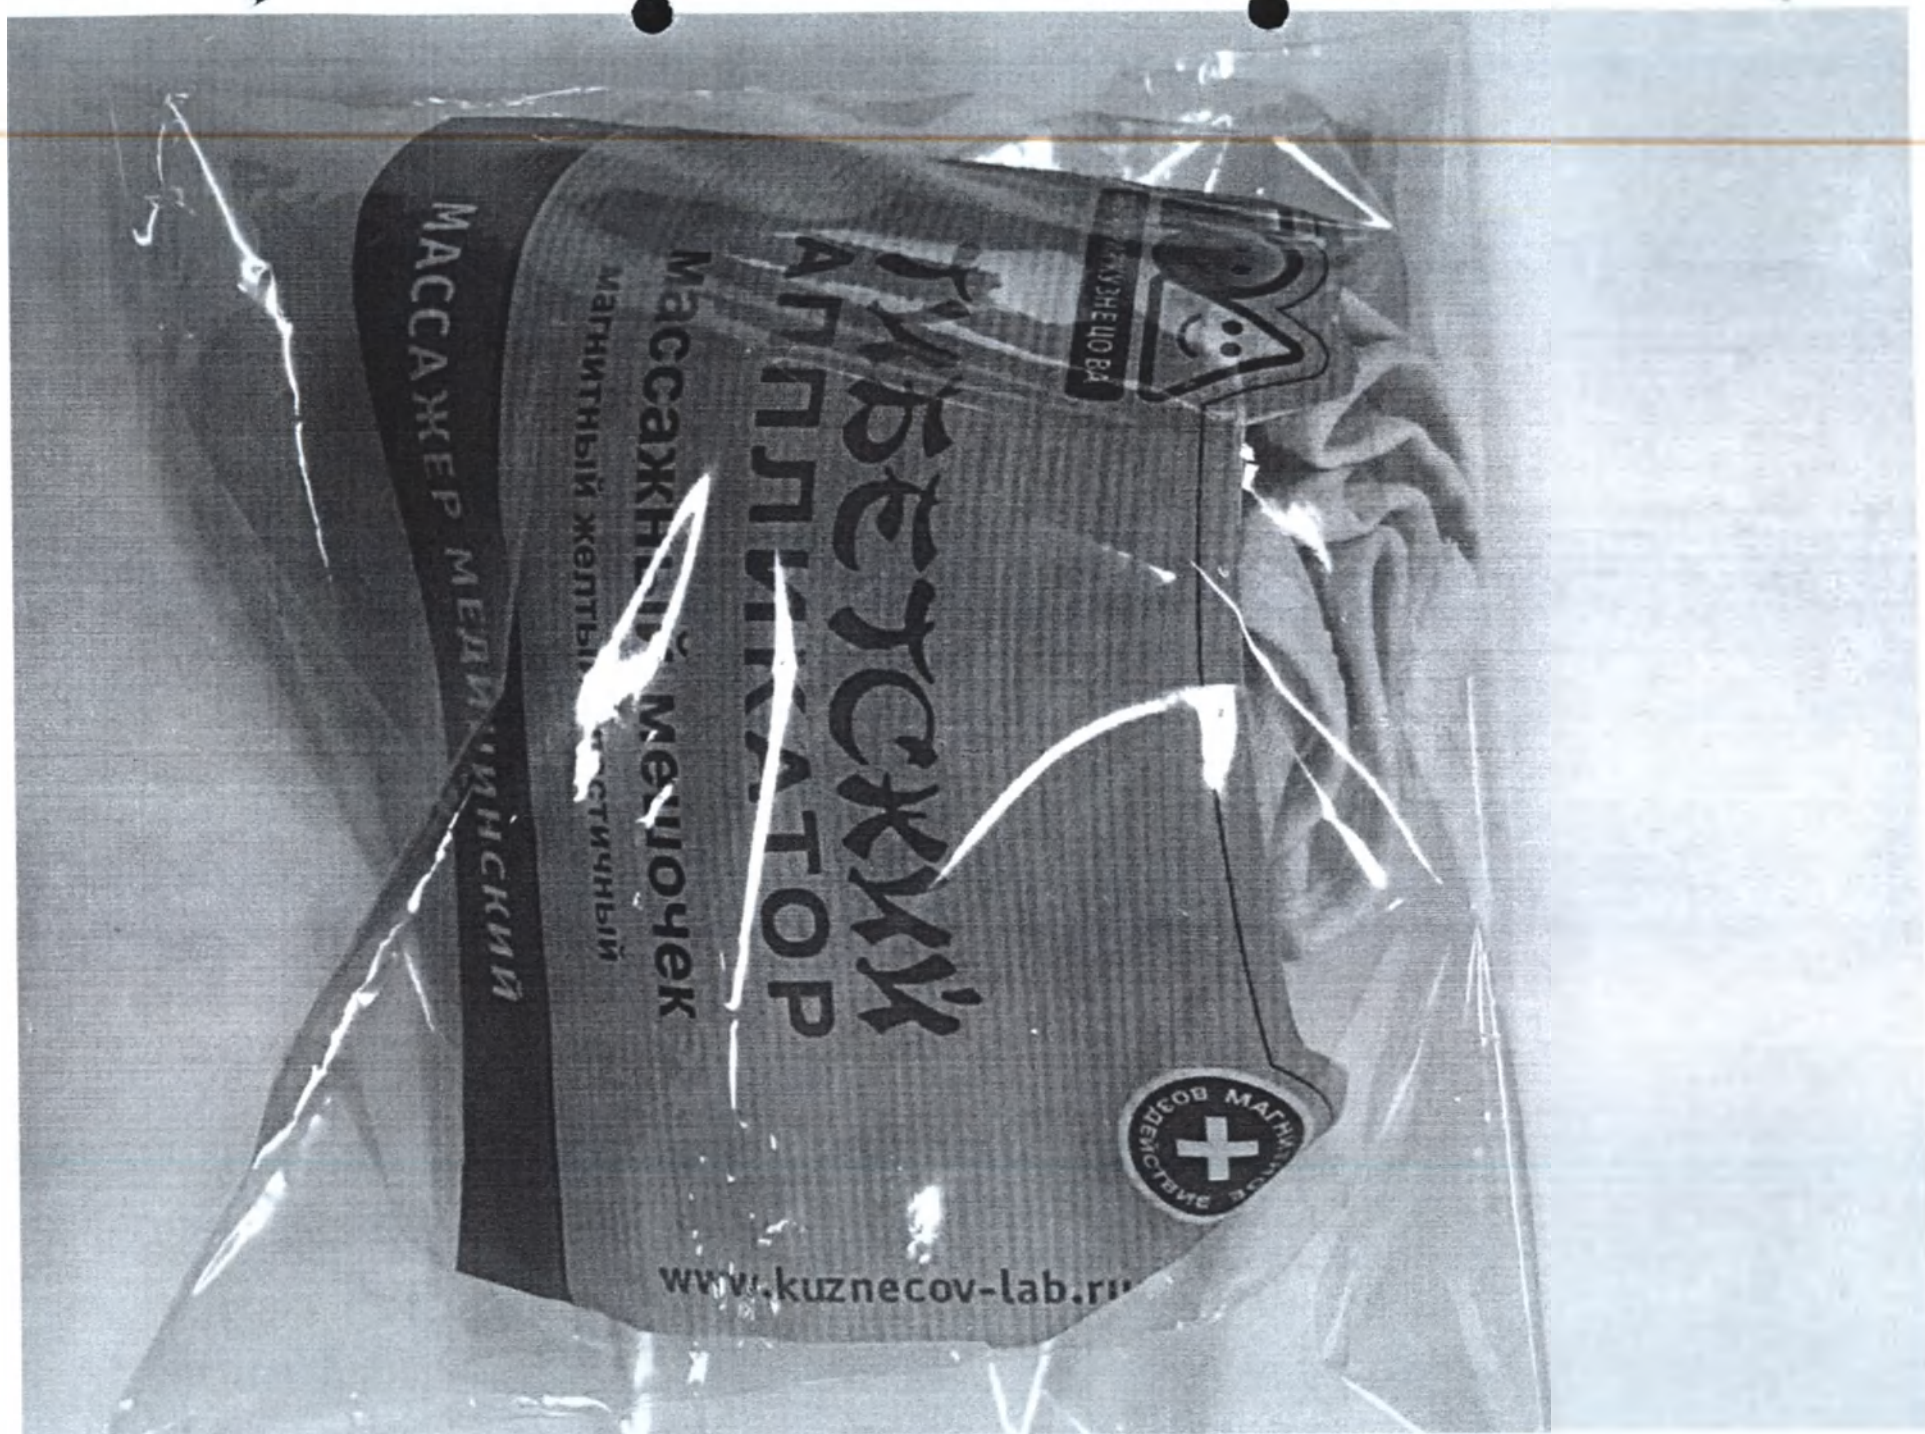

[illegible][illegible]

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

**Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» комплект для
антицеллюлитного обертывания, в исполнение: красный**

Дата изготовления

____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет



Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23

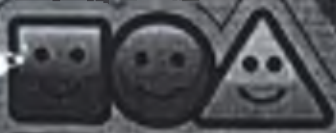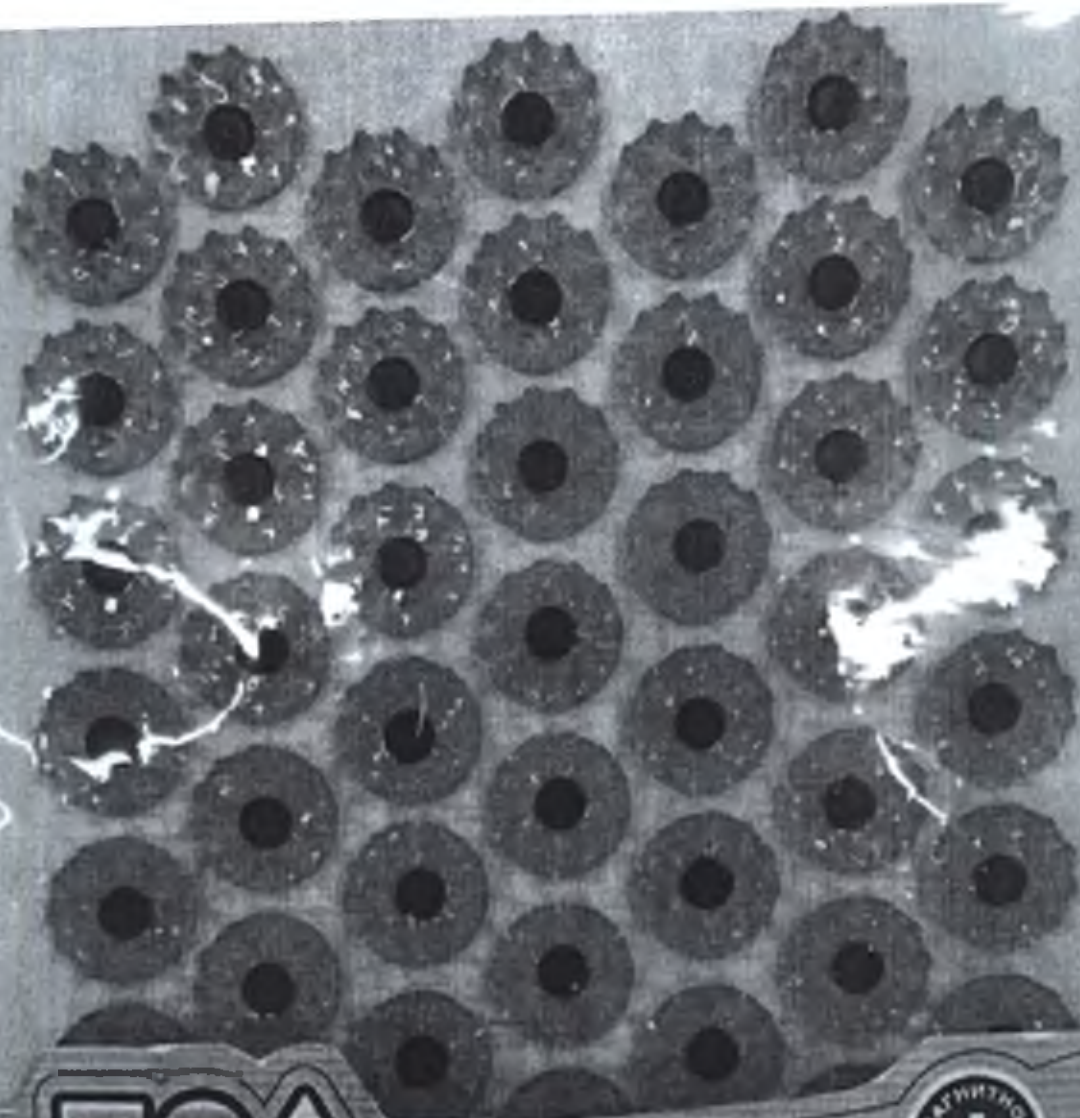

ЛАБОРАТОРИЯ КУЗНЕЦОВА



www.kuznetsov-lab.ru

ТИБЕТСКИЙ АППЛИКАТОР

комплект для антицеллюлитного

обертывания
магнитный красный

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

**Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» комплект для
антицеллюлитного обертывания, в исполнение:желтый**

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ


ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведения об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3,корп.2, комнаты 14,15,21,часть 23

858

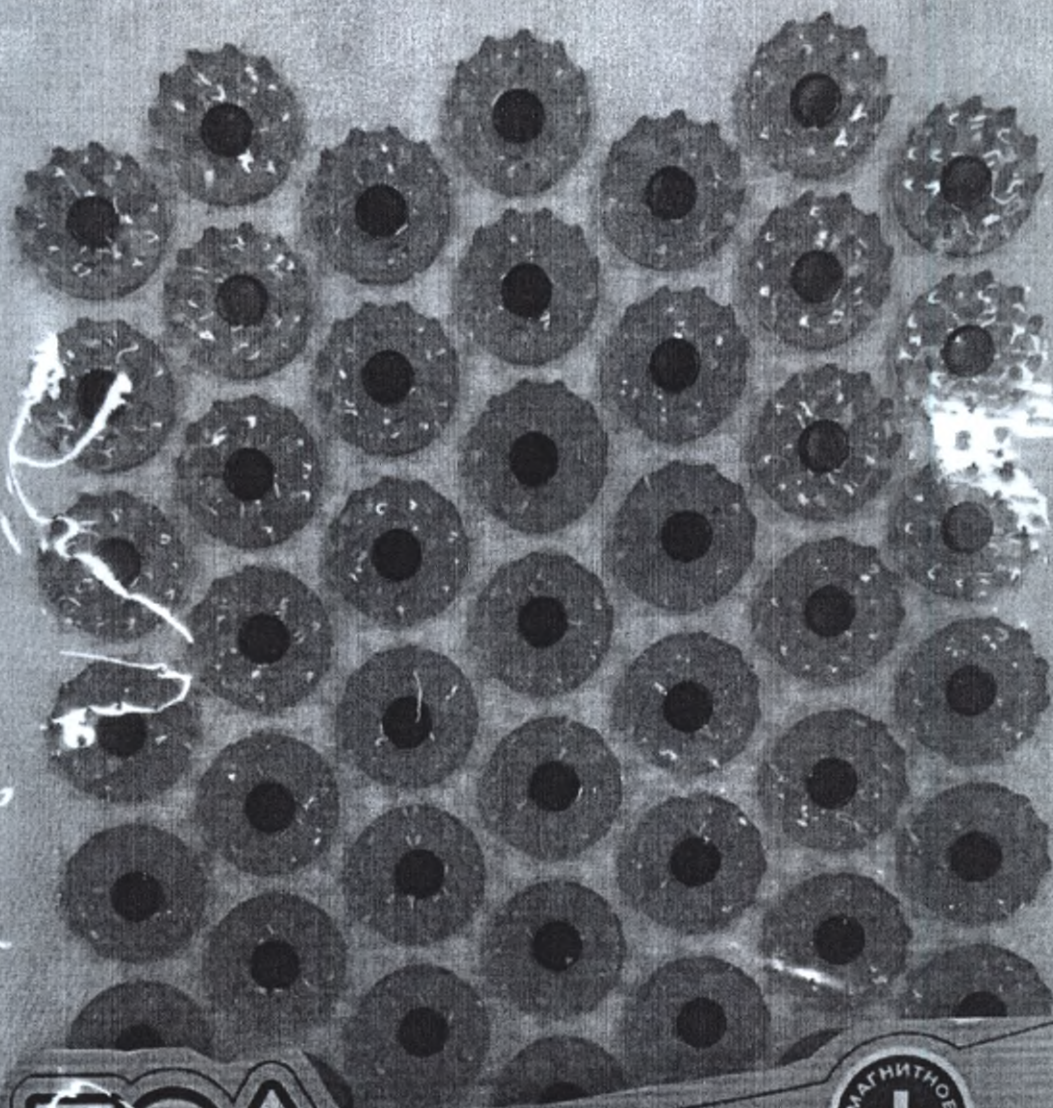

www.kuznetsov-lab.ru

ТИБЕТСКИЙ АППЛИКАТОР

комплект для антицеллюлитного
обертывания
магнитный желтый

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

**Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» комплект для
антицеллюлитного обертывания , в исполнение: желтый эластичный.**

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ


ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3,корп.2, комнаты 14,15,21,часть 23

162

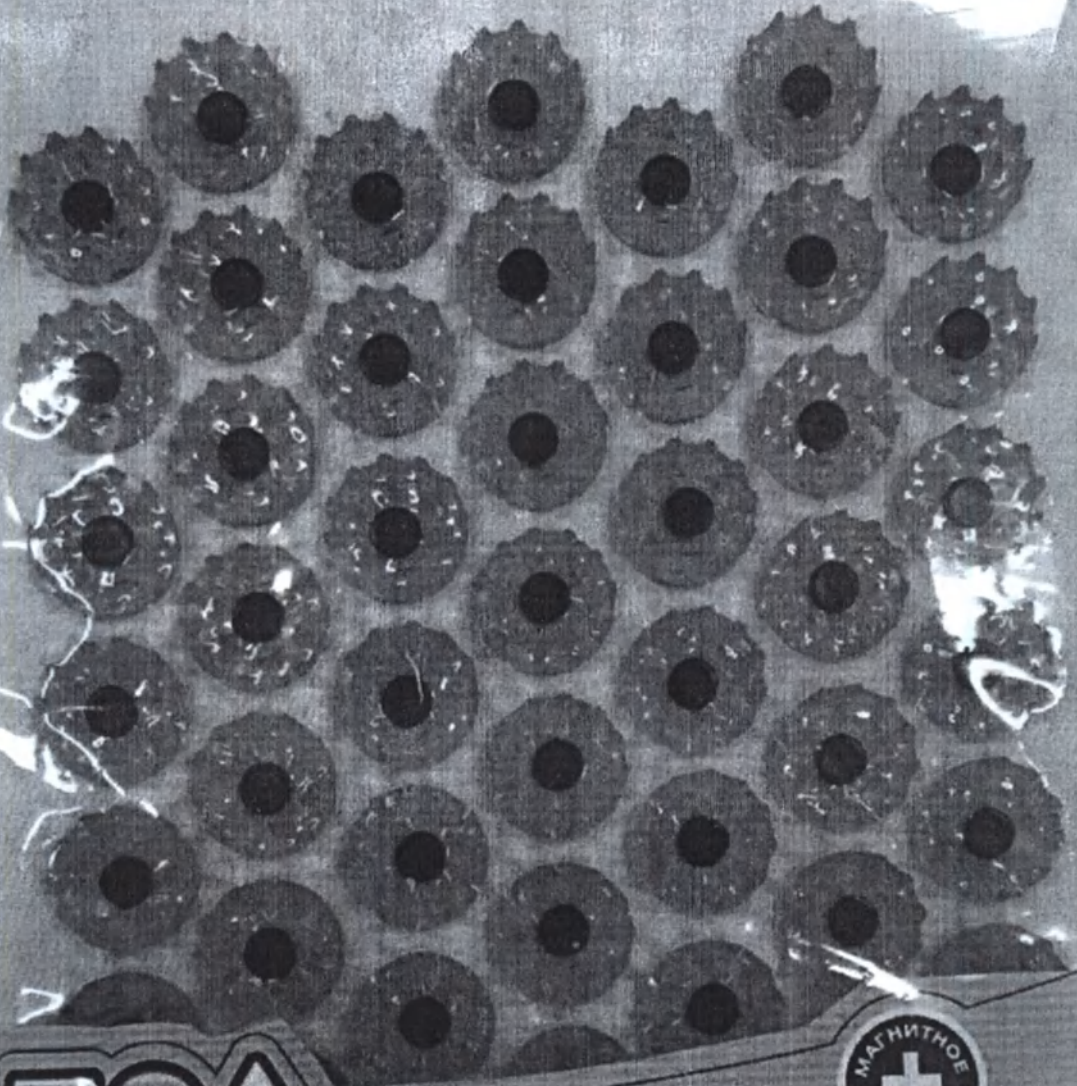

kuznetsov-lab.ru

ТИБЕТСКИЙ АППЛИКАТОР

комплект для антицеллюлитного
обертывания

магнитный желтый эластичный

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

**Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный»» пояс с двумя
сменными мягкими подушечками , в исполнение: красный/желтый**

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3,корп.2, комнаты 14,15,21,часть 23

165

ЛАБОРАТОРИЯ КУЗНЕЦОВА

ТИБЕТСКИЙ АППЛИКАТОР



НА МЯГКОЙ ПОДЛОЖКЕ В КОМПЛЕКТЕ С ПОЯСОМ

МАГНИТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ
МАГНИТНЫЙ КРАСНЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖЕР



Хранить при t от +5 до +40°

Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ №РЗН 2017/5774

ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва

набережная Тараса Шевченко, дом 3, корпус 2, комнаты

14, 15, 21, этаж 23



4 627135 780117

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

**Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» пояс с двумя
сменными мягкими подушечками, в исполнение: красный/желтый эластичный.**

Дата изготовления

____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведения об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23

ЛАБОРАТОРИЯ КУЗНЕЦОВА

ТИБЕТСКИЙ АППЛИКАТОР



НА МЯГКОЙ ПОДЛОЖКЕ В КОМПЛЕКТЕ С ПОЯСОМ

МАГНИТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ
МАГНИТНЫЙ КРАСНЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖЕР



Хранить при t от +5 до +40°
Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления
ТУ 32.50.43-002-59794024-2018
РУ №РЗН 2017/5774
ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва
набережная Тараса Шевченко, дом 3, корпус 2, комнаты
14, 15, 21, часть 23



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» мягкий валик для шеи дорожный, в исполнение: красный

Дата изготовления

____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет


Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23

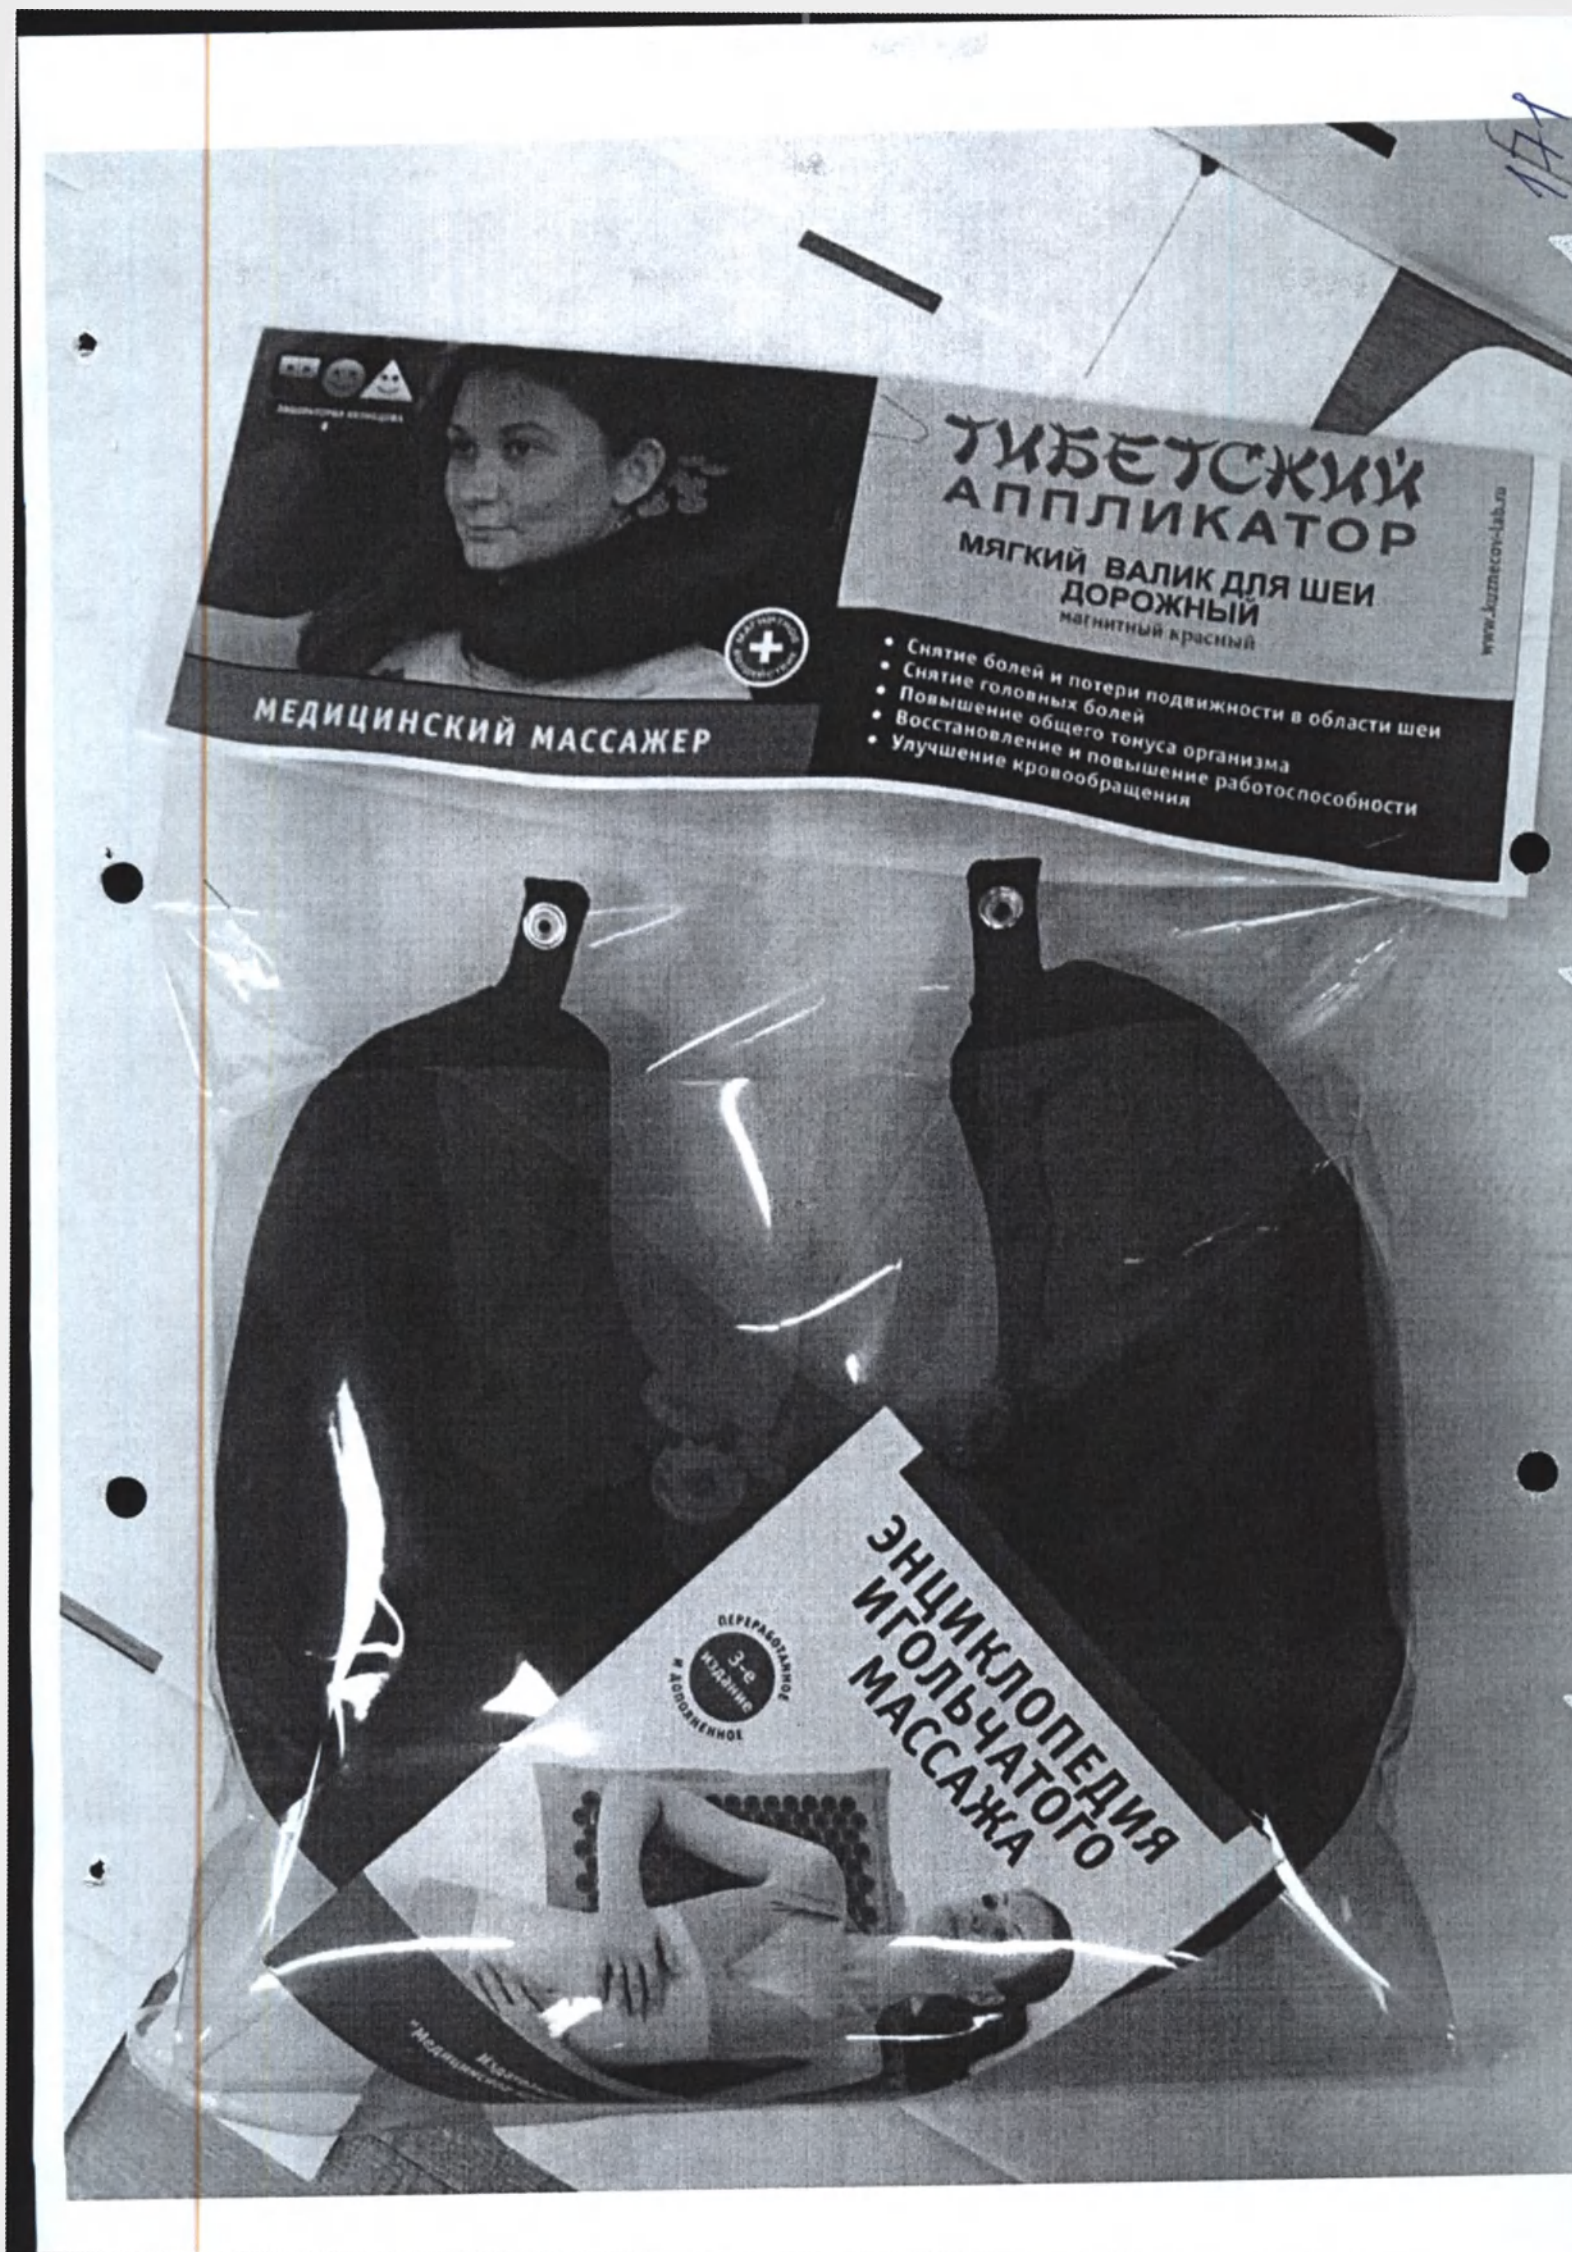

172

ТИБЕТСКОГО АППЛИКАТОРА

пайное острое в соответствии с
методом иглоукалывания массажа.
Двойное острое препятствует
вхождению иглы в кожу. Делает
процедуру более комфортной и эффек-

нажитые вставки усиливают
из-за благодаря дополнительному
статическим магнитным полям;

он обеспечивает равномерное
давление использование массажера

инструмент выполнен из качествен-
ного металла и прочно закреплен

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Надписанный массажер «Тибетский аппликатор» предназна-
чен для выполнения процедуры иглоукалывания массажа.
Иглоукалывательный массаж оказывает лечебное воздействие на
отдельные части тела и органы, в том числе рефлекторно и на
всю систему организма. Особенностью Тибетского апплика-
тора является разделение острой иглы, которое повышает
лечебный эффект и снижает риск травмирования кожи.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

• Снятие боли • Потеря подвижности в области шеи • Сжатие
головных болей • Улучшение кровообращения • Повышение
общего тонуса организма, восстановление и повышение
работоспособности, восстановление после физических
нагрузок • По назначению врача возможны иные показания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Наличие в зоне воздействия опухолей (доброкачественных),
нагноений, бородавок и других образований. Дерматиты,
онкологические заболевания любых локализаций.

Важно! При возникновении симптомов вегетативных расстройств
(учащенное сердцебиение, слабость, головокружение и др.)
необходимо уменьшить продолжительность и интенсивность
процедуры вплоть до полного их прекращения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Легкий массажный валяк для шеи (длинное исполнение) торкает на
шею и обмотавшись на шпильку кресла обеспечивает необходимое
прижатие, наклоняя элемент. Для увеличения интенсивности
массажа можно поворачивать голову из стороны в сторону. Сила
давления должна обеспечить контакт воздействия в пределах
болеей переносимости, которое обычно сопровождается ощущением

жжения. Выдавление тепла свидетельствует о высокой эффективности
воздействия. Время и сила воздействия является индивидуаль-
ными для каждого человека и определяется опытом путем. Период
воздействия может колебаться от одной минуты до нескольких
часов, но в большинстве случаев, процедура длится 5-15 минут.
Рекомендуется проводить одну-две процедуры в сутки. Противопо-
казания к применению.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 до +40°C. Гарантийный срок
использования 5 лет со дня изготовления.

Важно! Тибетский аппликатор является предметом лич-
ной гигиены. При использовании массажа возможны микро-
ранения кожи, поэтому категорически запрещается
использование одного массажера разными людьми.

Узнайте больше на www.kuznecov-lab.ru

Дата изготовления:

Май 2018



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» мягкий валик для шеи дорожный, в исполнение: желтый

Дата изготовления

____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ


ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23

5774

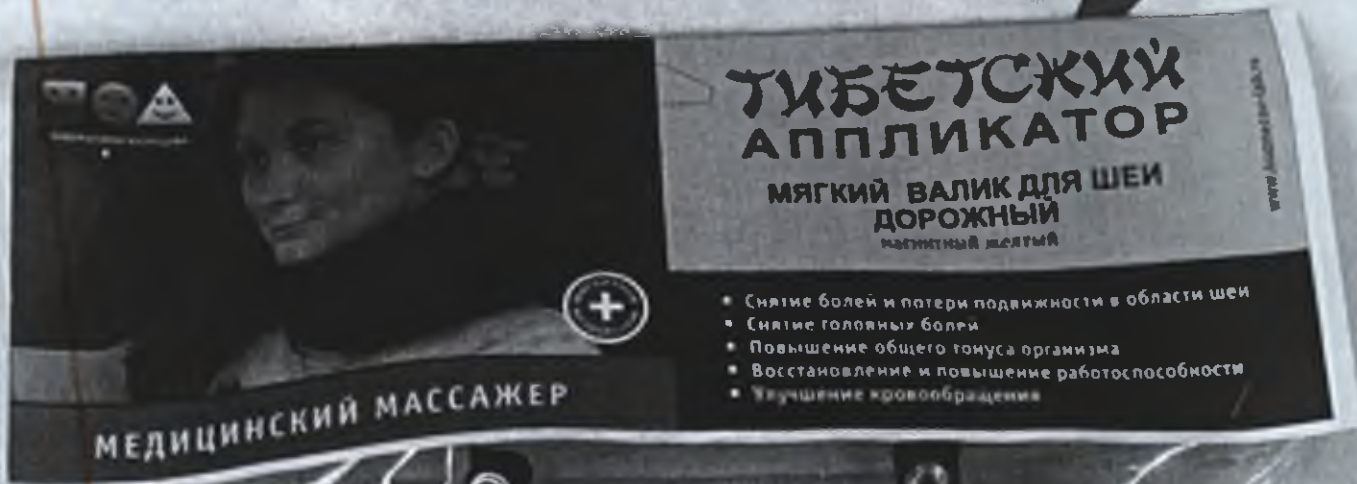

**ТИБЕТСКИЙ
АППЛИКАТОР**

МЯГКИЙ ВАЛИК ДЛЯ ШЕИ
ДОРОЖНОЙ
НАТУРНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖЕР

- Снятие боли и потери подвижности в области шеи
- Снятие головных болей
- Повышение общего тонуса организма
- Восстановление и повышение работоспособности
- Улучшение кровообращения



**ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ИГОЛЬЧАТОГО
МАССАЖА**

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
МАССАЖА

574

ТИБЕТСКОГО АППЛИКАТОРА

...острие в соответствии с...
...острие представляет...
...более комфортной и эффек-

...острии усиливают...
...благодаря дополнительному...
...магнитным полем;

...обеспечивает равномерное...
...использование массажера

...из качествен-...
...и прочно закрепле-

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Иглоукалывательный массажер «Тибетский аппликатор» предназна-
чен для выполнения процедуры иглоукалывательного массажа.
Иглоукалывательный массаж оказывает лечебное воздействие на
отдельные части тела и органы, а также рефлекторно и на
все системы организма. Особенностью Тибетского апплика-
тора является разделение острой иглы, которое повышает
лечебный эффект и снижает риск травмирования кожи.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

• Снятие боли и потерю подвижности в области шеи • Снятие
головных болей • Улучшение кровообращения • Повышение
общего тонуса организма, восстановление и повышение
работоспособности, восстановление после физических
нагрузок • По назначению врача возможны иные показания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Нельзя в зоне воздействия выщипывать волосы (депиляция),
прижигать, бритье и другие обработки. Дерматиты.
Онкологические заболевания любой локализации.

Важно! При возникновении сильных вегетативных реакций
(головокружение, слабость, тошнота и др.)
необходимо уменьшить продолжительность и интенсив-
ность процедур вплоть до полного их прекращения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Мягкий массажный аппликатор для шеи (длительное использование) оказывает на
шею и обеспечивает на спине массаж обеспечивает необходимое
прижатие, которое является. Для увеличения интенсивности
массажа можно повернуть голову из стороны в сторону. Сила
давления должна обеспечить контакт аппликатора с кожей
большой переносимости, которая обычно сопровождается ощущением

тепла. Ощущение тепла свидетельствует о высокой эффективности
использования. Время и сила воздействия является индивидуаль-
ной для каждого человека и определяется опытным путем. Перед
использованием аппликатора необходимо провести тестирование.
Время воздействия может колебаться от одной минуты до нескольких
минут, но в большинстве случаев, процедура длится 5-15 минут.
Рекомендуется проводить процедуру 1-2 раза в неделю. Прокон-
сультируйтесь со специалистом об индивидуальных особенностях
применения.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 до +40°C. Гарантийный срок
использования 5 лет со дня изготовления.

Важно! Тибетский аппликатор является предметом лич-
ной гигиены. При использовании массажера возможны микро-
повреждения кожи, поэтому категорически запрещается
использование одного массажера разными людьми.

Узнайте больше на www.kuznetsov-lab.ru

Дата изготовления:

Май 2018



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Тибетский аппликатор магнитный» мягкий валик для шеи дорожный, в исполнение: желтый эластичный.

Дата изготовления

____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23

177

МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖЕР

ТИБЕТСКИЙ АППЛИКАТОР
МЯГКИЙ ВАЛИК ДЛЯ ШЕИ
ДОРОЖНОЙ

Снятие боли и потери подвижности в области шеи
Снятие головных болей
Повышение общего тонуса организма
Восстановление и повышение работоспособности
Улучшение кровообращения

www.kozmich.ru

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ИГОЛЬЧАТОГО
МАССАЖА

3-е издание

Сертификат
3-е издание
сертифицировано

44-38861-1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680,

ВНЕШНЕГО ДОПУСКАЮЩИМ.

ежные органы и специалисты с
методы изучения состояния
Данные о стране принимаются
анализом или в виде данно-
ру более информативной и эффек-

материю, которая устанавли-
ет базисом для принятия
своими властными органами
и обеспечивает разносторон-
ное использование информации

материю, которая устанавли-
ет базисом для принятия
своими властными органами
и обеспечивает разносторон-
ное использование информации

инструкция по применению

[illegible]

ПРОТИВОПОЖАРА
Начальник и члены колхозного пожарного дружина (справа): Александр Бардаков и Агния Бардакова. В центре — Александр Бардаков. Сзади — Александр Бардаков и Агния Бардакова.

[illegible]

сорта. Сорт «Солнечный» имеет желтую окраску и высокий эффективность использования. Третья и самая поздняя группа является промежуточной по времени созревания и характеризуется наличием густой, пышной листвы, но с более мелкими плодами, чем у сорта «Солнечный». Сорт «Солнечный» имеет плоды с массой 3-5 мг, что является оптимальным для использования в пищу. Плоды имеют желтую окраску.

УСЛОВИЯ ЗАДАНИЯ
 Масса m — температура t и λ — 400°C . Температурный коэффициент α — 10^{-5} на 1°C .
 Вспомогательная информация: λ — температура плавления, α — температурный коэффициент расширения.

узнайте больше на www.kuznetsov-lab.ru



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Аппликатор Кузнецова металломагнитный» без подложки, размерный ряд 15х 22 см

в исполнение: монометаллический

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23

081
180

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ



ЛАБОРАТОРИЯ КУЗНЕЦОВА



**АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА
МЕТАЛЛОМАГНИТНЫЙ**

**МОНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
15x22**

181

Хранить при t от +5 до +40°
Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления МИИ
ТУ 32.50.13-002-59794024-2018
РУ №РЗН 2017/5774
ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва, набережная
Тараса Шевченко, дом 3, корпус 2, комнаты 14, 15, 21, часть 23

Дата изготовления:



4 627135 780018

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Аппликатор Кузнецова металломагнитный» без подложки, размерный ряд 15х 22 см

в исполнение: полиметаллический

Дата изготовления

____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23

183

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ



**АПЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА
МЕТАЛЛОМАГНИТНЫЙ**

**полиметаллический
15x22**

184

Хранить при t от +5 до +40°
Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления МИ
ТУ 32.50.13-002-59794024-2018
РУ №РЗН 2017 /5774
ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва, набережная
Тараса Шевченко, дом 3, корпус 2, комнаты 14, 15, 21, часть 23

Дата изготовления:



4 627135 780018

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Аппликатор Кузнецова металломагнитный» на мягкой подложке, размерный ряд 15х 22 см

в исполнение: полиметаллический

Дата изготовления

____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23

186

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ



ЛАБОРАТОРИЯ КУЗНЕЦОВА



**АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА
МЕТАЛЛОМАГНИТНЫЙ**

**на мягкой подложке 15x22
полиметаллический**

187

Хранить при t от +5 до +40°

Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ №РЗН 2017 /5774

ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва,
набережная Тараса Шевченко, дом 3, корпус 2, комнаты
14, 15, 21, часть 23

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

**Массажер медицинский «Аппликатор Кузнецова металломагнитный» на мягкой подложке, размерный ряд 15x 22 см
в исполнение: монометаллический**

Дата изготовления

____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведения об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Трасса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23

188



МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ



**АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА
МЕТАЛЛОМАГНИТНЫЙ**

**на мягкой подложке 15x22
монометаллический**

190

Хранить при t от +5 до +40°

Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ №РЗН 2017 /5774

ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва,
набережная Тараса Шевченко, дом 3, корпус 2, комнаты
14, 15, 21, часть 23

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Аппликатор Кузнецова металломагнитный» на мягкой подложке, размерный ряд 30 x 22 см

в исполнение: полиметаллический

Дата изготовления

____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ



АПЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА
МЕТАЛЛОМАГНИТНЫЙ
на мягкой подложке
30*22 см
полиметаллический

Хранить при t от +5 до +40°
Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления МИ
ТУ 32.50.13-002-59794024-2018
РУ №РЗН 2017/5774
ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва, набережная
Тараса Шевченко, дом 3, корпус 2, комнаты 14, 15, 21, часть 23

Дата изготовления:



4 627135 780018

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

**Массажер медицинский «Аппликатор Кузнецова металломагнитный» на мягкой подложке, размерный ряд 30 x 22 см
в исполнение: монометаллический**

Дата изготовления

____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведения об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ



**АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА
МЕТАЛЛОМАГНИТНЫЙ
на мягкой подложке
30*22 см
монометаллический**

195

Хранить при t от $+5$ до $+40^{\circ}$
Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления МИ
ТУ 32.50.13-002-59794024-2018
РУ №РЗН 2017 /5774
ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва, набережная
Тараса Шевченко, дом 3, корпус 2, комнаты 14, 15, 21, часть 23

Дата изготовления:



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

**Массажер медицинский «Аппликатор Кузнецова металломагнитный» на мягкой подложке, размерный ряд 30 x 44 см
в исполнение: полиметаллический**

Дата изготовления

____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23

198

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ



АПЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА
МЕТАЛЛОМАГНИТНЫЙ
на мягкой подложке
30*44 см
полиметаллический

Хранить при t от +5 до +40°
Срок: не более 5 лет со дня изготовления МН
ТУ 32.50.13-002-99794034-2018
ФУ МРБ 2017.5724
ООО «Цирми» Кузнецкий, Россия, 121248 Москва, набережная
Тараса Шевченко, дом 1, корпус 2, этажи 14, 15, 21, этаж 21

Дата изготовления:



4 627135 780010

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

**Массажер медицинский «Аппликатор Кузнецова металломагнитный» на мягкой подложке, размерный ряд 30 x 44 см
в исполнение: монометаллический**

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ



АПЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА
МЕТАЛЛОМАГНИТНЫЙ
на мягкой подложке
30*44 см
монометаллический

202

Хранить при t от +5 до +40°
Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления МН
ТУ 12.50.13-003-99794024-2018
РУ МРНИ 2017 /5774
ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва, набережная
Тараса Шевченко, дом 3, корпус 2, комнаты 14, 15, 21, часть 23

Дата изготовления:



4 627135 780018

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Аппликатор Кузнецова металломагнитный» валик для шеи в исполнение: полиметаллический

Дата изготовления

____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведения об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23



МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ



**АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА
МЕТАЛЛОМАГНИТНЫЙ**

**ВАЛИК ДЛЯ ШЕИ
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ**

Хранить при t от +5 до +40°
Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления МН
ТУ 32.50.13-002-59794024-2018
РУ №РЗН 2017/5774
ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва, набережная
Тараса Шевченко, дом 3, корпус 2, комнаты 14, 15, 21, часть 23

Дата изготовления:



4 627135 780018

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Аппликатор Кузнецова металломагнитный» валик для шеи в исполнение: монометаллический

Дата изготовления

____ «____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведения об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23

202



X

Хранить при t от +5 до +40°
Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления МПН
ТУ 32.50.13-002-59794024-2018
Р/У №РЗН 2017 /5774
ООО «Лаборторм Кунцево», Россия, 121248 Москва, набережная
Тараса Шевченко, дом 3, корпус 2, комнаты 14, 15, 21, часть 23
Дата изготовления:
4 627138 1780018

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Аппликатор Кузнецова металломагнитный» валик для поясницы : полиметаллический

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23



МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ



ЛАБОРАТОРИЯ КУЗНЕЦОВА



**АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА
МЕТАЛЛОМАГНИТНЫЙ**

**ВАЛИК ДЛЯ ПОЯСНИЦЫ
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ**

211

Хранить при t от +5 до +40°
Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления МИ
ТУ 32.50.13-002-59794024-2018
РУ №РЗН 2017 /5774
ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва, набережная
Тараса Шевченко, дом 3, корпус 2, комнаты 14, 15, 21, часть 23

Дата изготовления:



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Аппликатор Кузнецова металломагнитный» валик для поясницы: монометаллический

Дата изготовления

____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ



ЛАБОРАТОРИЯ КУЗНЕЦОВА



**АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА
МЕТАЛЛОМАГНИТНЫЙ**

**ВАЛИК ДЛЯ ПОЯСНИЦЫ
МОНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ**

214

Хранить при t от +5 до +40°
Гарантийный срок годности 5 лет со дня изготовления МИ
ТУ 32.50.13-002-59794024-2018
РУ №РЗН 2017/5774
ООО «Лаборатория Кузнецова», Россия, 121248 Москва, набережная
Тараса Шевченко, дом 3, корпус 2, комнаты 14, 15, 21, часть 23

Дата изготовления:



4 627135 780018

Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Аппликатор Кузнецова металломагнитный» ролик: монометаллический

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведение об изготовителе

121148, Россия, Москва, набережная Траса Шевченко д.3, корп.2, комнаты 14,15,21, часть 23



МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ



АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА
МЕТАЛЛОМАГНИТНЫЙ
РОЛИК
МОНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕПЛОТЫ И АДАПТИВНОСТИ

В. А. на момент выбора оптимального метода (смысл) применения метода в зависимости от индивидуальных особенностей организма и состояния организма.

В. А. на момент выбора оптимального метода (смысл) применения метода в зависимости от индивидуальных особенностей организма и состояния организма.

Эффективность игольчатого массажа зависит от правильного выбора массажера



На игольчатый массажер 15 x 22 см



На игольчатый массажер 15 x 28 см



На игольчатый массажер 15 x 28 см



На игольчатый массажер 15 x 28 см



На игольчатый массажер 15 x 28 см



На игольчатый массажер 15 x 28 см

В. А. на момент выбора оптимального метода (смысл) применения метода в зависимости от индивидуальных особенностей организма и состояния организма.



На игольчатый массажер 15 x 60 см

В. А. на момент выбора оптимального метода (смысл) применения метода в зависимости от индивидуальных особенностей организма и состояния организма.

Узнайте больше на www.kuznetsov-lab.ru

В. А. на момент выбора оптимального метода (смысл) применения метода в зависимости от индивидуальных особенностей организма и состояния организма.



Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

ООО «Лаборатория Кузнецова»

Наименование массажера и обозначение исполнения, модификации

Массажер медицинский «Аппликатор Кузнецова металломагнитный» ролик : полиметаллический

Дата изготовления

_____ «_____» 20__ г.

Температура хранения

От +5 до +40

Гарантийный срок годности

5 лет

Обозначение настоящих ТУ

ТУ 32.50.13-002-59794024-2018

РУ РЗН 2017/5774

Сведения об изготовителе

121148, Россия, Москва, наберная Траса Шевченко д.3,корп.2, комнаты 14,15,21,часть 23



МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ



**АПЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА
МЕТАЛЛОМАГНИТНЫЙ
РОЛИК
полиметаллический**

ПРЕИМУЩЕСТВА ТИПОВОГО АППАРАТА

• Для заботы о спине при желании выбрать аппарат в зависимости от индивидуальных особенностей тела.

• Имеет много режимов, доступных в любой момент времени, что позволяет использовать аппарат в любое время и в любом месте.

• Аппарат имеет возможность работать в режиме «Автоматический режим».

• Сочетание массажных роликов, работающих в разных направлениях, обеспечивает комплексное воздействие на мышцы спины.

• Аппарат имеет возможность работать в режиме «Автоматический режим».

• Аппарат имеет возможность работать в режиме «Автоматический режим».

Эффективность и правильного выбора массажера



На массаж лежа 12 x 22 см



На массаж лежа 12 x 22 см



Массаж лежа для спины



Массаж лежа для спины



Массаж лежа для спины



Массаж лежа для спины

Массаж лежа для спины

Массаж лежа для спины



На массаж лежа 12 x 22 см



На массаж лежа 12 x 22 см

Массаж лежа для спины

Массаж лежа для спины



Узнайте больше на www.kuznetsov-lb.ru

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 220 листа(ов)

Генеральный директор ООО «Лаборатория
Кузнецова»

« 28 » ноября 2018 года

