



Фотографические изображения

Реагенты в кассете для количественного определения антител к стрептолизину О в сыворотке и плазме крови на модулях биохимических Roche/Hitachi cobas с (ASLOT/ Tina-quant Antistreptolysin О cobas с systems)


Реагенты в кассете для количественного определения антител к стрептолизину О в сыворотке и плазме крови на модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c (ASLOT/ Tina-quant Antistreptolysin O cobas c systems)

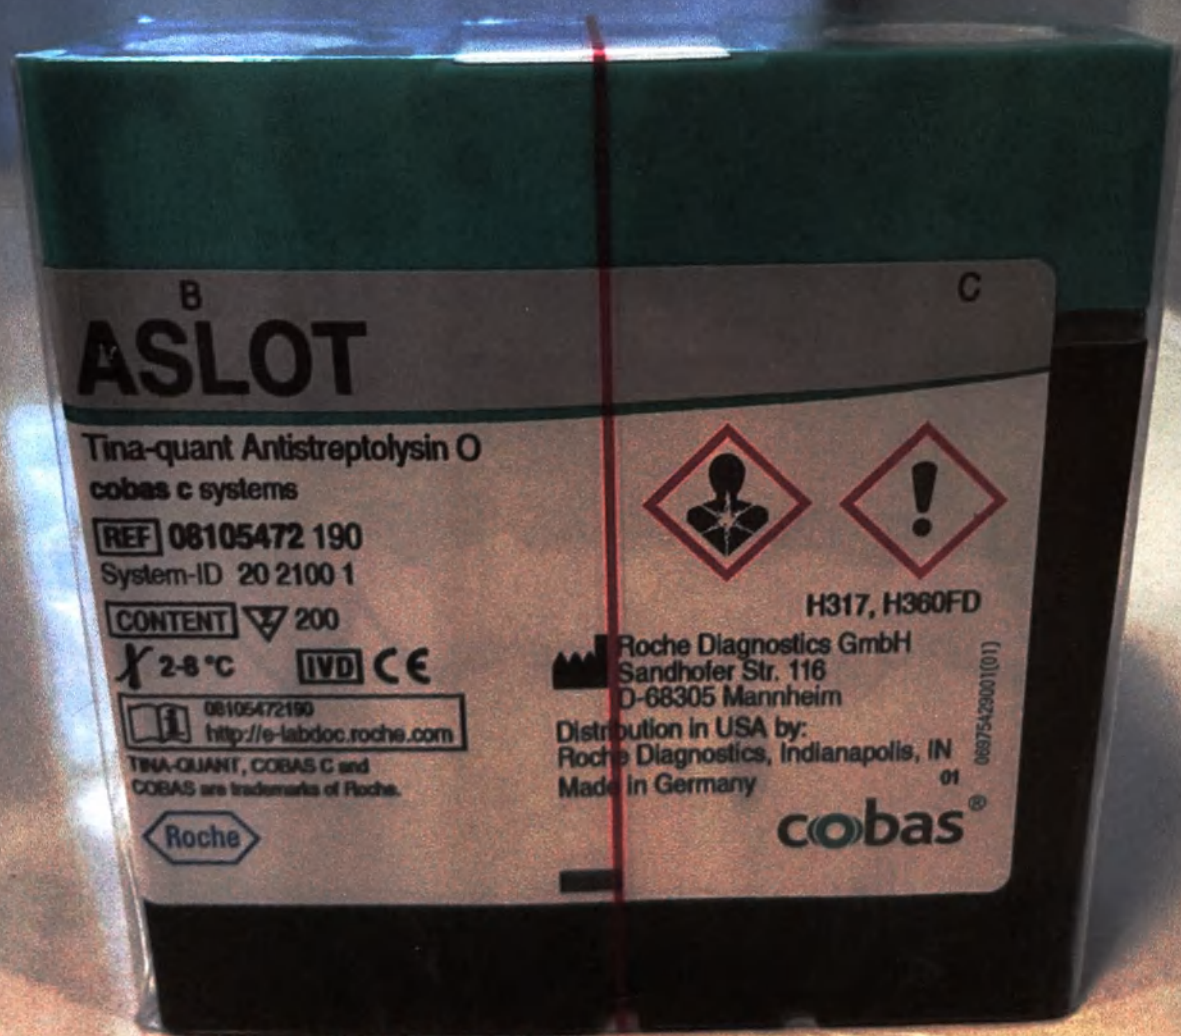

Реагенты в кассете для количественного определения антител к стрептолизину О в сыворотке и плазме крови на модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c (ASLOT/ Tina-quant Antistreptolysin O cobas c systems)

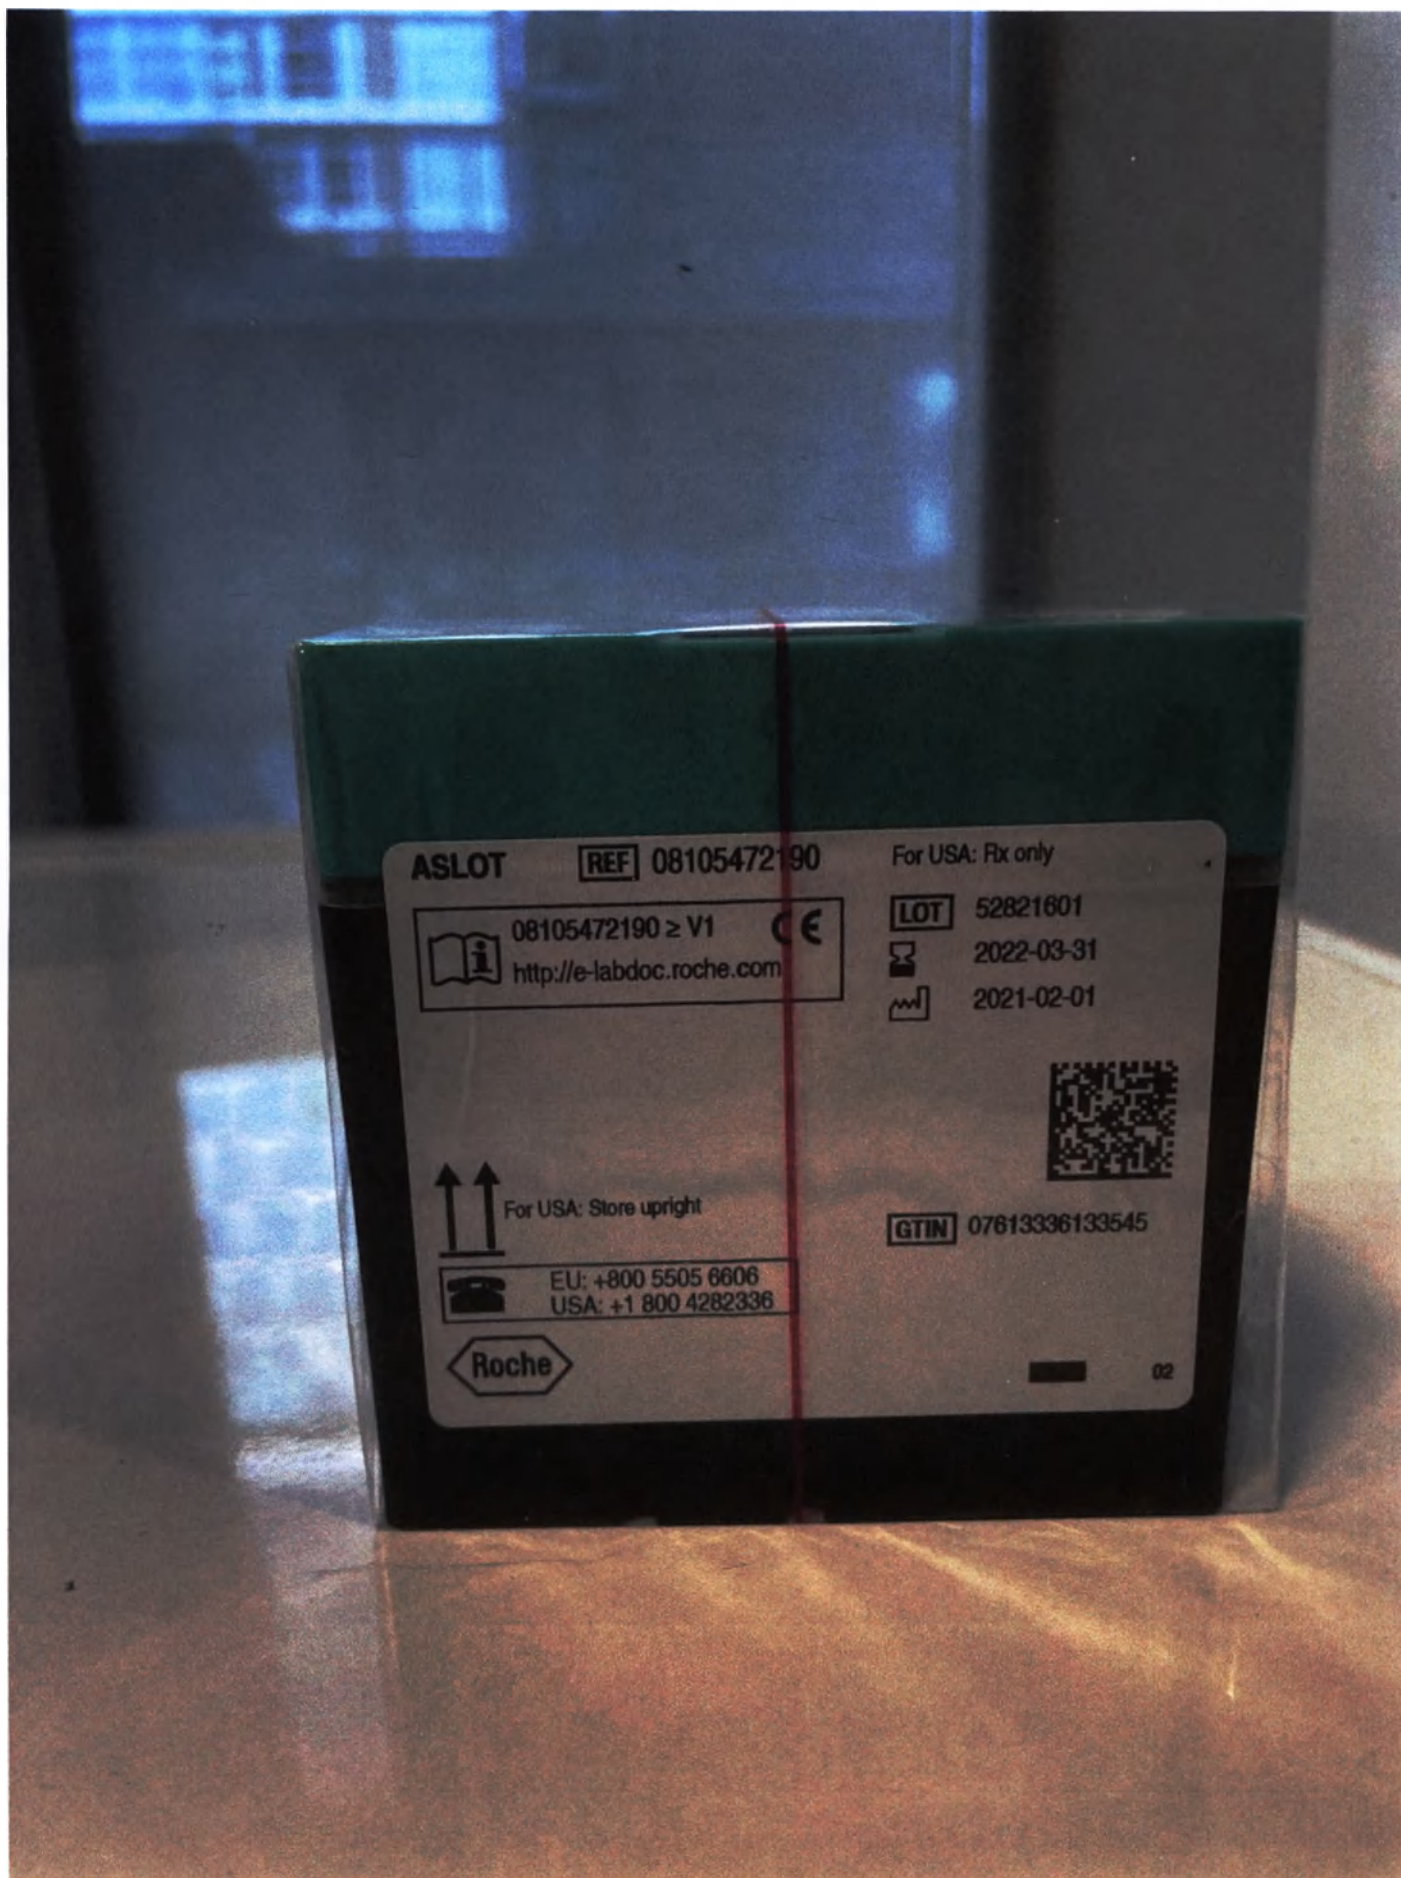

Реагенты в кассете для количественного определения антител к стрептолизину О в сыворотке и плазме крови на модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c (ASLOT/ Tina-quant Antistreptolysin O cobas c systems)

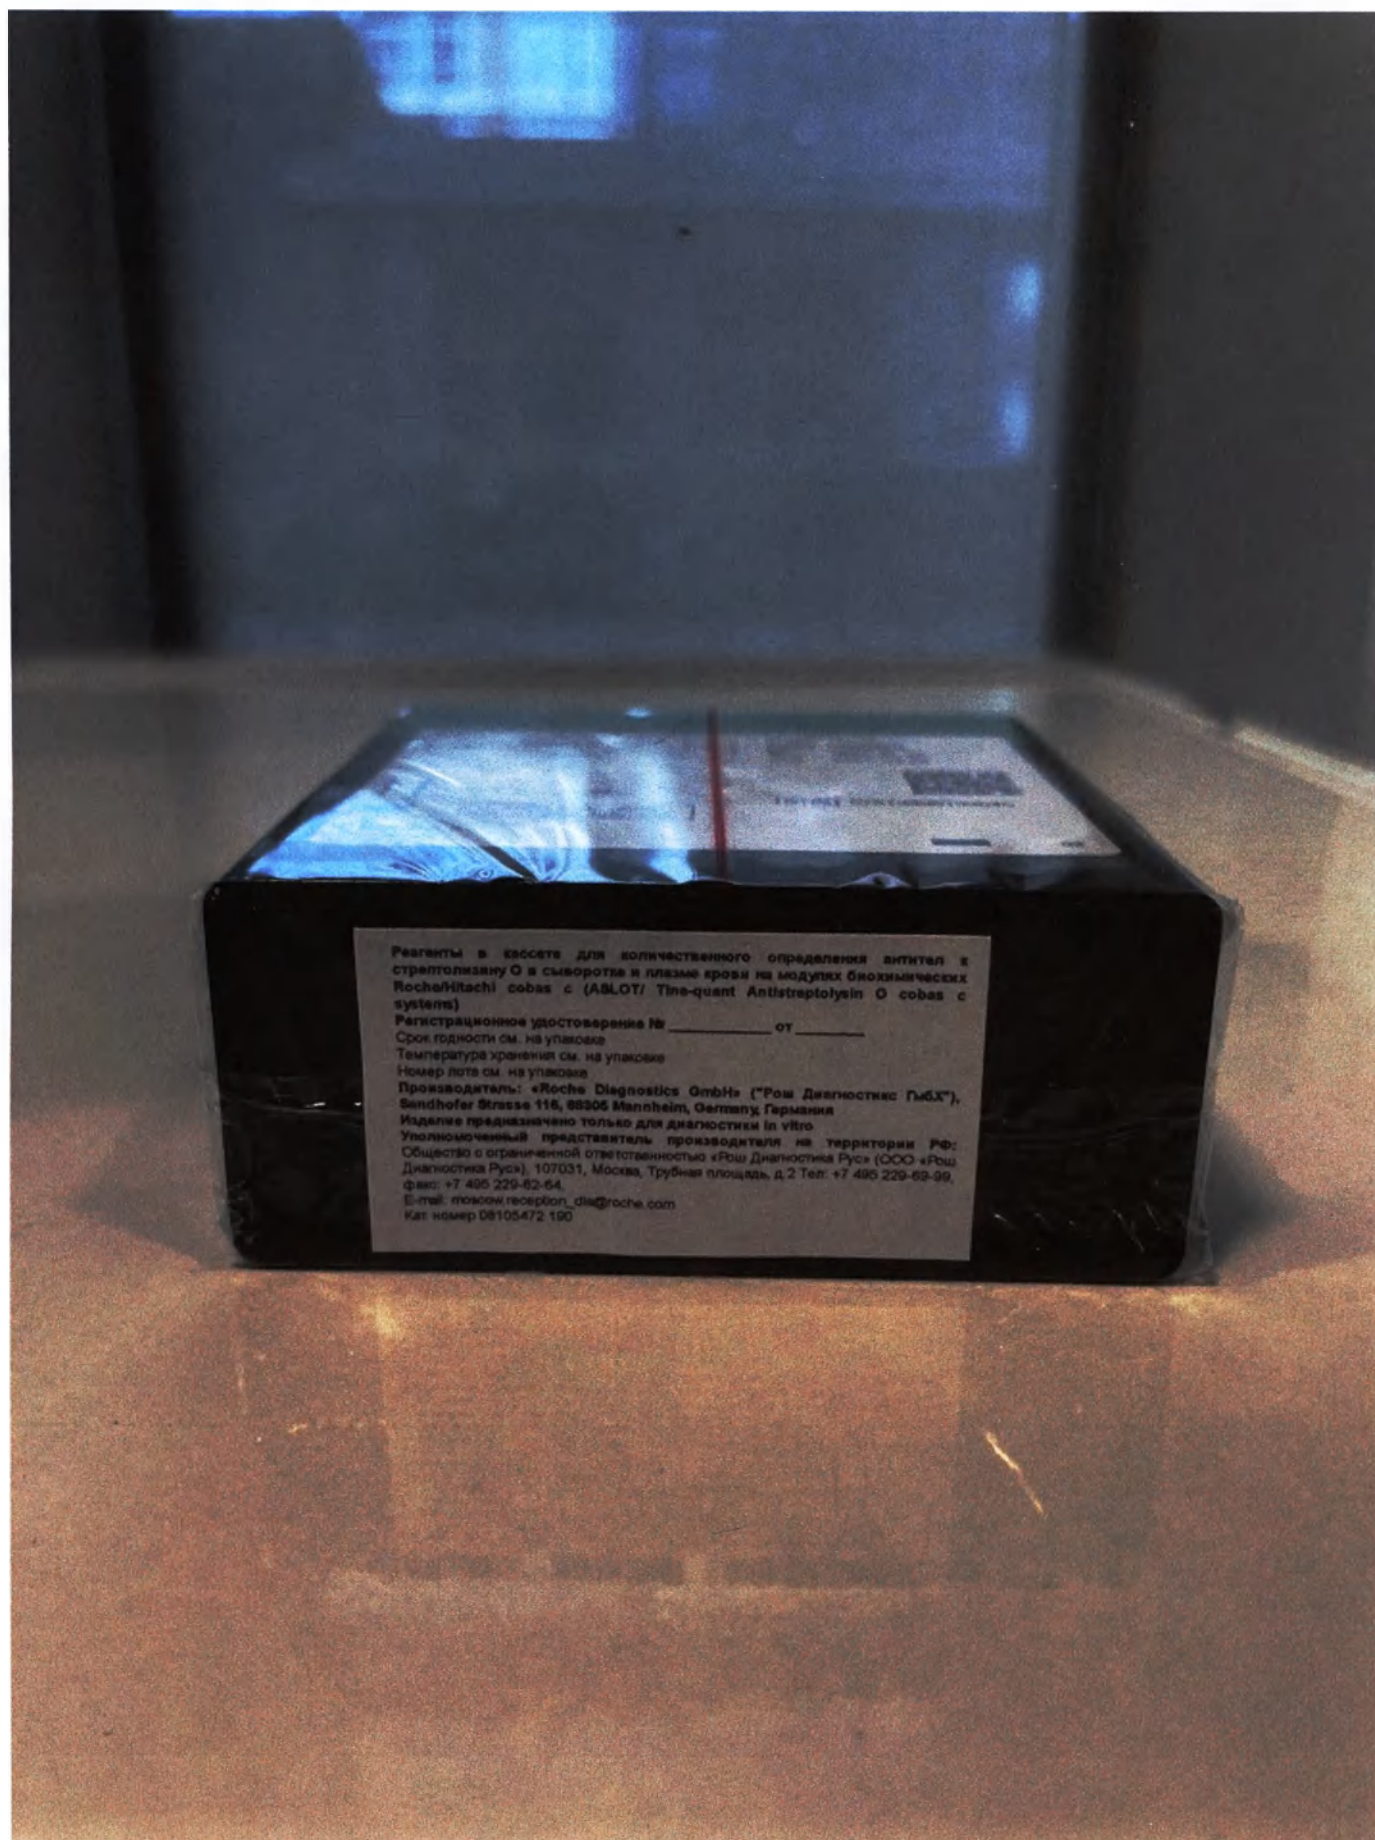

Реагенты в кассете для количественного определения антител к стрептолизину О в сыворотке и плазме крови на модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c (ASLOT/ Tina-quant Antistreptolysin O cobas c systems)
Регистрационное удостоверение № _____ от _____
Срок годности см. на упаковке
Температура хранения см. на упаковке
Номер лота см. на упаковке
Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рох Диагностикс ГмбХ"),
Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany Германия
Издание предназначено только для диагностики in vitro
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Рох Диагностикс Рус» (ООО «Рох
Диагностикс Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-63-99,
факс: +7 495 229-62-64,
E-mail: moscow.reception_dia@roche.com
Кат. номер 08105472 190

Реагенты в кассете для количественного определения антител к стрептолизину О в сыворотке и плазме крови на модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c (ASLOT/ Tina-quant Antistreptolysin O cobas c systems)



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью



по доверенности
от 04.02.2021

(Гришин ДВ)