

PHILIPS

Руководитель
по нормативному регулированию

ООО «ФИЛИПС»

Горкуша Д.В.




«08» декабря 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Система для внутрисосудистой ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы IntraSight с принадлежностями»



Общий вид медицинского изделия «Система для внутрисосудистой ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы IntraSight с принадлежностями». Процедура.

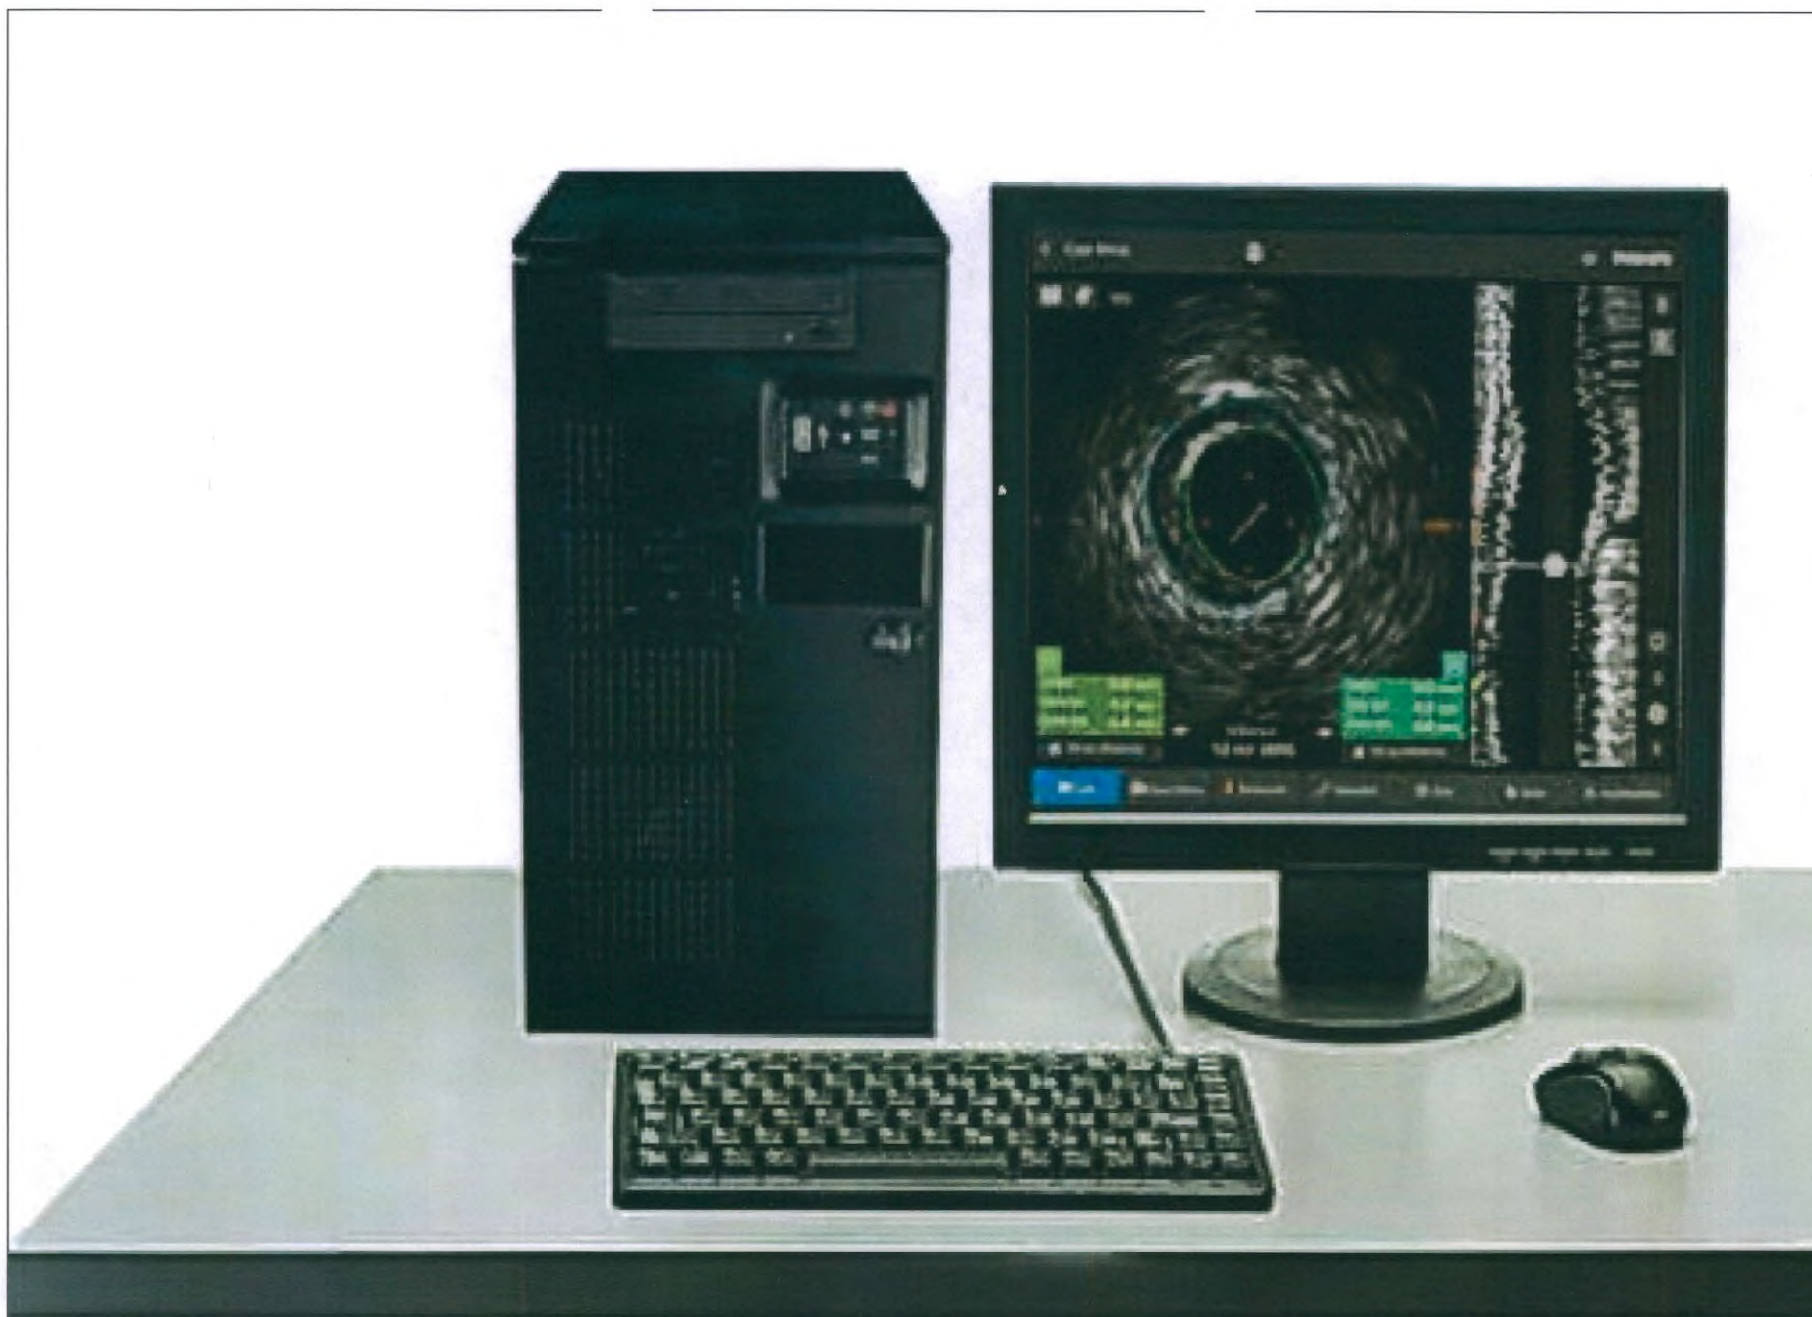

Общий вид медицинского изделия «Система для внутрисосудистой ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы IntraSight с принадлежностями». Аппаратная.



1 Монитор медицинского класса в процедурной, не более 3 шт. (при необходимости).




2 Монитор немедицинского класса в аппаратной, не более 3 шт.




3.1 Рабочая станция, не более 3 шт. Вид спереди.




3.1 Рабочая станция, не более 3 шт. Вид сзади.

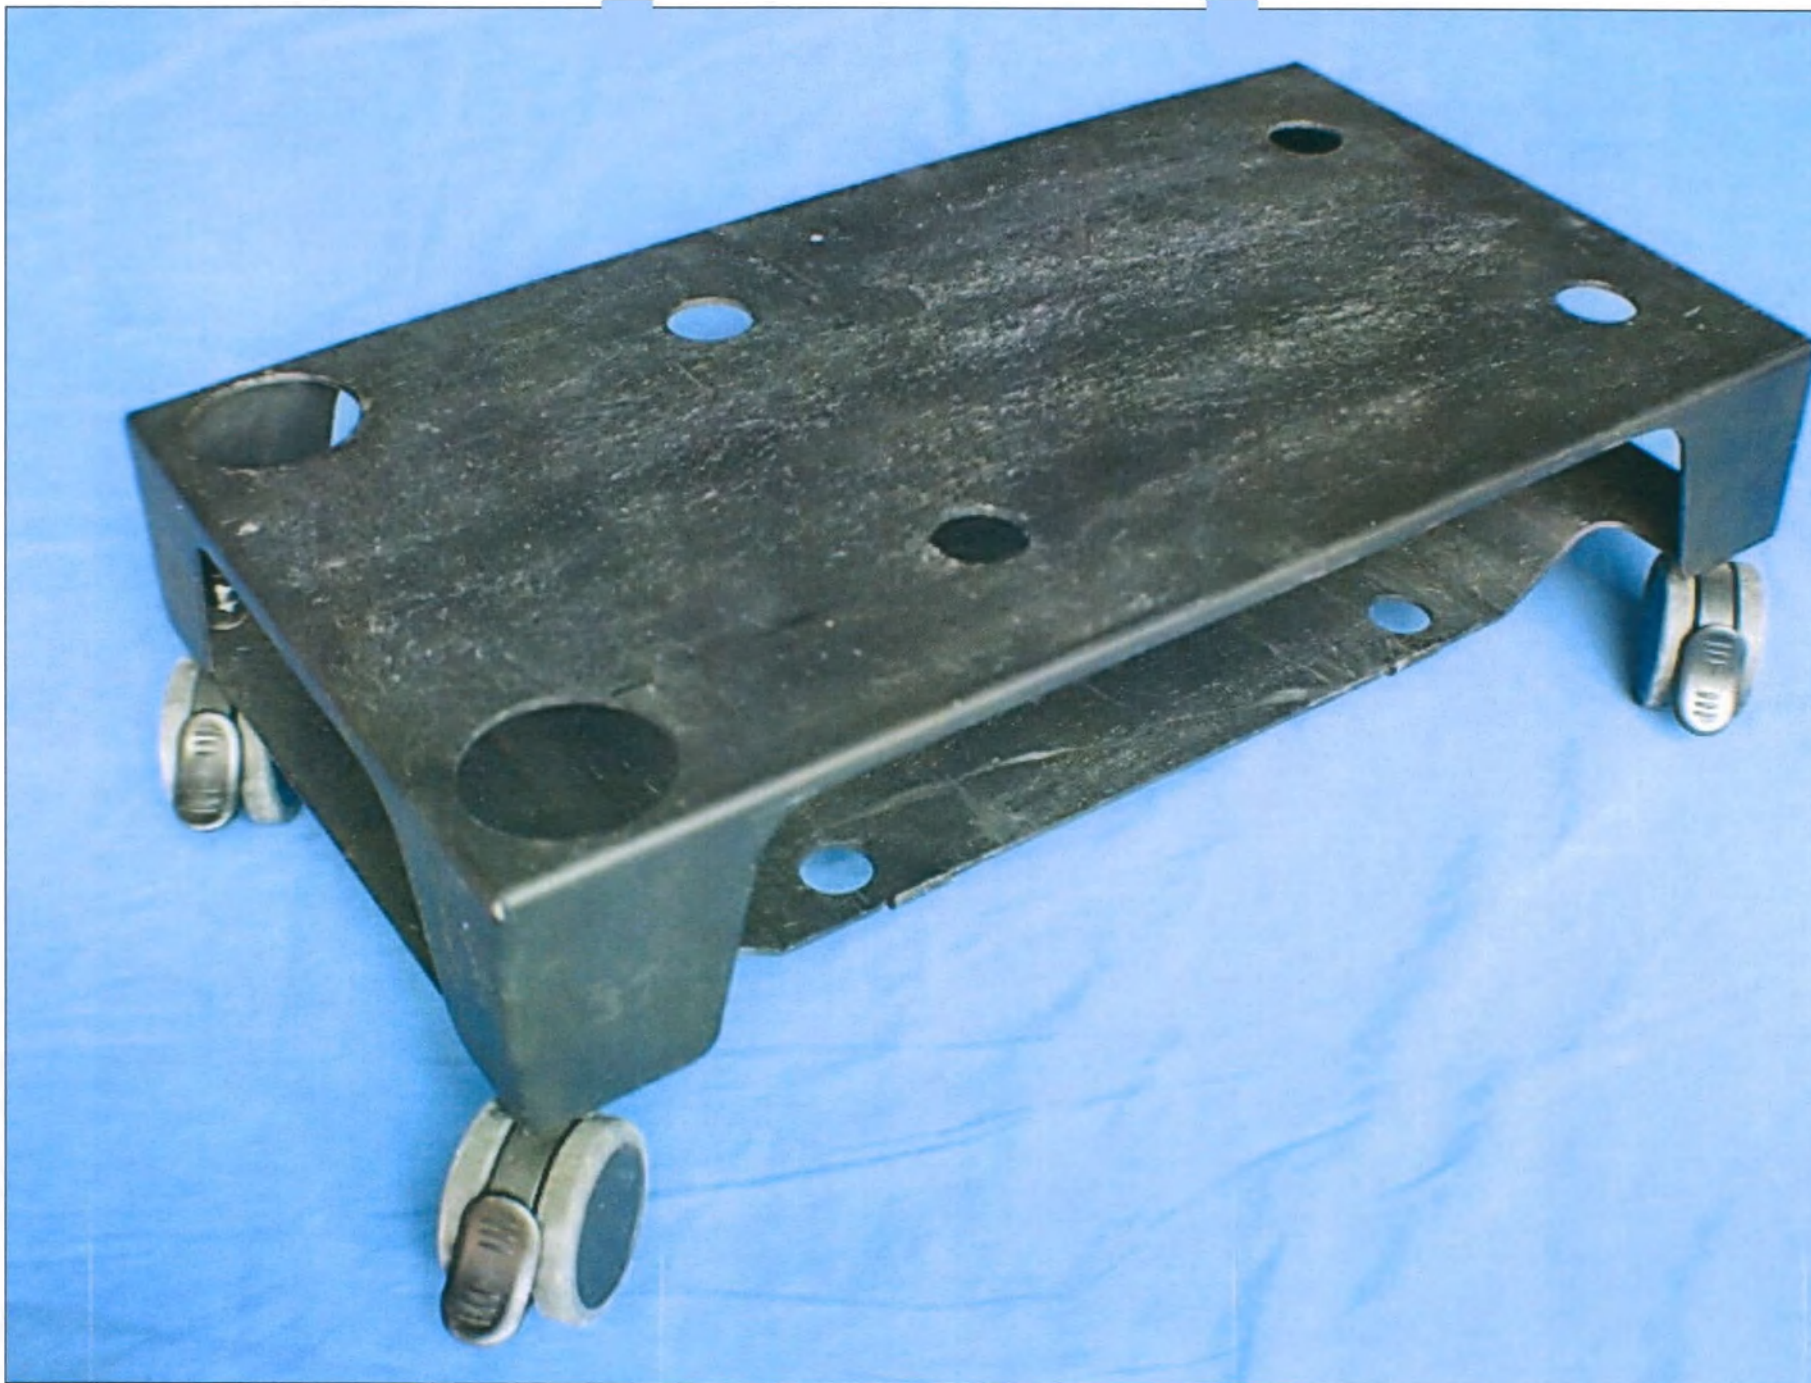

4 Тележка для рабочей станции, не более 3 шт.

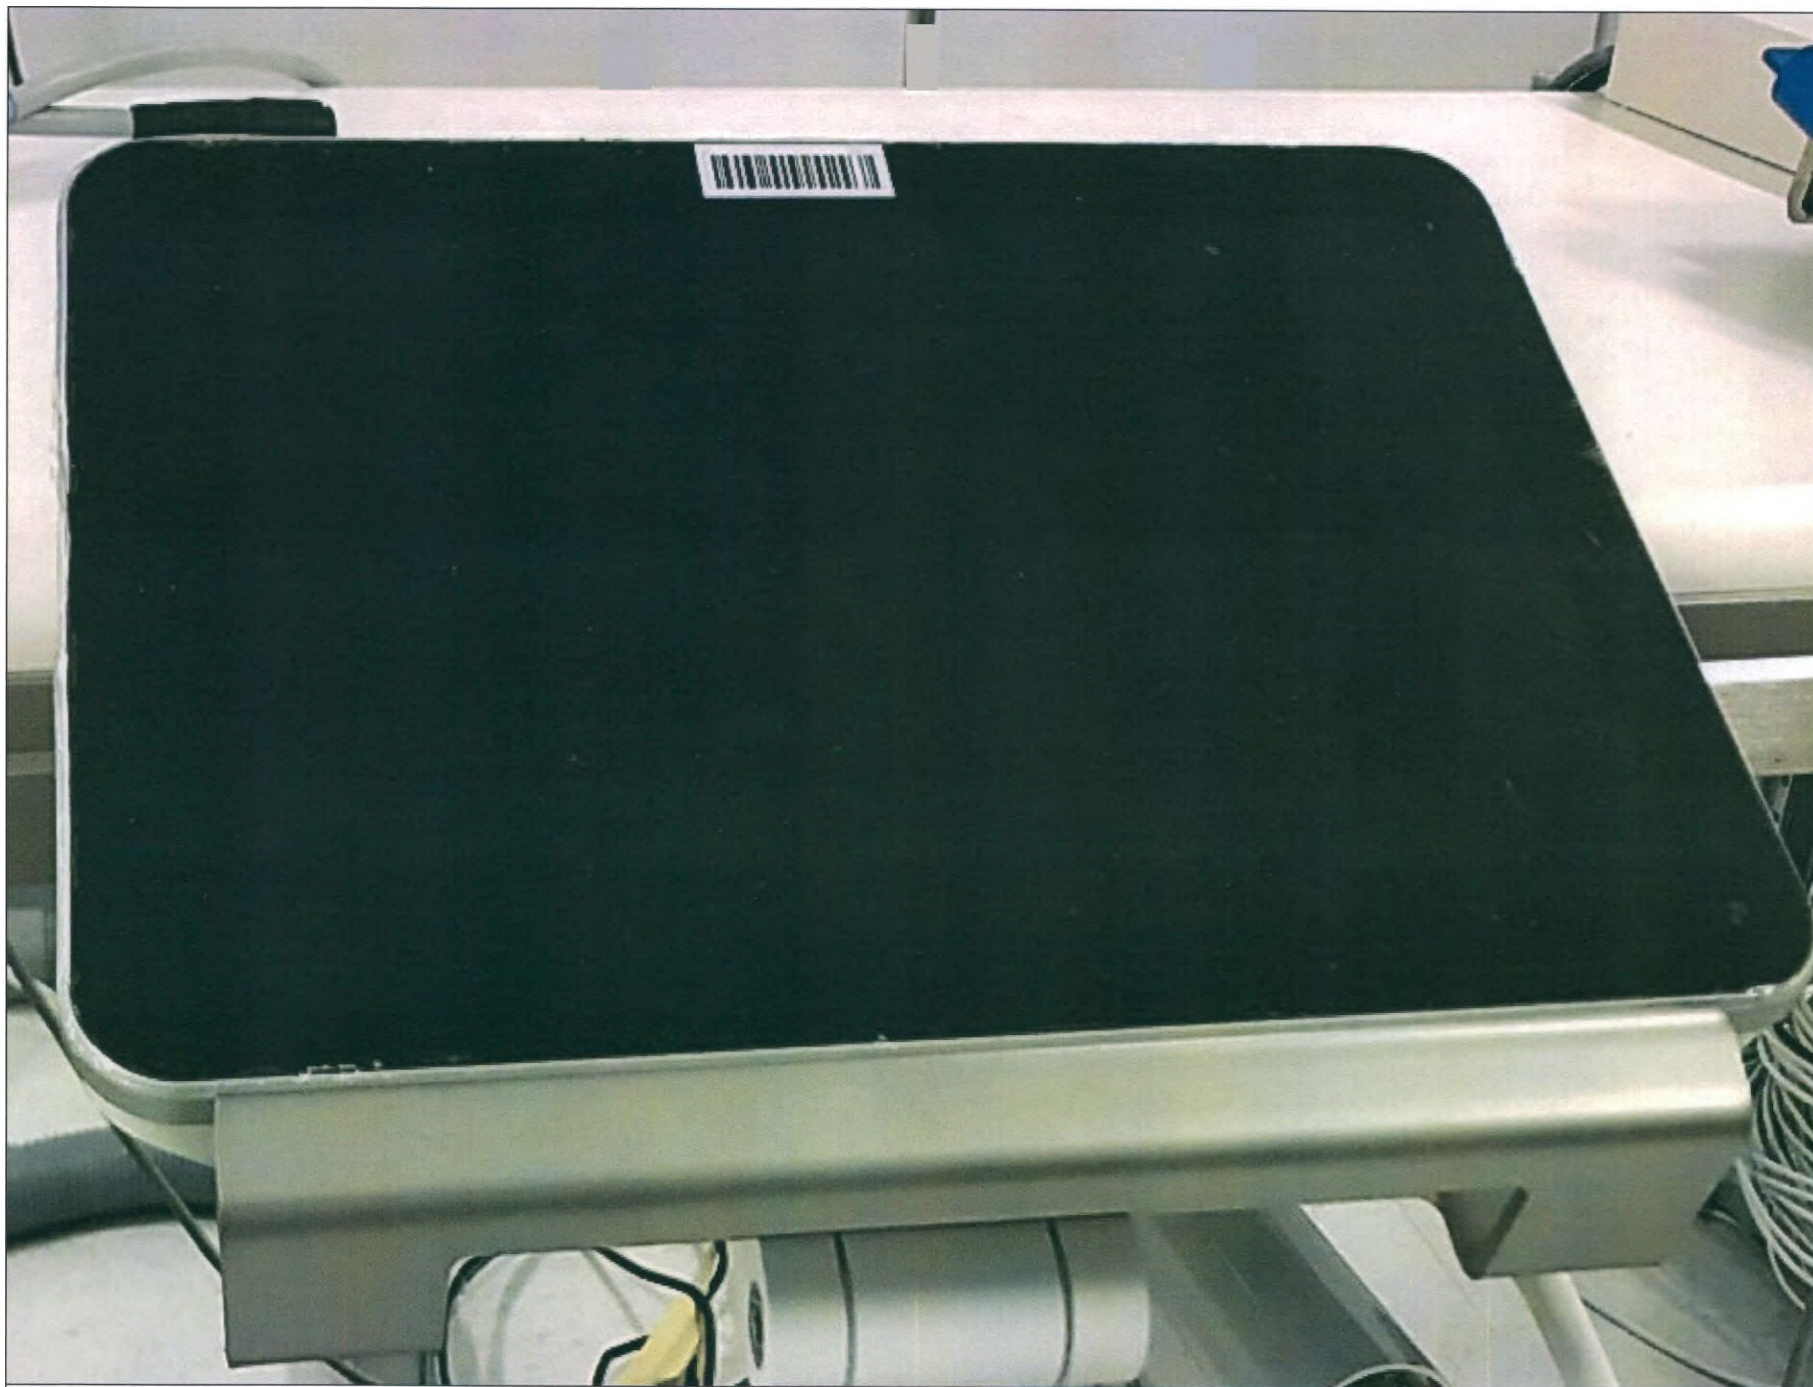


5.1 Прикроватный контроллер с сенсорным экраном, не более 2 шт. Вид спереди.

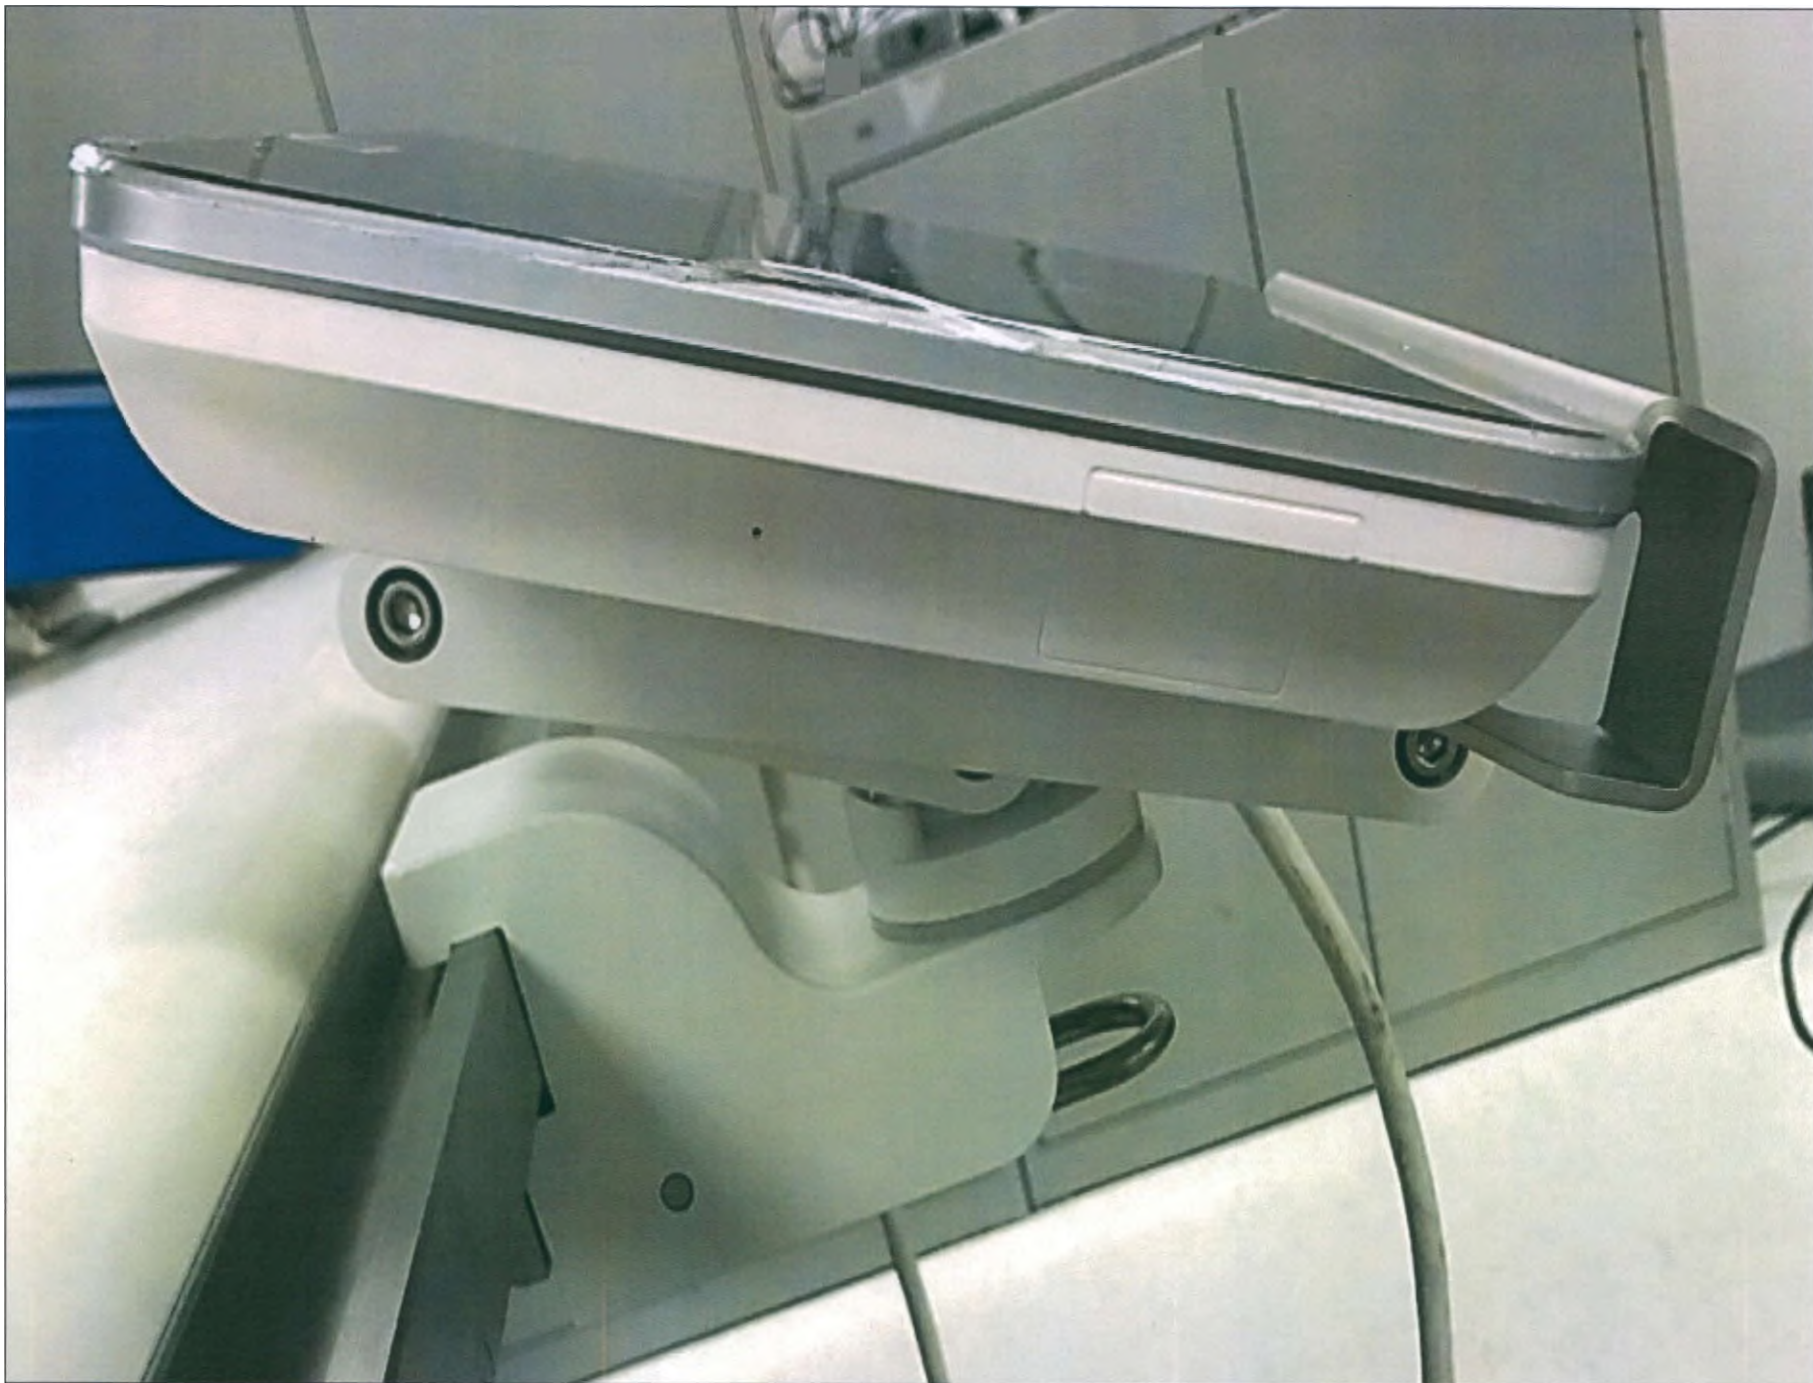


5.2 5 Прикроватный контроллер с сенсорным экраном, не более 2 шт. Вид сбоку.



6 Модуль интерфейса пациента (PIM).

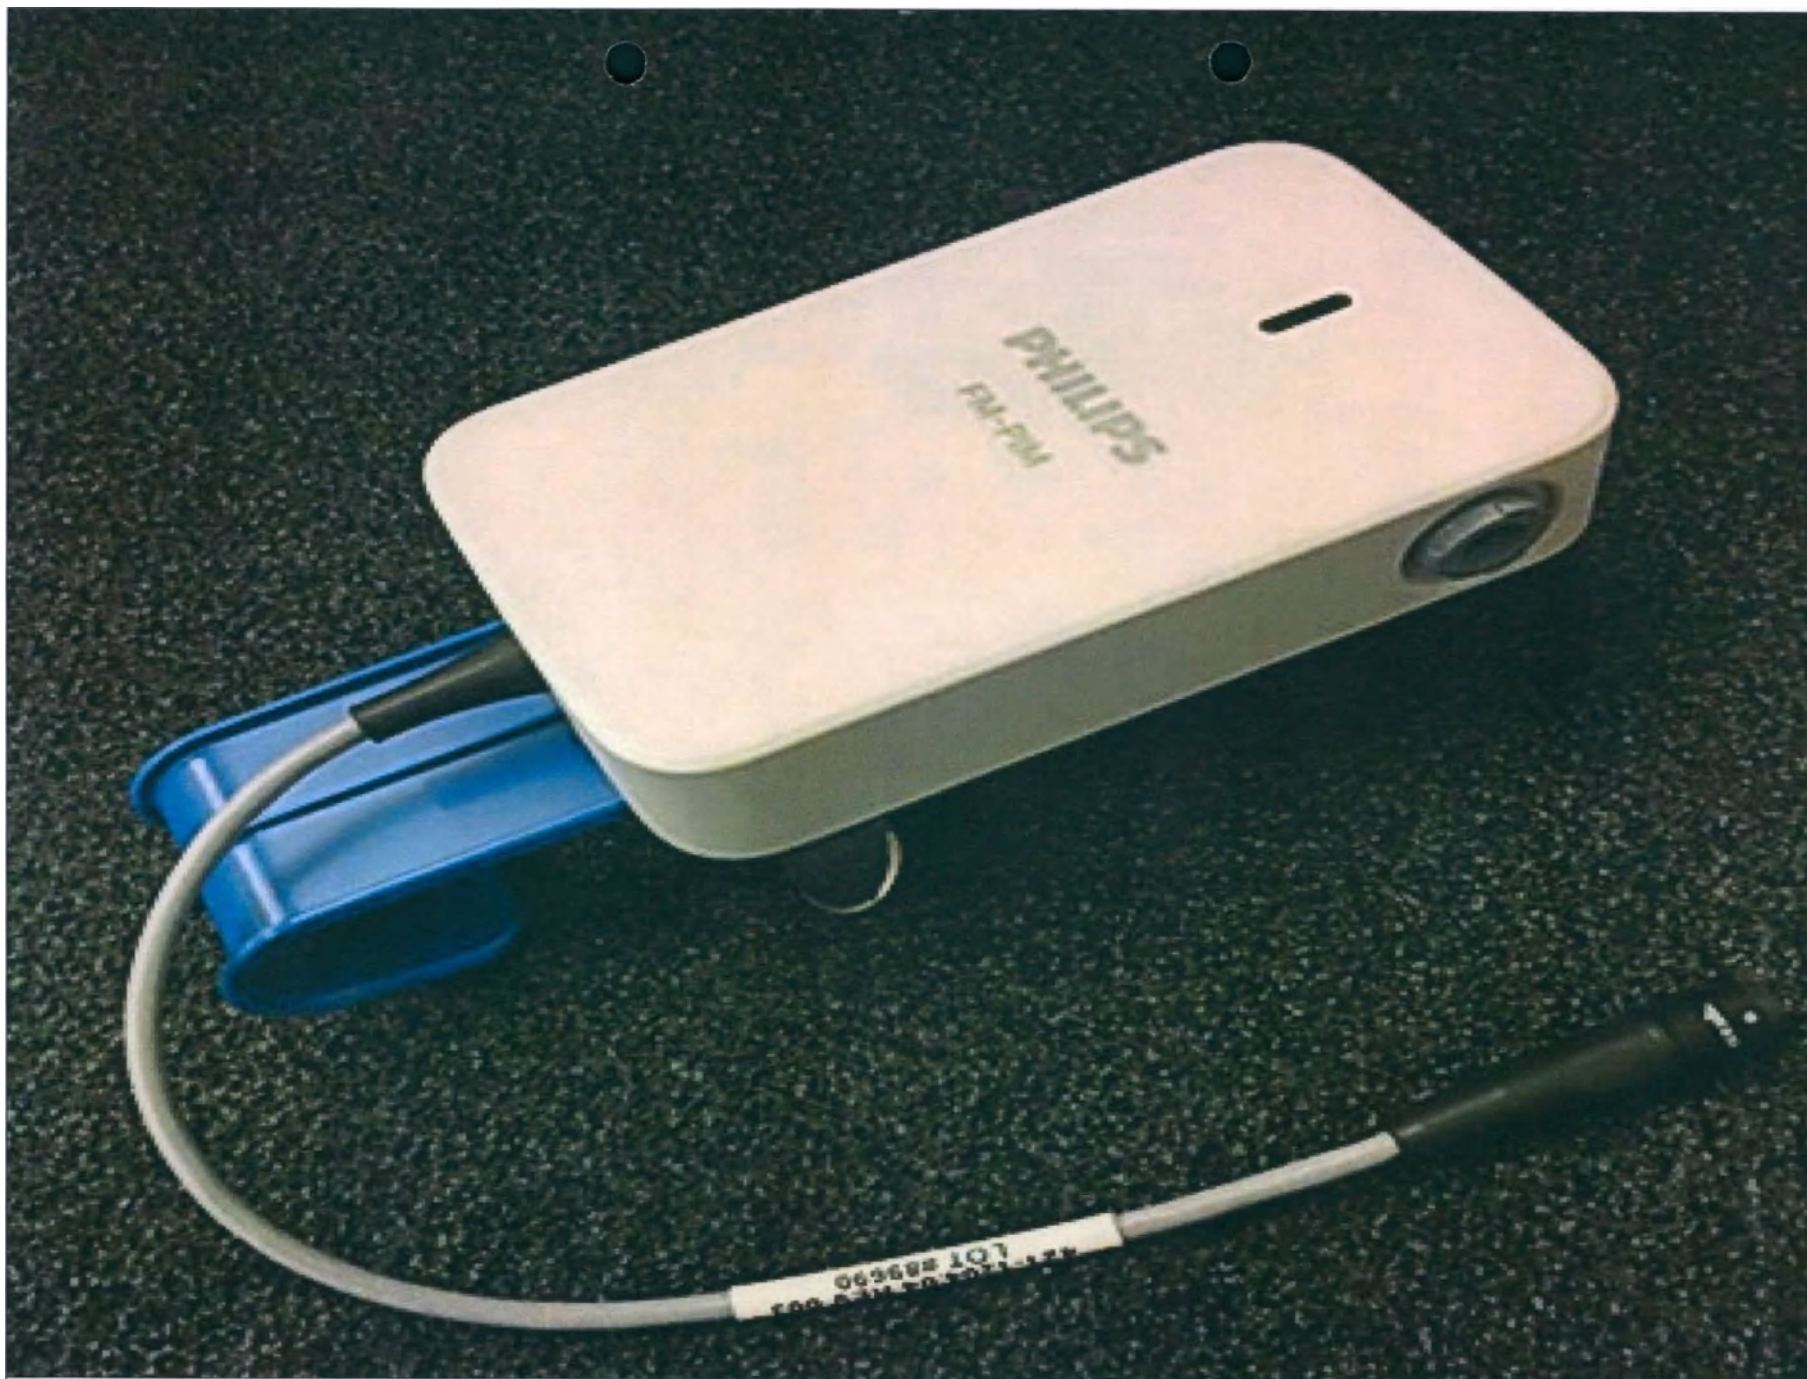


7 Модуль интерфейса пациента (FM PIM) для измерения iFR/FFR.

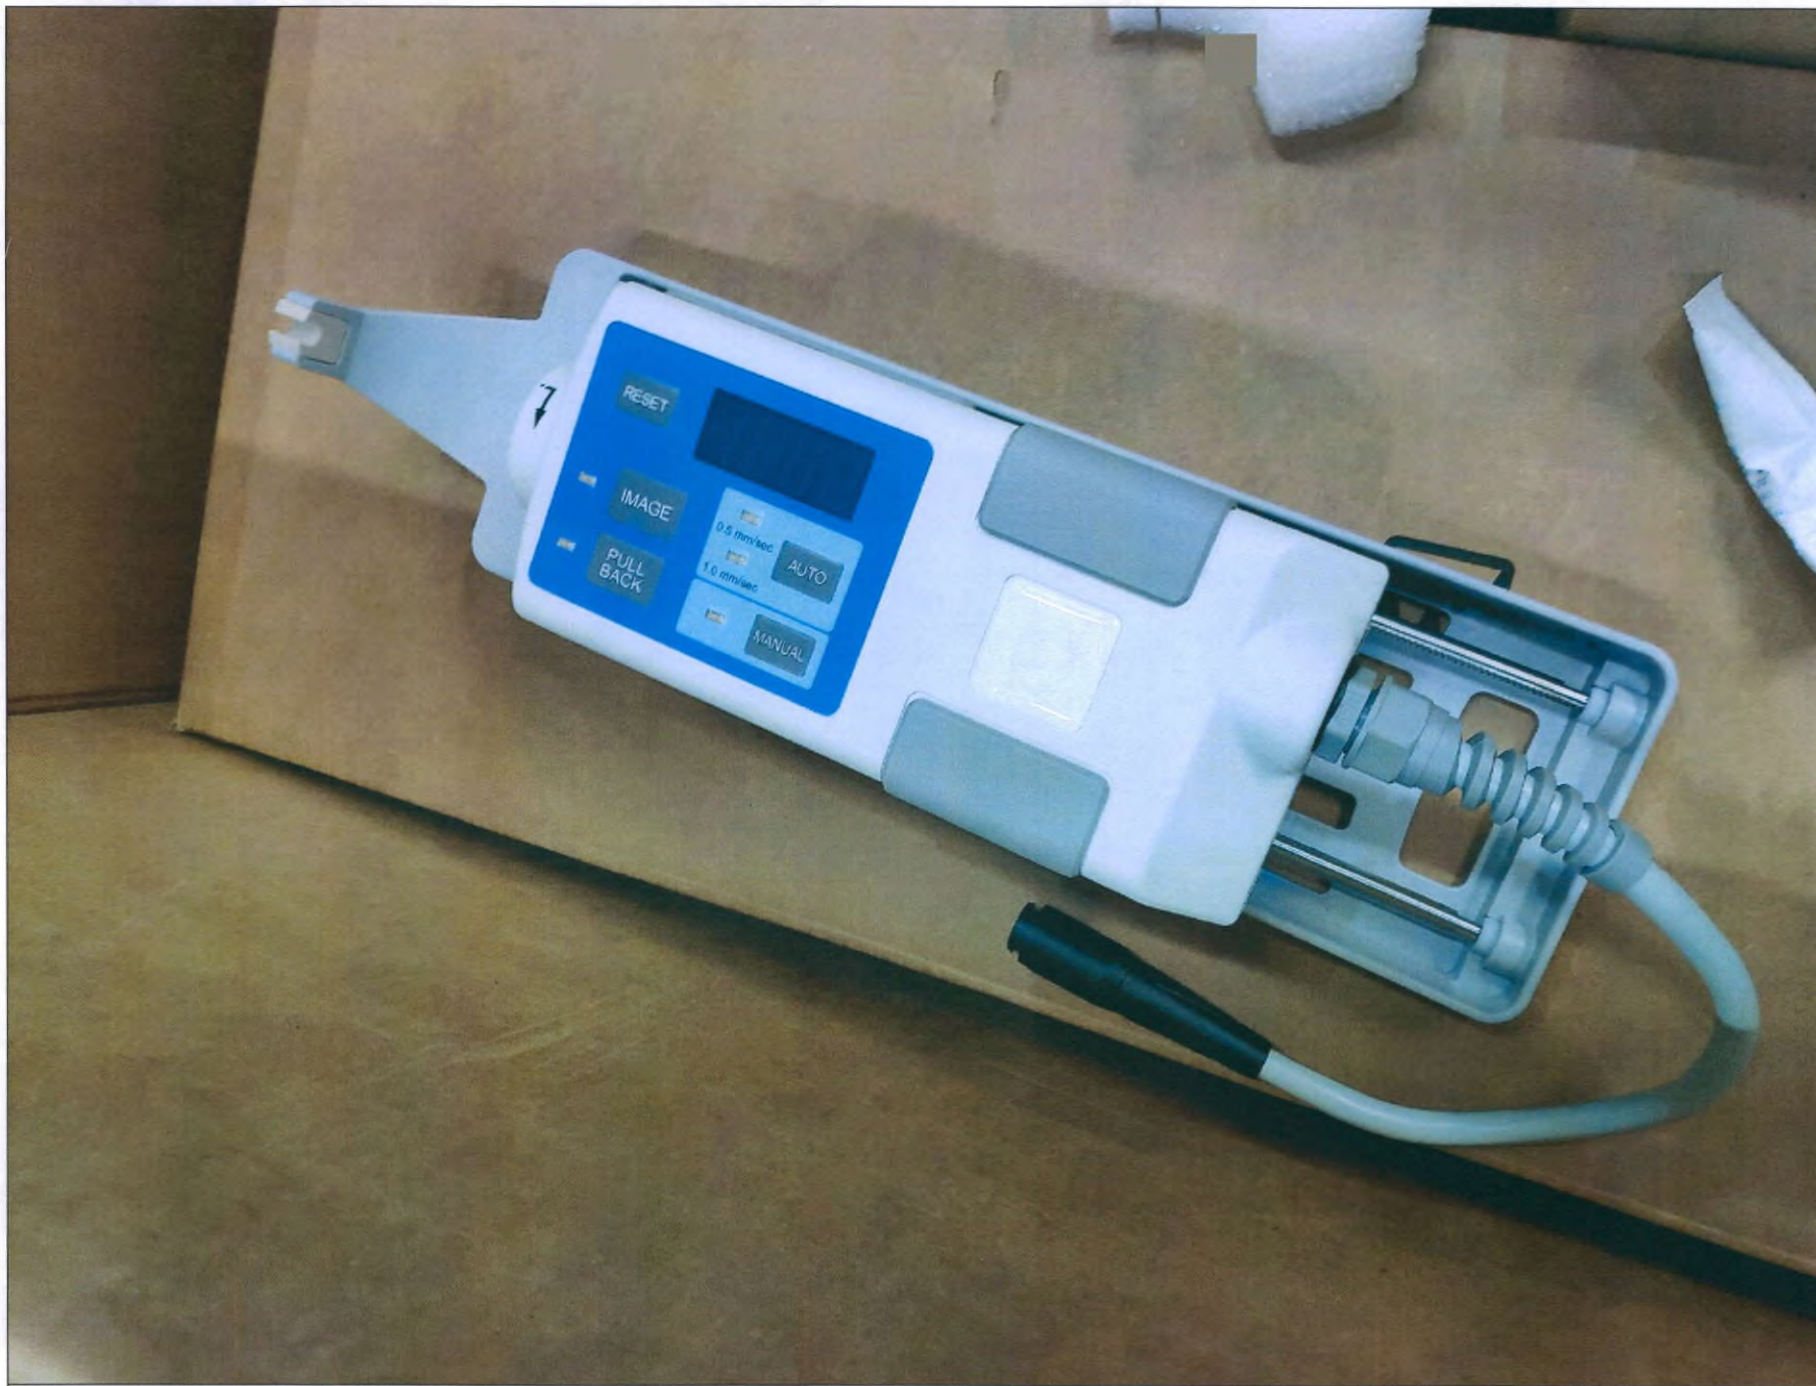


8 Модуль поворотный SpinVision (PIMr), (при необходимости).



9 Коробка соединительная.

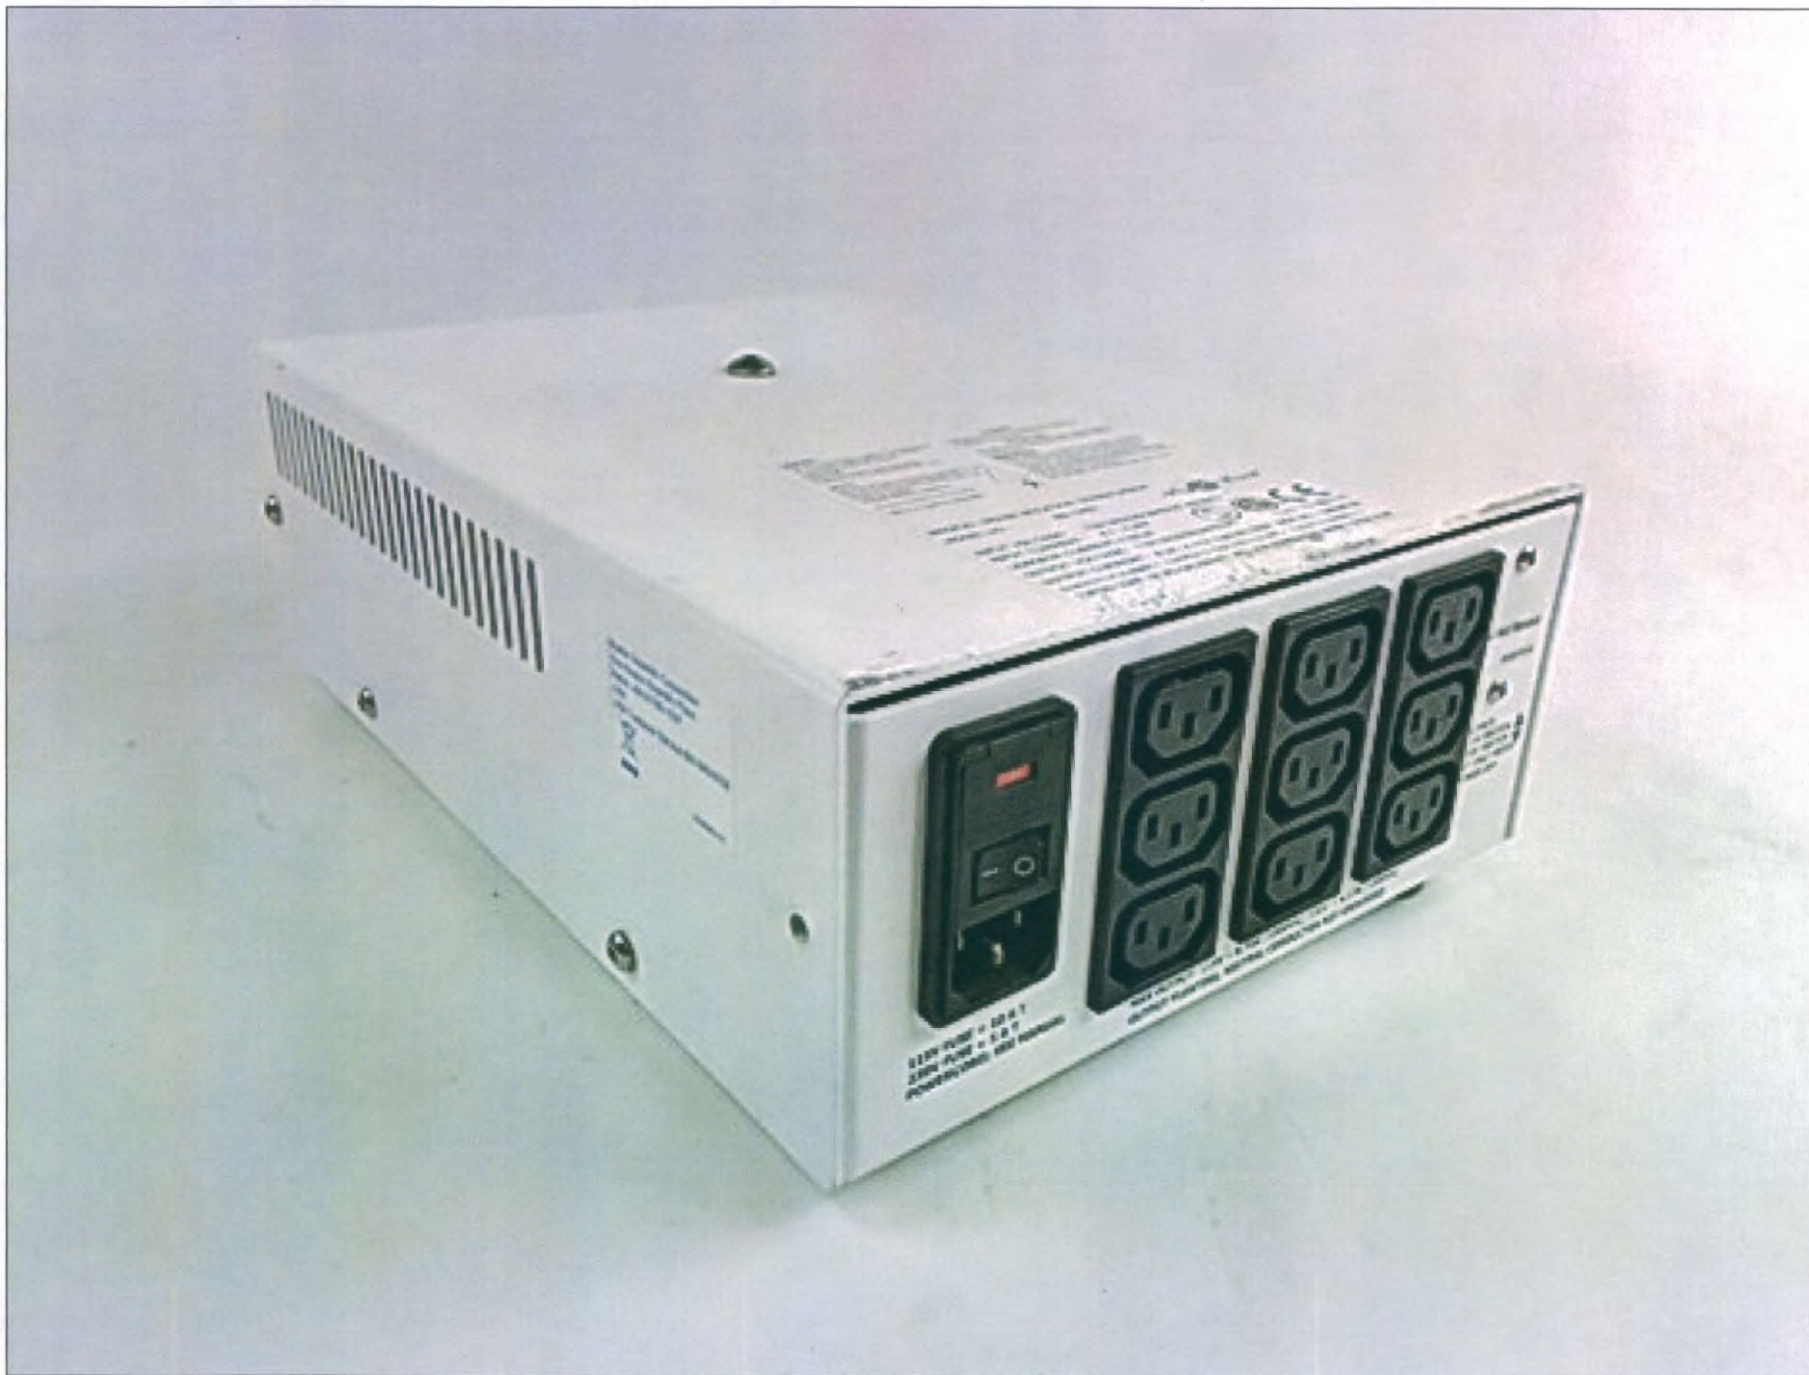

10.1 Трансформатор гальванической развязки. Вид сзади.

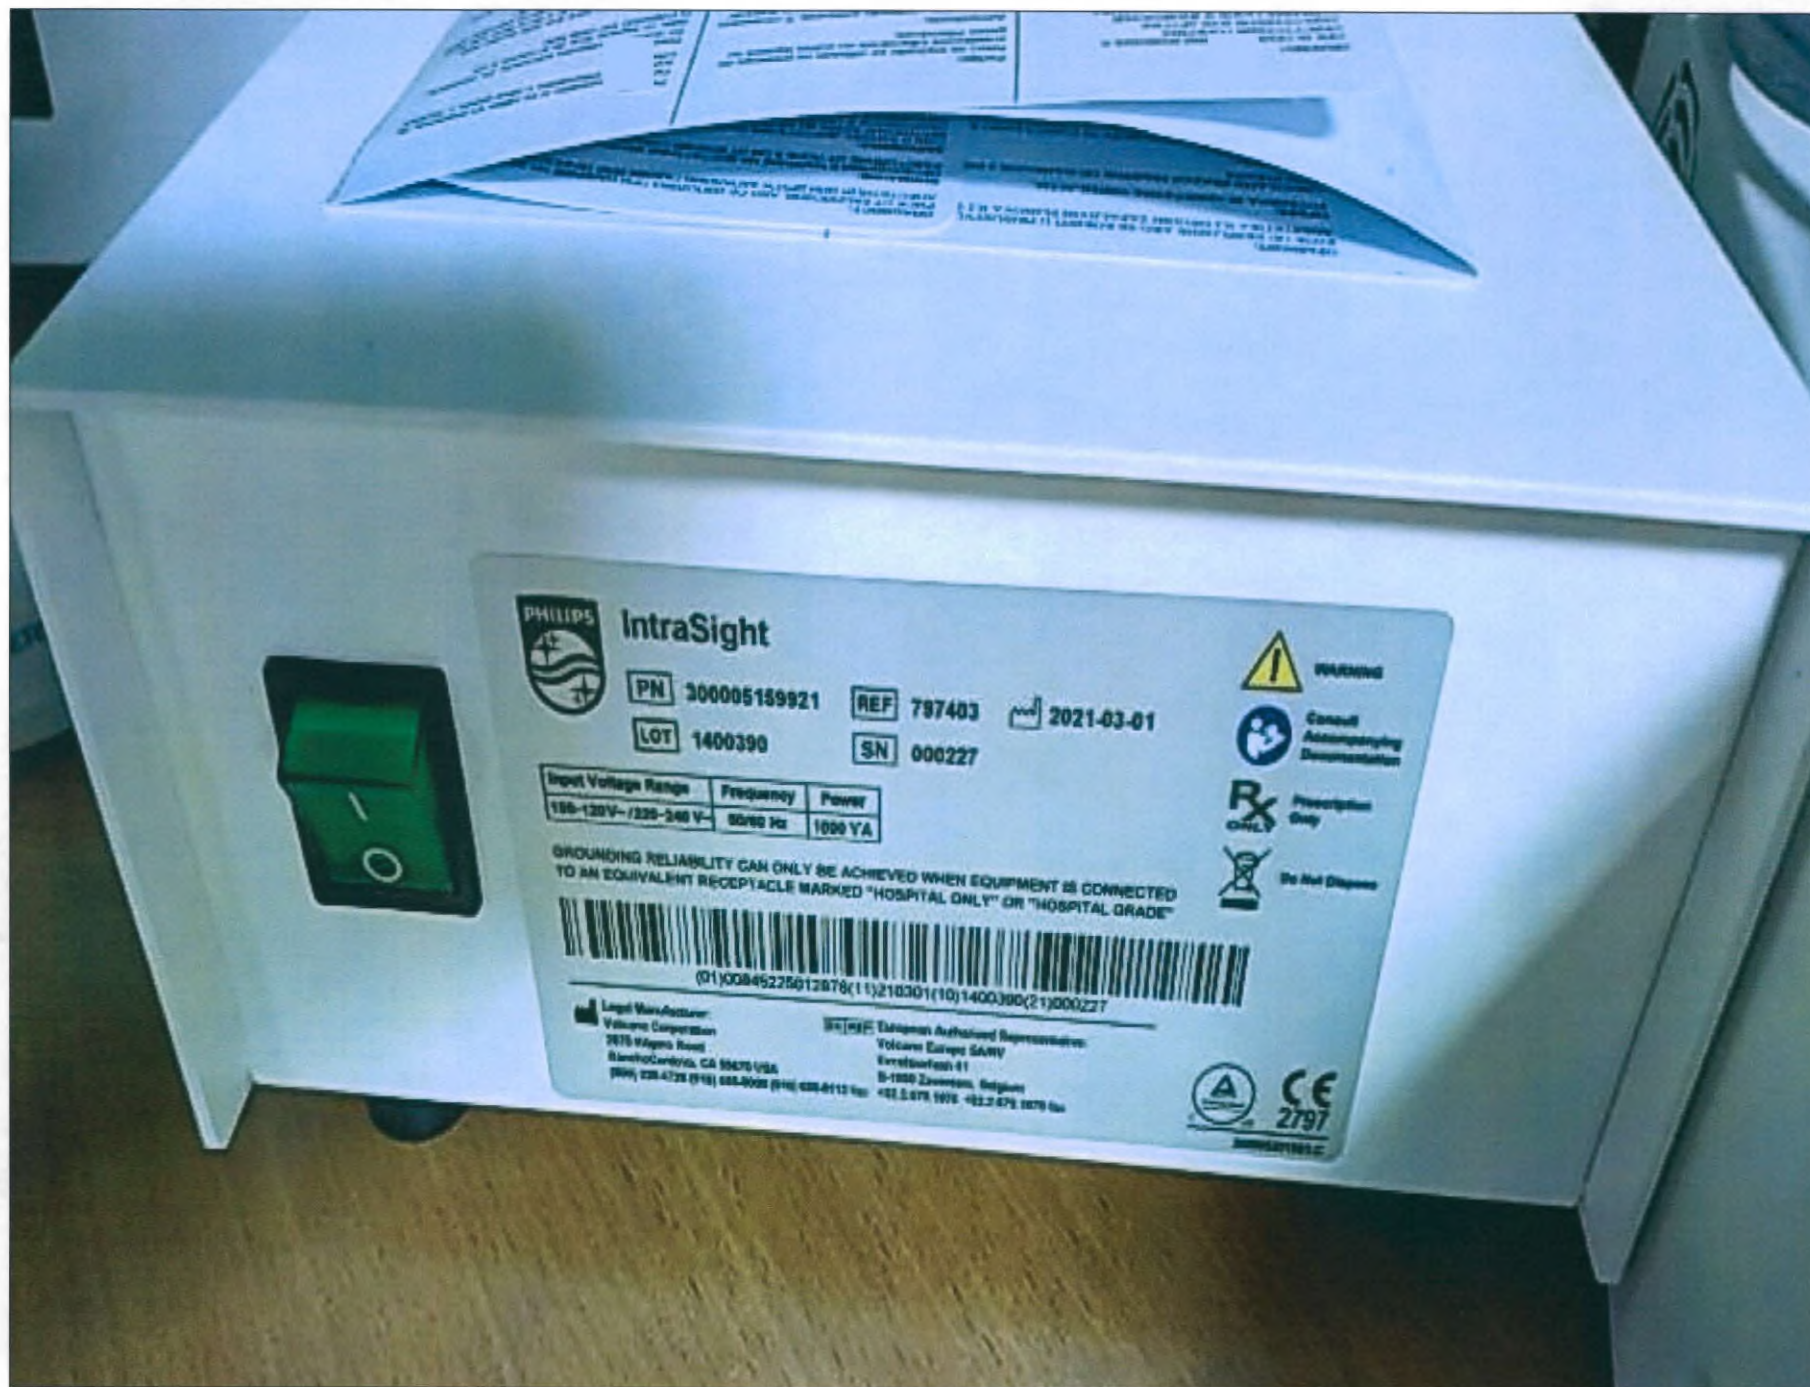

10.2 Трансформатор гальванической развязки. Вид спереди. Маркировка системы.



11.1 Расширитель USB для FM PIM. 2-х портовый USB расширитель.



11.2 Расширитель USB для FM PIM. 4-х портовый USB расширитель




12 Кабель PIM, 3 м и/или 5 м.



13.1 Кабели соединительные, 15 м и/или 27 м, не более 15 шт. Сетевой кабель для интернета.



13.2 Кабели соединительные, 15 м и/или 27 м, не более 15 шт. Удлиненный кабель PIM

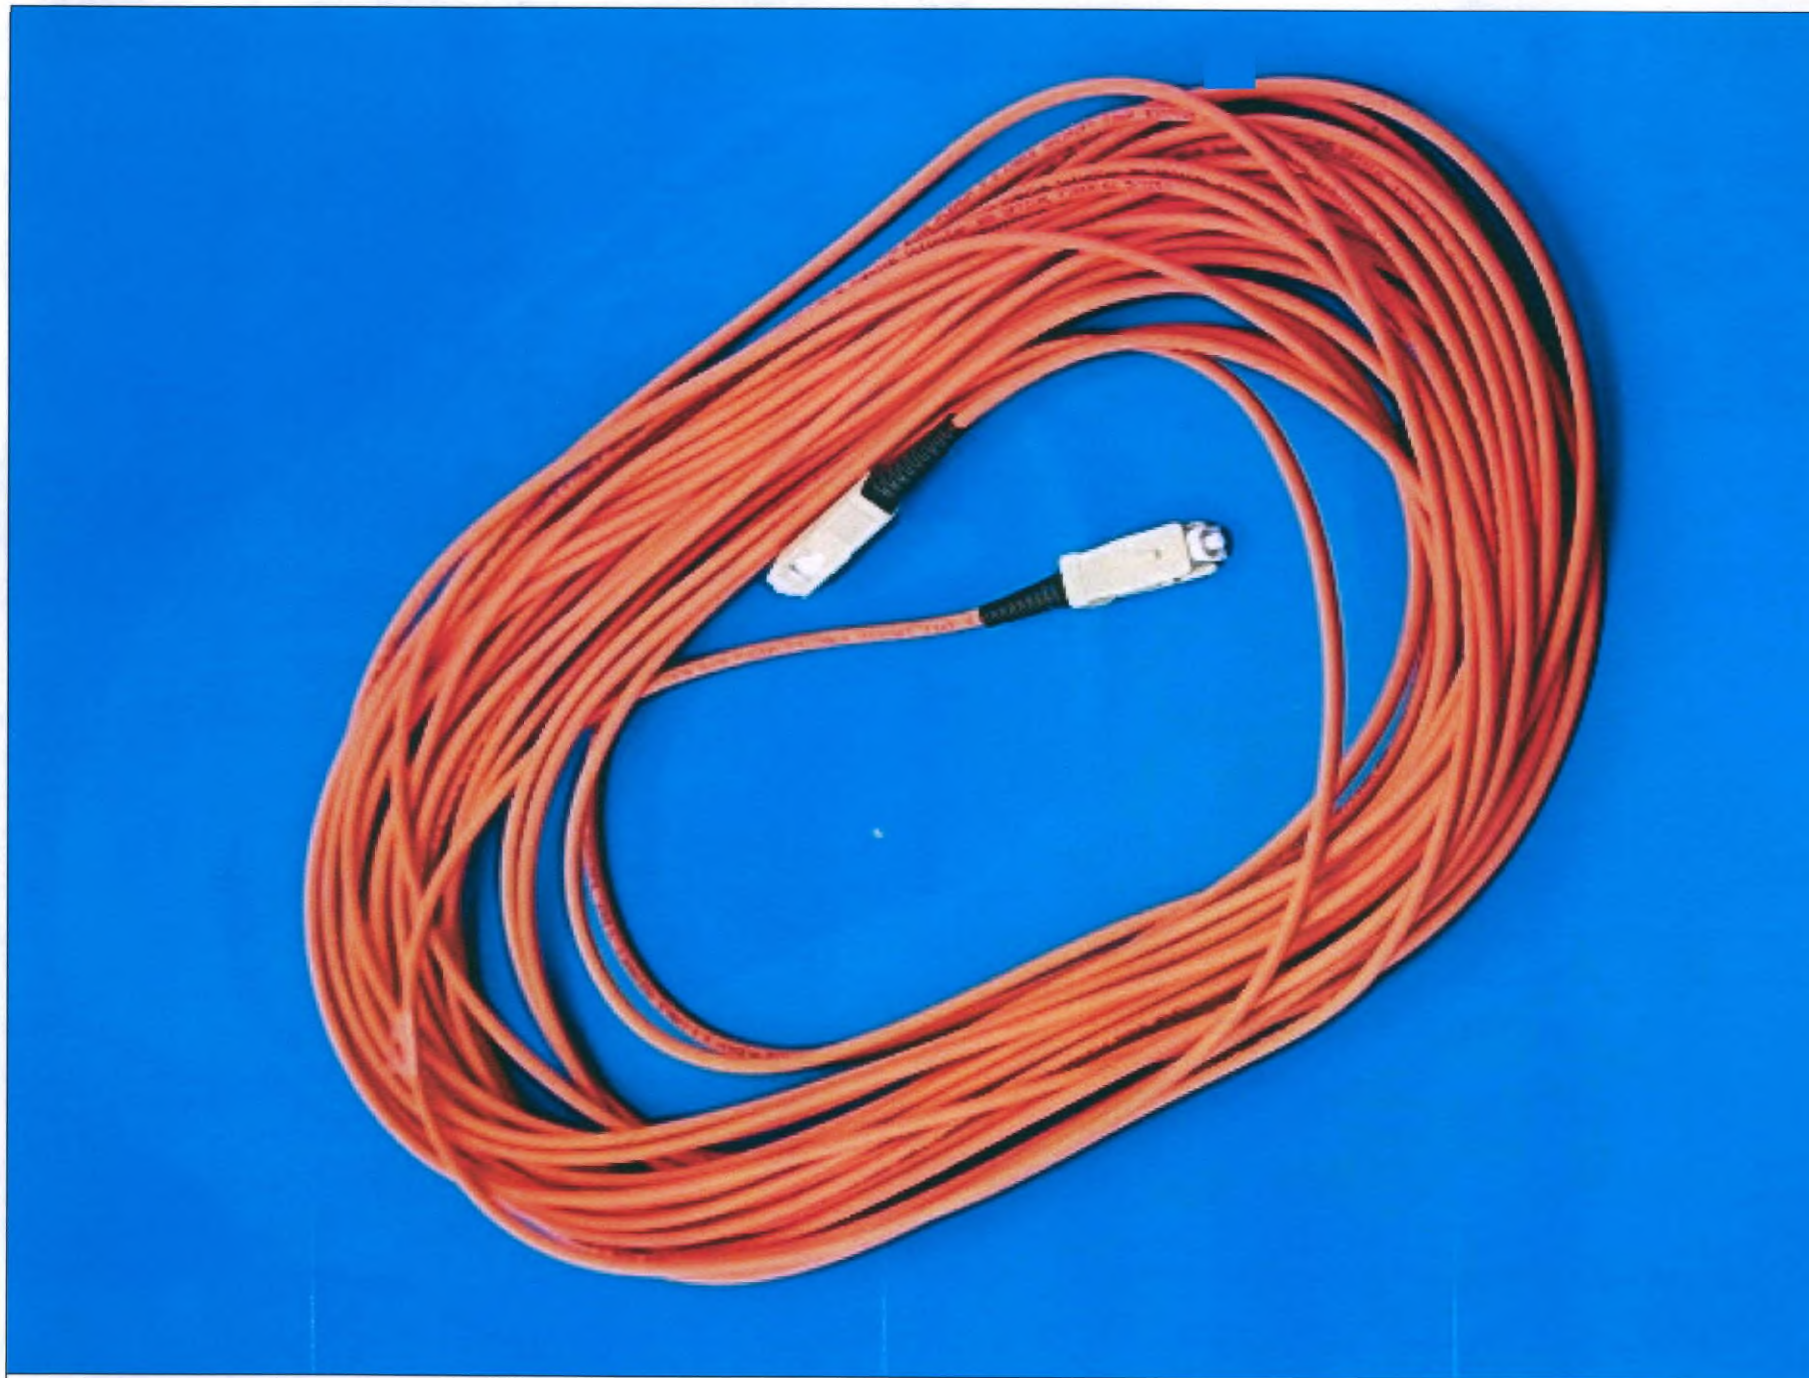

13.3 Кабели соединительные, 15 м и/или 27 м, не более 15 шт. Волоконно-оптический кабель.



13.4 Кабели соединительные, 15 м и/или 27 м, не более 15 шт. Силовой кабель.



13.5 Кабели соединительные, 15 м и/или 27 м, не более 15 шт. Твинаксиальный кабель ЭКГ / АД.



13.6 Кабели соединительные, 15 м и/или 27 м, не более 15 шт. Кабель заземления.



13.7 Кабели соединительные, 15 м и/или 27 м, не более 15 шт. Трос полипропиленовый.



14 Кабель для подключения к сети интернет, 3 м и/или 7,5 м и/или 15 м и/или 30 м, не более 6 шт.



15 Кабель питания переменного тока, 1 м, не более 4 шт.



Руководство
оператора

Русский

IntraSight

IntraSight для использования с интегрированной системой Philips

Версия программного обеспечения 1.1.X

PHILIPS

16.1 Руководство по эксплуатации на бумажном и/или электронном носителе, не более 5 шт.

PHILIPS FM-PIM

PHILIPS

Модуль интерфейса пациента для измерения функциональных показателей (FM-PIM)

Дополнительное руководство по эксплуатации

Для использования с
системой Philips Next XperFlex

16.2 Руководство по эксплуатации на бумажном и/или электронном носителе, не более 5 шт.



Дополнительное
руководство по
эксплуатации

Русский

IntraSight

Для использования с дополнительным комплектom поддержки методов iFR и FFR в интегрированной системе Philips IntraSight

Версия программного обеспечения 1.1.X

PHILIPS

16.3 Руководство по эксплуатации на бумажном и/или электронном носителе, не более 5 шт.



Дополнительное
руководство по
эксплуатации

Русский

IntraSight

Для использования с дополнительным ротационным комплектom ВСУЗИ в интегрированной системе Philips IntraSight

Версия программного обеспечения 1.1X

PHILIPS

16.4 Руководство по эксплуатации на бумажном и/или электронном носителе, не более 5 шт.

PHILIPS




SyncVision

Версия 2.x

**Версия программного
обеспечения 4.2**

Руководство оператора

16.5 Руководство по эксплуатации на бумажном и/или электронном носителе, не более 5 шт.

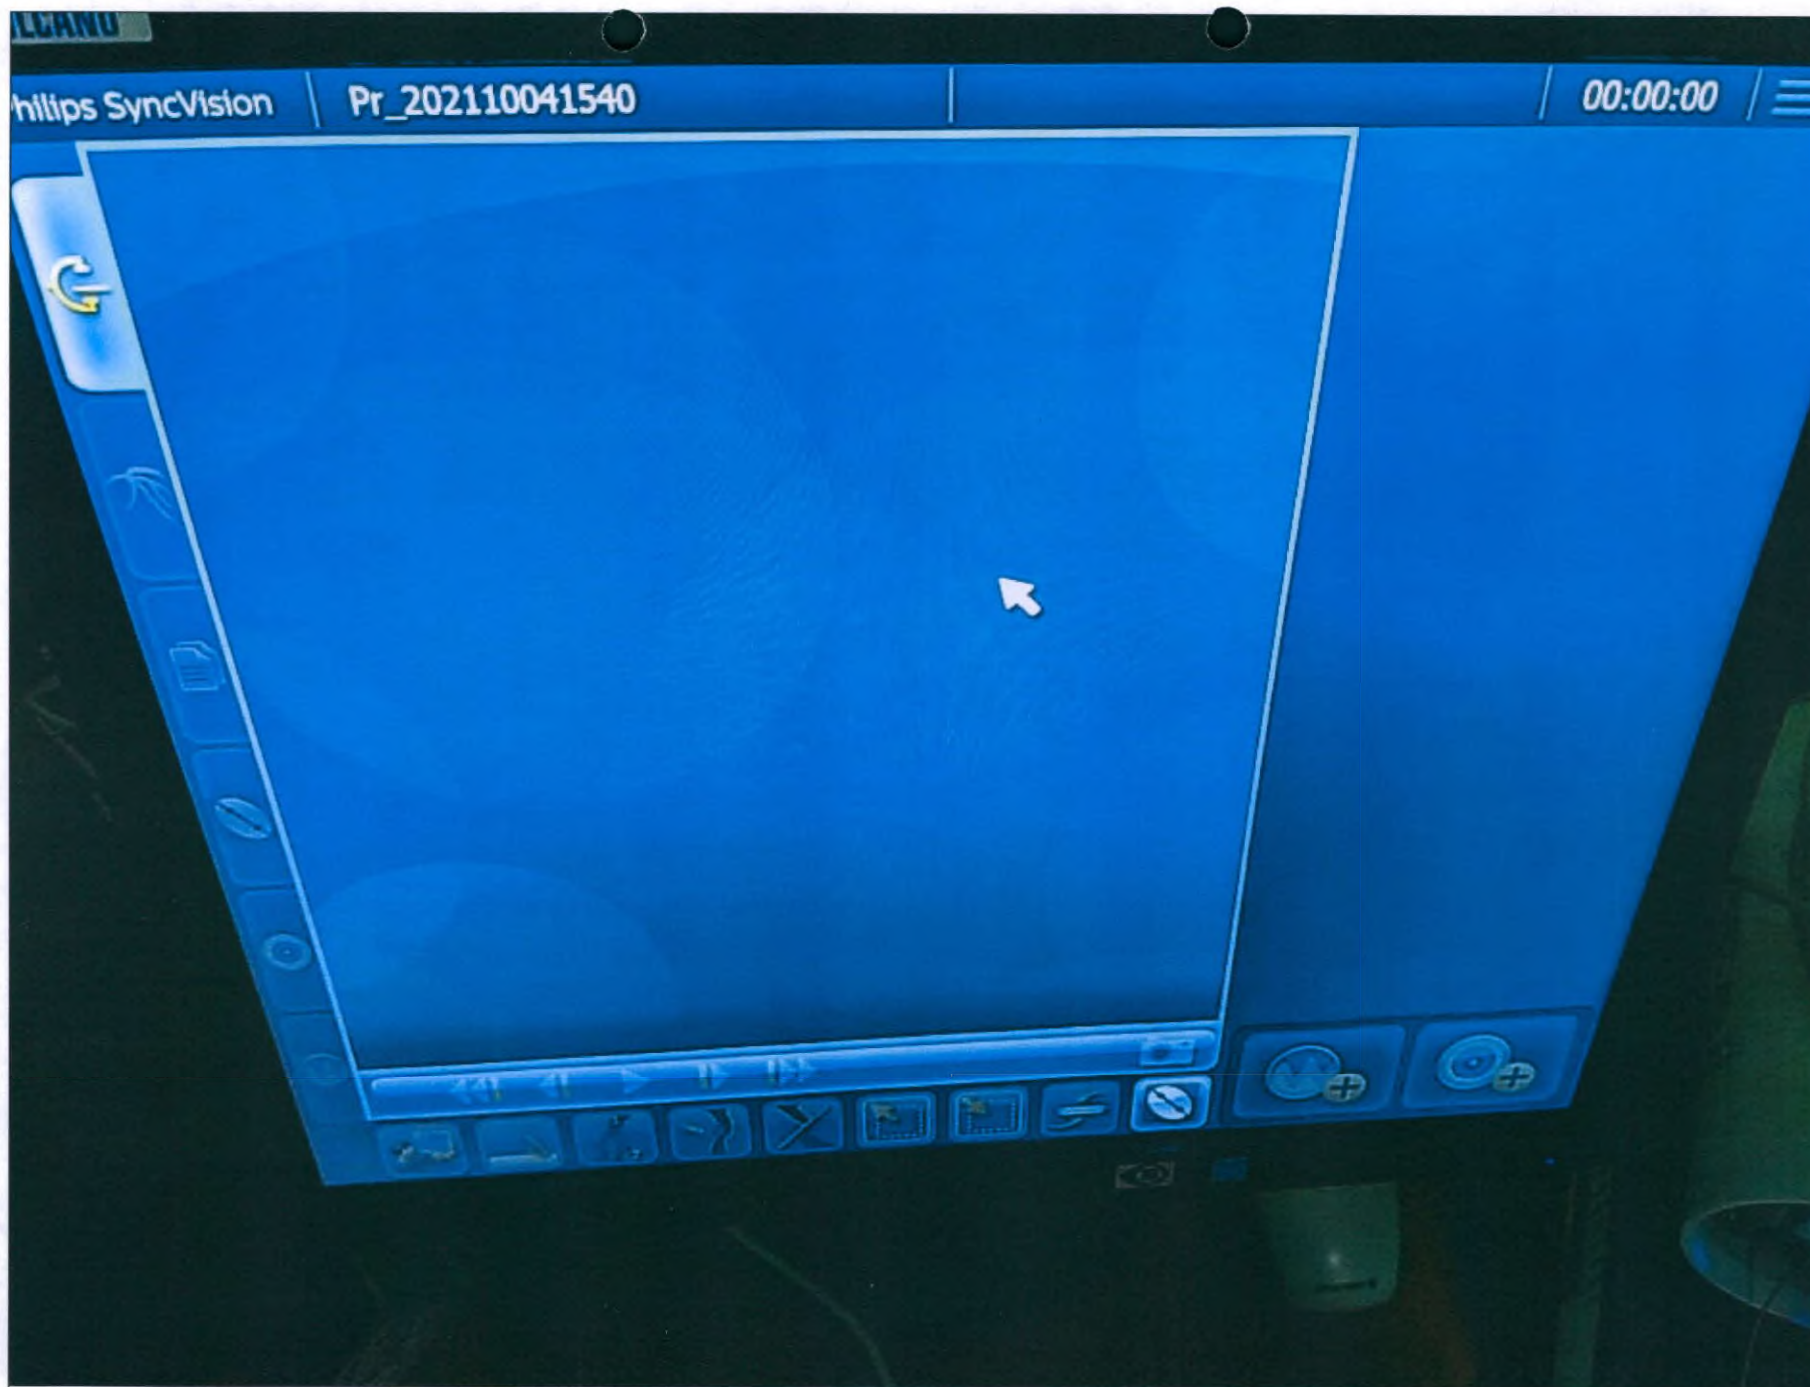

17 Обеспечение программное SyncVision предустановленное для получения и обработки медицинских изображений (при необходимости).


Принадлежности:




1 Преобразователь видеосигнала, не более 4 шт.



2 Джойстик с контроллером, не более 2 шт.

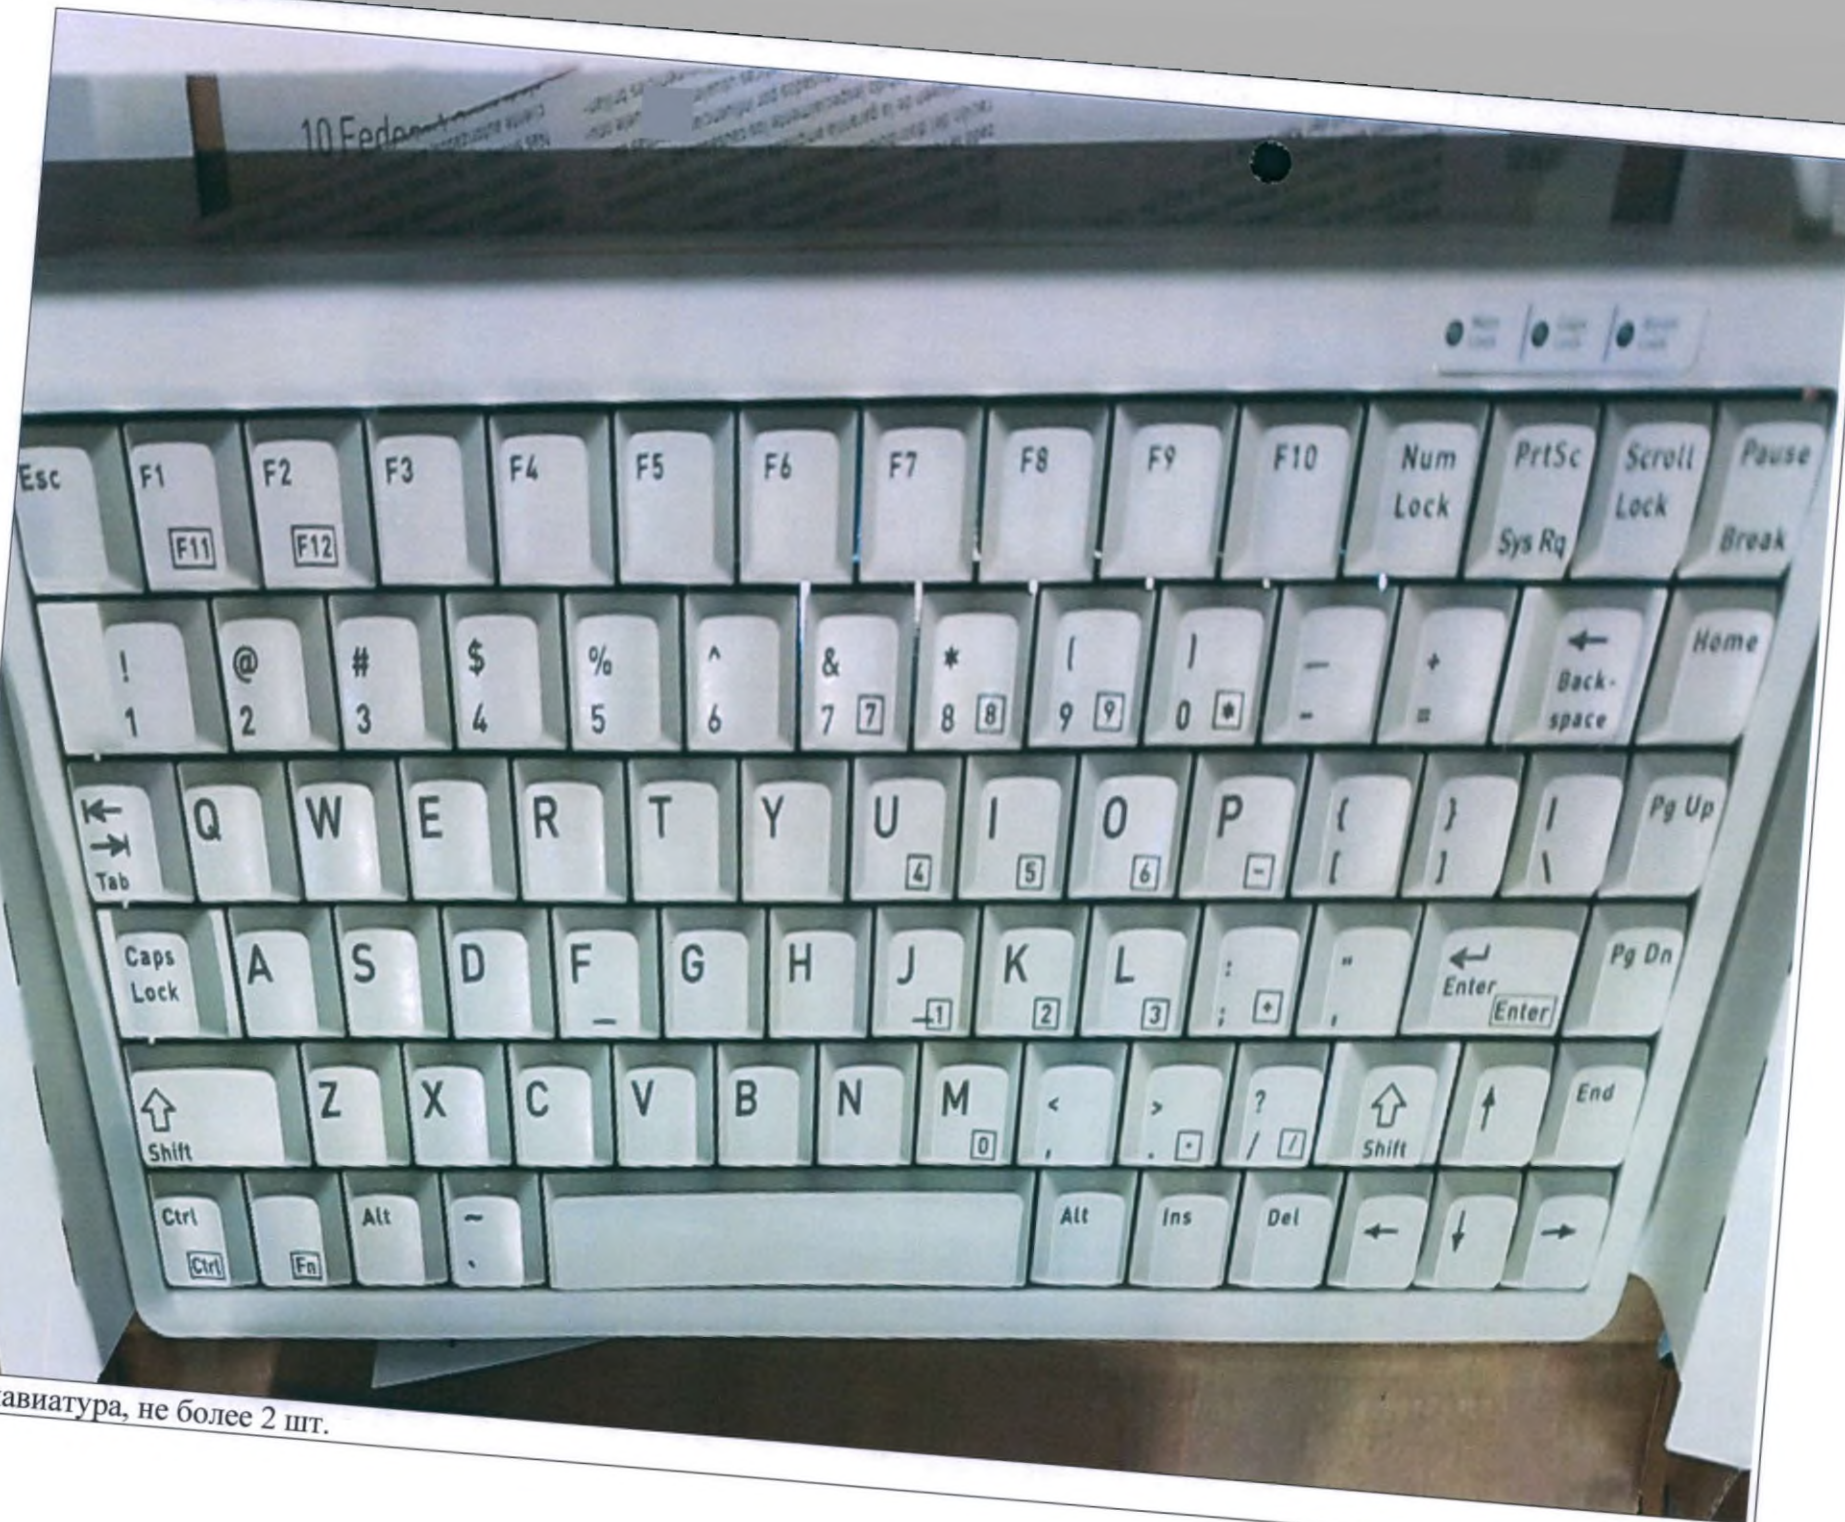

3 Клавиатура, не более 2 шт.

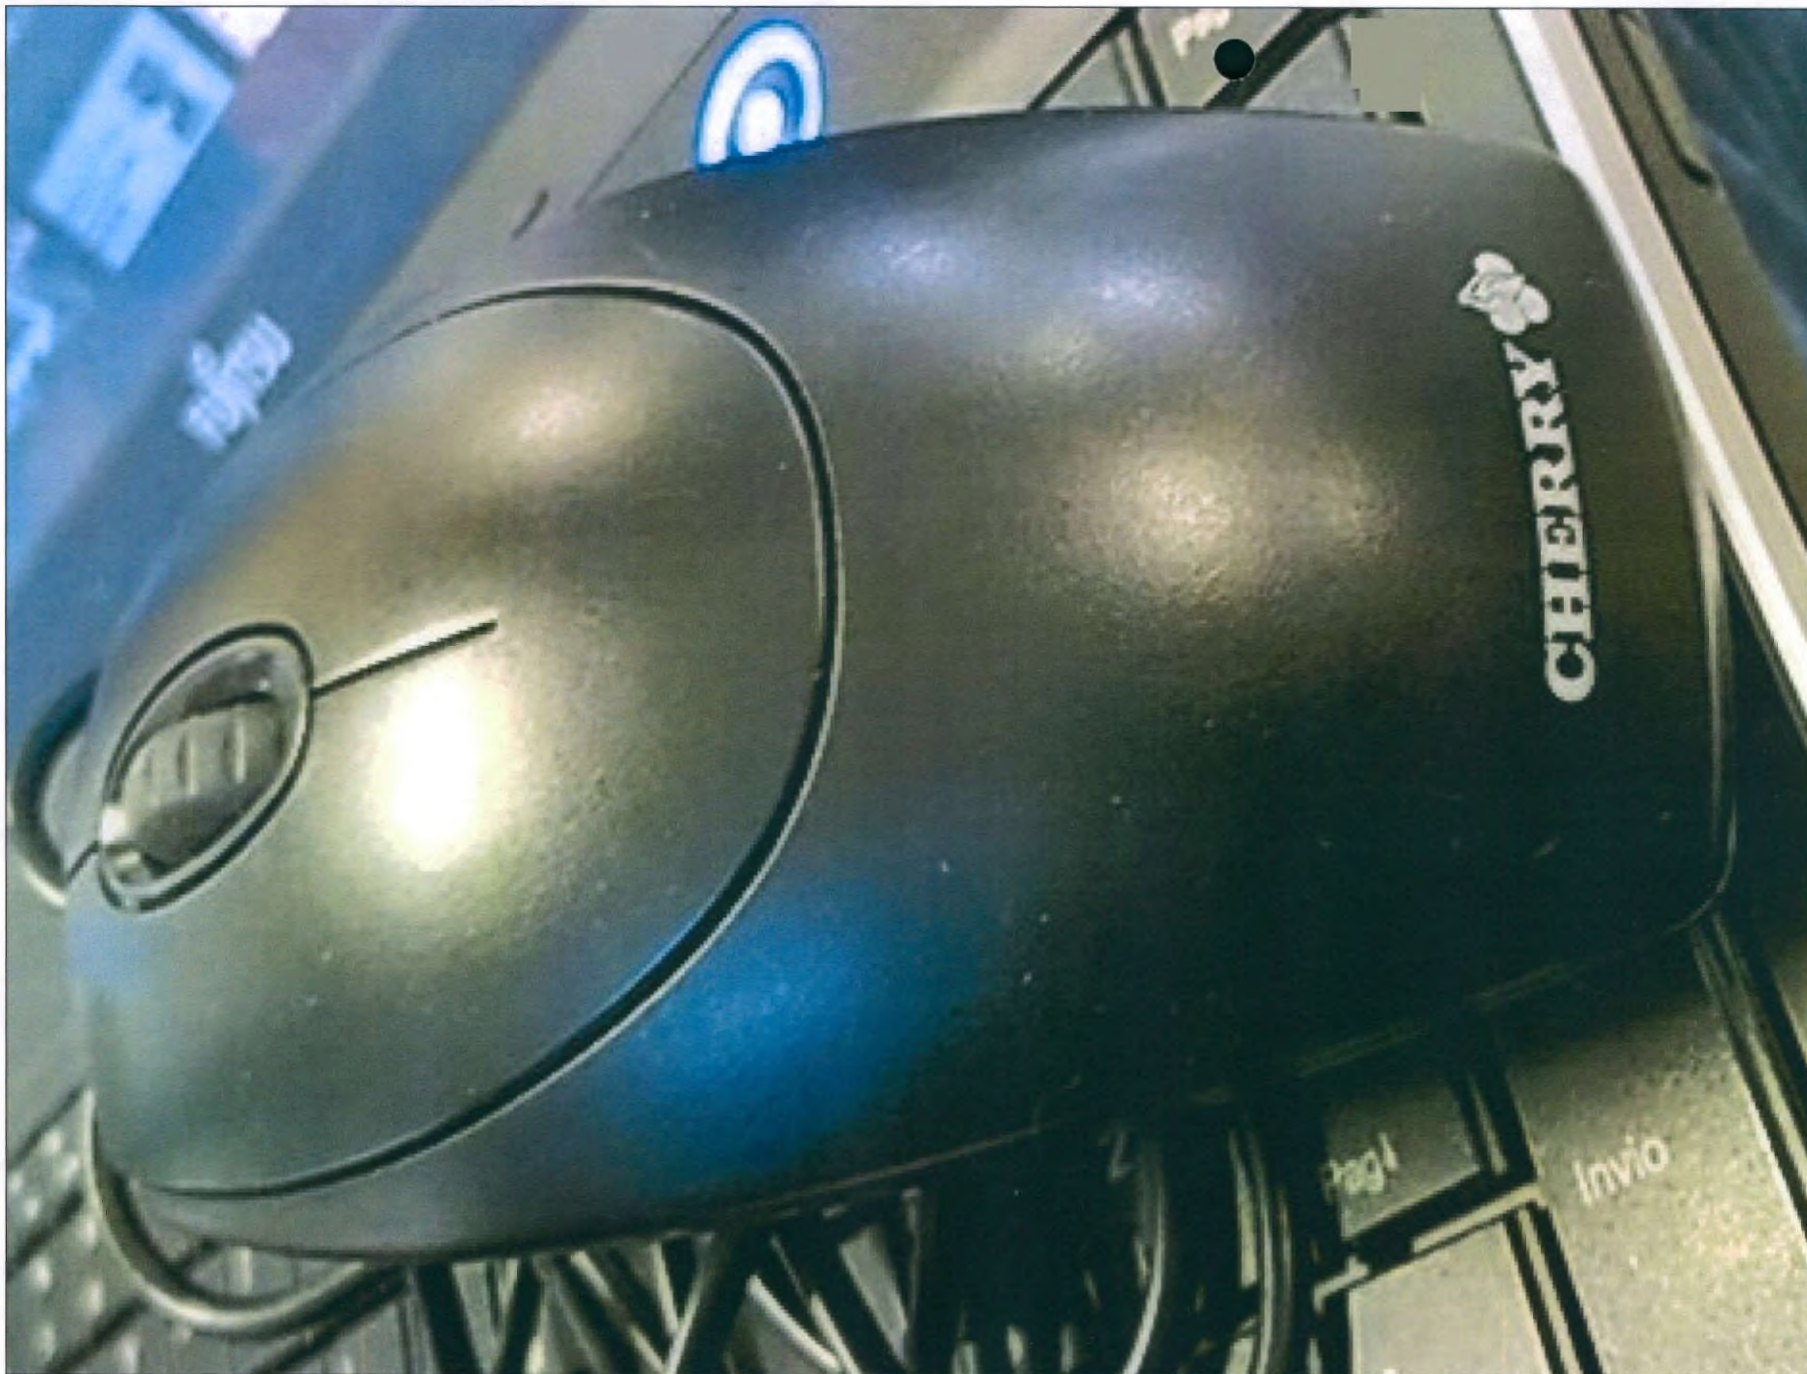


4 Мышь, не более 2 шт.




5.1 Видеоконмутатор 2-х и/или 4-х канальный, не более 4 шт. Видеоконмутатор с двумя входами VGA.



5.2 Видеоконмутатор 2-х и/или 4-х канальный, не более 4 шт. Видеоконмутатор с четырьмя входами VGA.

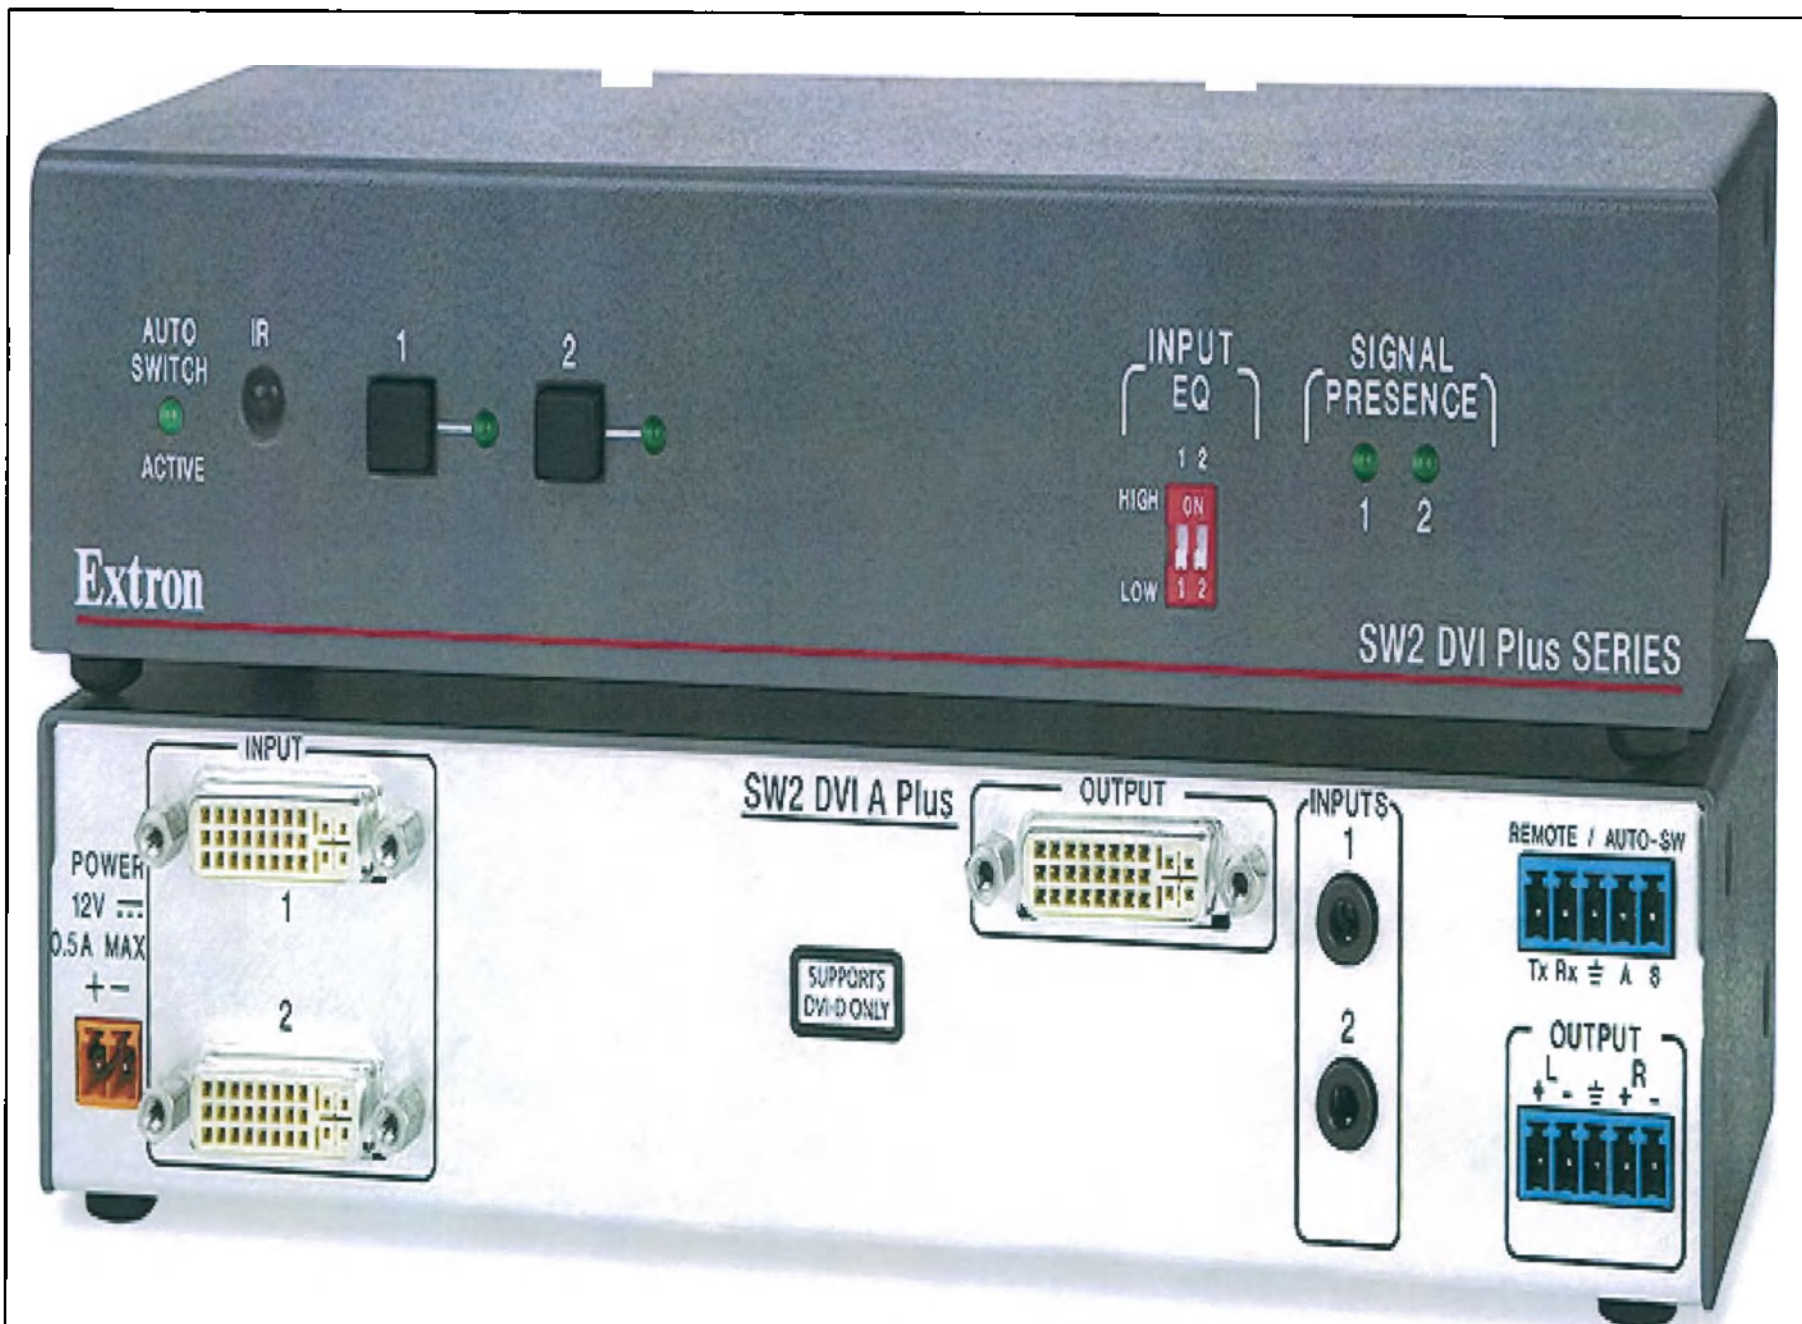

5.3 Видеосwitchер 2-х и/или 4-х канальный, не более 4 шт. Видеосwitchер с двумя входами DVI-D.

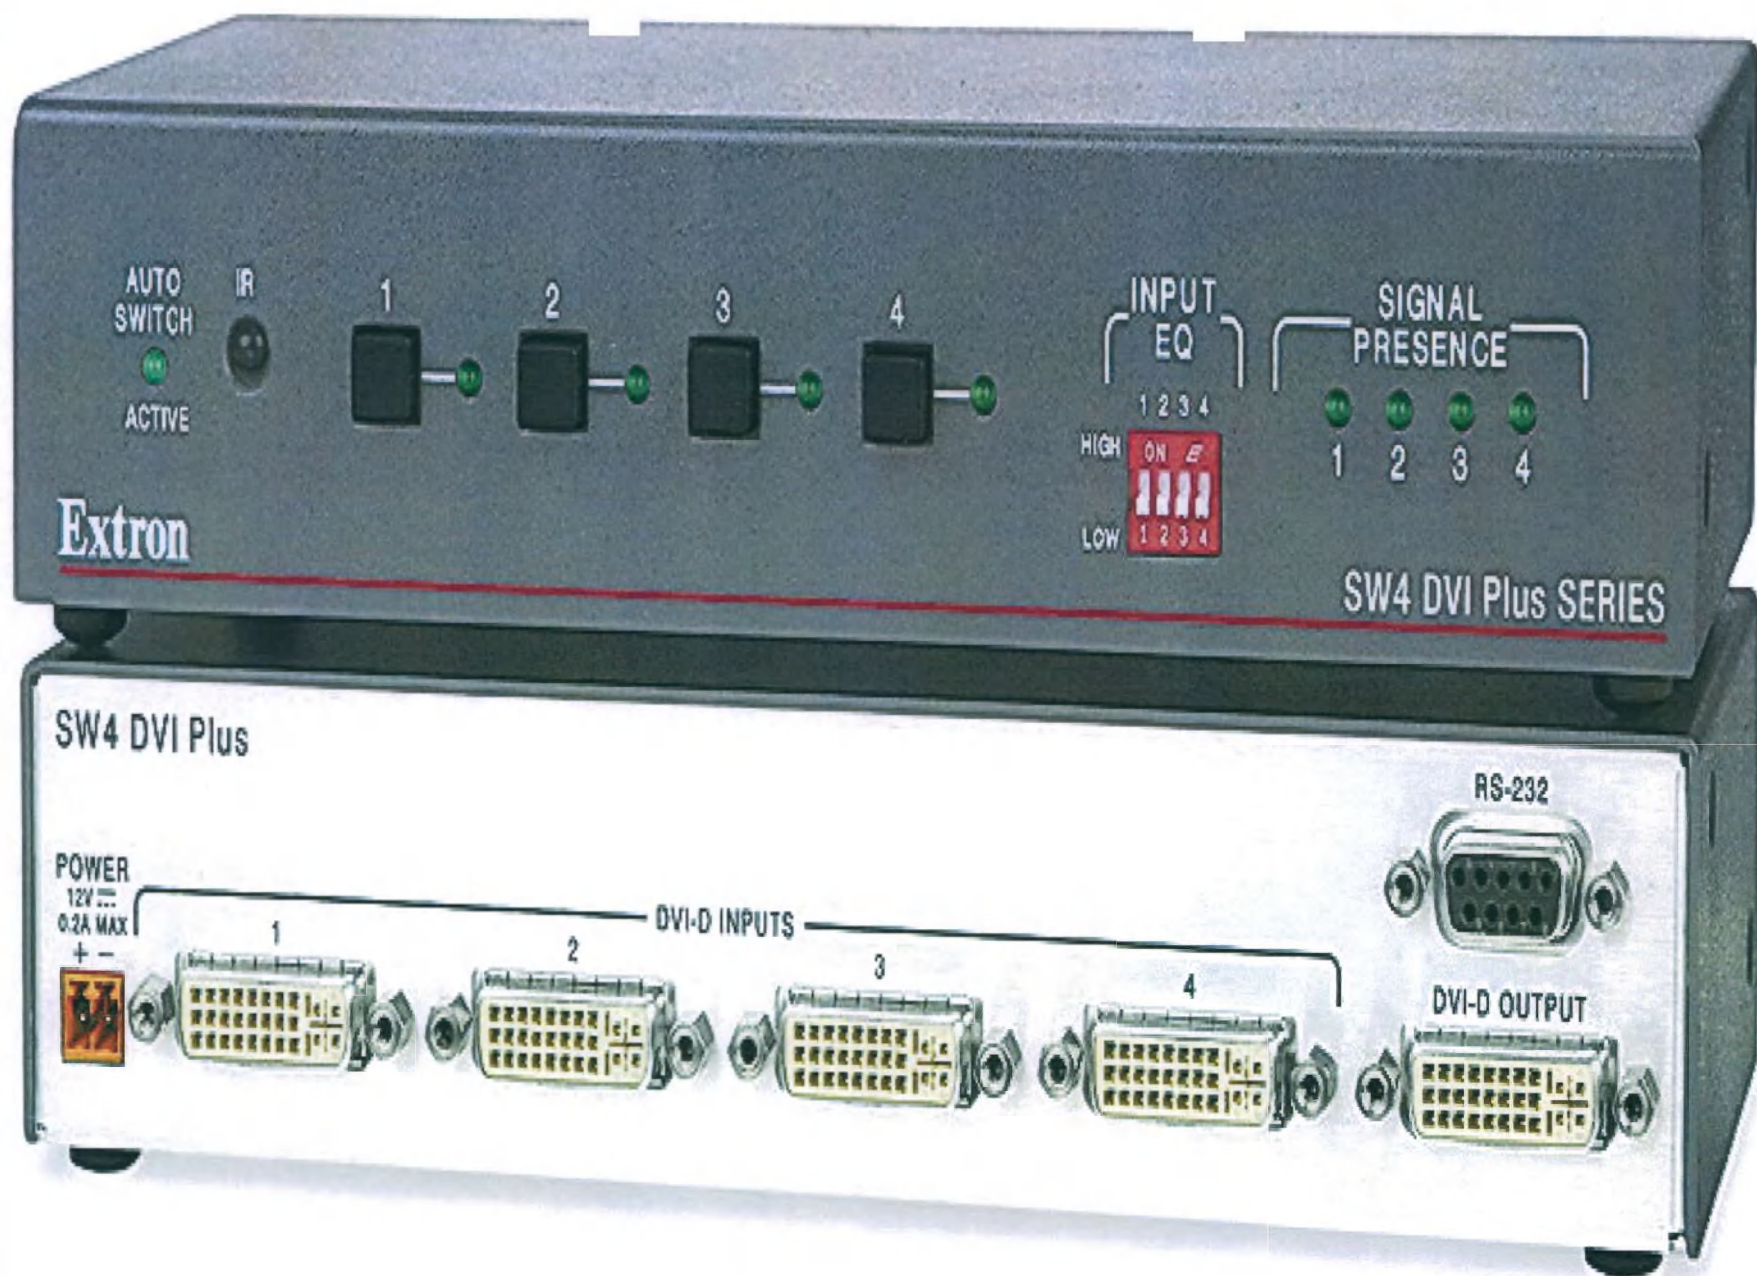


5.4 Видеоконмутатор 2-х и/или 4-х канальный, не более 4 шт. Видеоконмутатор с четырьмя входами DVI-D.



5.5 Видеоконмутатор 2-х и/или 4-х канальный, не более 4 шт. Видеоконмутатор с четырьмя входами DVI-D.



6.1 Видеоусилитель 2-х и/или 4-х канальный, не более 2 шт. Усилитель-распределитель с двумя выходами VGA.

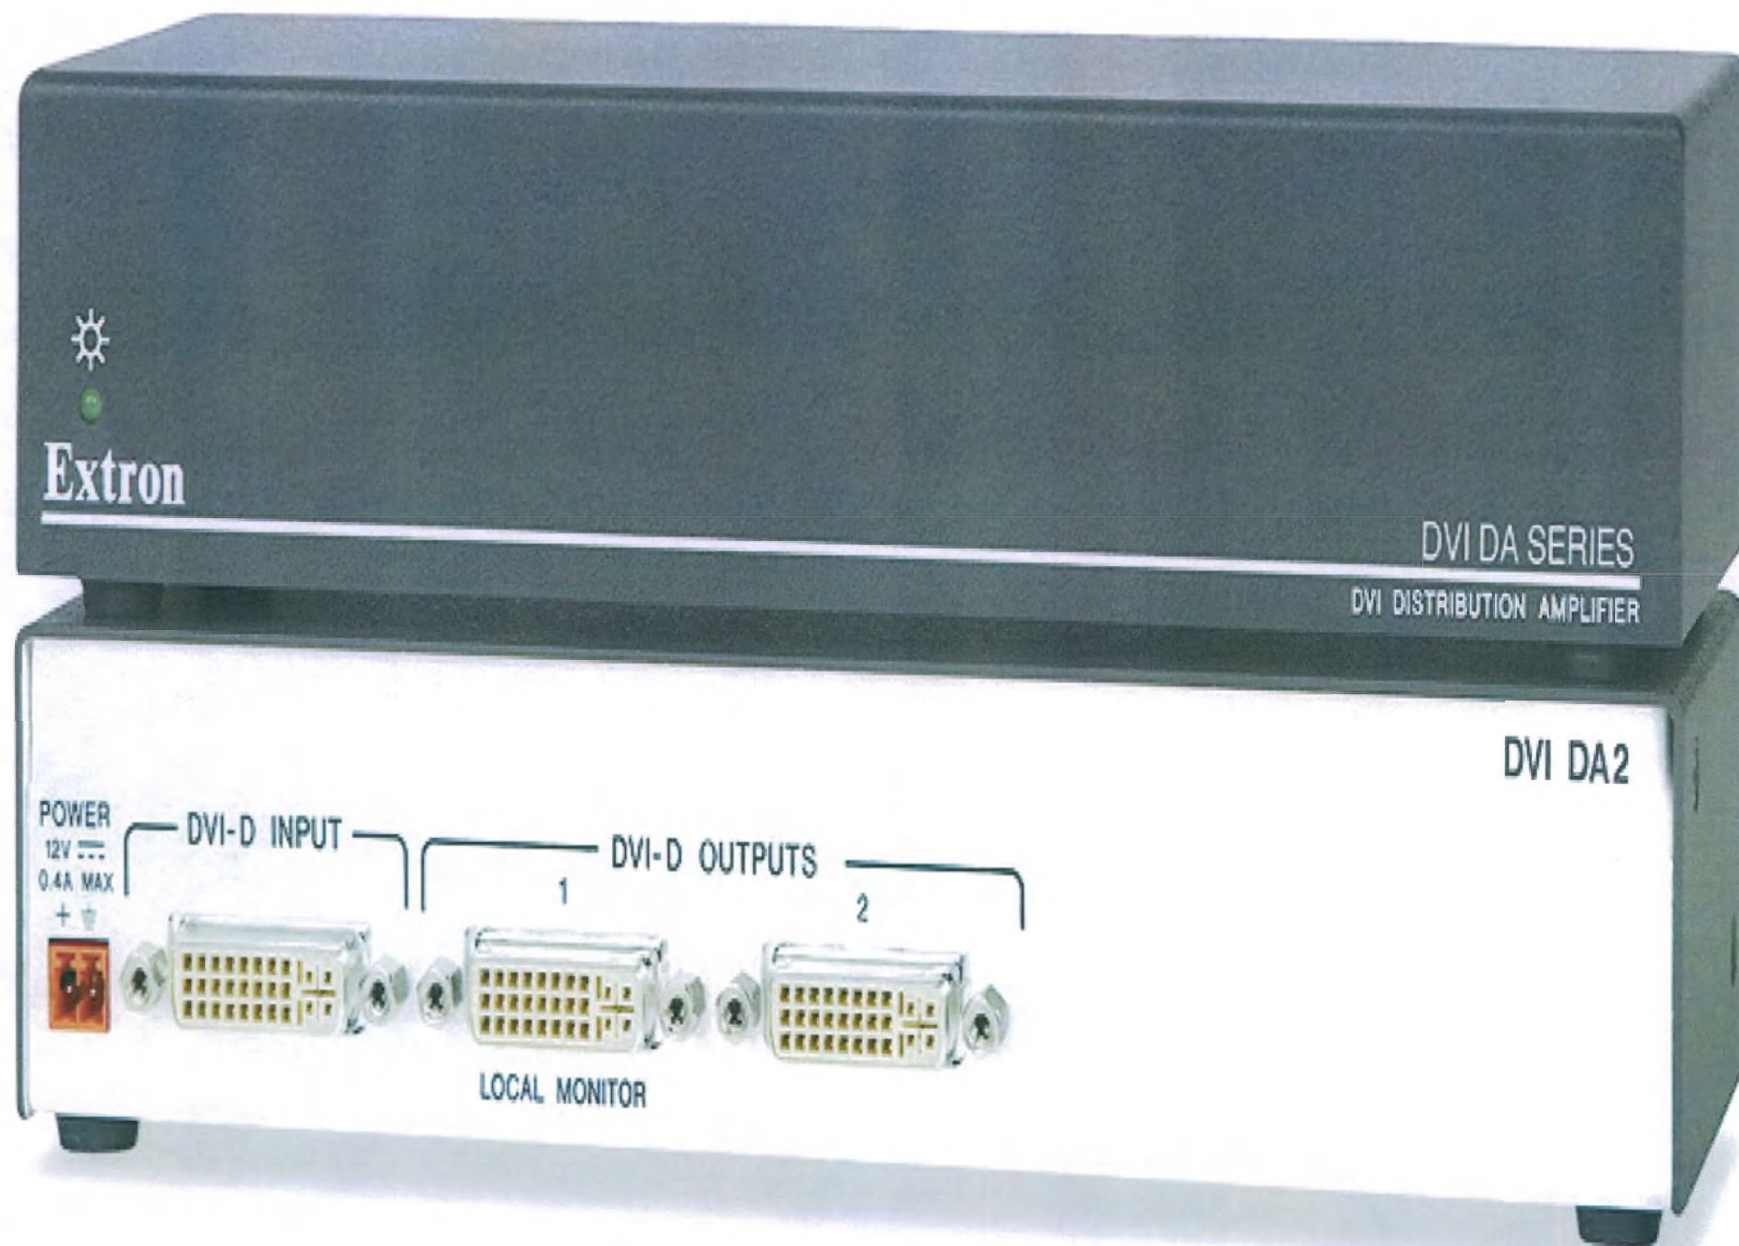

6.2 Видеоусилитель 2-х и/или 4-х канальный, не более 2 шт. Усилитель-распределитель с двумя выходами DVI-D




6.3 Видеоусилитель 2-х и/или 4-х канальный, не более 2 шт. Усилитель-распределитель с четырьмя выходами VGA-QXGA



6.4 Видеоусилитель 2-х и/или 4-х канальный, не более 2 шт. Усилитель-распределитель с одним входом и четырьмя выходами DVI-D.



7 Принтер специальный цветной.

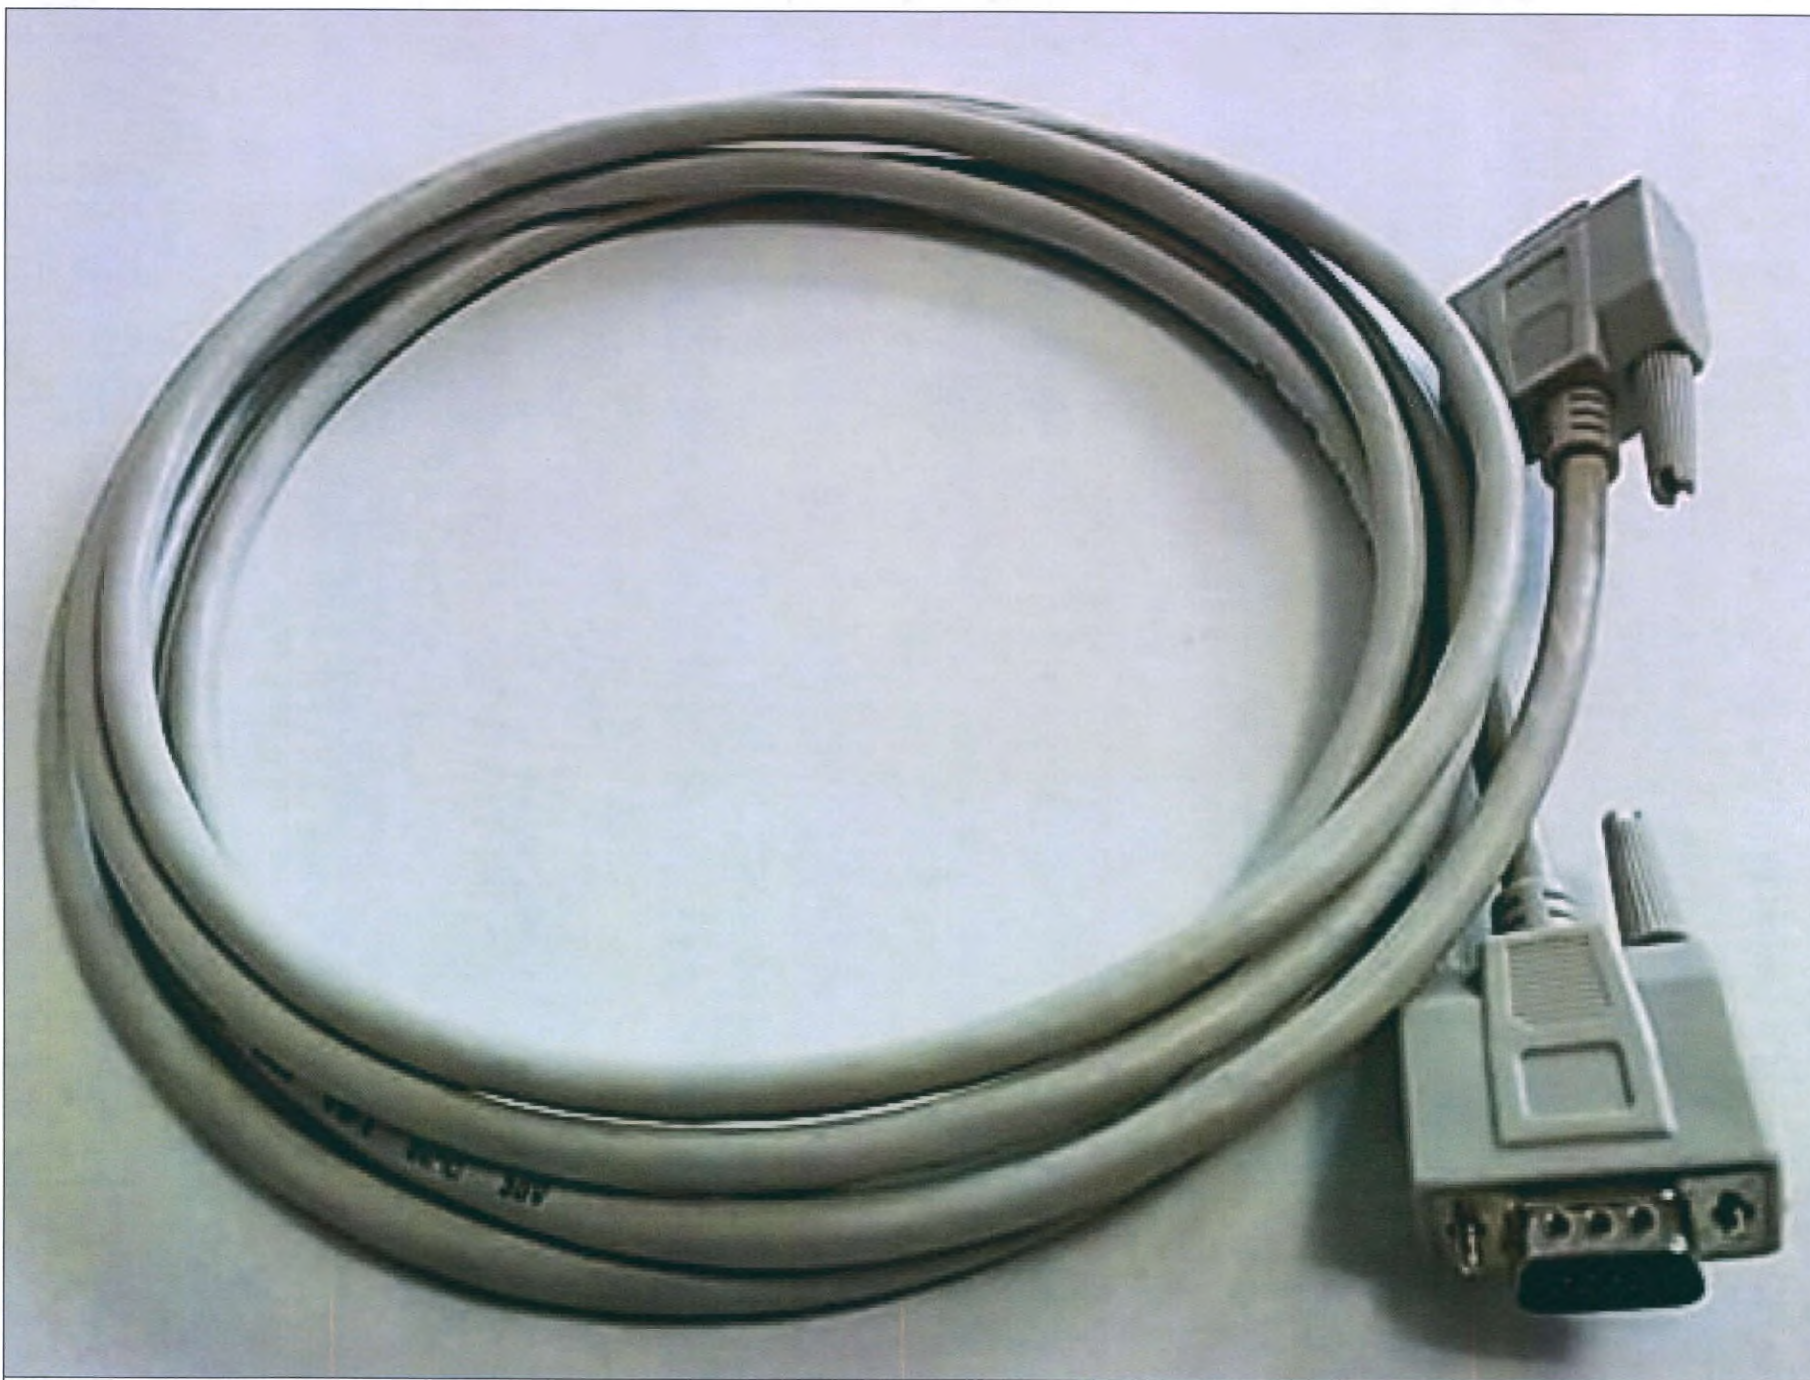

8.1 Кабели соединительные видеосигнала DVI, VGA, HDMI. Кабель соединительный VGA



8.2 Кабели соединительные видеосигнала DVI, VGA, HDMI. Кабель соединительный DVI-D.



8.3 Кабели соединительные видеосигнала DVI, VGA, HDMI. Кабель соединительный HDMI.



9 Кабель USB для подключения оборудования типа А к типу В, 1,8 м или 3 м, не более 10 шт.



10 Кабель заземления, 1 м или 3 м, не более 4 шт.



11 Предохранители.



12.1 Видеоадаптеры VGA, DVI, HDMI, Display Port, не более 15 шт. Видеоадаптер VGA / DVI.



12.2 Видеоадаптеры VGA, DVI, HDMI, Display Port, не более 15 шт. Видеоадаптер VGA / HDMI.



12.3 Видеоадаптеры VGA, DVI, HDMI, Display Port, не более 15 шт. Видеоадаптер VGA / Display Port



12.4 Видеоадаптеры VGA, DVI, HDMI, Display Port, не более 15 шт. Видеоадаптер DVI / HDMI



12.5 Видеоадаптеры VGA, DVI, HDMI, Display Port, не более 15 шт. Видеоадаптер DVI / Display Port



12.6 Видеоадаптеры VGA, DVI, HDMI, Display Port, не более 15 шт. Видеоадаптер HDMI / Display Port



12.7 Видеоадаптеры VGA, DVI, HDMI, Display Port, не более 15 шт. Видео адаптер волокно – DVI передатчик




12.8 Видеоадаптеры VGA, DVI, HDMI, Display Port, не более 15 шт. Видео адаптер волокно – DVI приемник




12.9 Видеоадаптеры VGA, DVI, HDMI, Display Port, не более 15 шт. Видео адаптер волокно – USB



12.10 Видеоадаптеры VGA, DVI, HDMI, Display Port, не более 15 шт. Адаптер 2 Pin JST - сетевой

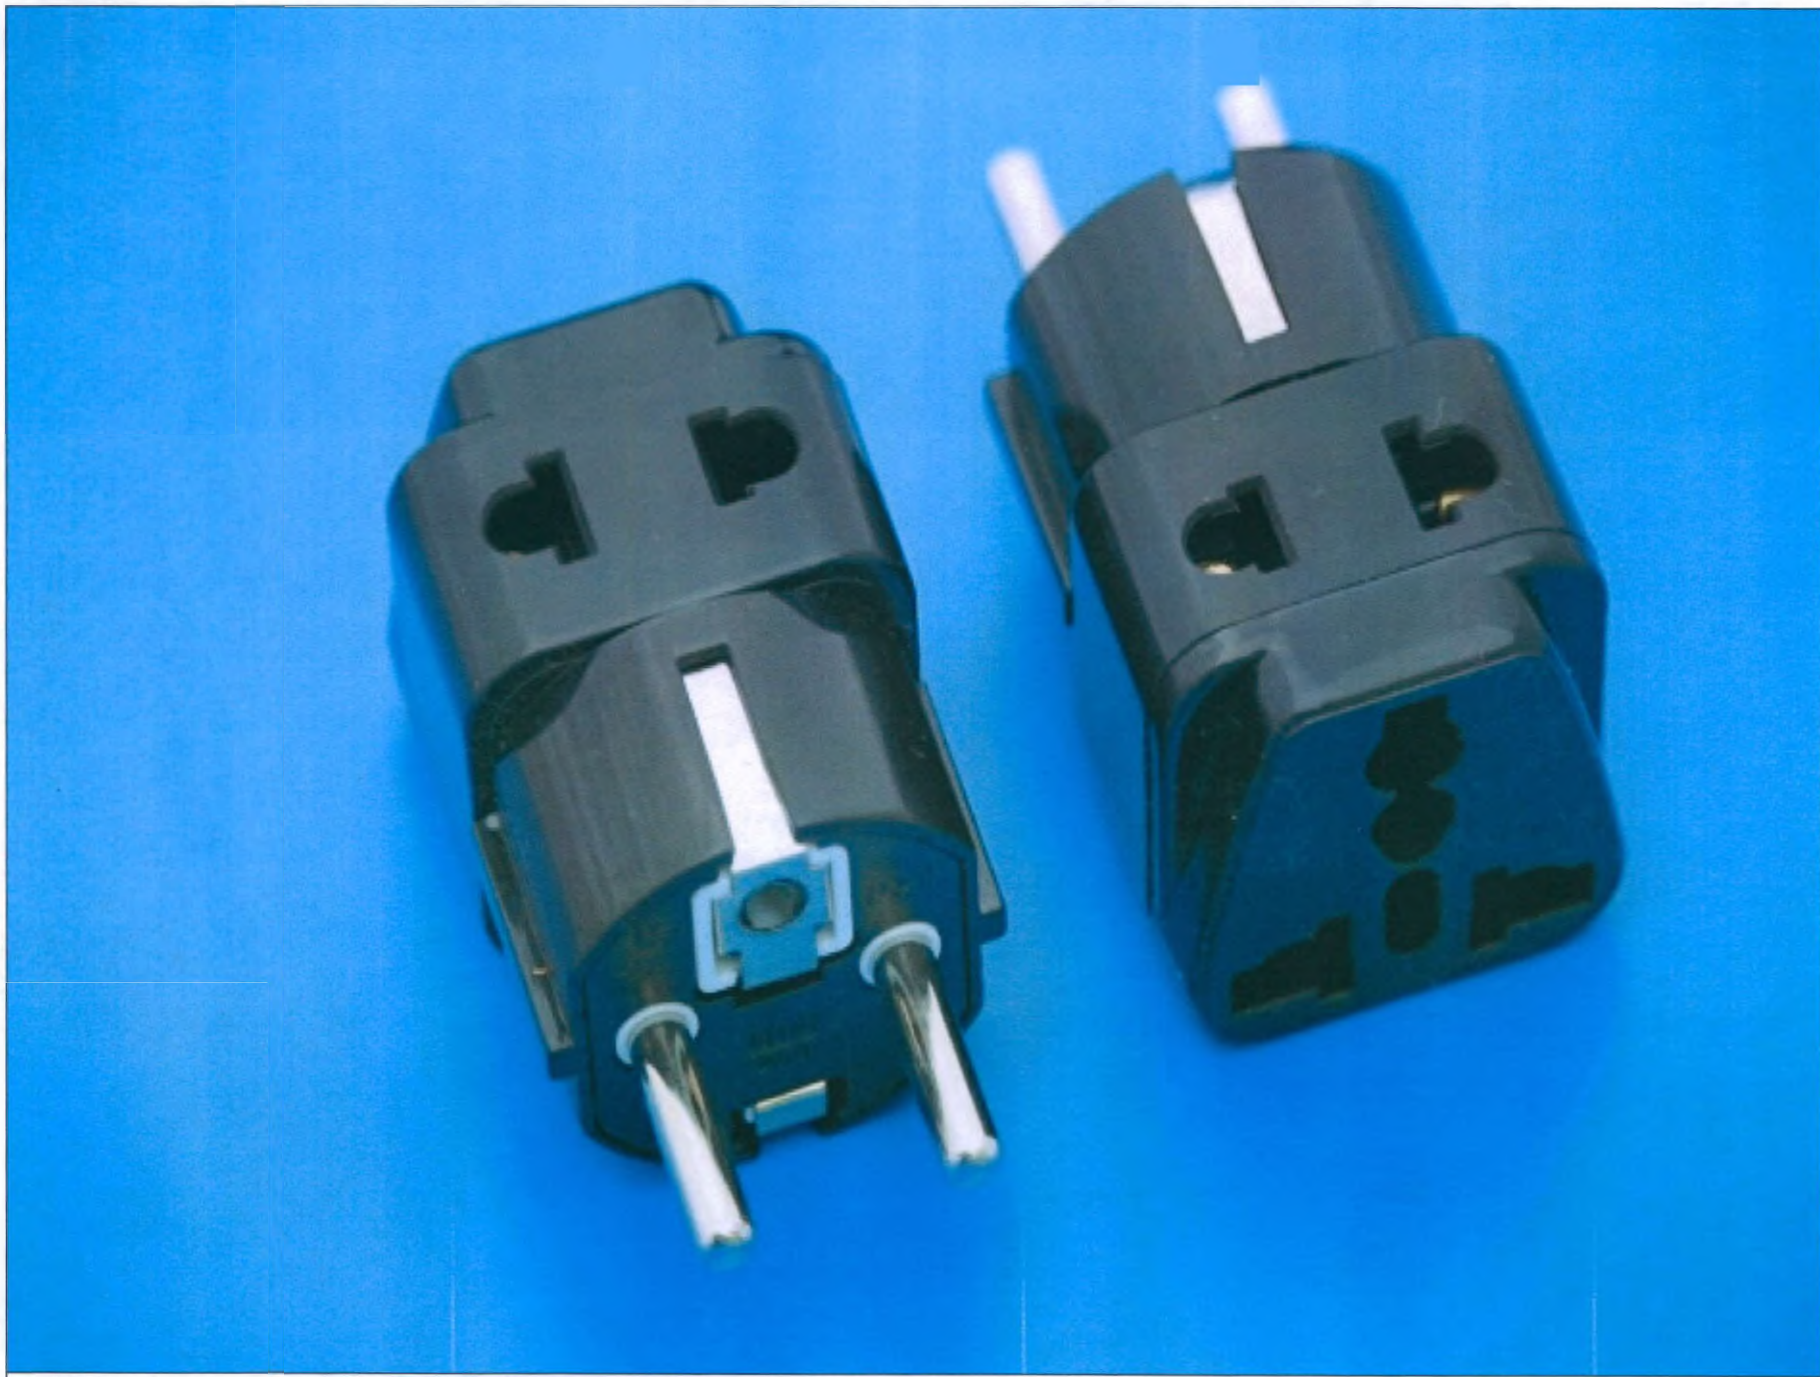


12.11 Видеоадаптеры VGA, DVI, HDMI, Display Port, не более 15 шт. Адаптер США - Европа

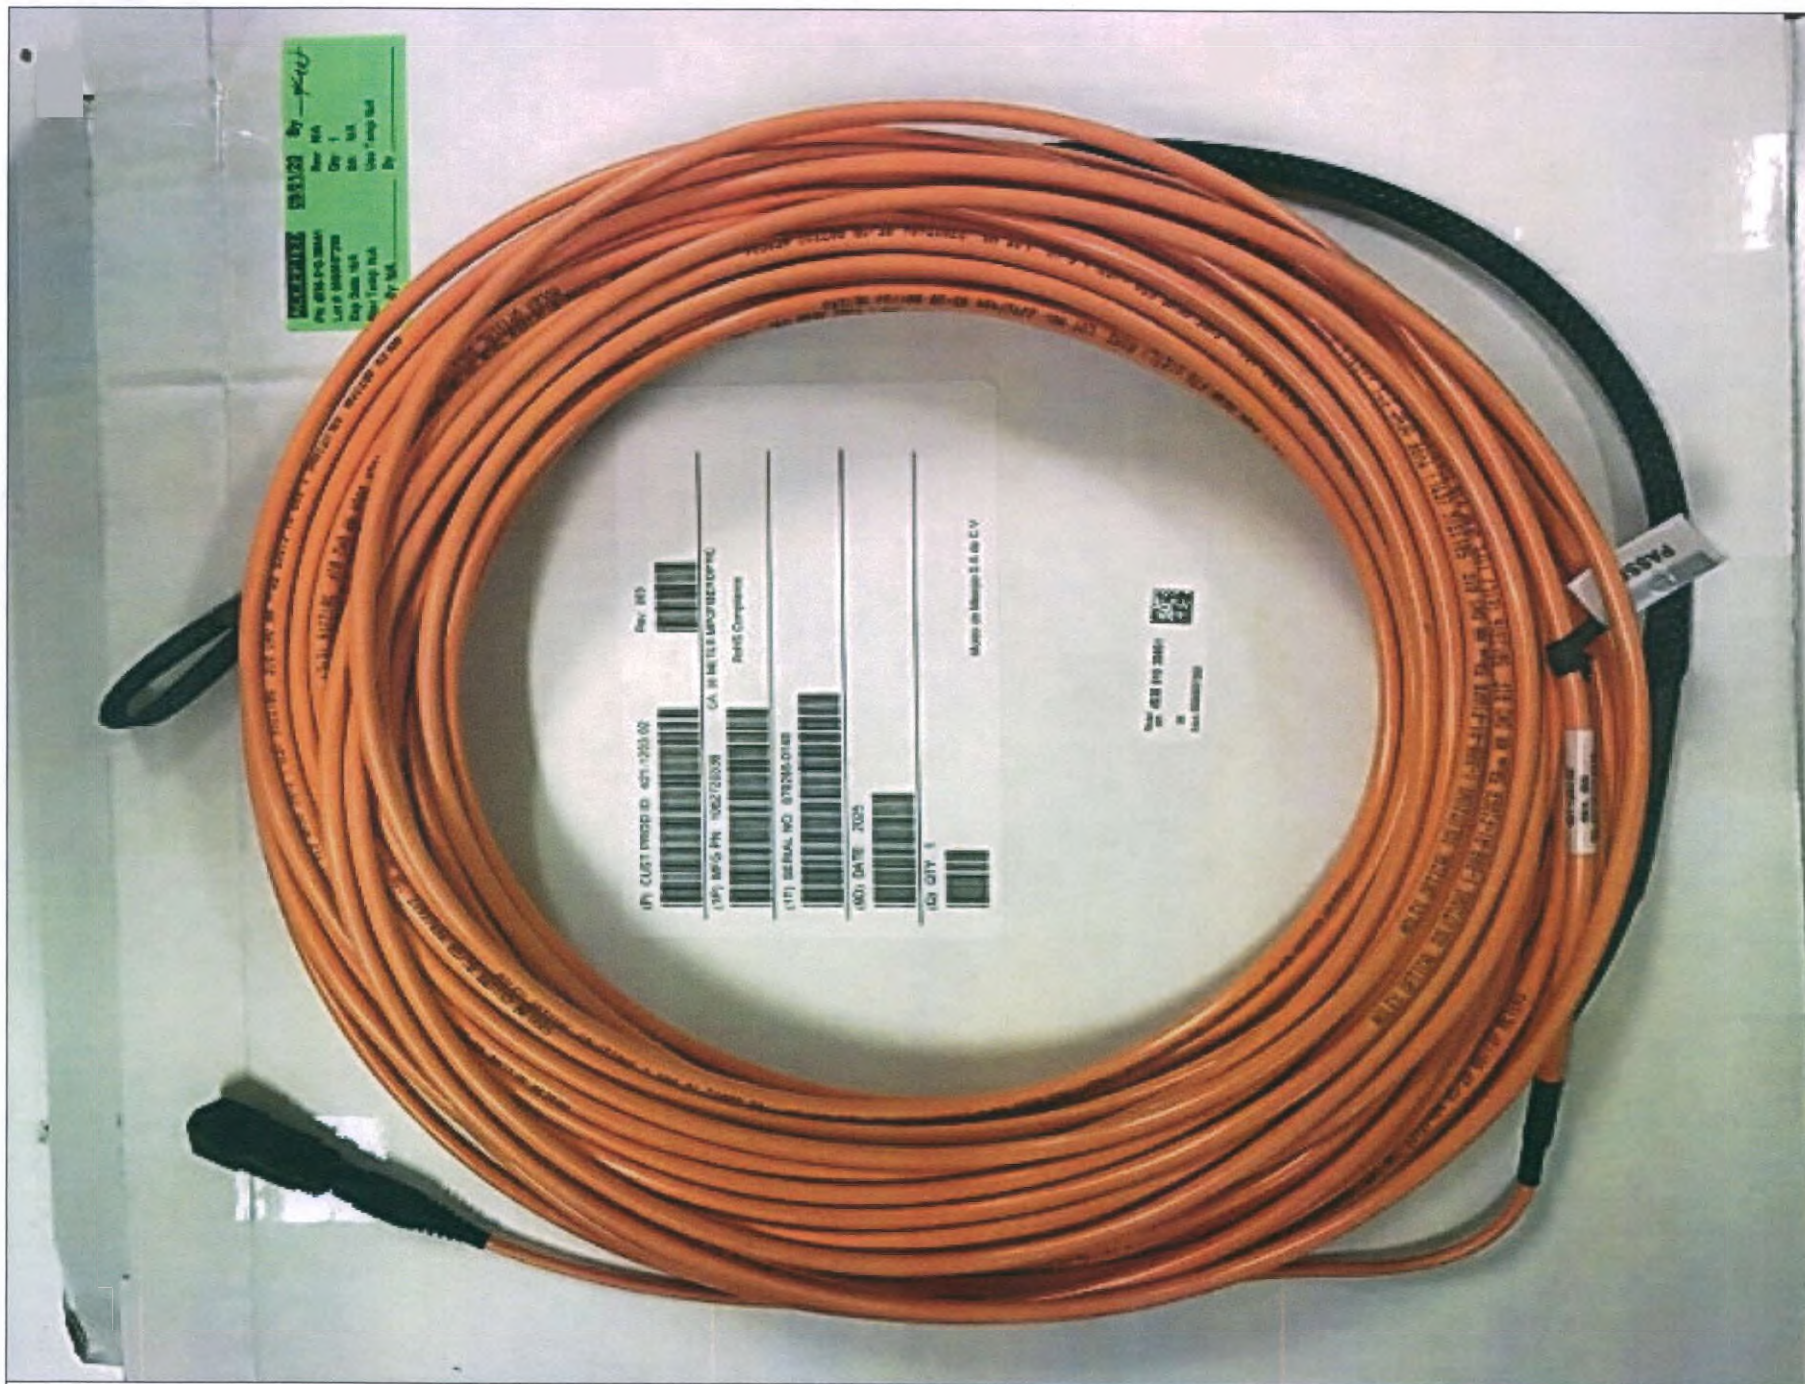

13 Видеокабель соединительный, 8 м или 15 м или 30 м или 45 м, не более 10 шт.



14.1 Кабели соединительные ЭКГ длиной 0,4 м и/или 1 м и/или 3 м и/или 5 м, не более 10 шт. ЭКГ / аортальный кабель

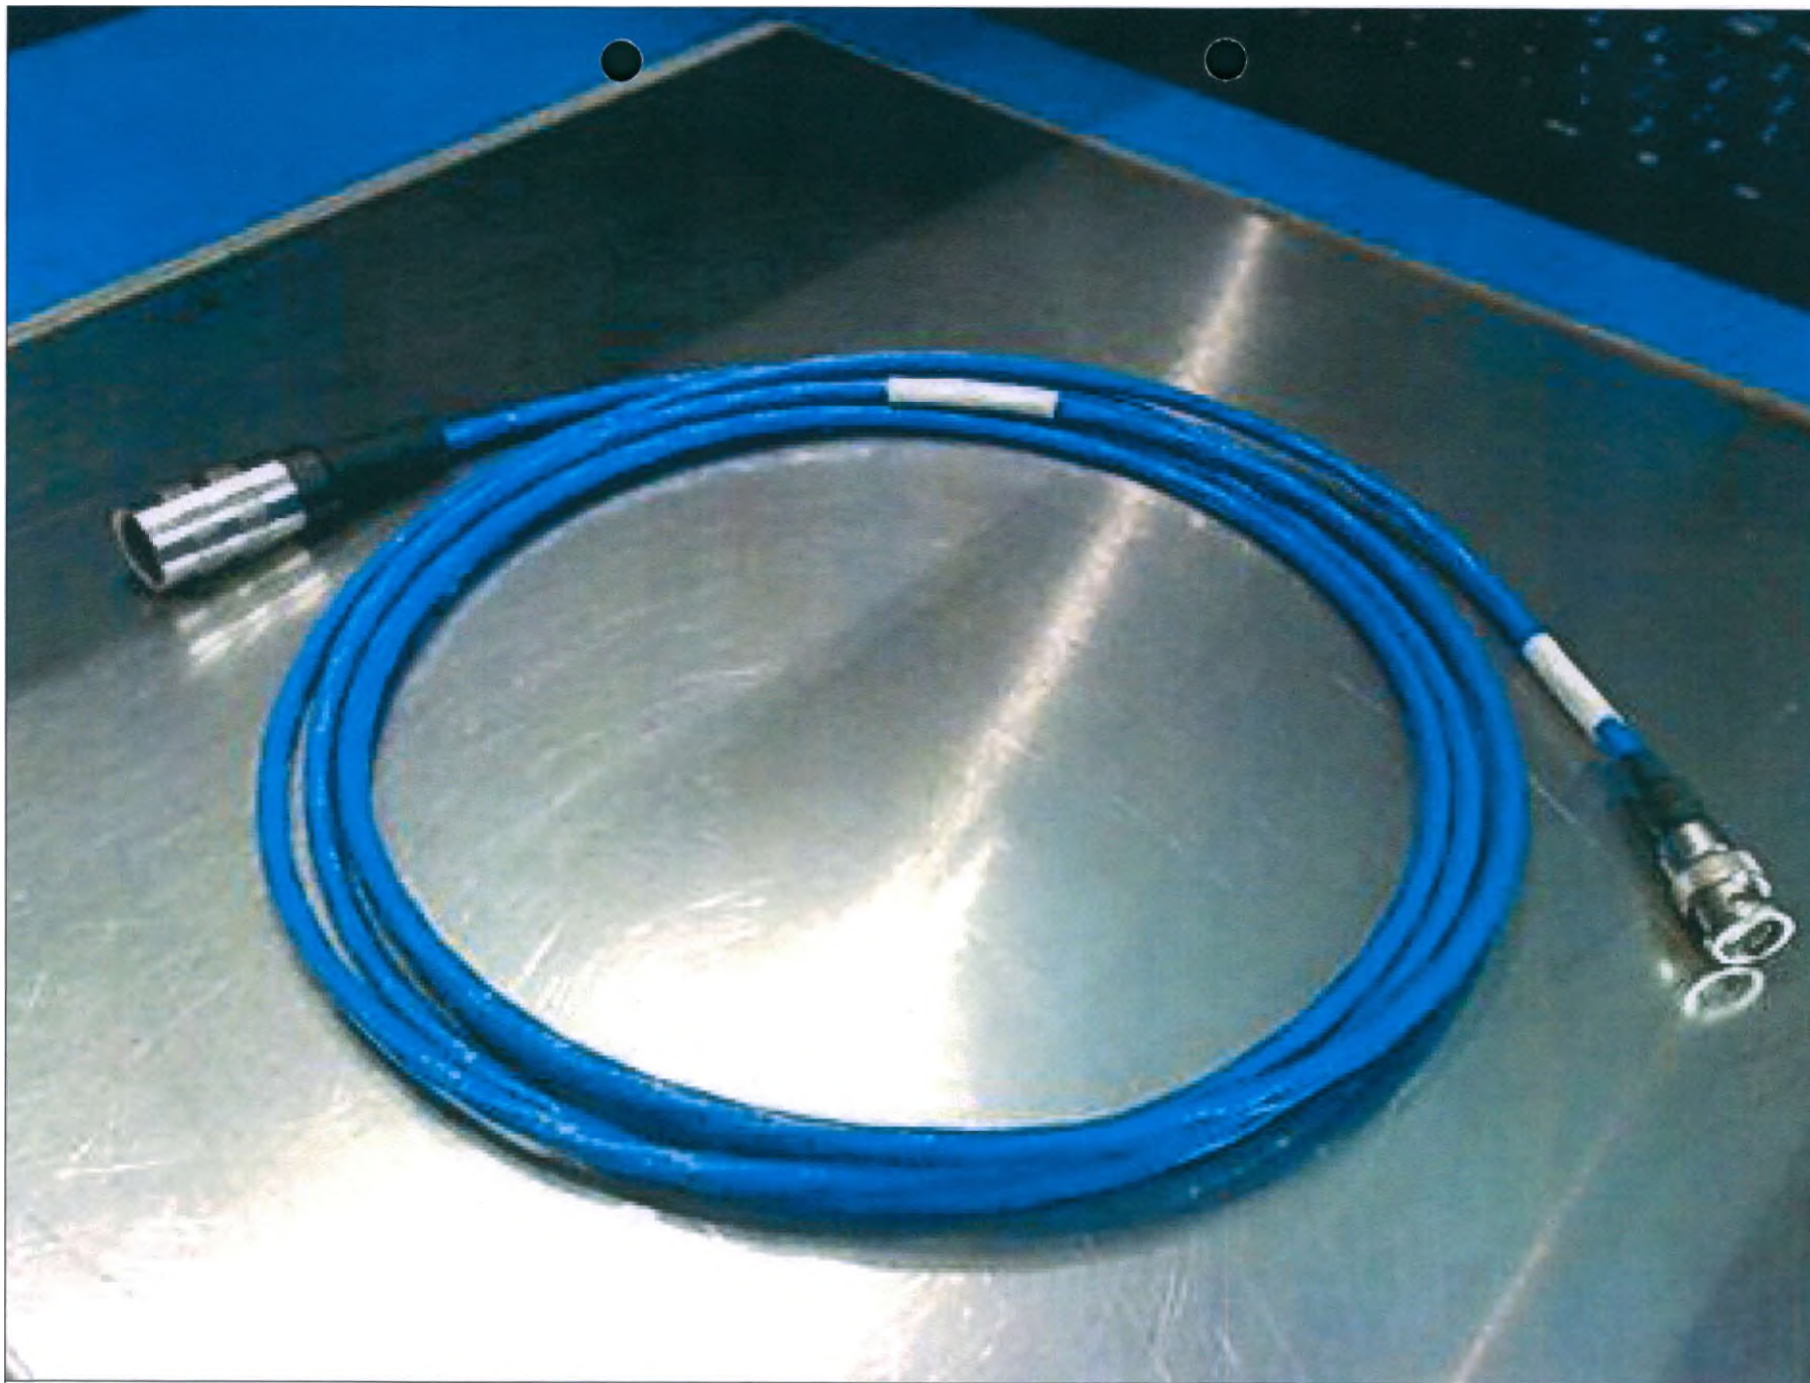


14.2 Кабели соединительные ЭКГ длиной 0,4 м и/или 1 м и/или 3 м и/или 5 м, не более 10 шт. ЭКГ / АД кабель



14.3 Кабели соединительные ЭКГ длиной 0,4 м и/или 1 м и/или 3 м и/или 5 м, не более 10 шт. ЭКГ / аортальный кабель



14.4 Кабели соединительные ЭКГ длиной 0,4 м и/или 1 м и/или 3 м и/или 5 м, не более 10 шт. ЭКГ / аортальный кабель

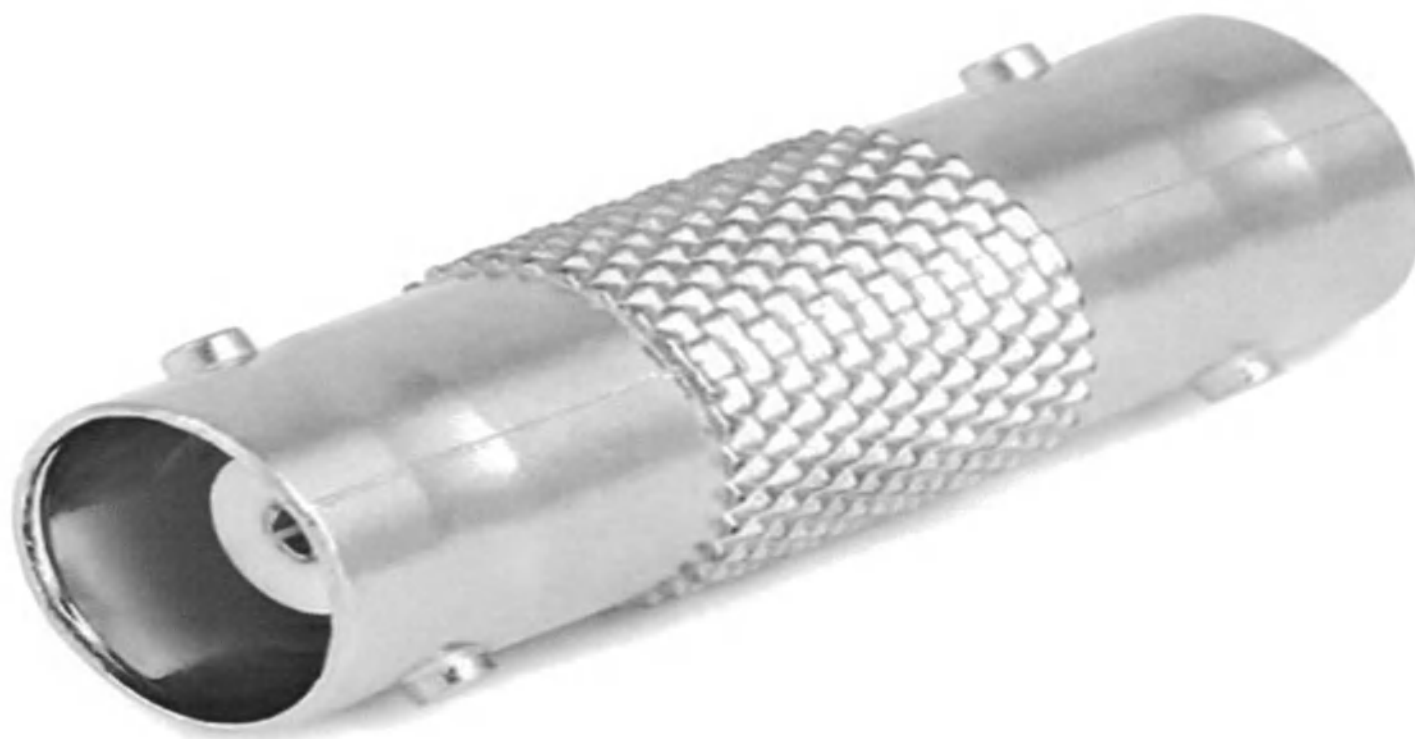

14.5 Кабели соединительные ЭКГ длиной 0,4 м и/или 1 м и/или 3 м и/или 5 м, не более 10 шт. Адаптер BNC



14.6 Кабели соединительные ЭКГ длиной 0,4 м и/или 1 м и/или 3 м и/или 5 м, не более 10 шт. Т-разветвитель BNC




14.7 Кабели соединительные ЭКГ длиной 0,4 м и/или 1 м и/или 3 м и/или 5 м, не более 10 шт. ЭКГ / АД кабель



14.8 Кабели соединительные ЭКГ длиной 0,4 м и/или 1 м и/или 3 м и/или 5 м, не более 10 шт. ЭКГ / АД кабель



14.9 Кабели соединительные ЭКГ длиной 0,4 м и/или 1 м и/или 3 м и/или 5 м, не более 10 шт. ЭКГ / АД кабель

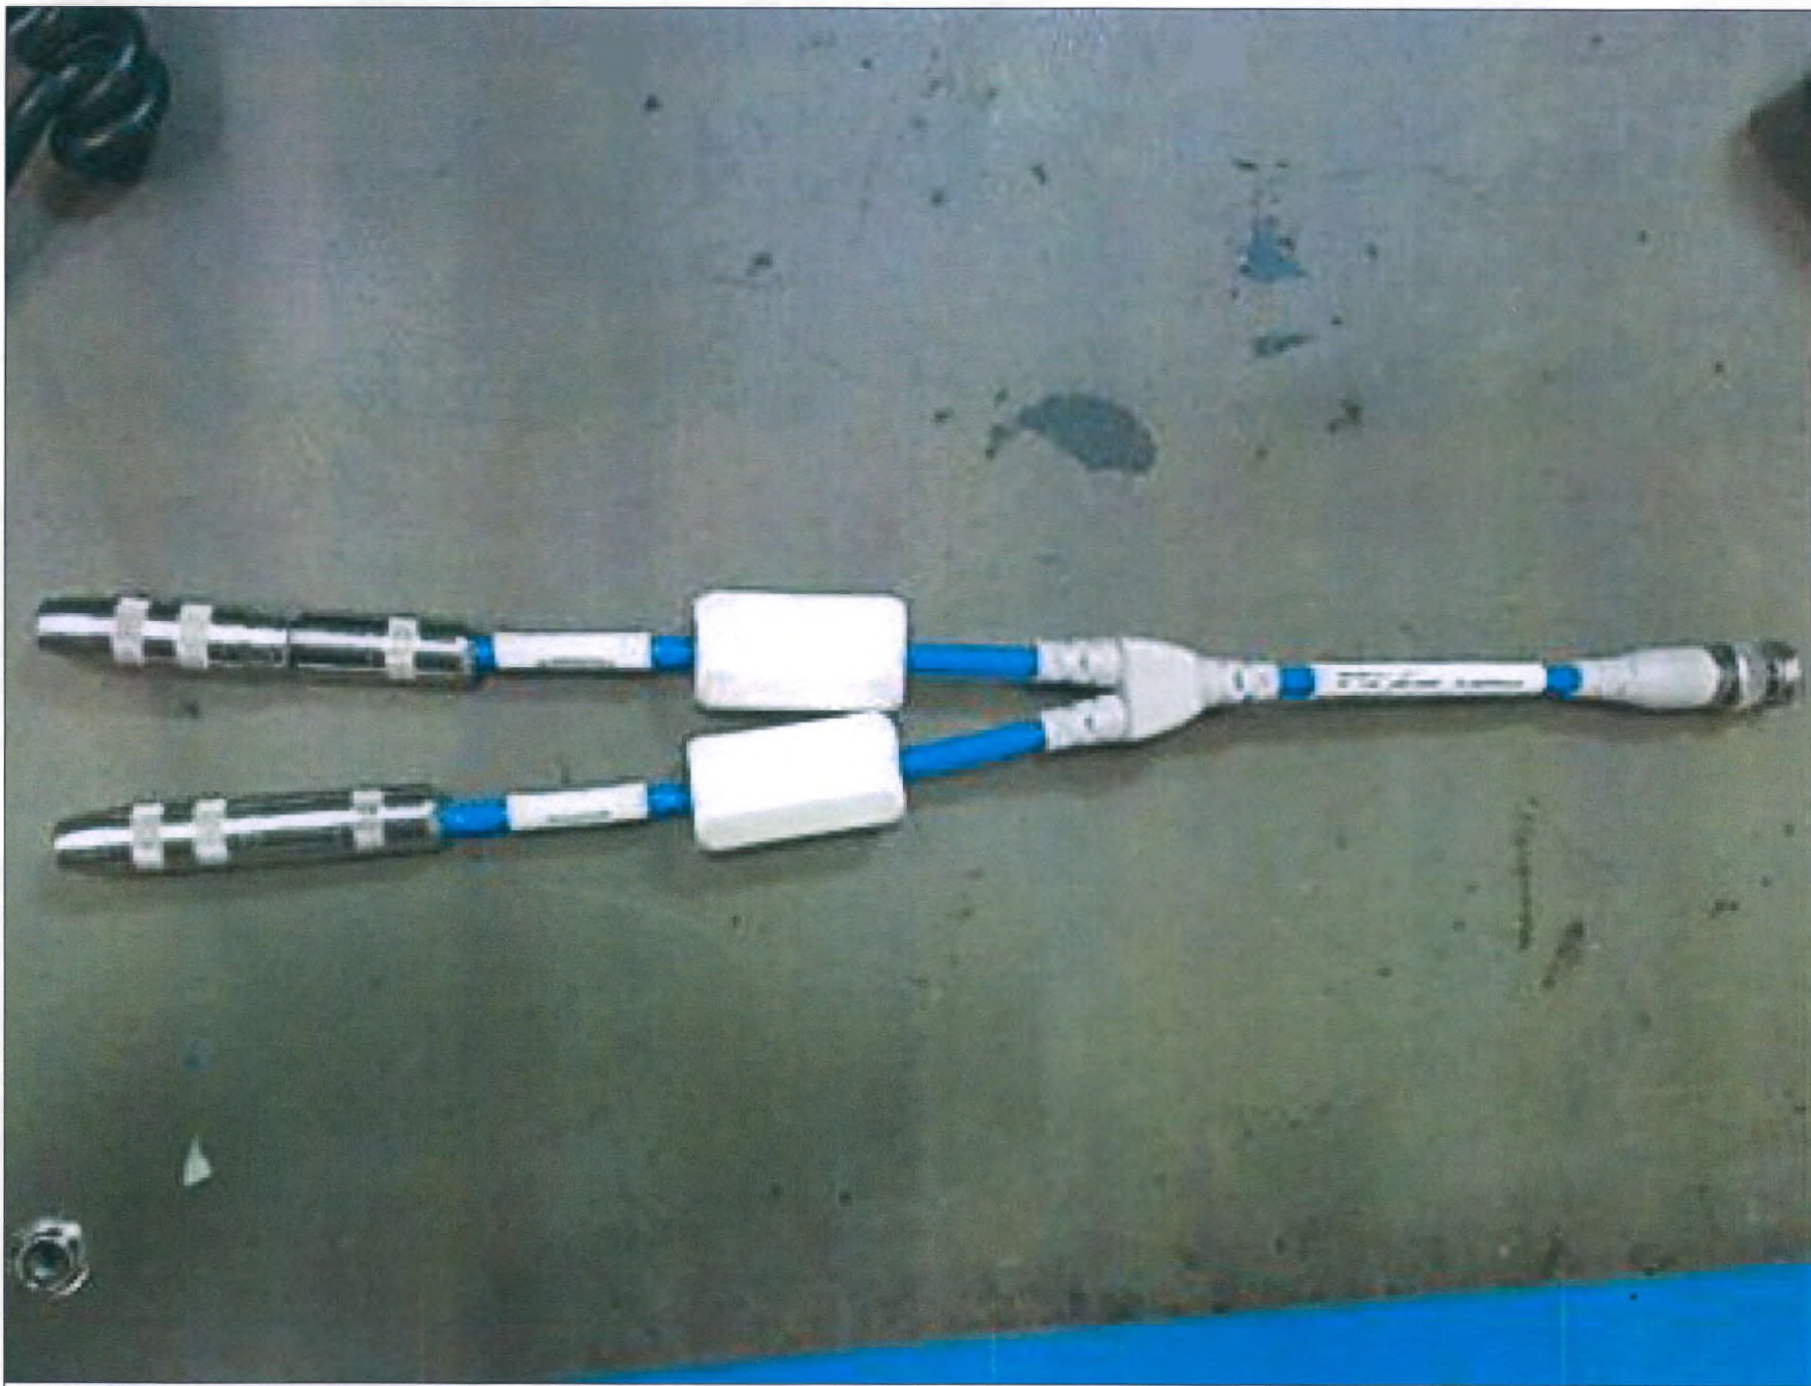

14.10 Кабели соединительные ЭКГ длиной 0,4 м и/или 1 м и/или 3 м и/или 5 м, не более 10 шт. Y-адаптер BUB-Lomar/TSM



Упаковка системы



Упаковка компонентов системы



Упаковка компонентов системы

Производитель: [по РУ]

Место производства: [по РУ]

Медицинское Изделие: [Наименование по РУ]

Вариант исполнения/Модель: [по РУ]

Серийный номер/номер партии:

см. **SN** / **LOT** на основной маркировке

Дата изготовления: см.  на основной маркировке

Номинальный режим работы: см.  или на основной маркировке

Предупреждения и знаки опасности: см. 

Регистрационное удостоверение: №

EAC

Макет маркировки на русском языке.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 80 листа (ов)

ООО «Филипс»

