



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Медтроник»
Плясунова Е.В.

30 «ноября» 2021 г.

Фотографические изображения

«Канюли артериотомические в вариантах исполнения»

Производства:

«Медтроник Инк.», США

Medtronic Inc., USA, 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432, USA

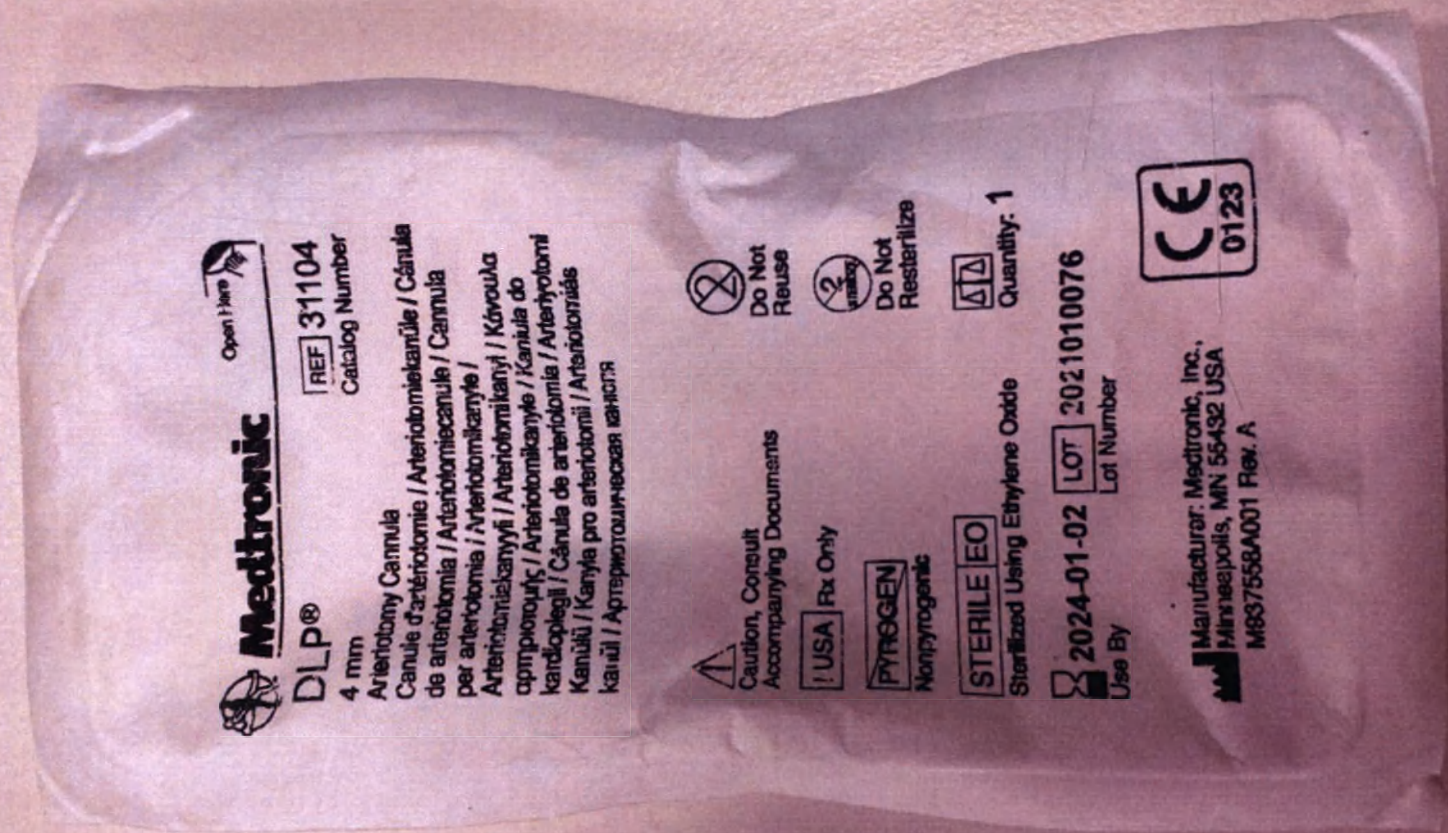


Рисунок 1. Маркировка упаковки Канюли артериотомической с грушевидным наконечником 4 мм, модель 31104

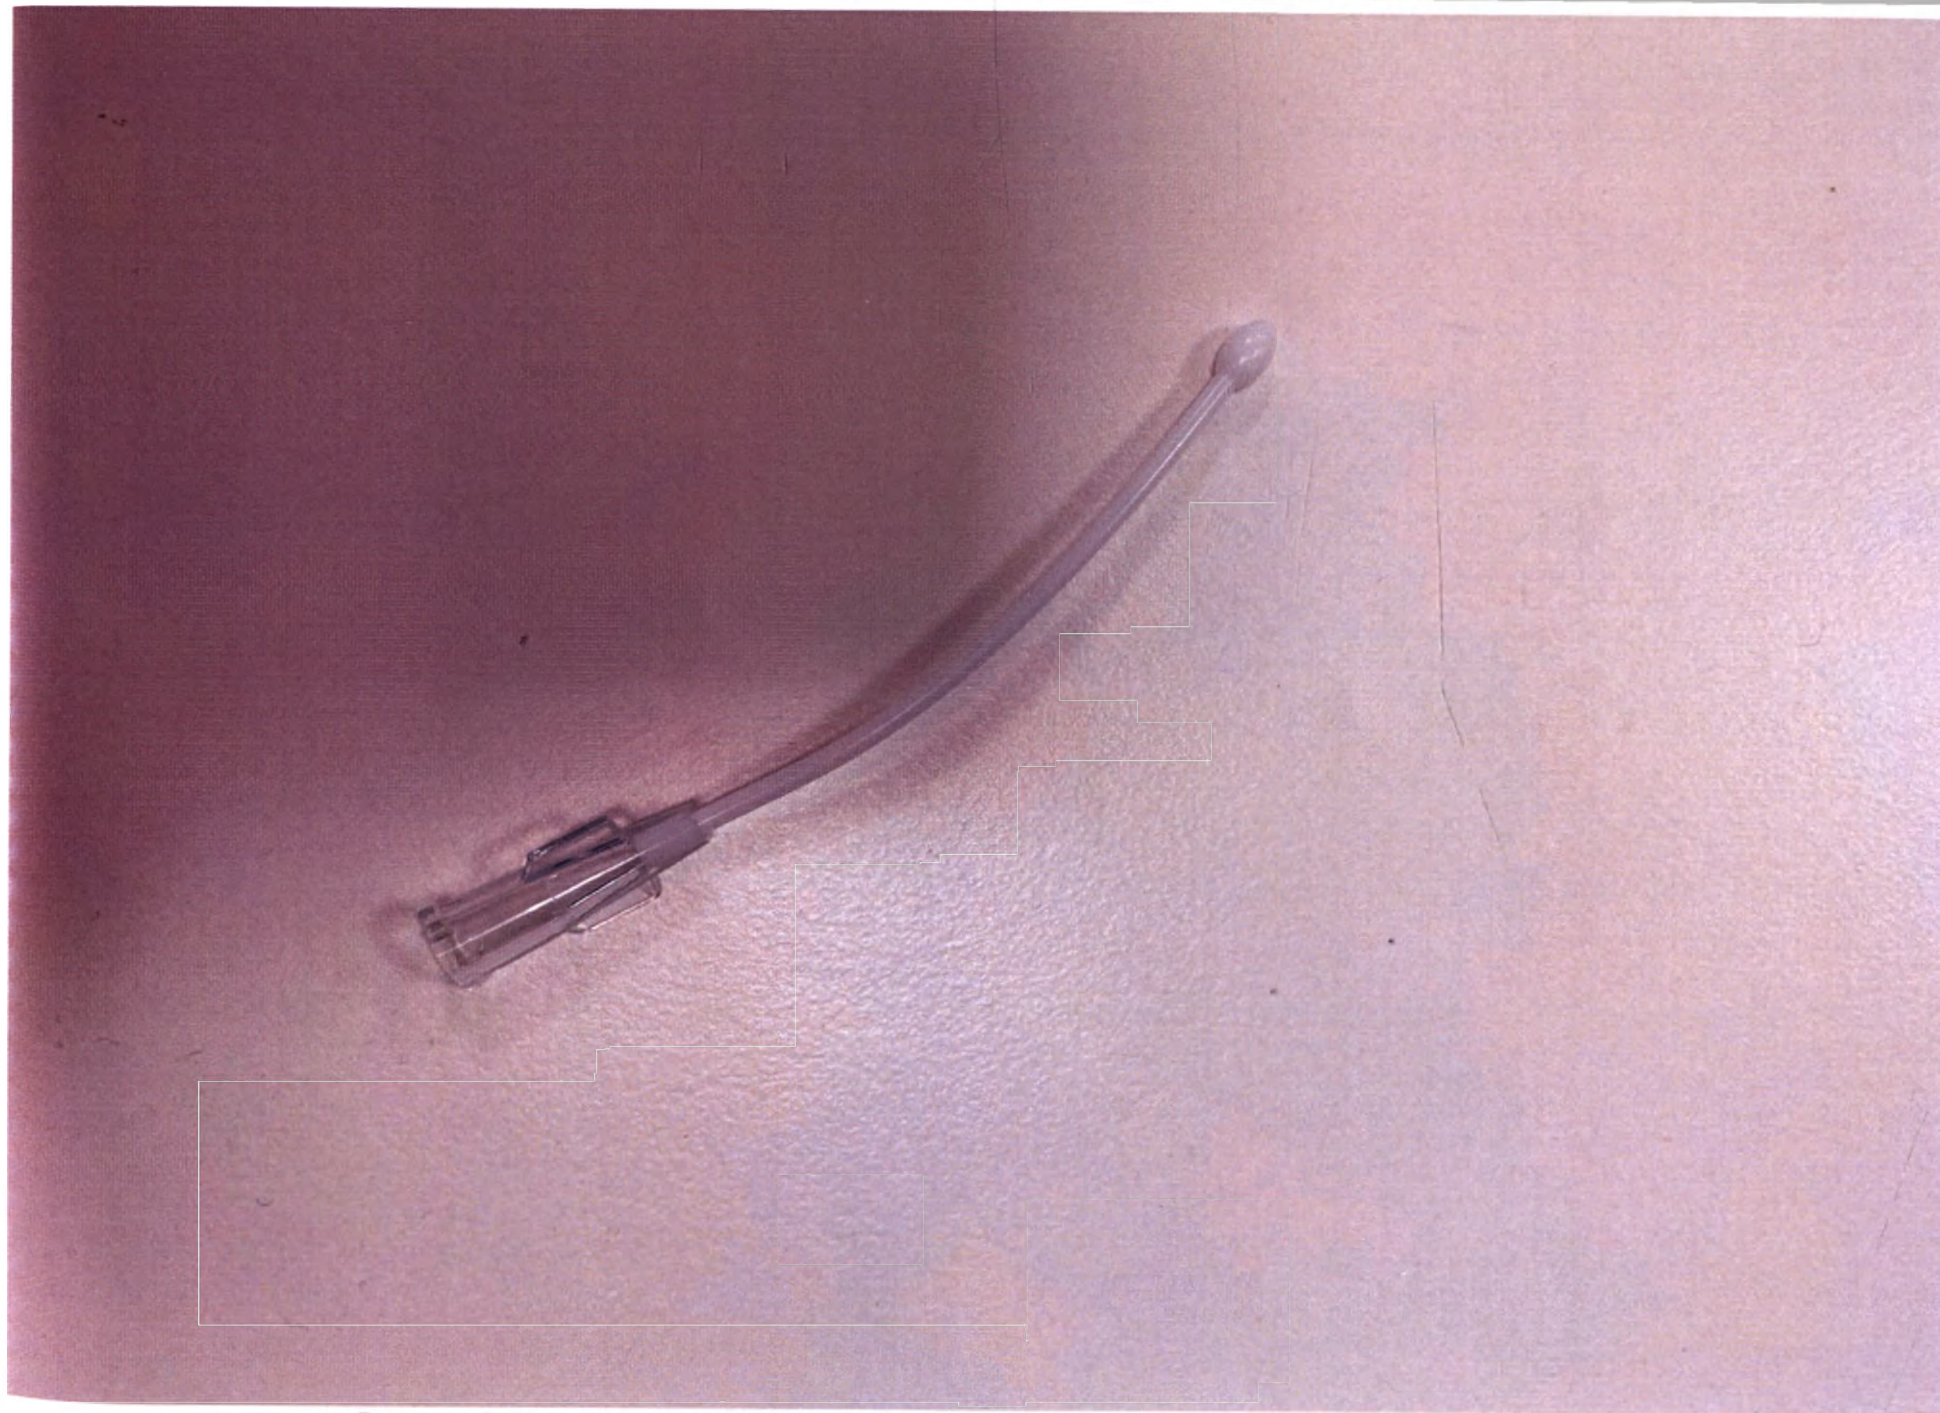


Рисунок 2. Канюля артериотомическая с грушевидным наконечником 4 мм, модель 31104



DLP®
5 mm
Arteriotomy Cannula
Canule d'arteriotomie / Arteriotomietkanüle / Cánula
de arteriotomia / Arteriotomietkanüle / Caninula
per arteriotomia / Arteriotomietkanüle /
Arteriotomietkanüle / Arteriotomietkanüle /
Arteriotomietkanüle / Arteriotomietkanüle /
Arteriotomietkanüle / Cánula de arteriotomia / Arteriotomietkanüle /
Kanyüla / Kanyüla pro arteriotomii / Arteriotomietkanüle /
kanül / Артериотомическая канюля

REF 31105
Catalog Number

Caution, Consult
Accompanying Documents
 USA Rx Only
 PYROGEN
Nonpyrogenic
 STERILE EO
Sterilized Using Ethylene Oxide
 Do Not
Reuse
 Do Not
Resterilize
 Quantity: 1

Use By 2023-09-30
 Lot Number 2020090664



Manufacturer: Medtronic, Inc.,
Minneapolis, MN 55432 USA
M837558A001 Rev. A





Medtronic



DLP®

REF 31003

Catalog Number

3 mm

Arteriotomy Sample
Cannule d'artériotomie / Arteriotomiekanüle / Cánula
de arteriotomia / Arteriotomieskanüle / Cannula
per arteriotomia / Arteriotomizkanüle /
Arteriotomizatsiya / Arteriotomizatsiya / Канюля
артериотомическая / Arteriotomizatsiya / Канюля до
кардиорег / Cánula de arteriotomia / Arteriotomi
Kanyülü / Канюля pro arteriotomii / Arteriotomies
kanüli / Артериотомическая канюля

Caution, Consult
Accompanying Documents

USA Rx Only


PYROGEN
Nonpyrogenic

STERILE EO

Sterilized Using Ethylene Oxide

2024-02-24 LOT 2021021017
Use By Lot Number

Quantity: 1



Do Not
Reuse




Do Not
Resterilize



Manufacturer: Medtronic, Inc.,
Minneapolis, MN 55432 USA
M837555A001 Rev. A



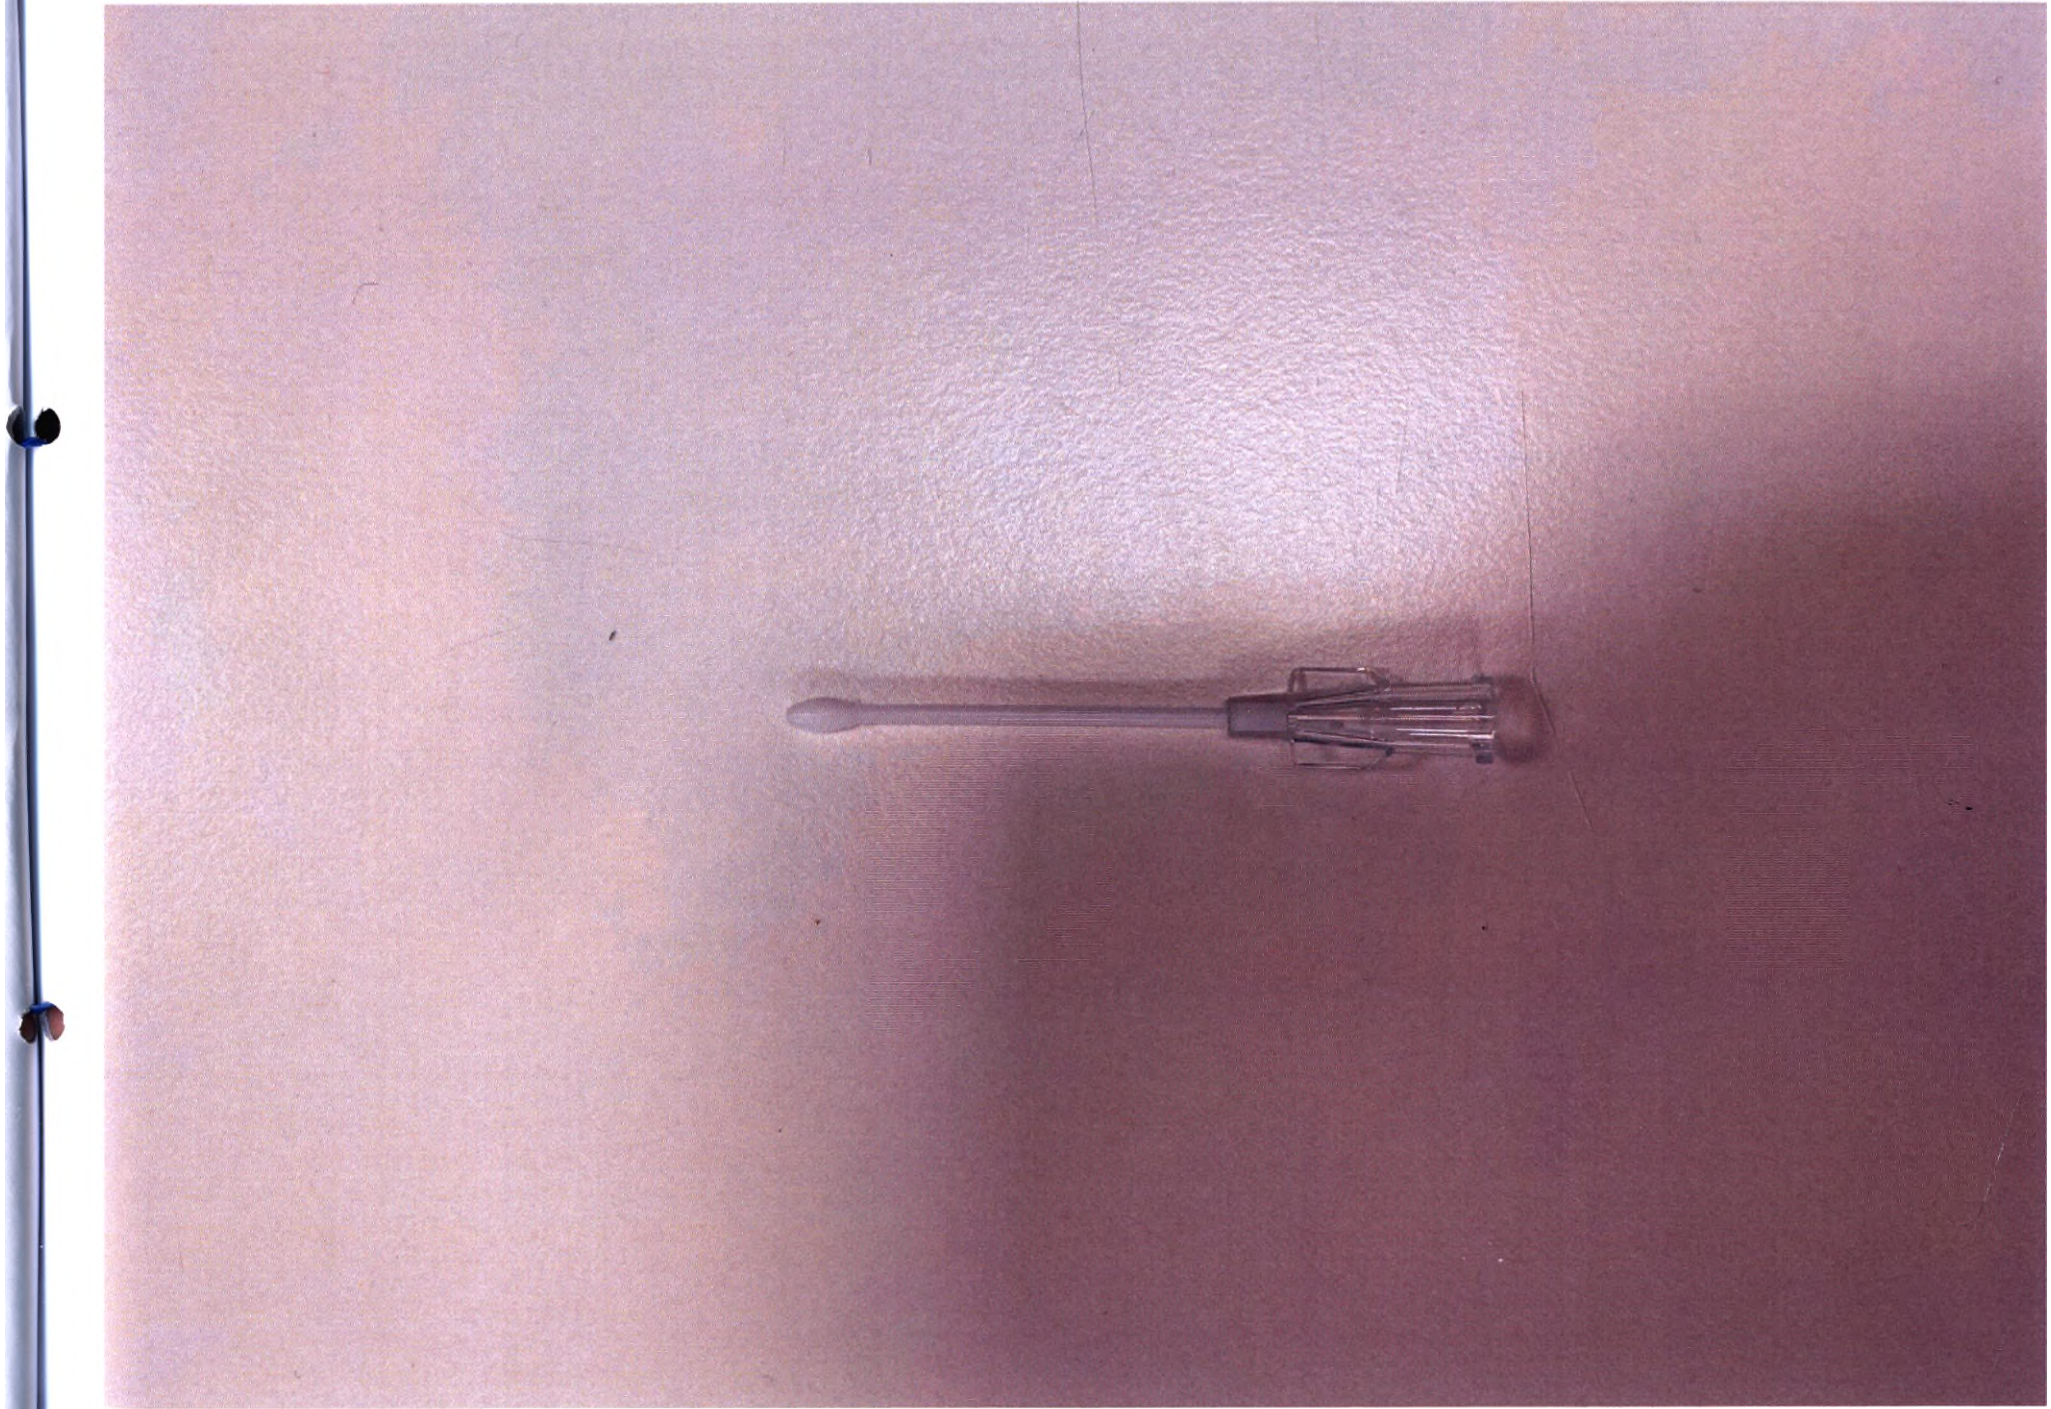



Medtronic

Open Here

DLR®

REF 31102

Catalog Number

2 mm

Arteriotomy Sample
Canule d'artériotomie / Arteriotomiekanüle / Canula
de arteriotomia / Arteriotomieskanüle / Canula
per arteriotomia / Arteriotomikanüle / Канюла
Arteriotomicheskuyu / Arteriotomikanüle / Kanüla do
artriyotomii / Canula de arteriotomia / Arteriotomi
kanülsedü / Canula pro arteriotomii / Arteriotomies
kanül / Артериотомическая канюла



Caution, Consult
Accompanying Documents

USA Rx Only

PYROGEN

Nonpyrogenic

STERILE EO

Sterilized Using Ethylene Oxide

2023-12-16

LOT

2020120654

Use By

Lot Number



Do Not
Reuse



Do Not
Restertilize




Quantity: 1




Manufacturer: Medtronic, Inc.,
Minneapolis, MN 55432 USA
MR37558A001 Rev. A



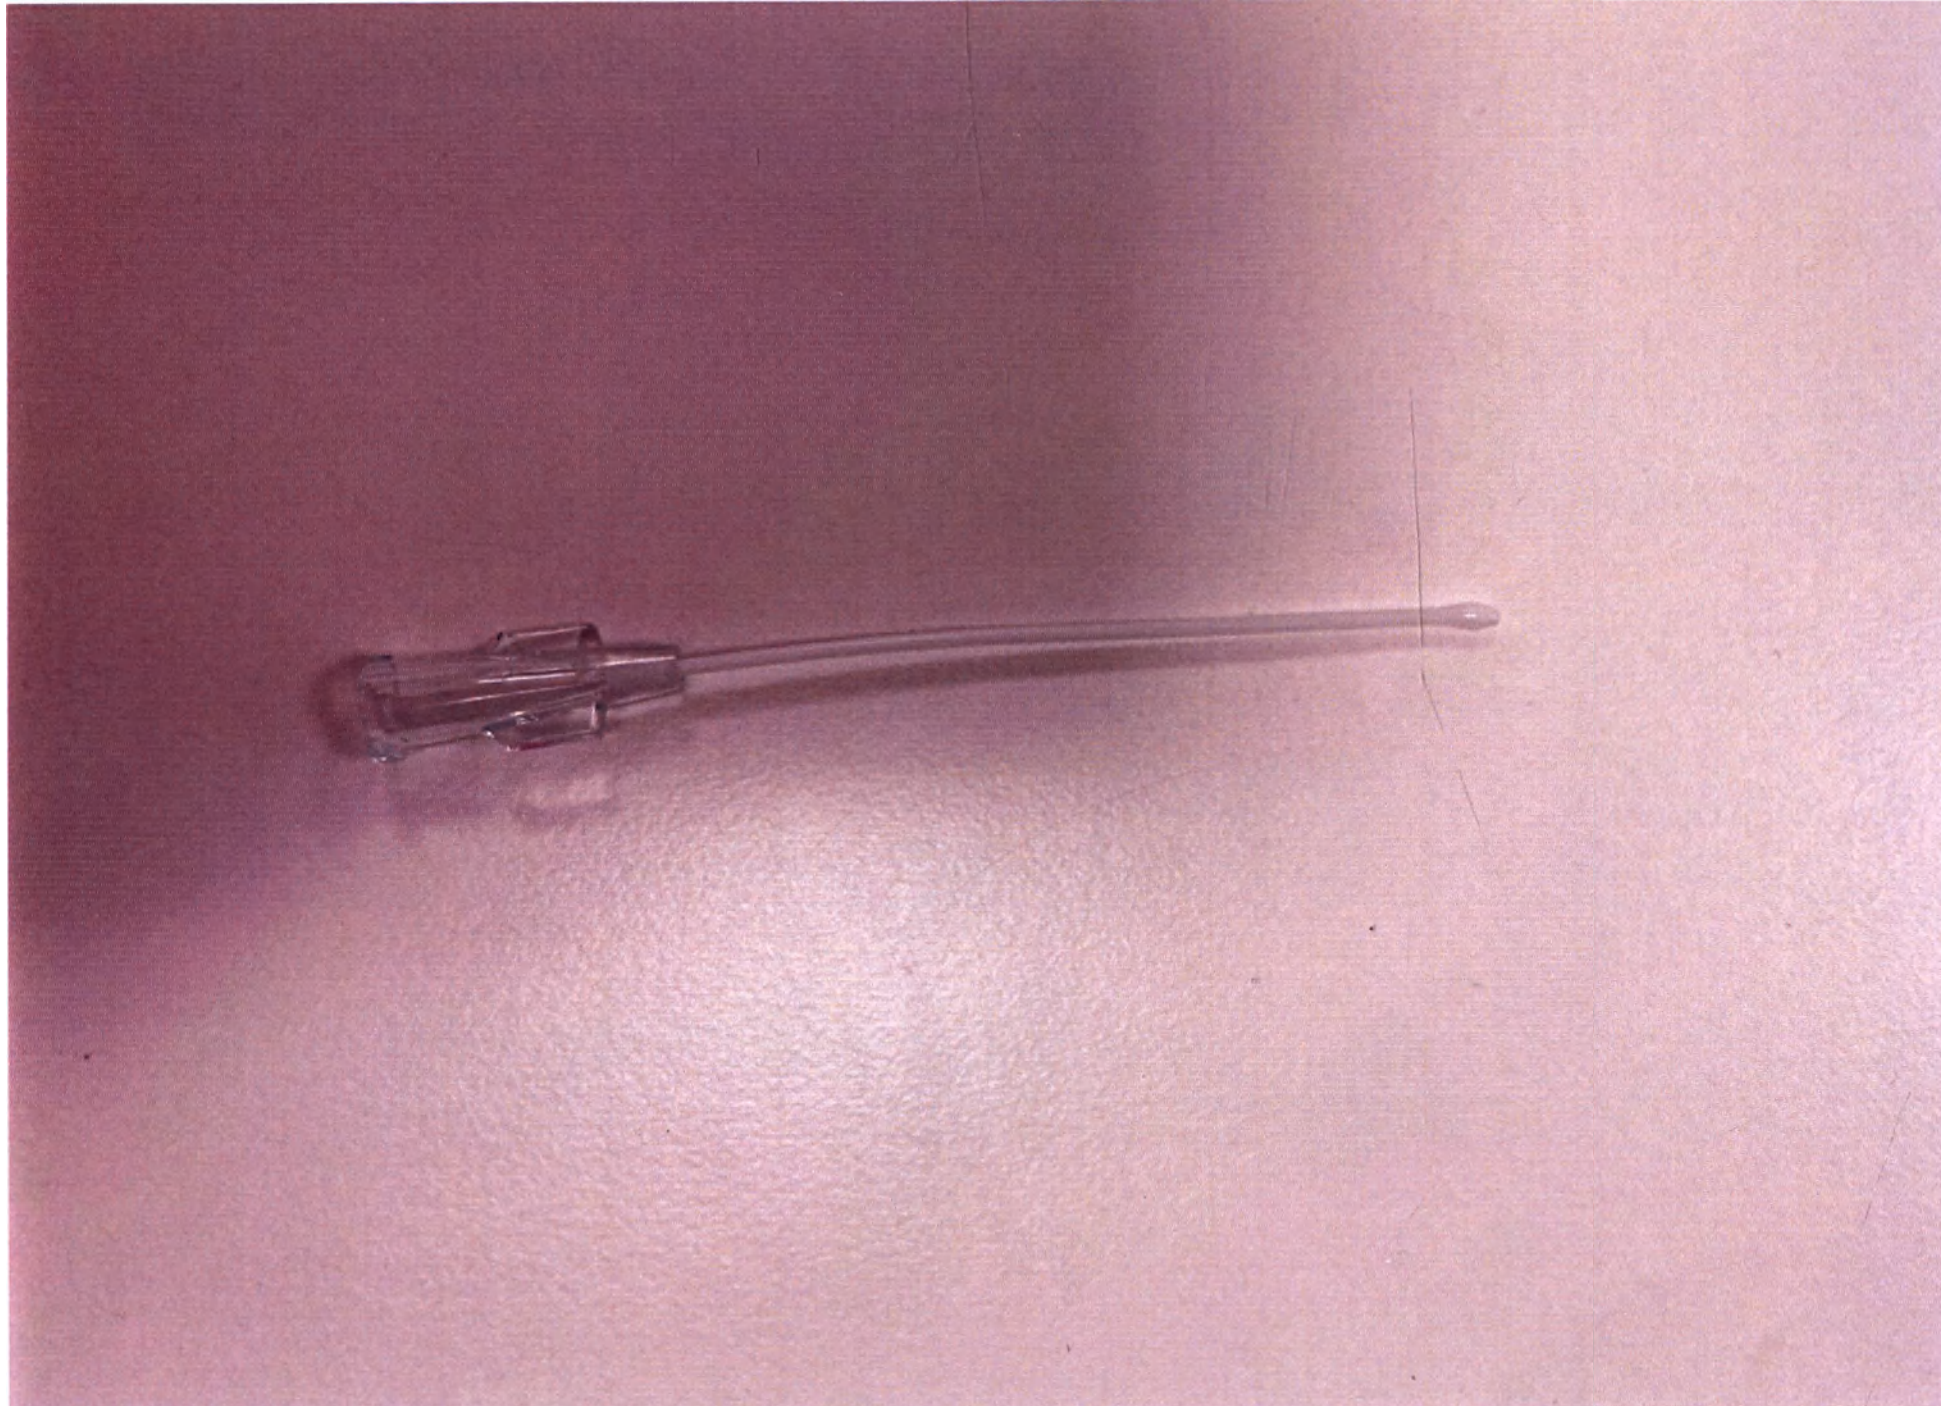



Medtronic



DLR®

1 mm

REF 31001
Catalog Number

Arteriotomy Catheter

Cathete d'arteriotomie / Arteriotomiekanüle / Cathete
de arteriotomie / Arteriotomiekanüle / Cathete
per arteriotomie / Arteriotomiekanüle /


Arteriotomiekanüle / Arteriotomiekanül / Канюла
артериотомическая / Артериотомическая / Канюла до
калорелли / Cathete de arteriotomie / Arteriotomi
kanül / Канюла pro arteriotomii / Arteriotomies
kanül / Артериотомическая канюла



Caution, Consult
Accompanying Documents

USA Rx Only

PYROGEN
Non-pyrogenic



Do Not
Reuse



Do Not
Sterilize

STERILE EO

Sterilized Using Ethylene Oxide



Quantity: 1

2024-01-06 LOT 2021010465
Use By Lot Number

Manufacturer: Medtronic, Inc.,
Minneapolis, MN 55432 USA
MB37551A001 Rev. A







REF 31002

Catalog Number

Electronic / Chemical

tube / Cartridge

10/1/1994

11

10/10/2007

Abstract

3



三

④

Do Not

1

DRUG

1

960

10

1

5

2


012







Medtronic




DLP®

REF 31103
Catalog Number

3 mm

Arteriotomy Canula

Canula d'arteriotomie / Arteriotomiekanüle / Canula
de arteriotomia / Arteriotomieskanüle / Canula
per arteriotomia / Arteriotomikanüle / Канула
артериотомическая / Артериотоміканула / Канула до
кардіорегії / Canula de arteriotomia / Arteriotomi
Kanülü / Canula pro arteriotomii / Arteriotomias
kanül / Артериотомическая канюля



Caution, Consult
Accompanying Documents

USA Rx Only

PYROGEN

Nonpyrogenic

STERILE EO

Sterilized Using Ethylene Oxide



Quantity: 1

2024-01-20 LOT 2021010944
Use By Lot Number



Manufacturer: Medtronic, Inc.,
Minneapolis, MN 55432 USA
M837557A001 Rev. A



Do Not
Reuse



Do Not
Resterilize

Рисунок 13. Канюля артериотомическая с грушевидным наконечником 3 мм, модель 31103

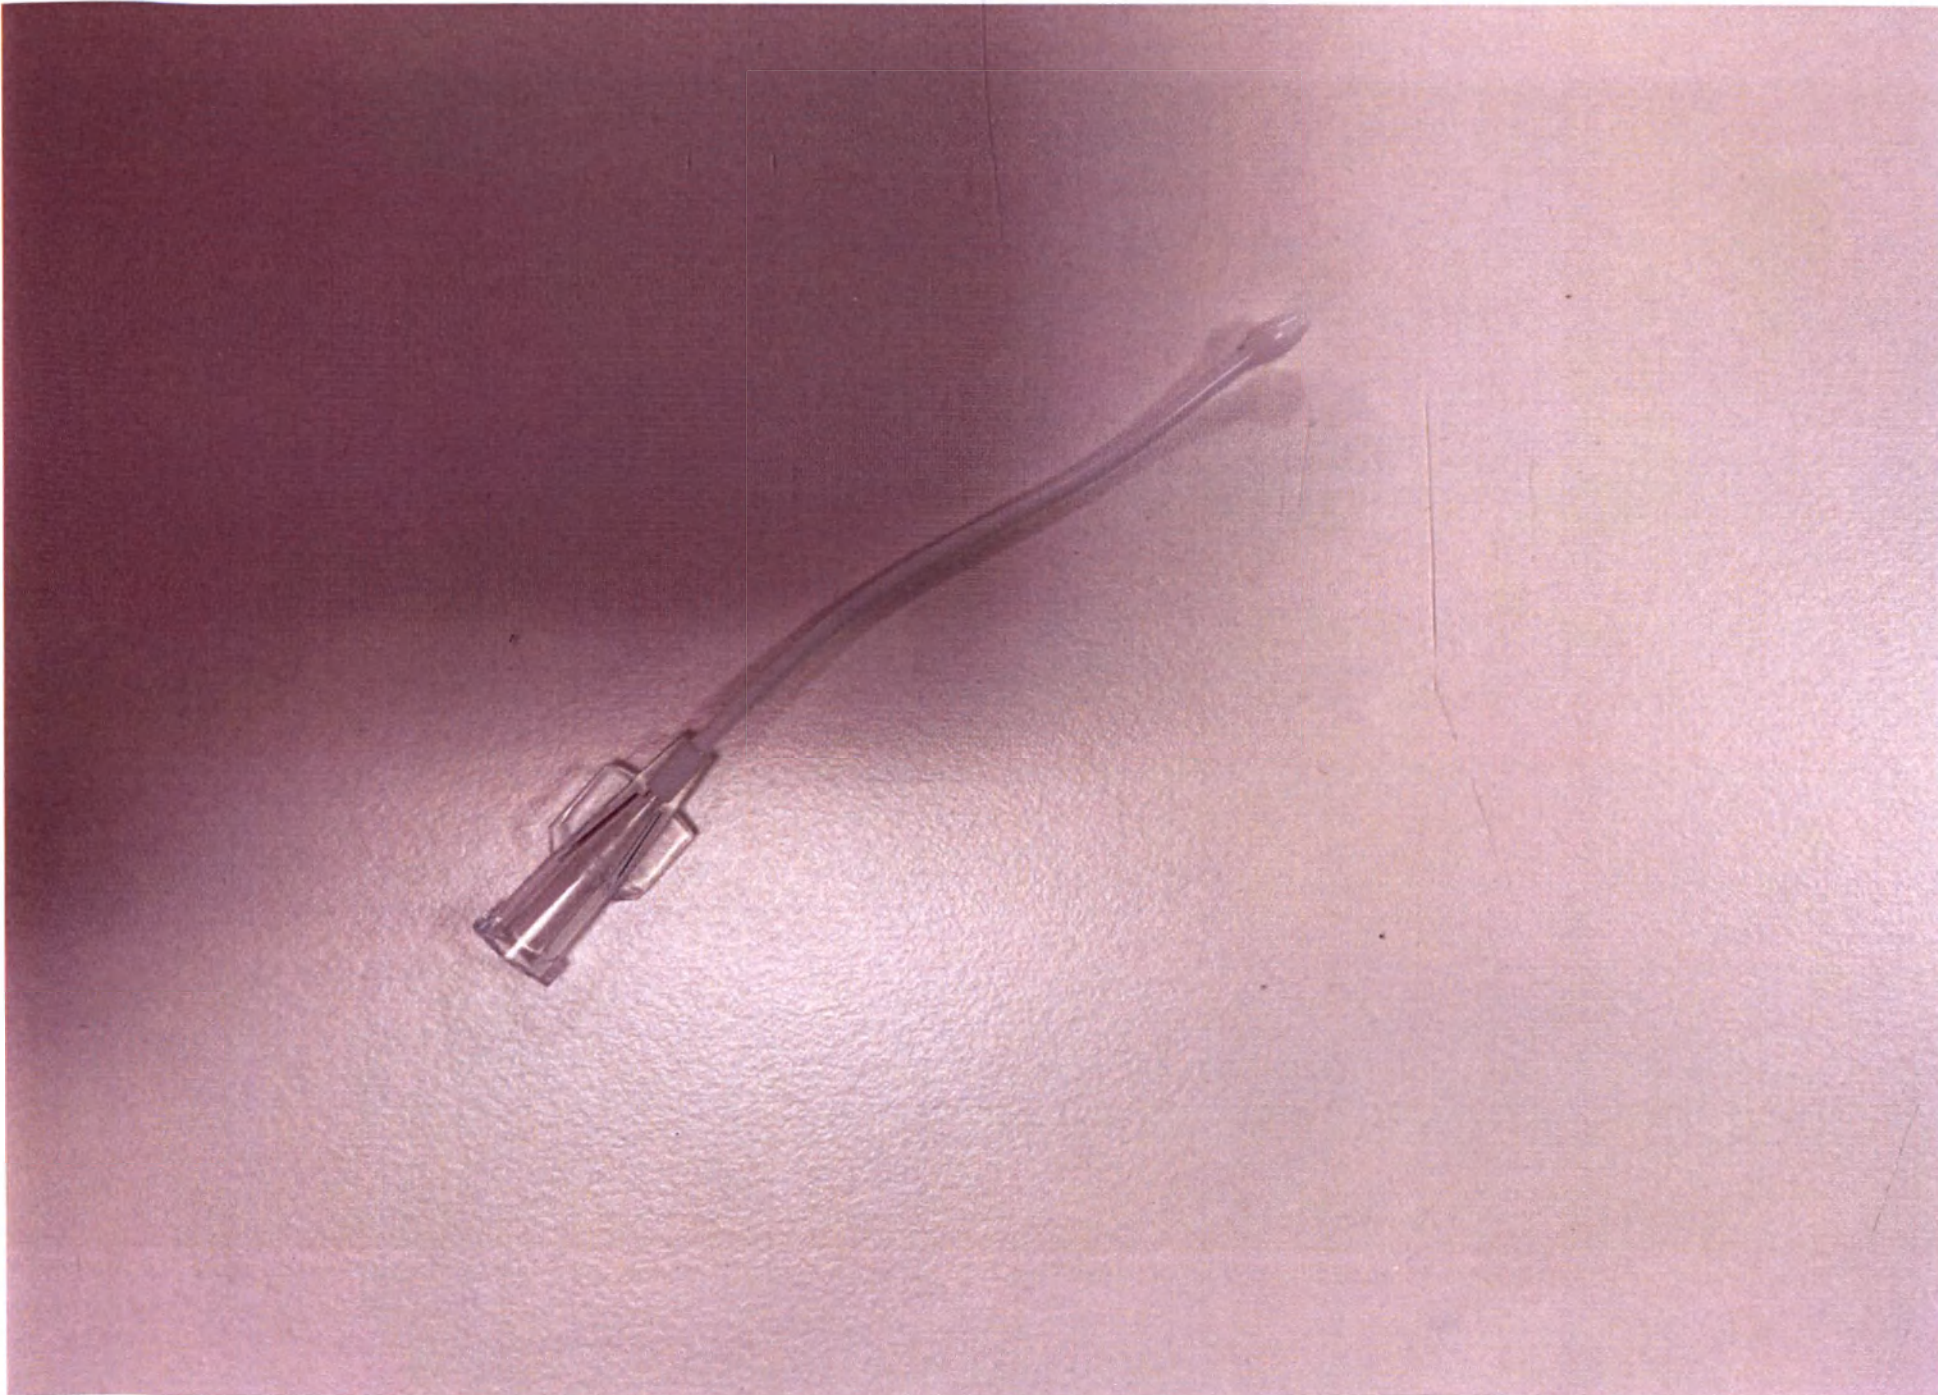


Рисунок 14. Канюля артериотомическая с грушевидным наконечником 3 мм, модель 31103



Medtronic



Manufacturer
Medtronic, Inc., Minneapolis, MN 55432 USA

DLP®

3 mm

Arteriotomy Cannula

Canule d'artériotomie / Arteriotomiekanüle / Cânula de arteriotomia / Arteriotomiecanule /

Canzula per arteriotomia / Arteriotomikanyle / Arteriotomiakanyyli / Arteriotomikanyl / Κάνουλα

αρτηριотомієς / Arteriotomikanyle / Kaniula do kardioplegii / Cânula de arteriotomia / Arteriyotomi

Kanülü / Kanyla pro arteriotomie / Arteriotomiás kanül / Артериотомическая каниюля

REF

31003

Catalog Number



Do Not
Reuse

USA Rx Only



Do Not
Reinsert

STERILE EO

Sterilized Using Ethylene Oxide



Caution, Consult
Accompanying Documents

PYROGEN

Nonpyrogenic

QTY

Quantity: 20



2024-02-24

Use By

LOT

2021021017

Lot Number

M937565A001 Rev. A

Рисунок 15. Маркировка транспортной упаковки на примере Каниюли артериотомической с грушевидным наконечником 3 мм, модель 31003

Пример локального стикера:

	Название медицинского изделия	
	Производитель:	Код UPN
	Страна происхождения:	Код CFN
	Представитель производителя в РФ:	
	Регистрационное Удостоверение №____ от____	
	Дата изгот./Серия/Годен до: см. упаковку	См. Инструкцию См. символы на упаковке



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью ООО "Медтроник"

4 листа(ов)

