

Medtronic

ООО «Медтроник»

Вн. тер. г., м.о. Пресненский
Пресненская наб., д.10
Башня С
9 эт., пом. III, ком.41
г. Москва, 123112
Россия

Tel: +7(495) 580 73 77

Fax: +7(495) 580 73 78

www.medtronic.com

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ООО «Медтроник»

Е. В. Плясунова

2022 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

**«Электрод для кардиостимуляции Attain Stability
Quad MRI SureScan, модель 4798, различных
размеров»**


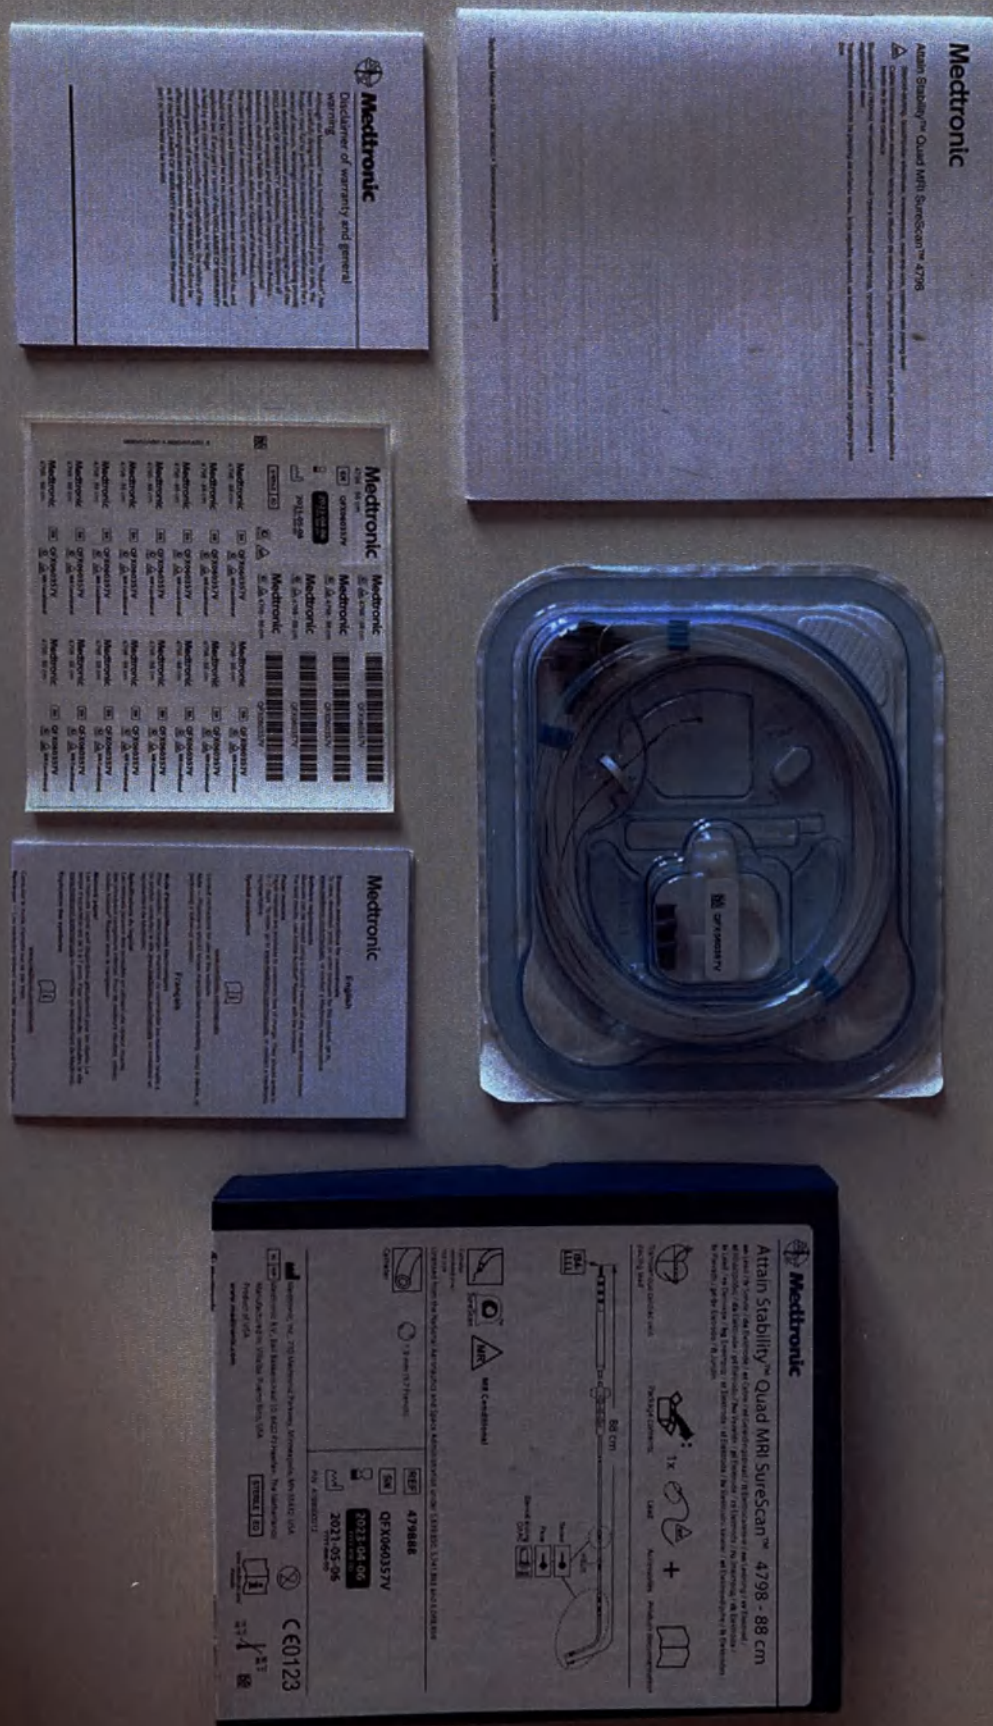


Рисунок 1. Комплект поставки Electroда для кардиостимуляции Attain Stability Quad MRI SureScan, модель 4798, различных размеров (содержимое упаковки) на примере: Electroд для кардиостимуляции Attain Stability Quad MRI SureScan, модель 4798, размер 88 см



Attain Stability™ Quad MRI SureScan™ 4798 - 88 cm

en Lead / fr Sonde / de Elektrode / es Cable / nl Geleidingsdraad / it Elettrocatteter / no Ledning / sv Elektrod / el Ηλεκτρόδιο / da Elektrode / pt Eléctrodo / hu Vezeték / pl Elektroda / cs Elektroda / ru Электрод / sk Elektroda / tr Lead / ro Derivație / bg Електрод / sr Elektroda / sl Elektroda / hr Elektrodni kateter / et Elektroodijuhe / lt Elektrodas / lv Plevads / pt-br Eletrodo / fi Johdin




Transvenous cardiac vein
pacing lead



Package contents:

1x




Lead

+

Accessories



Product documentation

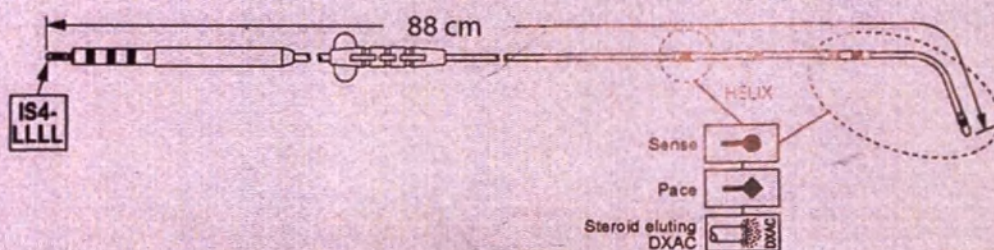

Catheter
delivered over
the wire



MR Conditional

Licensed from the National Aeronautics and Space Administration under 5,639,850, 5,741,883 and 6,048,959.



Catheter

1.9 mm (5.7 French)

REF 479888

SN QFX060357V

2023-04-06
YYYY-MM-DD

2021-05-06
YYYY-MM-DD

PIN: 4798000012

Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432 USA

Medtronic B.V., Earl Bakkenstraat 10, 6422 PJ Heerlen, The Netherlands

Manufactured in: Villalba, Puerto Rico, USA

Product of USA

www.medtronic.com

STERILE EO



CE0123



www.medtronic.com/
manuals


15 °C
59 °F

30 °C
86 °F


Рисунок 2. Маркировка упаковки Электрода для кардиостимуляции Attain Stability Quad MRI SureScan, модель 4798, различных размеров на примере: Электрод для кардиостимуляции Attain Stability Quad MRI SureScan, модель 4798, размер 88 см



Рисунок 3. Маркировка упаковки (боковая часть) Electrode for cardiac stimulation Attain Stability Quad MRI SureScan, model 4798, different sizes on example: Electrode for cardiac stimulation Attain Stability Quad MRI SureScan, model 4798, size 88 cm



Attain Stability™ Quad MRI SureScan™ 4798 - 88 cm

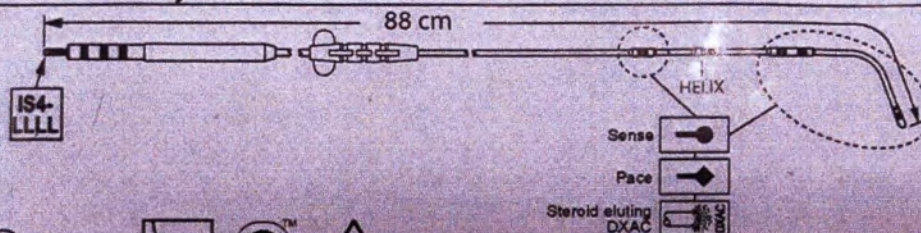

Transvenous cardiac
vein pacing lead



Catheter
delivered
over the wire



MR Conditional

Licensed from the National Aeronautics and Space Administration under 5,639,850, 5,741,883 and 6,048,959.



Catheter

1.9 mm (5.7 French)

SN

QFX060357V



2023-04-06


YYYY-MM-DD



2021-05-06

YYYY-MM-DD

STERILE EO



www.medtronic.com/
manuals

Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432 USA
www.medtronic.com

M065553A001 A - M065591A001 A

CE0123

Рисунок 4. Стерильная упаковка (внешний лоток с крышкой), маркировка Electrode для кардиостимуляции Attain Stability Quad MRI SureScan, модель 4798, различных размеров на примере: Electrode для кардиостимуляции Attain Stability Quad MRI SureScan, модель 4798, размер 88 см



Рисунок 5. Стерильная упаковка (внутренний лоток с крышкой) Electroда для кардиостимуляции Attain Stability Quad MRI SureScan, модель 4798, различных размеров (состав изделия) на примере: Electroд для кардиостимуляции Attain Stability Quad MRI SureScan, модель 4798, размер 88 см

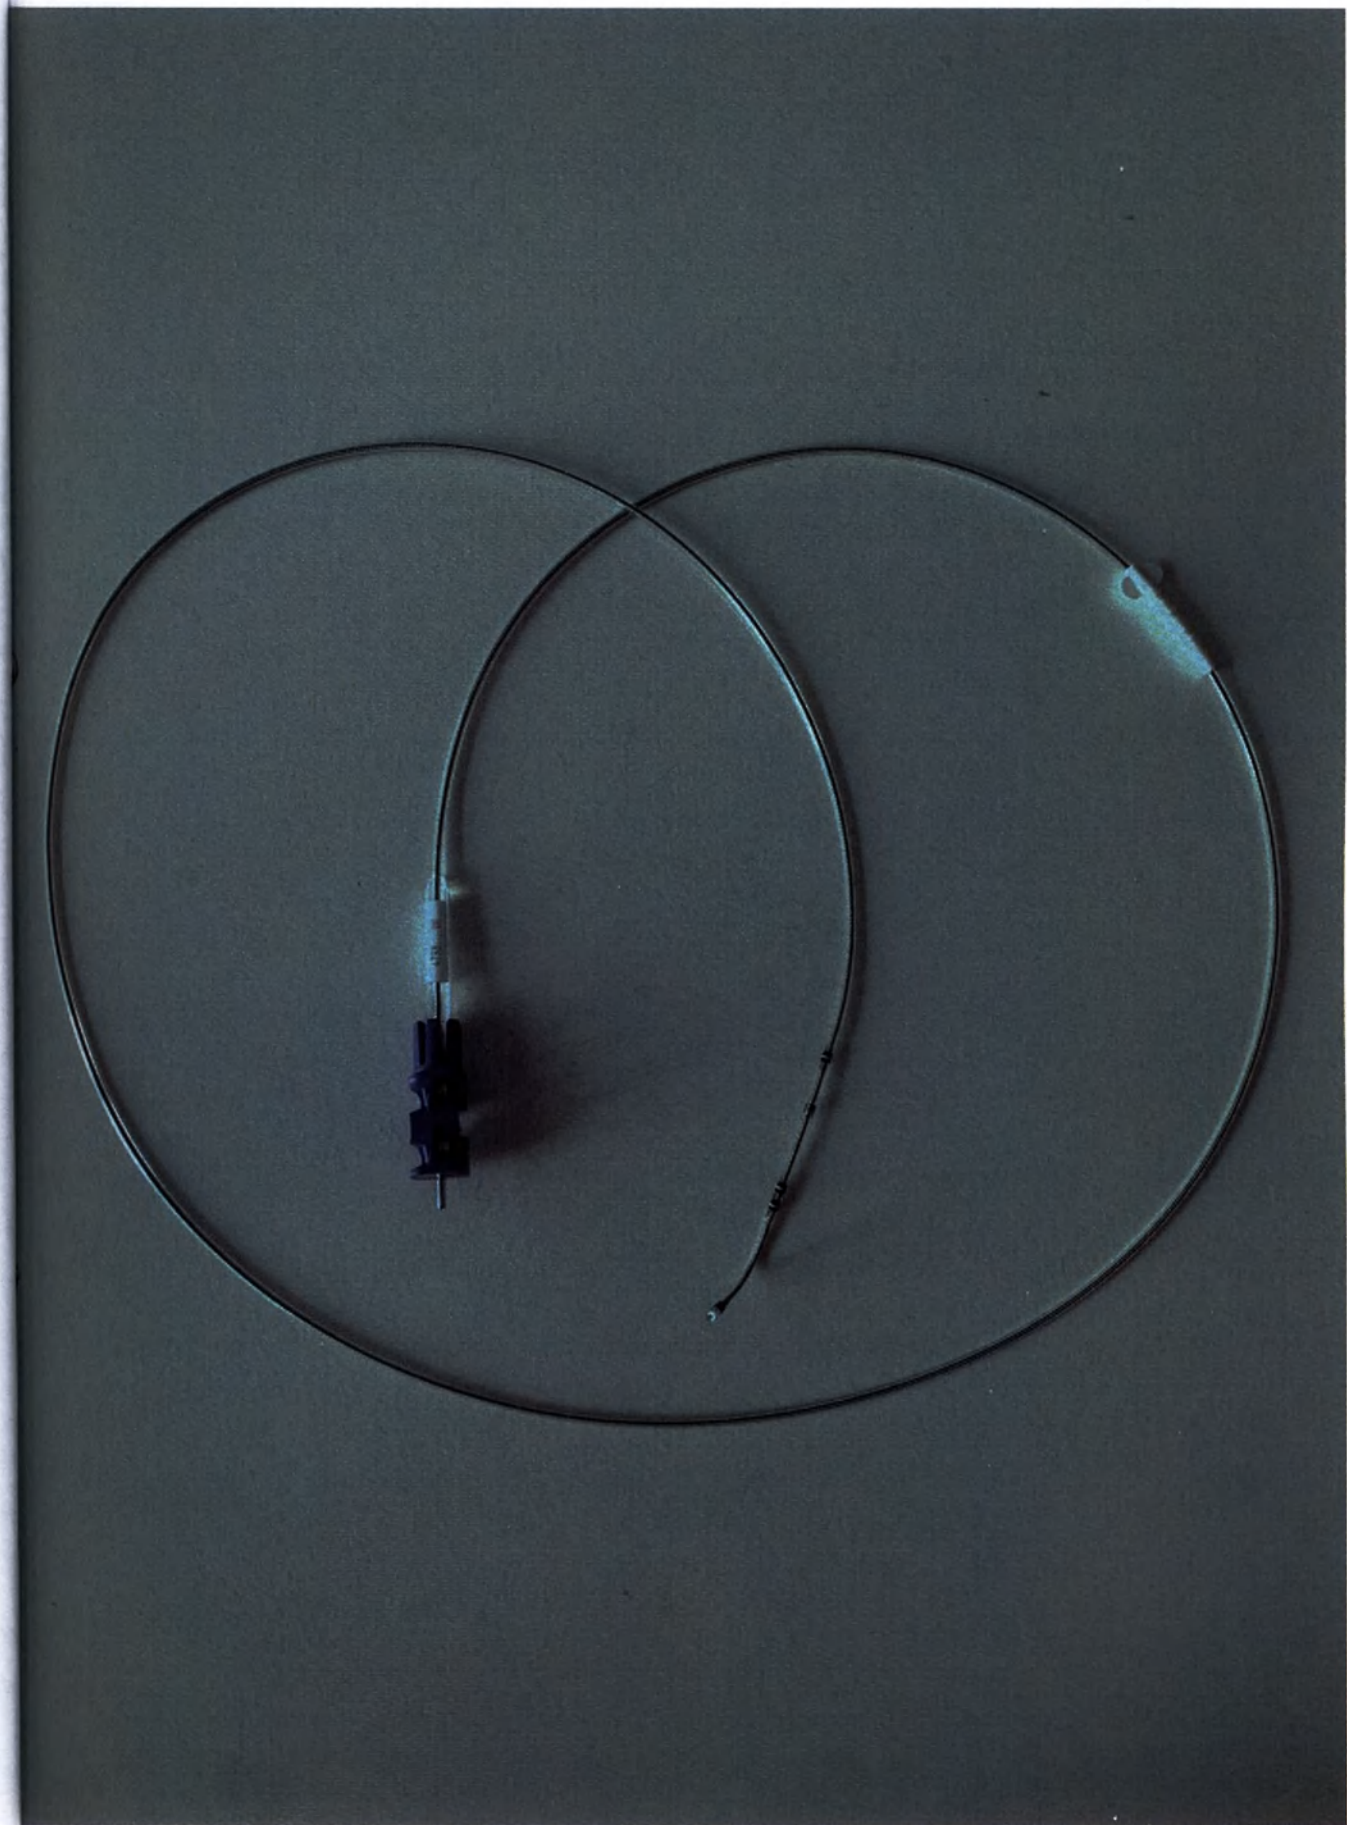


Рисунок 6. Электрод с фиксирующей муфтой с инструментом анализатора кабельного интерфейса AccuRead 2.0

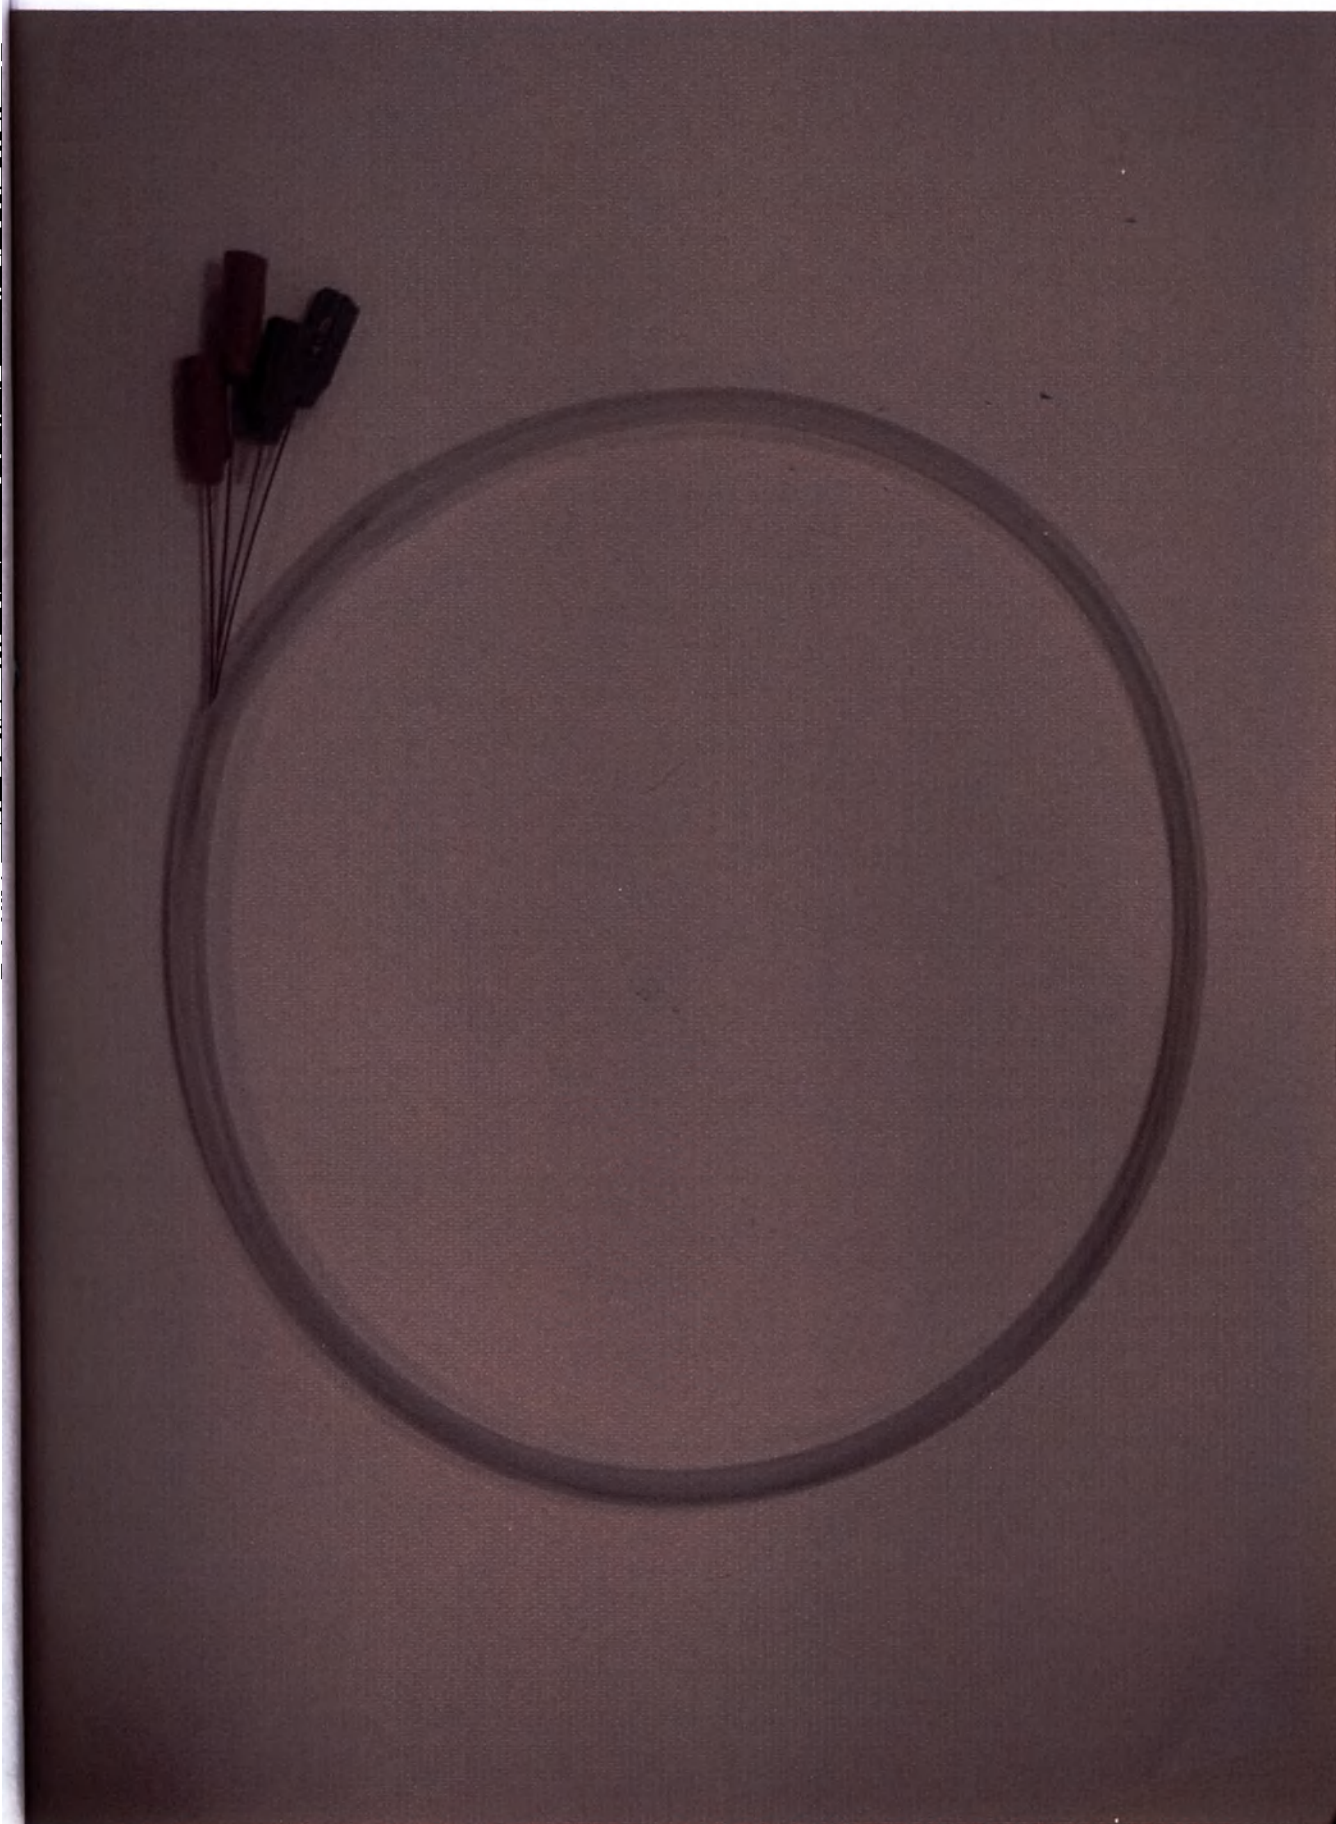


Рисунок 7. Стиллет – не более 4 шт.

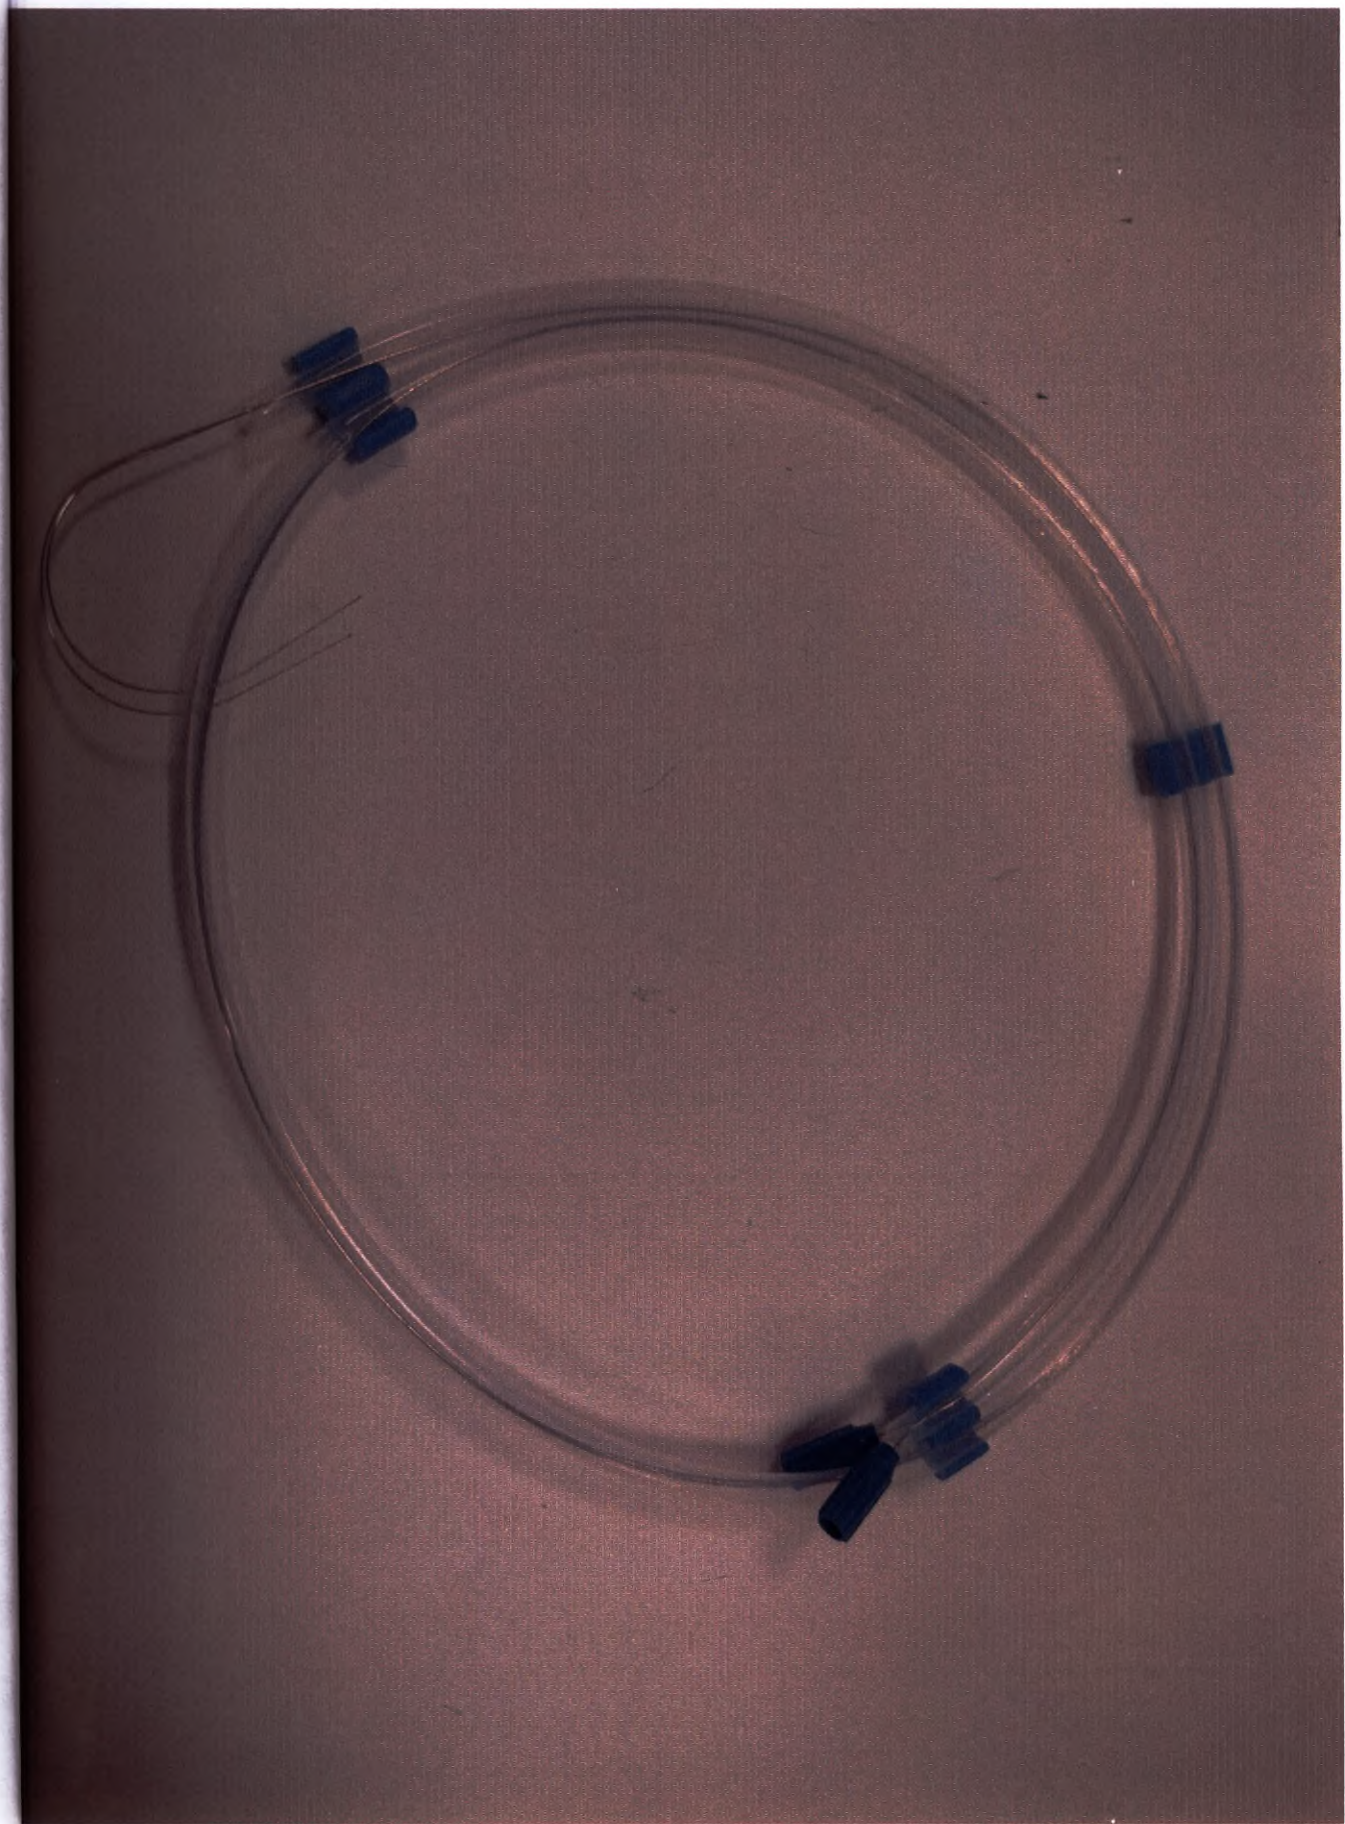


Рисунок 8. - J-образные стилеты – не более 2 шт.



Рисунок 9. Рукоятка управления проводником



Рисунок 10. Инструмент для введения проводника

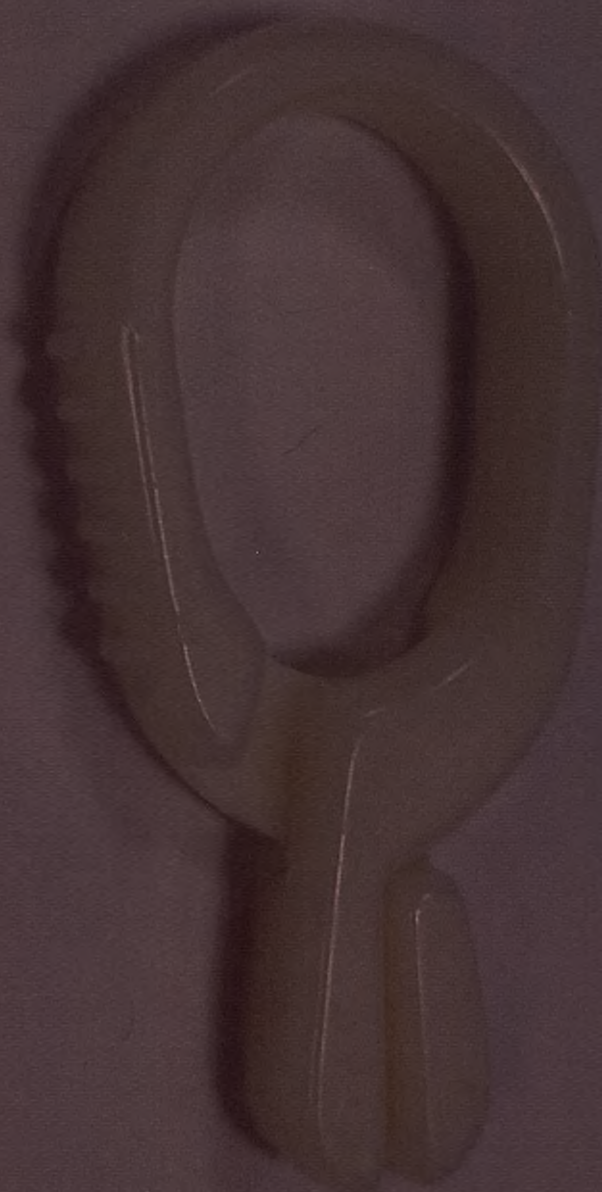


Рисунок 11. Зажим проводника

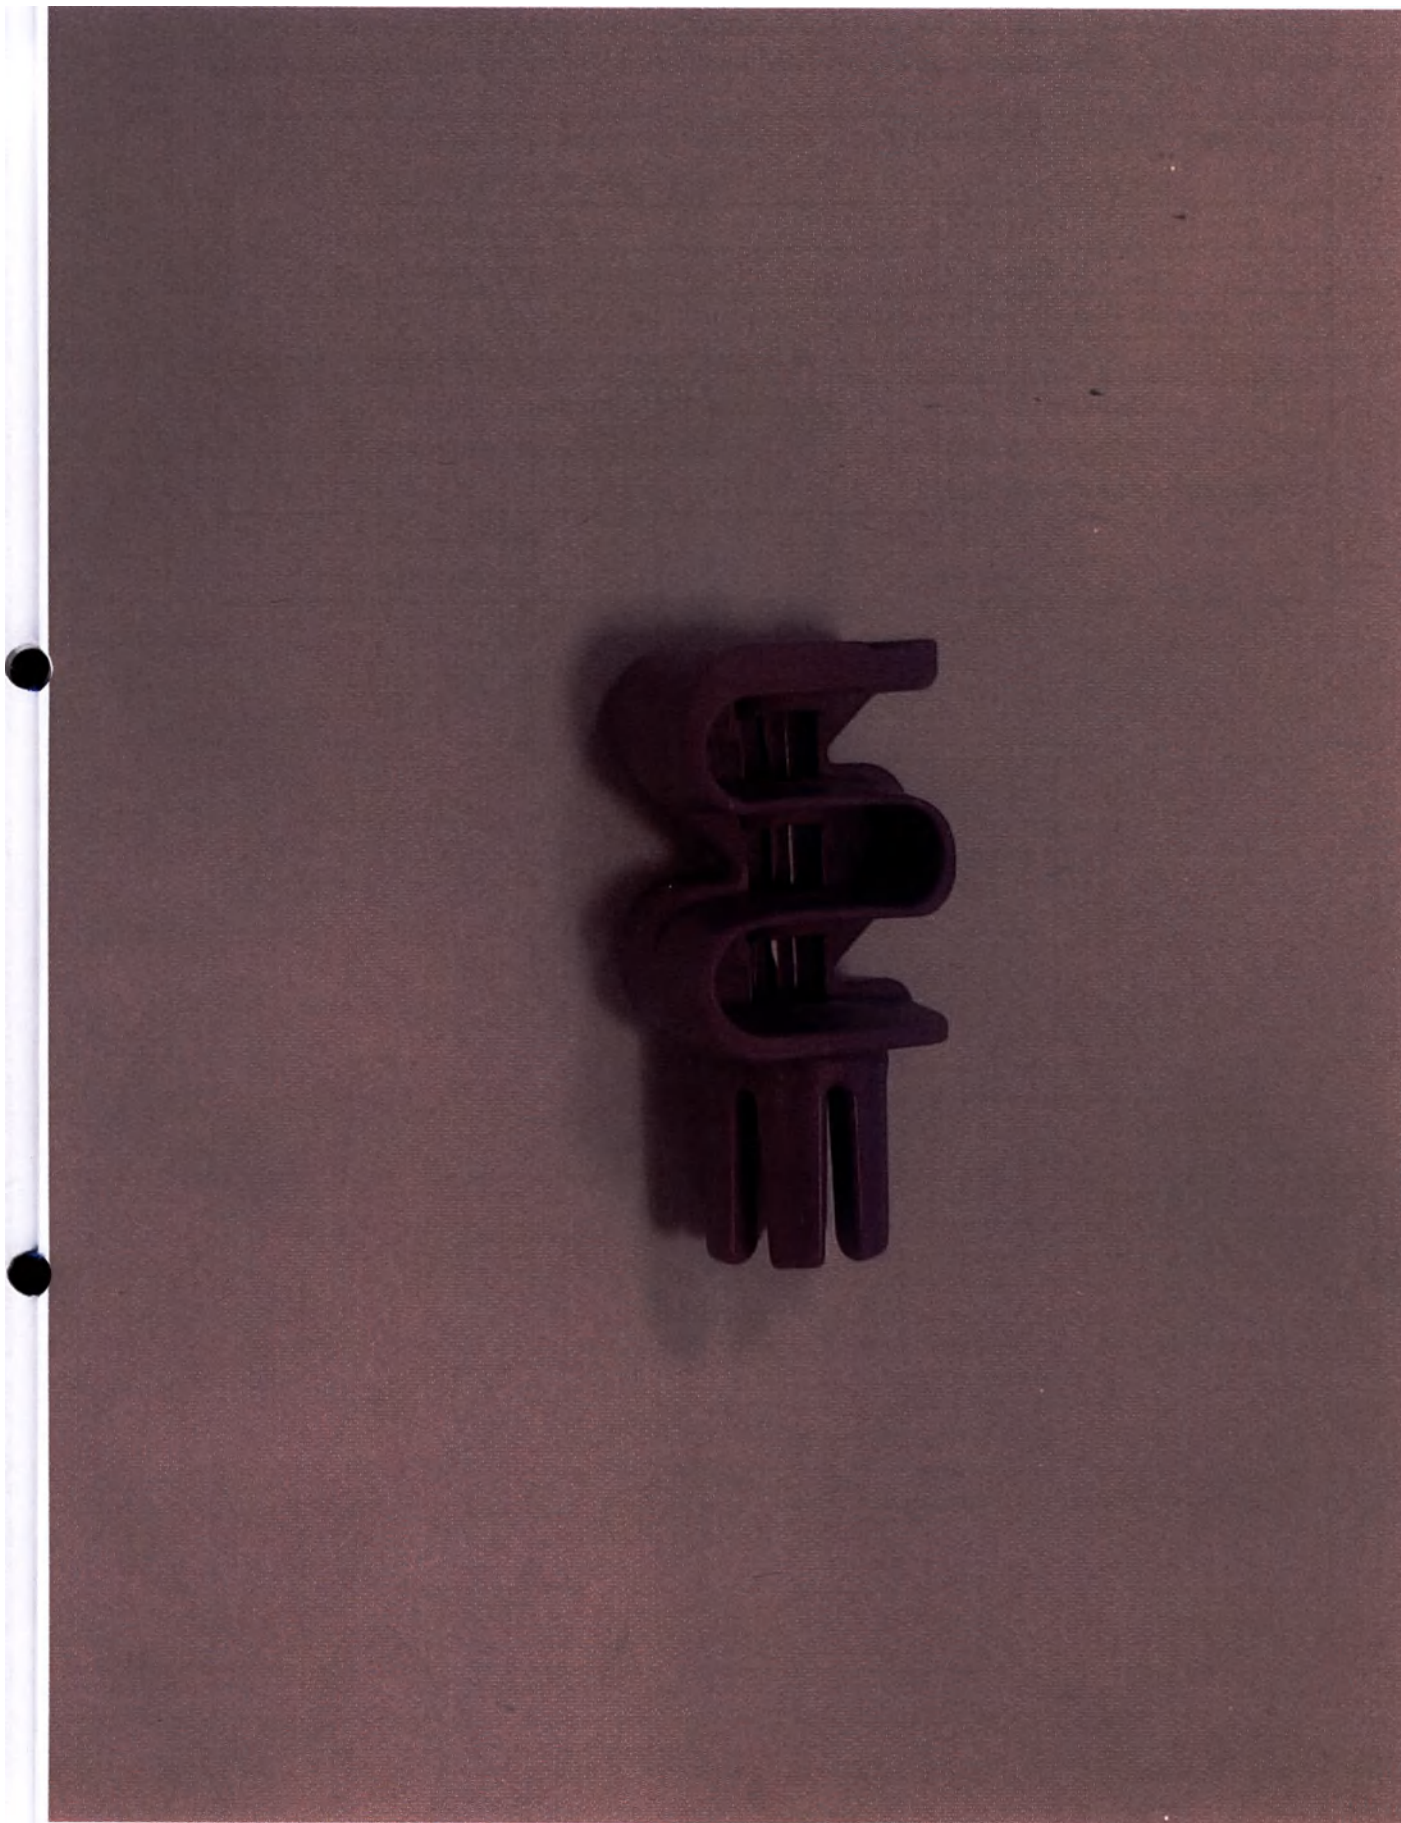


Рисунок 12. Инструмент анализатора кабельного интерфейса AccuRead 2.0

Образец локальной маркировки медицинского изделия на примере: «Электрод для кардиостимуляции Attain Stability Quad MRI SureScan, модель 4798, размер 88 см»

	Электрод для кардиостимуляции Attain Stability Quad MRI SureScan, модель 4798, размер 88 см	
	Производитель:	Код UPN
	Страна происхождения:	Код CFN
	Представитель компании-производителя в Российской Федерации:	
	Свидетельство о регистрации № ____ от ____	
	Дата изготовления / выпуск / срок годности: см. на упаковке	См. техническое руководство См. символы на упаковке
	Нетоксично Апирогенно	



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью ООО "Медтроник"
14 листа(ов)