

Руководитель группы регистрации

Горшкова Н.А.

2021 г.



Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для определения микроальбумина_2 для автоматических биохимических анализаторов серии ADVIA (ADVIA Chemistry Microalbumin_2 Reagents (μALB_2))



Рисунок 1. Набор реагентов для определения микроальбумина 2 для автоматических биохимических анализаторов серии ADVIA (ADVIA Chemistry Microalbumin 2 Reagents (μALB 2))

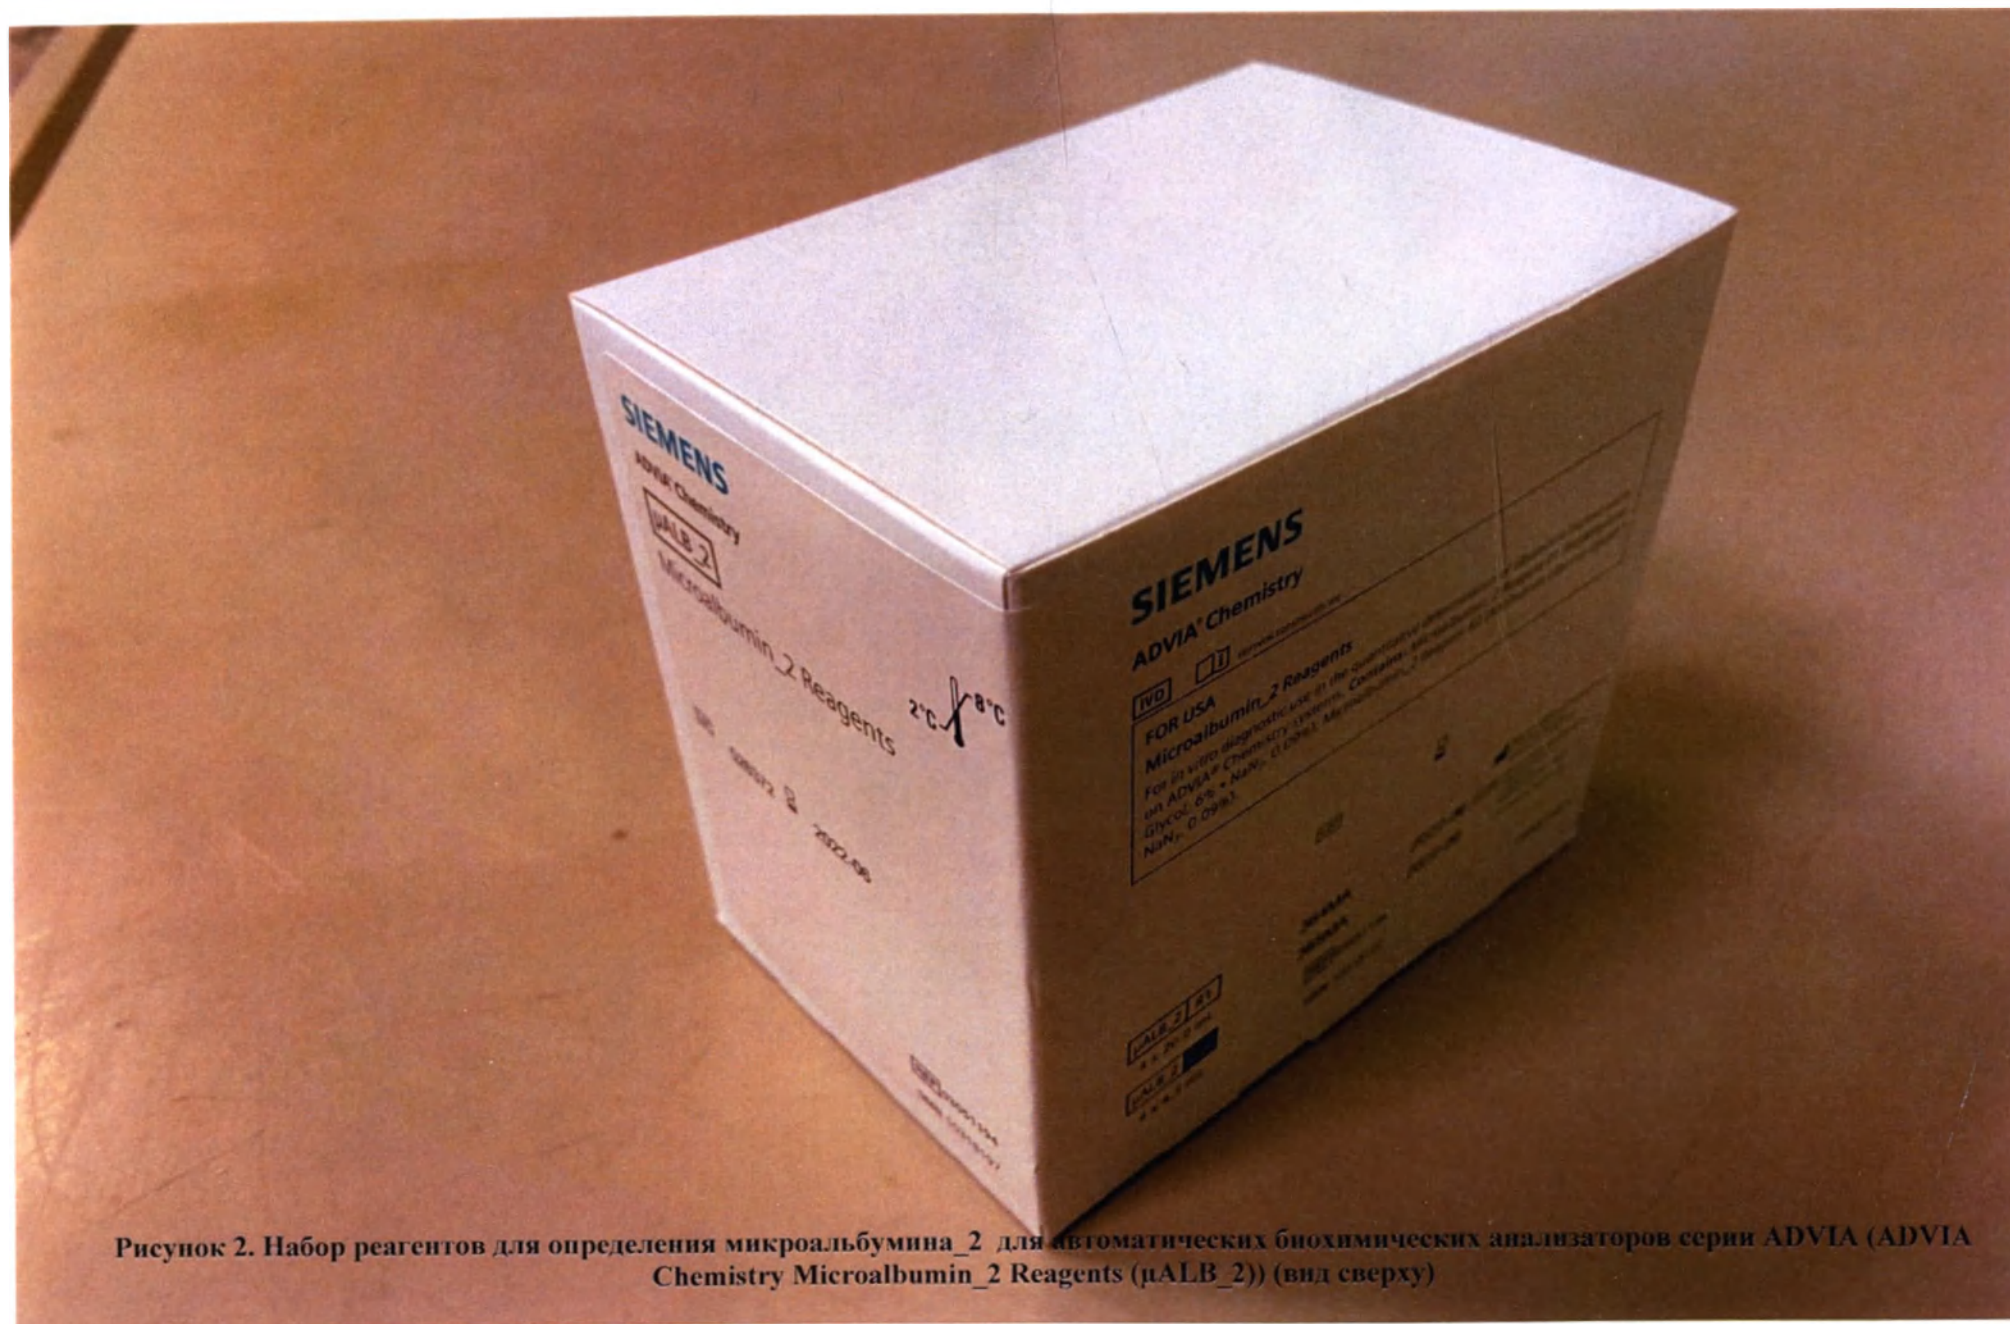




Рисунок 3. Реагент 1 (μALB_2 | R1), флакон емкостью 20 мл (20 мл реагента/флакон) – 4 шт;



μ ALB
 μ ALB
 μ ALB
 μ ALB

μ ALB
 μ ALB
 μ ALB
 μ ALB

If method uses a 70 mL bottle, place label **ON TOP** of 70 mL reagent bottle.

μ ALB

μ ALB

μ ALB

μ ALB

μ ALB

μ ALB

μ ALB

μ ALB

If method uses a 20 mL bottle, place label **ON SIDE** of 20 mL reagent bottle.

APPLY LABELS TO A DRY SURFACE

05888687 Rev. B

10318197 Набор реагентов для определения микроальбумина_2
для автоматических биохимических анализаторов
серии ADVIA (ADVIA Chemistry Microalbumin_2 Reagents
(μ ALB_2))

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2018/7757 от _____

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на
оригинальной упаковке

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 5. Макет маркировки для Российской Федерации

Всего прошито и пронумеровано
7 листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»

