

## **Фотографические изображения**

**«Реагенты в кассете для количественного определения общего  
трийодтиронина в сыворотке и плазме крови  
иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях  
иммунохимических cobas e (Elecsys T3 cobas e analyzers)»**

агенты в кассете для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T3 cobas e analyzers), вариант исполнения на 200 тестов

# Elecsys T3

**cobas e analyzers**

**CONTENT**

 200

**REF** 09007725190

|           |       |
|-----------|-------|
| <b>M</b>  | 12 mL |
| <b>R1</b> | 16 mL |
| <b>R2</b> | 16 mL |

COBAS, COBAS E  
and ELECSYS are  
trademarks of Roche.



 Roche Diagnostics GmbH  
Sandhofer Str. 116  
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:  
Roche Diagnostics,  
Indianapolis, IN  
Made in Germany

01

**IVD** **CE**  2-8 °C

 [dialog.roche.com](http://dialog.roche.com)



**cobas®**

реагенты в кассете для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T3 cobas e analyzers), вариант исполнения на 200 тестов



реагенты в кассете для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T3 cobas e analyzers), вариант исполнения на 200 тестов

## Elecsys T3

**REF** 09007725190

For USA: **CONTENT**

- M** Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL
- R1** Polyclonal anti-T3-antibody (sheep) labeled with ruthenium complex 75 ng/mL; ANS 0.8 mg/mL
- R2** Biotinylated T3 3 ng/mL; ANS 0.8 mg/mL



Rx only

01



реагенты в кассете для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T3 cobas e analyzers), вариант исполнения на 200 тестов



Реагенты в кассете для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T3 cobas e analyzers), вариант исполнения на 200 тестов

Реагенты в кассете для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T3 cobas e analyzers), вариант исполнения на 200 тестов

Регистрационное удостоверение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке


Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» («Рох Дианостикс ГмбХ»), Sandhofer Strasse 118, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro


Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рох Дианостика Рус» (ООО «Рох Дианостика Рус»), 107031, Москва, Трудовая площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow\_reception\_dia@roche.com

Кат. номер 05007725190

реагенты в кассете для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T3 cobas e analyzers), вариант исполнения на 200 тестов

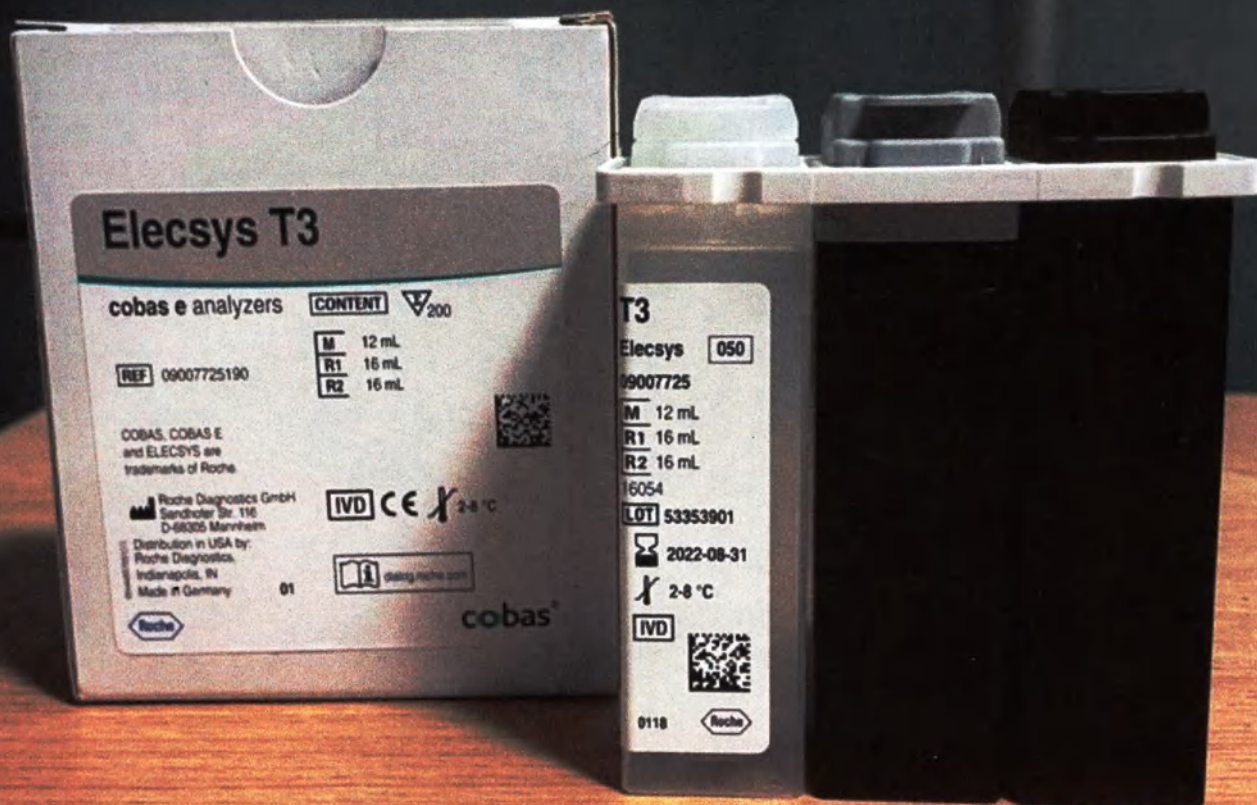

Реагенты в кассете для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T3 cobas e analyzers), вариант исполнения на 300 тестов

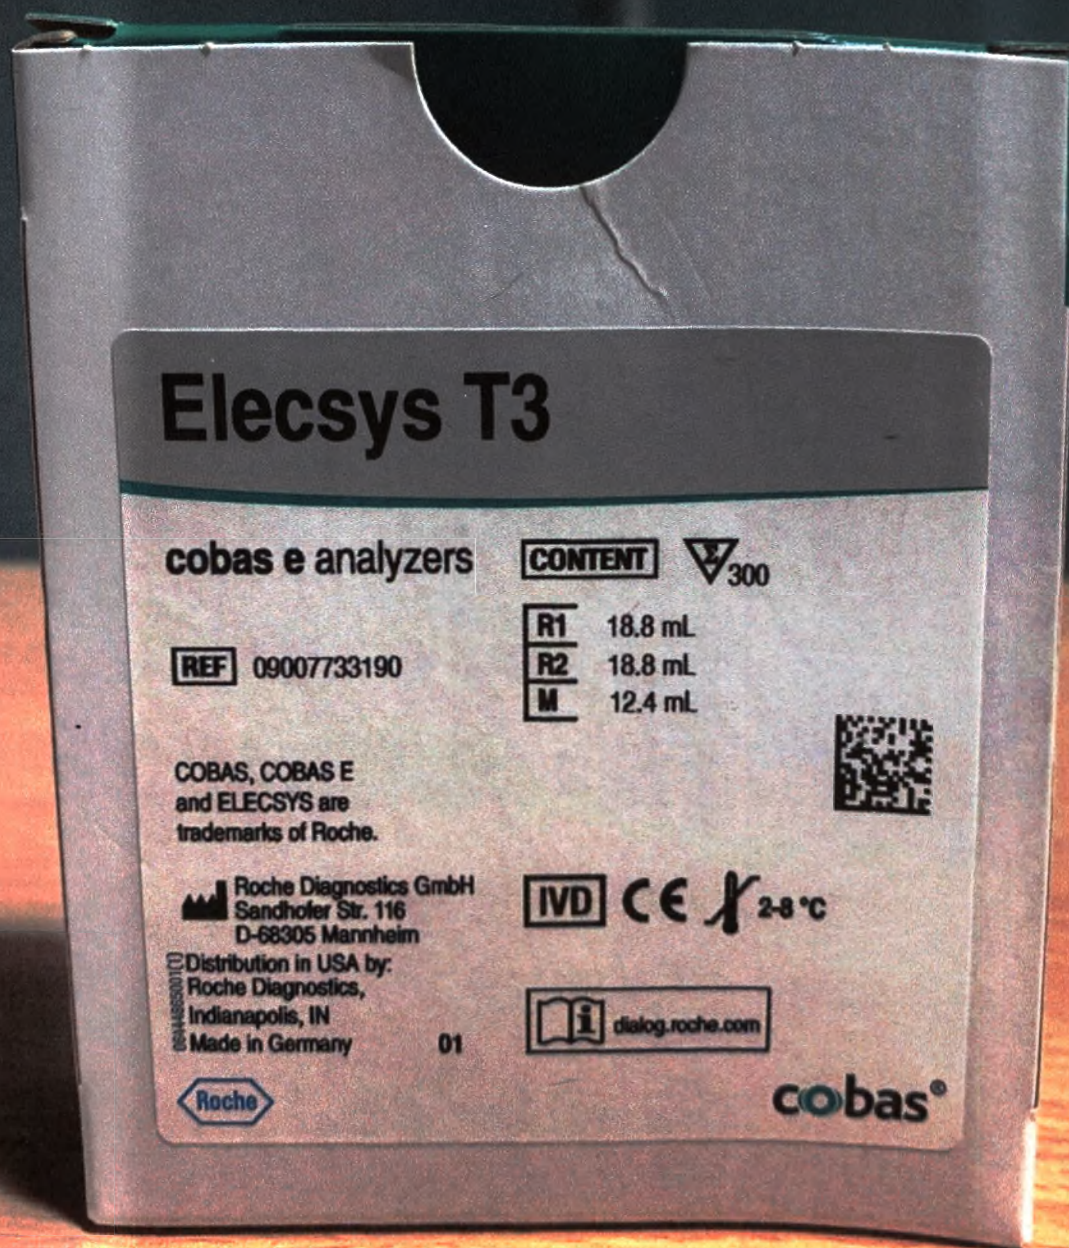

реагенты в кассете для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови  
иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T3 cobas e analyzers), вариант  
исполнения на 300 тестов



реагенты в кассете для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови  
иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T3 cobas e analyzers), вариант  
исполнения на 300 тестов

## Elecsys T3

REF 09007733190

For USA: CONTENT

- M Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL
- R1 Polyclonal anti-T3-antibody (sheep) labeled with  
ruthenium complex 75 ng/mL; ANS 0.8 mg/mL
- R2 Biotinylated T3 3 ng/mL; ANS 0.8 mg/mL




Rx only

01



агенты в кассете для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови  
иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T3 cobas e analyzers), вариант  
исполнения на 300 тестов

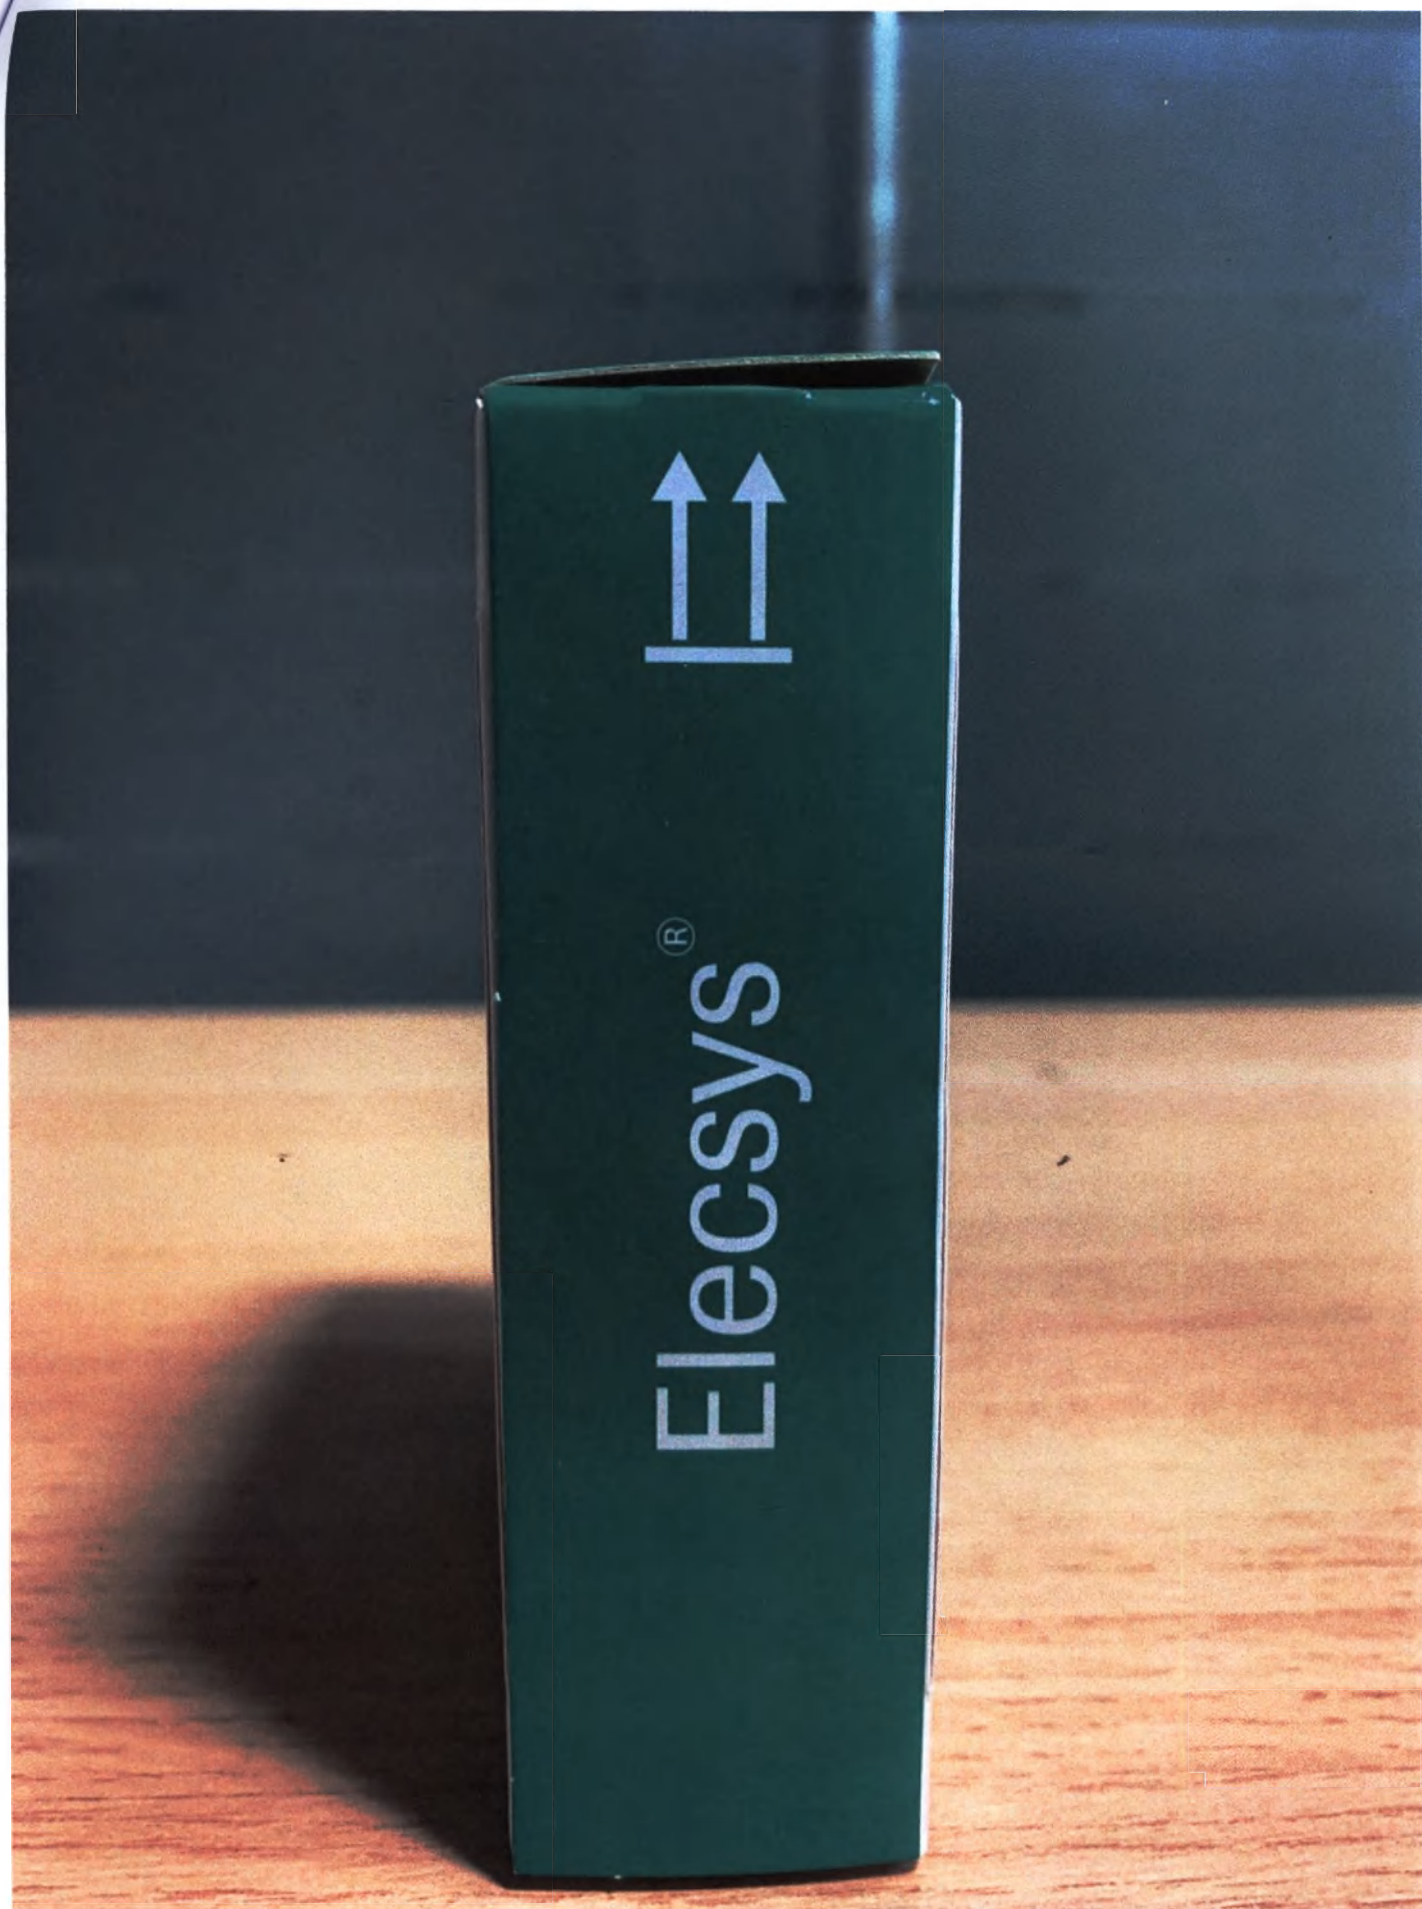

реагенты в кассете для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови  
иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T3 cobas e analyzers), вариант  
исполнения на 300 тестов



реагенты в кассете для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T3 cobas e analyzers), вариант исполнения на 300 тестов




реагенты в кассете для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови  
иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T3 cobas e analyzers), вариант  
исполнения на 300 тестов



реагенты в кассете для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T3 cobas e analyzers), вариант исполнения на 300 тестов



Реагенты в кассете для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T3 cobas e analyzers), вариант исполнения на 300 тестов

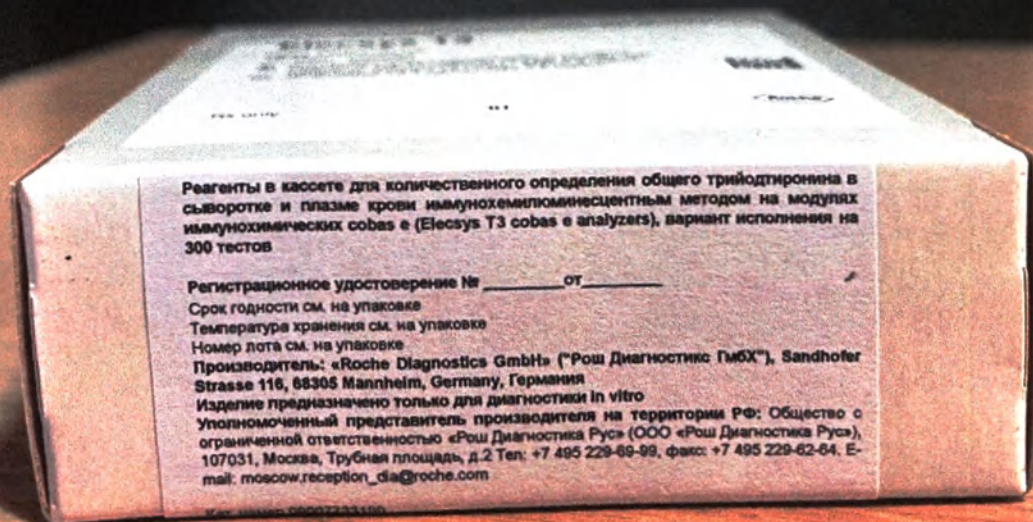

Реагенты в кассете для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys T3 cobas e analyzers), вариант исполнения на 300 тестов

Регистрационное удостоверение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рох Диагностикс ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рох Диагностикс Рус» (ООО «Рох Диагностикс Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception\_dia@roche.com

Кат. номер: 08507233100

Всего пронумеровано,  
прошнуровано и  
скреплено печатью

16



*Иванов Иван Иванович*

по доверенности  
от 04.02.2021