

Руководитель группы регистрации

Пичугова Н.А.

«10» декабря 2021 г.



Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор калибраторов общего белка в моче и спинномозговой жидкости для анализаторов биохимических серии Atellica (Atellica CH Urinary/Cerebrospinal Fluid Protein Calibrator (Atellica CH UCFP CAL))

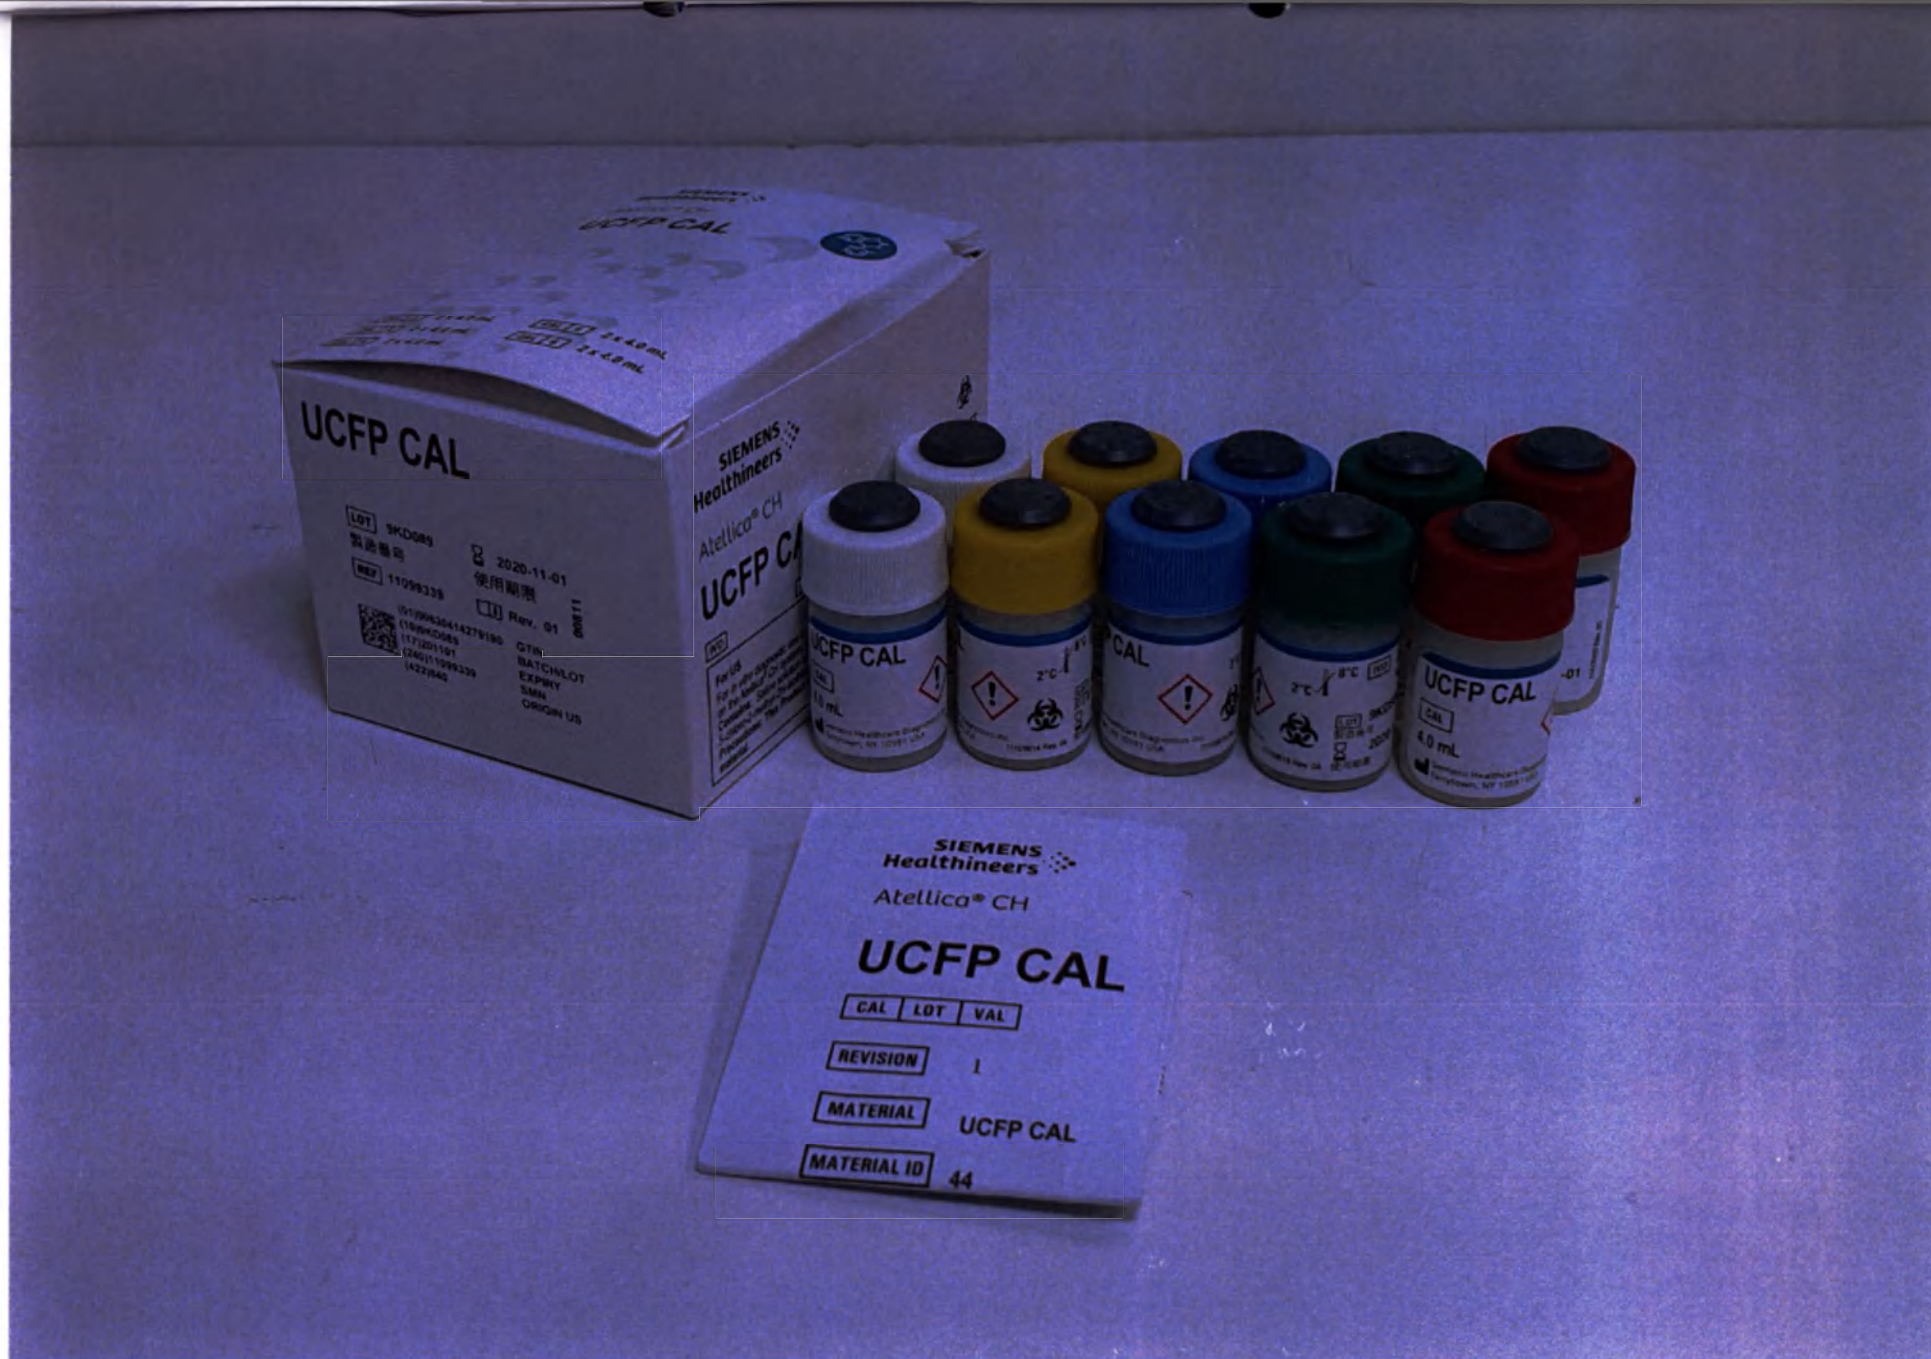


Рисунок 1. Набор калибраторов общего белка в моче и спинномозговой жидкости для анализаторов биохимических серии Atellica (Atellica CH Urinary/Cerebrospinal Fluid Protein Calibrator (Atellica CH UCFP CAL)); общий вид изделия

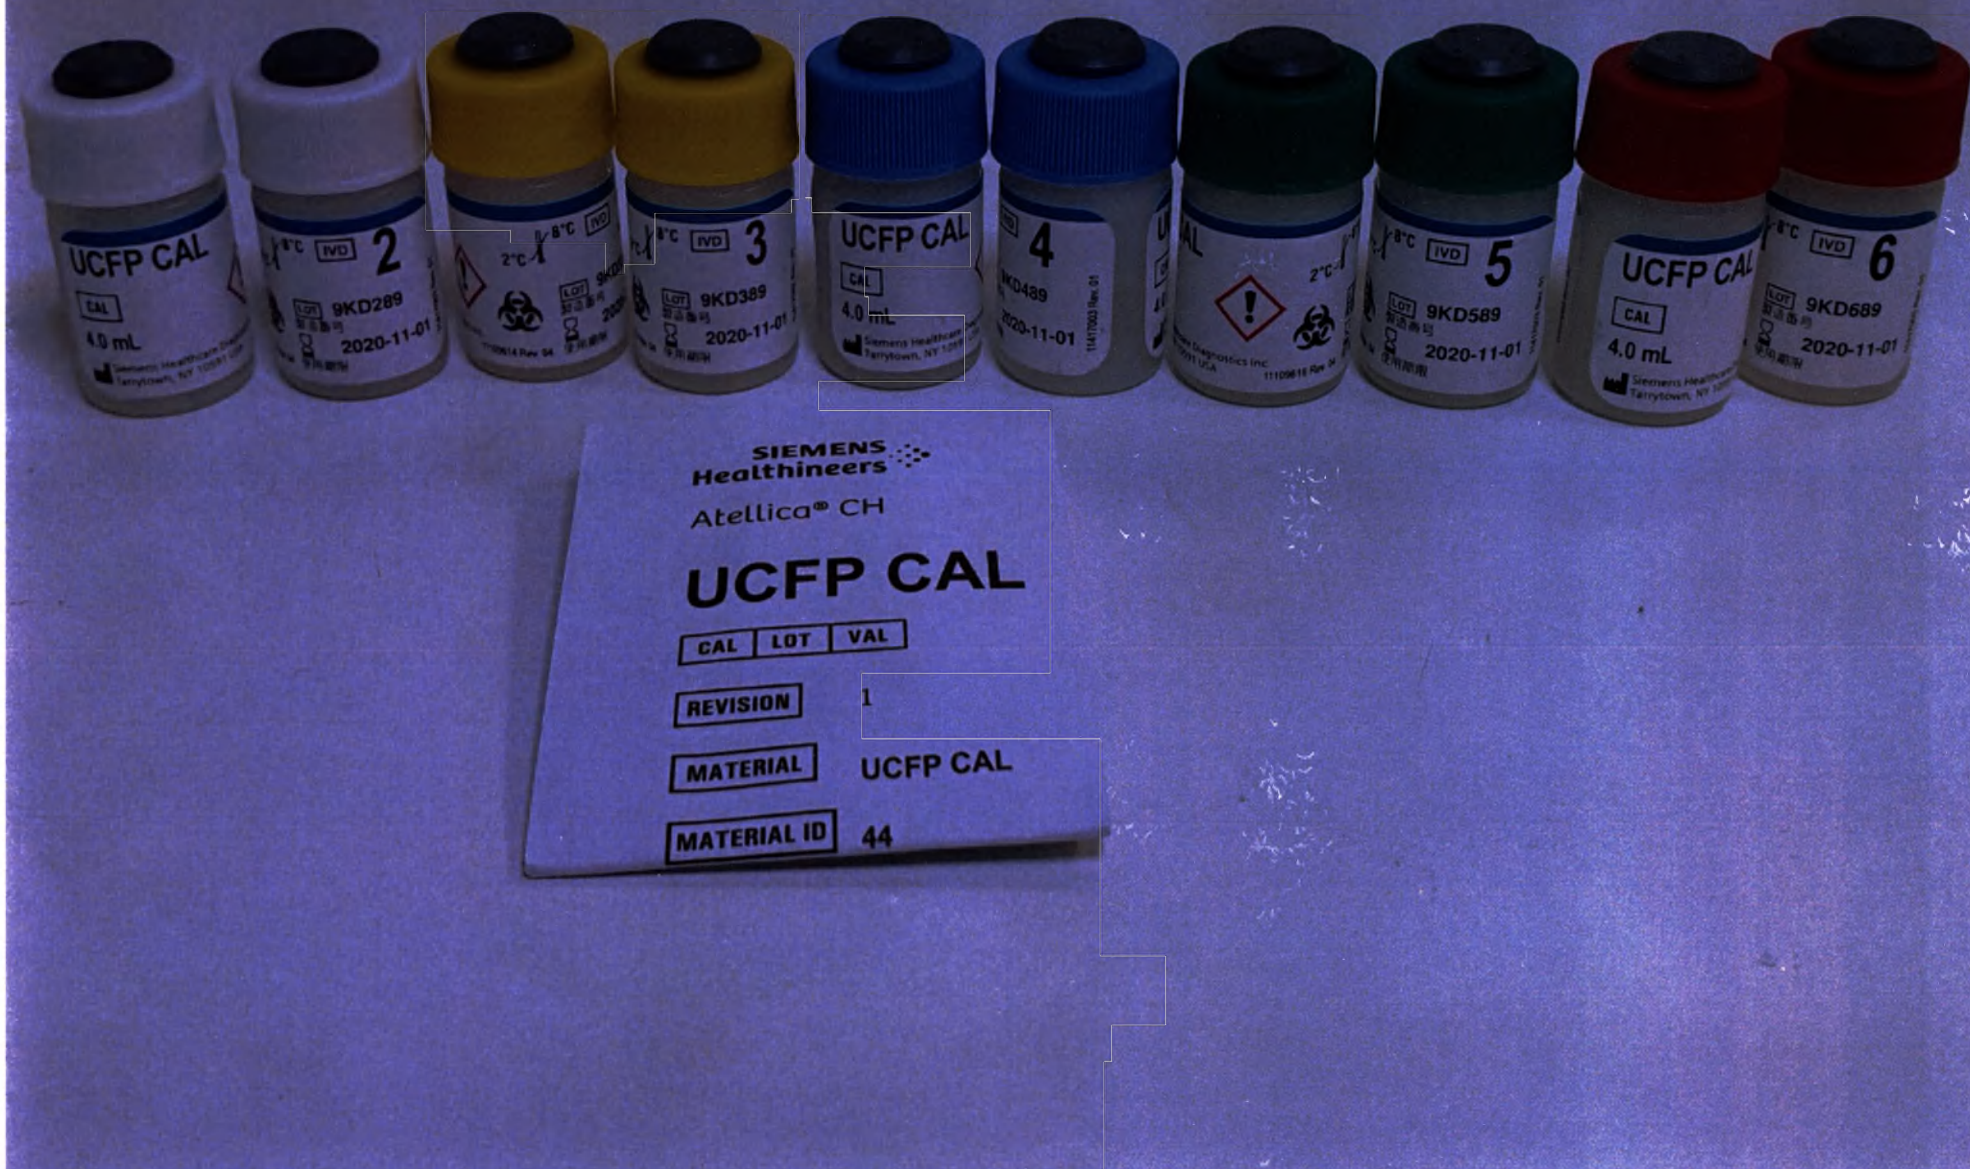


Рисунок 2. Набор калибраторов общего белка в моче и спинномозговой жидкости для анализаторов биохимических серии Atellica (Atellica CH Urinary/Cerebrospinal Fluid Protein Calibrator (Atellica CH UCFP CAL)): общий вид флаконов












Рисунок 7. Набор калибраторов общего белка в моче и спинномозговой жидкости для анализаторов биохимических серии Atellica (Atellica CH Urinary/Cerebrospinal Fluid Protein Calibrator (Atellica CH UCFP CAL)): флакон с калибратором, общий вид, уровень 6

SIEMENS
Healthineers

Atellica® CH

UCFP CAL

CAL LOT VAL

REVISION 1

MATERIAL UCFP CAL

MATERIAL ID 44

LOT

9KD089

製造番号



2020-11-01

使用期限

REF

11099339

[siemens.com/ru](https://www.siemens.com/ru)

UCFP	UNITS C		UNITS SI	
CAL 2	5.7	mg/dL	57	mg/L
CAL 3	36.0	mg/dL	360	mg/L
CAL 4	71.8	mg/dL	718	mg/L
CAL 5	140.0	mg/dL	1400	mg/L
CAL 6	265.3	mg/dL	2653	mg/L



11109610 Rev. 02

Рисунок 8. Набор калибраторов общего белка в моче и спинномозговой жидкости для анализаторов биохимических серии Atellica (Atellica CH Urinary/Cerebrospinal Fluid Protein Calibrator (Atellica CH UCFP CAL)): лист значений параметров серии калибратора

Всего прошито и пронумеровано
9 листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»

