

ООО «БИ Плюс»

«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий - индивидуальный предприниматель
ООО «БИ Плюс»



В.Ф. Потака

2021г.

МАКЕТ УПАКОВКИ

медицинского изделия

Наконечники для слюноотсосов стоматологические одноразовые DENTAL FORMULA®

НАЗНАЧЕНИЕ. Наконечники предназначены для удаления слюны и влаги из полости рта пациента в процессе стоматологических процедур в составе аспирационной системы.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ. Транспортировка изделий может осуществляться всеми видами крытого транспорта в упаковке производителя в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Изделия необходимо хранить в крытых помещениях при температуре от 0°C до 30°C, избегая воздействия агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света и высокой влажности (относительная влажность воздуха до 85%). Неиспользованные медицинские изделия, пришедшие в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, принадлежат к мусору. Обшир список отходов класса А согласно нормативному руководству РФ СанПиН 2.1.3684-21). Использованные медицинские изделия принадлежат к мусору. Информацию отходы класса Б согласно нормативному руководству РФ СанПиН 2.1.3684-21. Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

МАТЕРИАЛ: поливинилхлорид (PVC) без содержания фталатов.

КОЛИЧЕСТВО: XX шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. Перед применением проверьте герметичность крепления колпачка на канале, приложив небольшое усилие. Колпачок должен плотно сидеть на конце канала. Установите наконечник в переключатель шланга слюноотсоса, при нажатии либо непосредственно в аспирационный контур пневматической или гидравлической системы. Придайте форму наконечнику в зависимости от особенностей ротации полости пациента. Главною отличительной особенностью является возможность зажима, обеспечивающая эффективность слюноотсоса. Если необходимо обработать сильный канал наконечника, проведите его в два этапа. Используйте подушечку большого пальца или упор, сделайте первый нажим, затем осуществите второй шаг с поворотом наконечника вокруг своей оси.



См. продолжение ниже

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ. Наконечники должны применяться в соответствии с инструкцией на медицинское изделие. Применение изделий не требует специальной квалификации или специального образования. Наконечники для слюноотсосов применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, удаленном от прямых солнечных лучей, при температуре от 15°C до 35°C и относительной влажности от 45% до 85%. Изделия предназначены только для однокоронного применения. Только для индивидуального применения. При эксплуатации изделия необходимо предохранять его от механических повреждений. Избегать резких боковых ударов изделий наконечника.

ВОРЛД БОРК СРЛ, Италия, Виа дель Приракко, д. 47 - 39054 г. Монтебелло-Вичентина (Виченца), Италия.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ:
ООО «ДМ Плекс», Россия, 19492 г. Санкт-Петербург, восточн.г., муниципальный округ «Саргисское», пер. 8-й Восточный, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, тел. 17 (812) 309-38-62;
e-mail: vborck@terru.ru, pl.

ИМПОРТЕР: ООО «ДМ Плекс»

Не подлежит обязательной сертификации
ТУ 17.000.000.000 от 00.00.0000 г.

Срок годности. Установленный срок годности 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

Гарантии производителя. Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик наконечников для слюноотсосов в течение 5 лет с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Артикул: XXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXX



НАЗНАЧЕНИЕ. Наконечники предназначены для удаления жидкостей и взвесей из полости рта пациента в процессе стоматологических процедур в составе аспирационной системы.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами крытого транспорта в упаковке производителя в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Изделия необходимо хранить в крытых помещениях при температуре от 0°C до 35°C вдали от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горячих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света и высокой влажности (относительная влажность воздуха до 85%). Неиспользованное медицинское изделие, пришедшее в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, принадлежит к категории Общих отходов (Отходы класса А согласно нормативному руководству РФ СанПиН 2.1.3684-21). Использованное медицинское изделие принадлежит к категории Инфекционных отходов (Отходы класса Б согласно нормативному руководству РФ СанПиН 2.1.3684-21). Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

МАТЕРИАЛ: поливинилхлорид (ПВХ) без содержания фталатов.

КОЛИЧЕСТВО: XX шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. Перед применением проверьте прочность крепления колпачка на канюле, приложив небольшое усилие. Колпачок должен плотно сидеть на конце канюли. Установите наконечник в переходник шланга слюноотсоса, при наличии, либо непосредственно в аспирационный контур пневматической или гидравлической системы. Придайте форму наконечнику в зависимости от особенностей ротовой полости пациента. Плавное согните наконечник, не допуская резких блокирующих заломов, снижающих эффективность слюноотсоса. Если необходимо осуществить сильный изгиб наконечника, проведите его в два этапа. Используя подушечку большого пальца как упор, сделайте плавный первый сгиб, затем осуществите второй сгиб с поворотом наконечника вокруг своей оси.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ. Наконечники должны применяться в соответствии с инструкцией на медицинское изделие. Применение изделия не требует специальной квалификации или специального образования. Наконечники для слюноотсосов применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 15°C до 35°C и относительной влажности от 45% до 85%. Изделие предназначено только для одноразового применения. Только для индивидуального применения. При эксплуатации изделия необходимо предохранять его от механических повреждений. Избегать резких блокирующих заломов наконечника.



ВОРЛД ВОРК СРЛ, Италия, Виа дель Прогрессо, д. 47 - 36054 г. Монтебелло-Вичентино (Виченца), Италия.

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ:**

ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, пер 6-й Верхний, д. 12 литера А, часть пом. 5.3.1 Тел.: +7 (812) 309-36-62;
e-mail: beplus@beplus.spb.ru.

ИМПОРТЕР: XXXXXXXX

Не подлежит обязательной сертификации.

РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Срок годности. Установленный срок годности 5 лет.




Не использовать по истечении срока годности.

Гарантии производителя. Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик наконечников для слюноотсосов в течение 5 лет с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Артикул: XXXXXXXXXX








НАЗНАЧЕНИЕ. Наконечники предназначены для применения в качестве слюноотсосов для пациентов в стоматологической клинике. Предназначены для использования в стоматологической клинике. Предназначены для использования в стоматологической клинике.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. Наконечники должны храниться в упаковке производителя в соответствии с требованиями к условиям хранения. Наконечники должны храниться в упаковке производителя в соответствии с требованиями к условиям хранения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. Перед применением наконечника необходимо проверить его целостность. Наконечник должен быть использован только один раз. Наконечник должен быть использован только один раз.

МАТЕРИАЛ: поликарбонат (ПК) без наполнителей.

КОЛИЧЕСТВО: 20 шт.

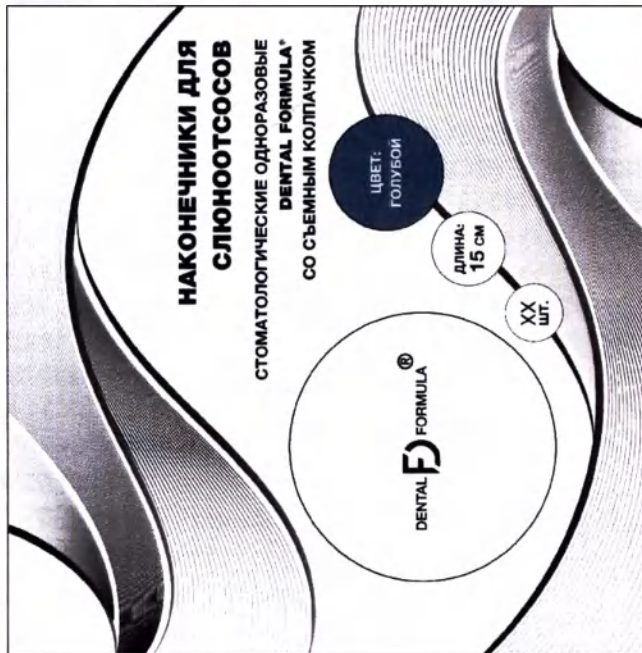

См. продолжение ниже

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ. Наконечники должны использоваться в соответствии с инструкцией на упаковке. Наконечники должны использоваться в соответствии с инструкцией на упаковке.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. Наконечники должны храниться в упаковке производителя в соответствии с требованиями к условиям хранения. Наконечники должны храниться в упаковке производителя в соответствии с требованиями к условиям хранения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. Перед применением наконечника необходимо проверить его целостность. Наконечник должен быть использован только один раз. Наконечник должен быть использован только один раз.

МАТЕРИАЛ: поликарбонат (ПК) без наполнителей.

КОЛИЧЕСТВО: 20 шт.

НАЗНАЧЕНИЕ. Наконечники предназначены для удаления жидкостей и взвесей из полости рта пациента в процессе стоматологических процедур в составе аспирационной системы.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами крытого транспорта в упаковке производителя в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Изделия необходимо хранить в крытых помещениях при температуре от 0°C до 35°C вдали от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горячих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света и высокой влажности (относительная влажность воздуха до 85%). Неиспользованное медицинское изделие, пришедшее в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, принадлежит к категории Общих отходов (Отходы класса А согласно нормативному руководству РФ СанПиН 2.1.3684-21). Использованное медицинское изделие принадлежит к категории Инфекционных отходов (Отходы класса Б согласно нормативному руководству РФ СанПиН 2.1.3684-21). Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

МАТЕРИАЛ: поливинилхлорид (ПВХ) без содержания фталатов.

КОЛИЧЕСТВО: XX шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. Перед применением проверьте прочность крепления колпачка на канюле, приложив небольшое усилие. Колпачок должен плотно сидеть на конце канюли. Установите наконечник в переходник шланга слюноотсоса, при наличии, либо непосредственно в аспирационный контур пневматической или гидравлической системы. Придайте форму наконечнику в зависимости от особенностей ротовой полости пациента. Плавнo согните наконечник, не допуская резких блокирующих заломов, снижающих эффективность слюноотсоса. Если необходимо осуществить сильный изгиб наконечника, проведите его в два этапа. Используя подушечку большого пальца как упор, сделайте плавный первый сгиб, затем осуществите второй сгиб с поворотом наконечника вокруг своей оси.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ. Наконечники должны применяться в соответствии с инструкцией на медицинское изделие. Применение изделия не требует специальной квалификации или специального образования. Наконечники для слюноотсосов применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 15°C до 35°C и относительной влажности от 45% до 85%. Изделие предназначено только для одноразового применения. Только для индивидуального применения. При эксплуатации изделия необходимо предохранять его от механических повреждений. Избегать резких блокирующих заломов наконечника.



ВОРЛД ВОРК СРЛ, Италия, Виа дель Прогрессо, д. 47 - 36054 г. Монтебелло-Вичентино (Виченца), Италия.

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ:**

ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, пер 6-й Верхний, д. 12 литера А, часть пом. 5.3.1 Тел.: +7 (812) 309-36-62;
e-mail: beplus@beplus.spb.ru.

ИМПОРТЕР: XXXXXXXX

Не подлежит обязательной сертификации.

РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Срок годности. Установленный срок годности 5 лет.


Не использовать по истечении срока годности.

Гарантии производителя. Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик наконечников для слюноотсосов в течение 5 лет с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Артикул: XXXXXXXXX



LOT



Наконечники для слюноотсосов стоматологические одноразовые DENTAL FORMULA® со съёмным колпачком, длина 15 см, цвет: синий.

НАЗНАЧЕНИЕ. Наконечники предназначены для удаления слюны и влаги из полости рта пациента в процессе стоматологических процедур. Наконечники предназначены для использования в качестве слюноотсоса.


УСТРОЙСТВО И КОНСТРУКЦИЯ. Наконечники имеют форму конуса, расширяющегося к основанию. Наконечники имеют съёмный колпачок, который защищает наконечник от загрязнения и повреждения. Наконечники имеют отверстие для подключения к системе отсасывания.

Материал. Наконечники изготовлены из полипропилена (PP) без содержания бисфенола А (BPA).

Свойства. Наконечники обладают высокой прочностью, устойчивостью к деформации и воздействию химических веществ. Наконечники имеют гладкую поверхность, которая предотвращает прилипание слюны и влаги.

Использование. Наконечники используются для удаления слюны и влаги из полости рта пациента в процессе стоматологических процедур. Наконечники подключаются к системе отсасывания.

Упаковка. Наконечники упакованы в стерильной упаковке. Упаковка имеет маркировку с названием продукта и количеством наконечников.

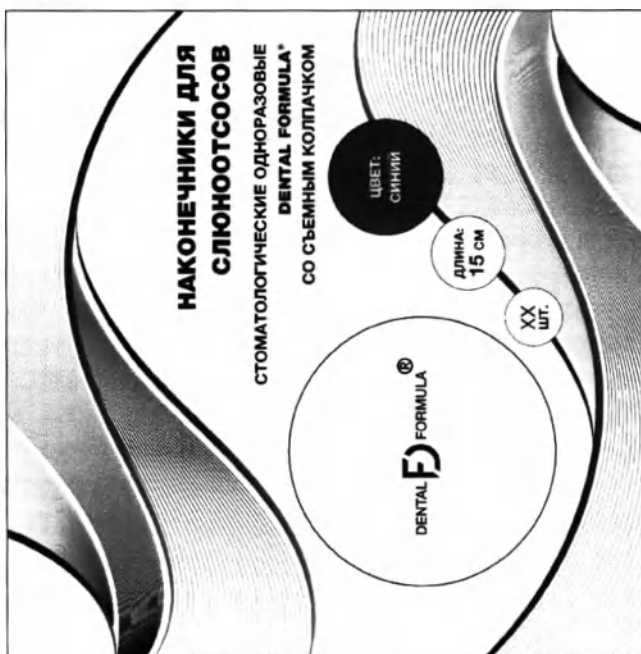

См. продолжение ниже

УСТРОЙСТВО И КОНСТРУКЦИЯ. Наконечники имеют форму конуса, расширяющегося к основанию. Наконечники имеют съёмный колпачок, который защищает наконечник от загрязнения и повреждения. Наконечники имеют отверстие для подключения к системе отсасывания.

Материал. Наконечники изготовлены из полипропилена (PP) без содержания бисфенола А (BPA).

Свойства. Наконечники обладают высокой прочностью, устойчивостью к деформации и воздействию химических веществ. Наконечники имеют гладкую поверхность, которая предотвращает прилипание слюны и влаги.

Использование. Наконечники используются для удаления слюны и влаги из полости рта пациента в процессе стоматологических процедур. Наконечники подключаются к системе отсасывания.

Упаковка. Наконечники упакованы в стерильной упаковке. Упаковка имеет маркировку с названием продукта и количеством наконечников.

Артикул: XXXXXXXX

Barcode: XXXXXXXX

Свойства: Высокая прочность, устойчивость к деформации, гладкая поверхность, предотвращающая прилипание слюны и влаги.

Использование: Для удаления слюны и влаги из полости рта пациента в процессе стоматологических процедур.

Упаковка: Стерильная упаковка, содержащая XX штук наконечников.

НАЗНАЧЕНИЕ. Наконечники предназначены для удаления жидкостей и взвесей из полости рта пациента в процессе стоматологических процедур в составе аспирационной системы.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами крытого транспорта в упаковке производителя в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Изделия необходимо хранить в крытых помещениях при температуре от 0°C до 35°C вдали от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горячих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света и высокой влажности (относительная влажность воздуха до 85%). Неиспользованное медицинское изделие, пришедшее в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, принадлежит к категории Общих отходов (Отходы класса А согласно нормативному руководству РФ СанПин 2.1.3684-21). Использованное медицинское изделие принадлежит к категории Инфекционных отходов (Отходы класса Б согласно нормативному руководству РФ СанПин 2.1.3684-21). Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

МАТЕРИАЛ: поливинилхлорид (ПВХ) без содержания фталатов.

КОЛИЧЕСТВО: XX шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. Перед применением проверьте прочность крепления колпачка на канюле, приложив небольшое усилие. Колпачок должен плотно сидеть на конце канюли. Установите наконечник в переходник шланга слюноотсоса, при наличии, либо непосредственно в аспирационный контур пневматической или гидравлической системы. Придайте форму наконечнику в зависимости от особенностей ротовой полости пациента. Плавное согните наконечник, не допуская резких блокирующих заломов, снижающих эффективность слюноотсоса. Если необходимо осуществить сильный изгиб наконечника, проведите его в два этапа. Используя подушечку большого пальца как упор, сделайте плавный первый сгиб, затем осуществите второй сгиб с поворотом наконечника вокруг своей оси.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ. Наконечники должны применяться в соответствии с инструкцией на медицинское изделие. Применение изделия не требует специальной квалификации или специального образования. Наконечники для слюноотсосов применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 15°C до 35°C и относительной влажности от 45% до 85%. Изделие предназначено только для одноразового применения. Только для индивидуального применения. При эксплуатации изделия необходимо предохранять его от механических повреждений. Избегать резких блокирующих заломов наконечника.

 **ВОРЛД ВОРК СРЛ**, Италия, Виа дель Прогрессо, д. 47 - 36054 г. Монтебелло-Вичентино (Виченца), Италия.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ:

ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, пер 6-й Верхний, д. 12 литера А, часть пом. 5.3.1 Тел.: +7 (812) 309-36-62;
e-mail: beplus@beplus.spb.ru.

ИМПОРТЕР: XXXXXXX

Не подлежит обязательной сертификации.


РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Срок годности. Установленный срок годности 5 лет.

Не использовать по истечении срока годности.

Гарантии производителя. Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик наконечников для слюноотсосов в течение 5 лет с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Артикул: XXXXXXXXXX

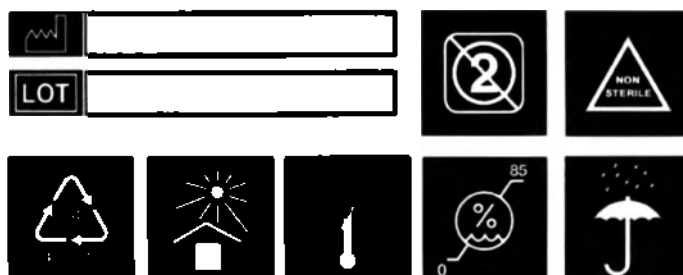

[illegible]

НАЗНАЧЕНИЕ. Наконечники предназначены для удаления жидкостей и взвесей из полости рта пациента в процессе стоматологических процедур в составе аспирационной системы.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами крытого транспорта в упаковке производителя в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Изделия необходимо хранить в крытых помещениях при температуре от 0°C до 35°C вдали от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горячих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света и высокой влажности (относительная влажность воздуха до 85%). Неиспользованное медицинское изделие, пришедшее в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, принадлежит к категории Общих отходов (Отходы класса А согласно нормативному руководству РФ СанПиН 2.1.3684-21). Использованное медицинское изделие принадлежит к категории Инфекционных отходов (Отходы класса Б согласно нормативному руководству РФ СанПиН 2.1.3684-21). Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

МАТЕРИАЛ: поливинилхлорид (ПВХ) без содержания фталатов.

КОЛИЧЕСТВО: XX шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. Перед применением проверьте прочность крепления колпачка на канюле, приложив небольшое усилие. Колпачок должен плотно сидеть на конце канюли. Установите наконечник в переходник шланга слюноотсоса, при наличии, либо непосредственно в аспирационный контур пневматической или гидравлической системы. Придайте форму наконечнику в зависимости от особенностей ротовой полости пациента. Плавное согните наконечник, не допуская резких блокирующих заломов, снижающих эффективность слюноотсоса. Если необходимо осуществить сильный изгиб наконечника, проведите его в два этапа. Используя подушечку большого пальца как упор, сделайте плавный первый сгиб, затем осуществите второй сгиб с поворотом наконечника вокруг своей оси.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ. Наконечники должны применяться в соответствии с инструкцией на медицинское изделие. Применение изделия не требует специальной квалификации или специального образования. Наконечники для слюноотсосов применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 15°C до 35°C и относительной влажности от 45% до 85%. Изделие предназначено только для одноразового применения. Только для индивидуального применения. При эксплуатации изделия необходимо предохранять его от механических повреждений. Избегать резких блокирующих заломов наконечника.

 **ВОРЛД ВОРК СРЛ**, Италия, Виа дель Прогрессо, д. 47 - 36054 г. Монтебелло-Вичентино (Виченца), Италия.

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ:**

ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, пер 6-й Верхний, д. 12 литера А, часть пом. 5.3.1 Тел.: +7 (812) 309-36-62;
e-mail: beplus@beplus.spb.ru.

ИМПОРТЕР: XXXXXXXX

Не подлежит обязательной сертификации.


РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Срок годности. Установленный срок годности 5 лет.

Не использовать по истечении срока годности.

Гарантии производителя. Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик наконечников для слюноотсосов в течение 5 лет с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Артикул: XXXXXXXXXX



Наконечники для слюноотсосов стоматологические одноразовые DENTAL FORMULA® со съемным колпачком, длина 15 см, цвет: фуксия.

**НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ
СЛЮНООТСОСОВ**

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ
ДЕНТАЛ ФОРМУЛА®

СО СЪЕМНЫМ КОЛПАЧКОМ

ЦВЕТ:
ФУКСИЯ

ДЛИНА:
15 см

XX
шт.

DENTAL FORMULA®

См. продолжение ниже

[illegible]

НАЗНАЧЕНИЕ. Наконечники предназначены для удаления жидкостей и взвесей из полости рта пациента в процессе стоматологических процедур в составе аспирационной системы.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами крытого транспорта в упаковке производителя в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Изделия необходимо хранить в крытых помещениях при температуре от 0°C до 35°C вдали от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горячих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света и высокой влажности (относительная влажность воздуха до 85%). Неиспользованное медицинское изделие, пришедшее в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, принадлежит к категории Общих отходов (Отходы класса А согласно нормативному руководству РФ СанПиН 2.1.3684-21). Использованное медицинское изделие принадлежит к категории Инфекционных отходов (Отходы класса Б согласно нормативному руководству РФ СанПиН 2.1.3684-21). Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

МАТЕРИАЛ: поливинилхлорид (ПВХ) без содержания фталатов.

КОЛИЧЕСТВО: XX шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. Перед применением проверьте прочность крепления колпачка на канюле, приложив небольшое усилие. Колпачок должен плотно сидеть на конце канюли. Установите наконечник в переходник шланга слюноотсоса, при наличии, либо непосредственно в аспирационный контур пневматической или гидравлической системы. Придайте форму наконечнику в зависимости от особенностей ротовой полости пациента. Плавнo согните наконечник, не допуская резких блокирующих заломов, снижающих эффективность слюноотсоса. Если необходимо осуществить сильный изгиб наконечника, проведите его в два этапа. Используя подушечку большого пальца как упор, сделайте плавный первый сгиб, затем осуществите второй сгиб с поворотом наконечника вокруг своей оси.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ. Наконечники должны применяться в соответствии с инструкцией на медицинское изделие. Применение изделия не требует специальной квалификации или специального образования. Наконечники для слюноотсосов применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 15°C до 35°C и относительной влажности от 45% до 85%. Изделие предназначено только для одноразового применения. Только для индивидуального применения. При эксплуатации изделия необходимо предохранять его от механических повреждений. Избегать резких блокирующих заломов наконечника.

 **ВОРЛД ВОРК СРЛ**, Италия, Виа дель Прогрессо, д. 47 - 36054 г. Монтебелло-Вичентино (Виченца), Италия.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ:

ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, пер 6-й Верхний, д. 12 литера А, часть пом. 5.3.1 Тел.: +7 (812) 309-36-62;
e-mail: beplus@beplus.spb.ru.

ИМПОРТЕР: XXXXXXXX

Не подлежит обязательной сертификации.

РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Срок годности. Установленный срок годности 5 лет.


Не использовать по истечении срока годности.

Гарантии производителя. Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик наконечников для слюноотсосов в течение 5 лет с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Артикул: XXXXXXXXXX



	
LOT	



Наконечники для слюноотсосов стоматологические одноразовые DENTAL FORMULA® со съёмным колпачком, длина 15 см, цвет: оранжевый.

**НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ
СЛЮНООТСОСОВ**

**СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ
DENTAL FORMULA®**

СО СЪЕМНЫМ КОЛПАЧОМ

**ЦВЕТ:
ОРАНЖЕВЫЙ**

**ДЛИНА:
15 см**

XX шт.

DENTAL FORMULA®

См. продолжение ниже

[illegible]

НАЗНАЧЕНИЕ. Наконечники предназначены для удаления жидкостей и взвесей из полости рта пациента в процессе стоматологических процедур в составе аспирационной системы.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами крытого транспорта в упаковке производителя в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Изделия необходимо хранить в крытых помещениях при температуре от 0°C до 35°C вдали от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горячих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света и высокой влажности (относительная влажность воздуха до 85%). Неиспользованное медицинское изделие, пришедшее в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, принадлежит к категории Общих отходов (Отходы класса А согласно нормативному руководству РФ СанПиН 2.1.3684-21). Использованное медицинское изделие принадлежит к категории Инфекционных отходов (Отходы класса Б согласно нормативному руководству РФ СанПиН 2.1.3684-21). Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

МАТЕРИАЛ: поливинилхлорид (ПВХ) без содержания фталатов.

КОЛИЧЕСТВО: XX шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. Перед применением проверьте прочность крепления колпачка на канюле, приложив небольшое усилие. Колпачок должен плотно сидеть на конце канюли. Установите наконечник в переходник шланга слюноотсоса, при наличии, либо непосредственно в аспирационный контур пневматической или гидравлической системы. Придайте форму наконечнику в зависимости от особенностей ротовой полости пациента. Плавное согните наконечник, не допуская резких блокирующих заломов, снижающих эффективность слюноотсоса. Если необходимо осуществить сильный изгиб наконечника, проведите его в два этапа. Используя подушечку большого пальца как упор, сделайте плавный первый сгиб, затем осуществите второй сгиб с поворотом наконечника вокруг своей оси.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ. Наконечники должны применяться в соответствии с инструкцией на медицинское изделие. Применение изделия не требует специальной квалификации или специального образования. Наконечники для слюноотсосов применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 15°C до 35°C и относительной влажности от 45% до 85%. Изделие предназначено только для одноразового применения. Только для индивидуального применения. При эксплуатации изделия необходимо предохранять его от механических повреждений. Избегать резких блокирующих заломов наконечника.

 **ВОРЛД ВОРК СРЛ**, Италия, Виа дель Прогрессо, д. 47 - 36054 г. Монтебелло-Вичентино (Виченца), Италия.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ:

ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, пер 6-й Верхний, д. 12 литера А, часть пом. 5.3.1 Тел.: +7 (812) 309-36-62;
e-mail: beplus@beplus.spb.ru.

ИМПОРТЕР: XXXXXXX

Не подлежит обязательной сертификации.




РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Срок годности. Установленный срок годности 5 лет.

Не использовать по истечении срока годности.

Гарантии производителя. Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик наконечников для слюноотсосов в течение 5 лет с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Артикул: XXXXXXXXXX



Наконечники для слюноотсосов стоматологические одноразовые DENTAL FORMULA® со съемным колпачком, длина 15 см, цвет: зеленый.

НАЗНАЧЕНИЕ. Наконечники предназначены для использования в качестве слюноотсосов при лечении пациентов в стоматологических кабинетах.

УПАКОВКА. Наконечники упакованы в стерильных индивидуальных упаковках по 20 шт.

УТИЛИЗАЦИЯ. Наконечники являются одноразовыми изделиями и подлежат утилизации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Материал: полиамид/поликарбонат (ПАК) без содержания фталатов.

Количество: 20 шт.

Инструкция по применению: Перед использованием наконечника необходимо убедиться, что он не поврежден и не загрязнен. Наконечник должен быть использован только один раз. После использования наконечник должен быть удален из полости рта пациента и утилизирован в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.



См. продолжение ниже

Условия применения: Наконечники должны использоваться в соответствии с инструкцией на упаковке. Применение наконечника не должно осуществляться в местах, где могут находиться пациенты. Наконечники должны быть использованы только один раз.

Производитель: ООО «Дентал Формула» (Dental Formula LLC), Россия. Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Б. Васильевская, д. 12, литера А, этаж 10.

Представитель: ООО «Дентал Формула» (Dental Formula LLC), Россия. Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Б. Васильевская, д. 12, литера А, этаж 10.

Адрес: XXXXXXXXXX

Barcode: XXXXXXXXXX

Символы: XXXXXXXXXX

НАЗНАЧЕНИЕ. Наконечники предназначены для удаления жидкостей и взвесей из полости рта пациента в процессе стоматологических процедур в составе аспирационной системы.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами крытого транспорта в упаковке производителя в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Изделия необходимо хранить в крытых помещениях при температуре от 0°C до 35°C вдали от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горячих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света и высокой влажности (относительная влажность воздуха до 85%). Неиспользованное медицинское изделие, пришедшее в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, принадлежит к категории Общих отходов (Отходы класса А согласно нормативному руководству РФ СанПиН 2.1.3684-21). Использованное медицинское изделие принадлежит к категории Инфекционных отходов (Отходы класса Б согласно нормативному руководству РФ СанПиН 2.1.3684-21). Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

МАТЕРИАЛ: поливинилхлорид (ПВХ) без содержания фталатов.

КОЛИЧЕСТВО: XX шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. Перед применением проверьте прочность крепления колпачка на канюле, приложив небольшое усилие. Колпачок должен плотно сидеть на конце канюли. Установите наконечник в переходник шланга слюноотсоса, при наличии, либо непосредственно в аспирационный контур пневматической или гидравлической системы. Придайте форму наконечнику в зависимости от особенностей ротовой полости пациента. Плавное согните наконечник, не допуская резких блокирующих заломов, снижающих эффективность слюноотсоса. Если необходимо осуществить сильный изгиб наконечника, проведите его в два этапа. Используя подушечку большого пальца как упор, сделайте плавный первый сгиб, затем осуществите второй сгиб с поворотом наконечника вокруг своей оси.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ. Наконечники должны применяться в соответствии с инструкцией на медицинское изделие. Применение изделия не требует специальной квалификации или специального образования. Наконечники для слюноотсосов применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 15°C до 35°C и относительной влажности от 45% до 85%. Изделие предназначено только для одноразового применения. Только для индивидуального применения. При эксплуатации изделия необходимо предохранять его от механических повреждений. Избегать резких блокирующих заломов наконечника.

 **ВОРЛД ВОРК СРЛ**, Италия, Виа дель Прогрессо, д. 47 - 36054 г. Монтебелло-Вичентино (Виченца), Италия.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ:

ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, пер 6-й Верхний, д. 12 литера А, часть пом. 5.3.1 Тел.: +7 (812) 309-36-62;
e-mail: beplus@beplus.spb.ru.

ИМПОРТЕР: XXXXXXXX

Не подлежит обязательной сертификации.


РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Срок годности. Установленный срок годности 5 лет.

Не использовать по истечении срока годности.

Гарантии производителя. Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик наконечников для слюноотсосов в течение 5 лет с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Артикул: XXXXXXXXXX

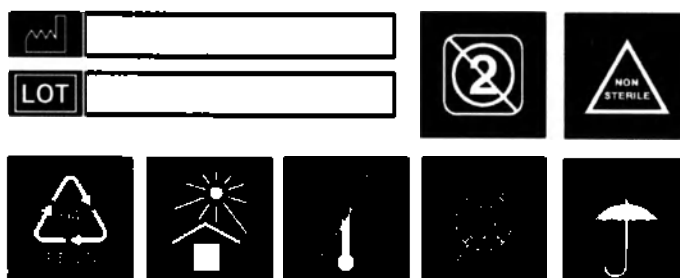


Наконечники для слюноотсосов стоматологические одноразовые DENTAL FORMULA® со съёмным колпачком, длина 15 см, цвет: мятно-зеленый.

НАЗНАЧЕНИЕ. Наконечники предназначены для использования в качестве слюноотсоса при лечении пациентов в стоматологической системе. Предназначены для использования в стоматологической системе.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. Наконечники должны храниться в упаковке производителя в соответствии с требованиями к условиям транспортировки и хранения. Наконечники должны быть защищены от воздействия влаги, пыли и других загрязнителей. При транспортировке наконечники должны быть защищены от воздействия влаги, пыли и других загрязнителей.

Материал: поликарбонат (ПК) без содержания фталатов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. Перед использованием наконечника необходимо убедиться, что он не поврежден и не загрязнен. Наконечник должен быть вставлен в слюноотсос и использован в соответствии с инструкцией производителя.

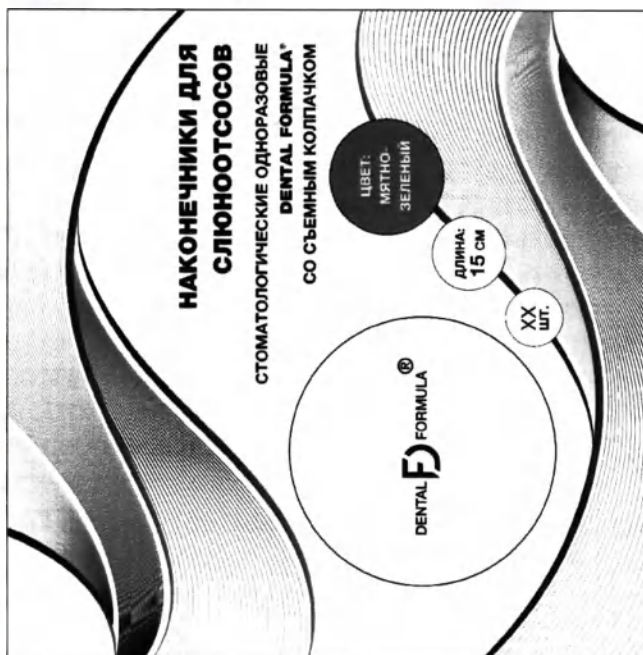

См. продолжение ниже

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ. Наконечники должны использоваться в соответствии с инструкцией производителя. Наконечники должны быть защищены от воздействия влаги, пыли и других загрязнителей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Наконечники должны быть защищены от воздействия влаги, пыли и других загрязнителей. При использовании наконечника необходимо соблюдать все меры предосторожности.

Адрес: XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

НАЗНАЧЕНИЕ. Наконечники предназначены для удаления жидкостей и взвесей из полости рта пациента в процессе стоматологических процедур в составе аспирационной системы.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами крытого транспорта в упаковке производителя в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Изделия необходимо хранить в крытых помещениях при температуре от 0°C до 35°C вдали от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горячих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света и высокой влажности (относительная влажность воздуха до 85%). Неиспользованное медицинское изделие, пришедшее в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, принадлежит к категории Общих отходов (Отходы класса А согласно нормативному руководству РФ СанПиН 2.1.3684-21). Использованное медицинское изделие принадлежит к категории Инфекционных отходов (Отходы класса Б согласно нормативному руководству РФ СанПиН 2.1.3684-21). Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

МАТЕРИАЛ: поливинилхлорид (ПВХ) без содержания фталатов.

КОЛИЧЕСТВО: XX шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. Перед применением проверьте прочность крепления колпачка на канюле, приложив небольшое усилие. Колпачок должен плотно сидеть на конце канюли. Установите наконечник в переходник шланга слюноотсоса, при наличии, либо непосредственно в аспирационный контур пневматической или гидравлической системы. Придайте форму наконечнику в зависимости от особенностей ротовой полости пациента. Плавное согните наконечник, не допуская резких блокирующих заломов, снижающих эффективность слюноотсоса. Если необходимо осуществить сильный изгиб наконечника, проведите его в два этапа. Используя подушечку большого пальца как упор, сделайте плавный первый сгиб, затем осуществите второй сгиб с поворотом наконечника вокруг своей оси.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ. Наконечники должны применяться в соответствии с инструкцией на медицинское изделие. Применение изделия не требует специальной квалификации или специального образования. Наконечники для слюноотсосов применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 15°C до 35°C и относительной влажности от 45% до 85%. Изделие предназначено только для одноразового применения. Только для индивидуального применения. При эксплуатации изделия необходимо предохранять его от механических повреждений. Избегать резких блокирующих заломов наконечника.



ВОРЛД ВОРК СРЛ, Италия, Виа дель Прогрессо, д. 47 - 36054 г. Монтебелло-Вичентино (Виченца), Италия.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ:

ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, пер 6-й Верхний, д. 12 литера А, часть пом. 5.3.1 Тел.: +7 (812) 309-36-62;

e-mail: beplus@beplus.spb.ru.

ИМПОРТЕР: XXXXXXXX

Не подлежит обязательной сертификации.



РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Срок годности. Установленный срок годности 5 лет.

Не использовать по истечении срока годности.

Гарантии производителя. Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик наконечников для слюноотсосов в течение 5 лет с даты производства при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения в соответствии с инструкцией.

Артикул: XXXXXXXXXX



Всего прошито и скреплено
печатью 25 листа / ов /
Управляющий-ИП
ПОТЕНА В Ф



ООО «БИ Плюс»

«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий - индивидуальный предприниматель
ООО «БИ Плюс»



В.Ф. Потака

2021г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
медицинского изделия

Наконечники для слюноотсосов стоматологические одноразовые
DENTAL FORMULA®

2021


Наконечники для слюноотсосов стоматологические одноразовые DENTAL FORMULA® со съемным колпачком, длина 15 см, цвет: прозрачный.




Наконечники для слюноотсосов стоматологические одноразовые DENTAL FORMULA® со съемным колпачком, длина 15 см, цвет: голубой.




Наконечники для слюноотсосов стоматологические одноразовые DENTAL FORMULA® со съемным колпачком, длина 15 см, цвет: синий.

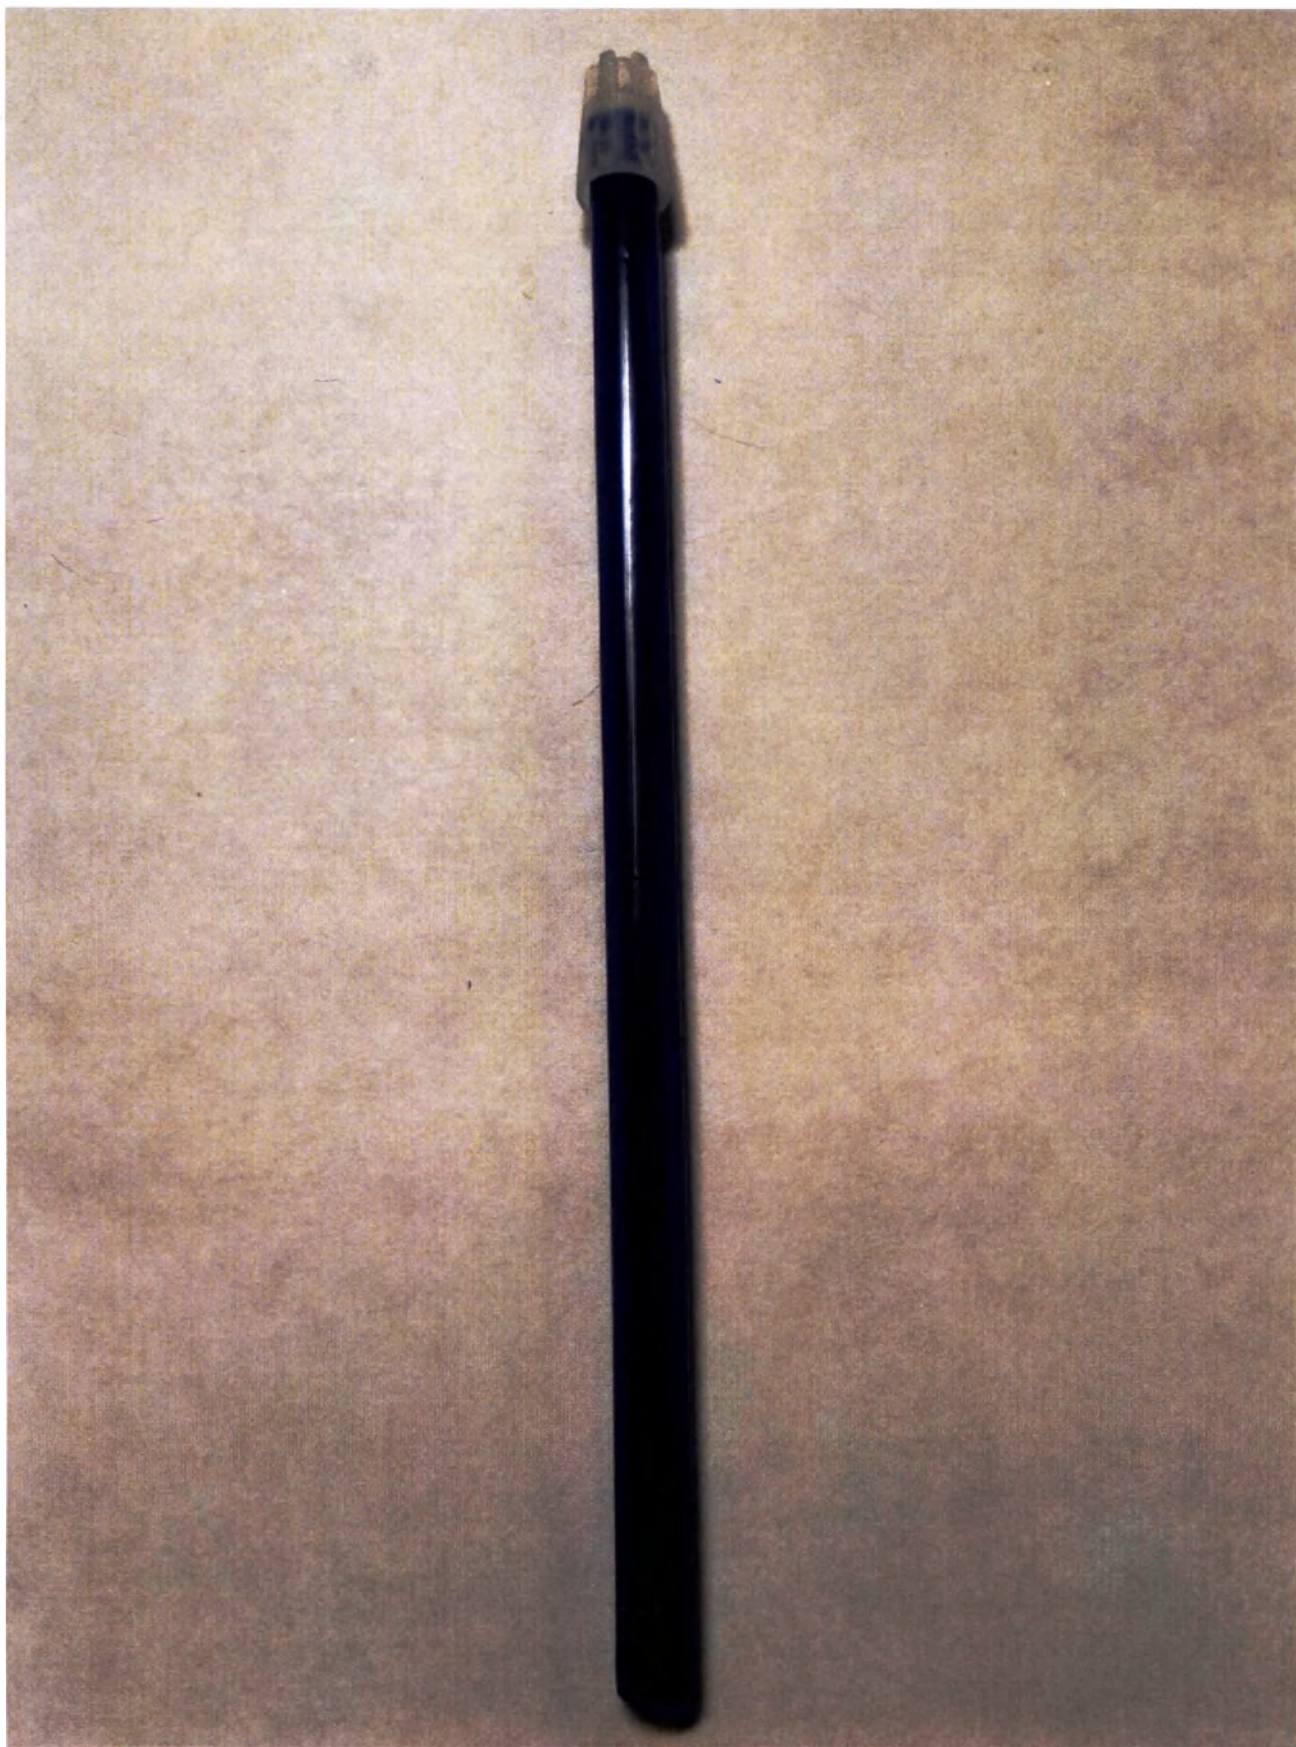


Наконечники для слюноотсосов стоматологические одноразовые DENTAL FORMULA® со съёмным колпачком, длина 15 см, цвет: сиреневый.

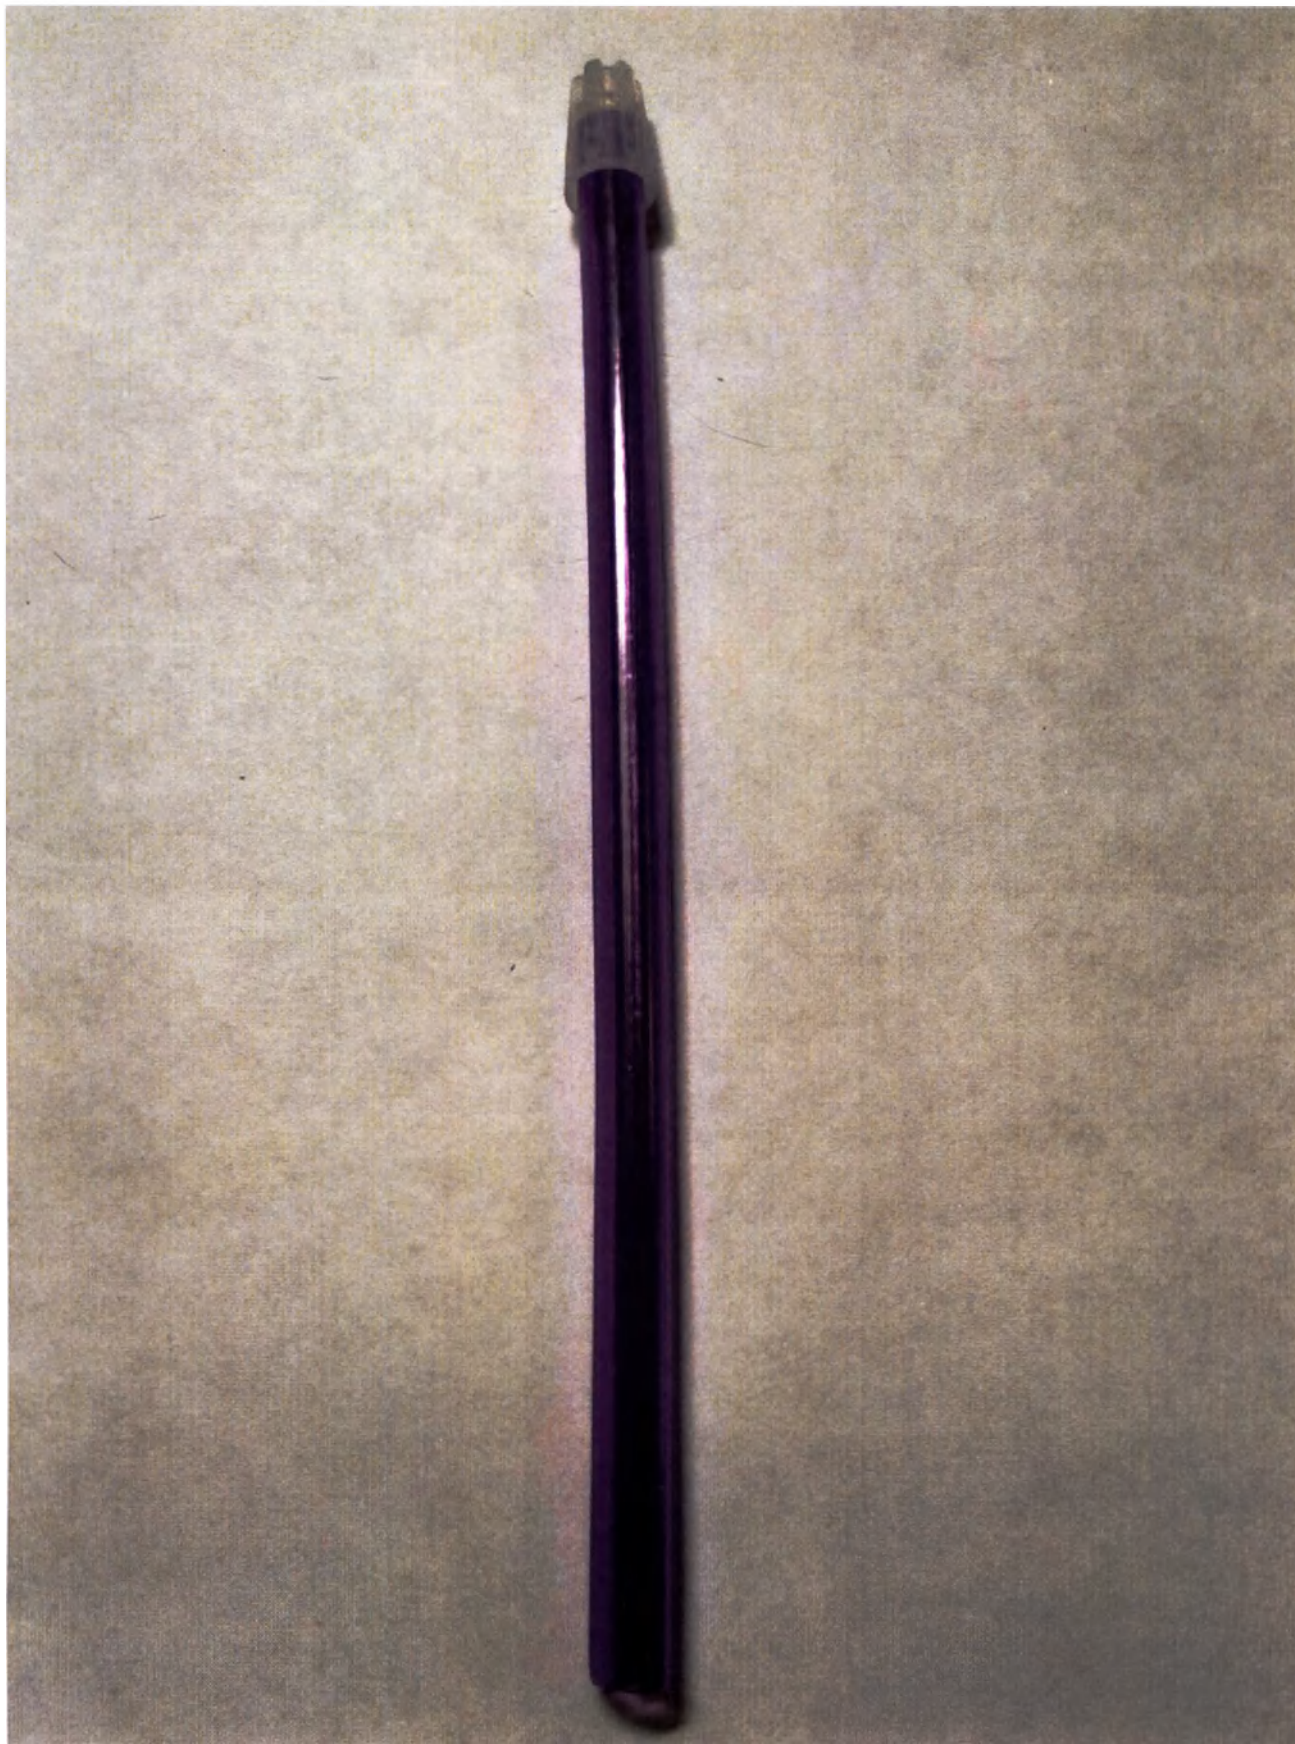


Наконечники для слюноотсосов стоматологические одноразовые DENTAL FORMULA® со съемным колпачком, длина 15 см, цвет: фуксия.

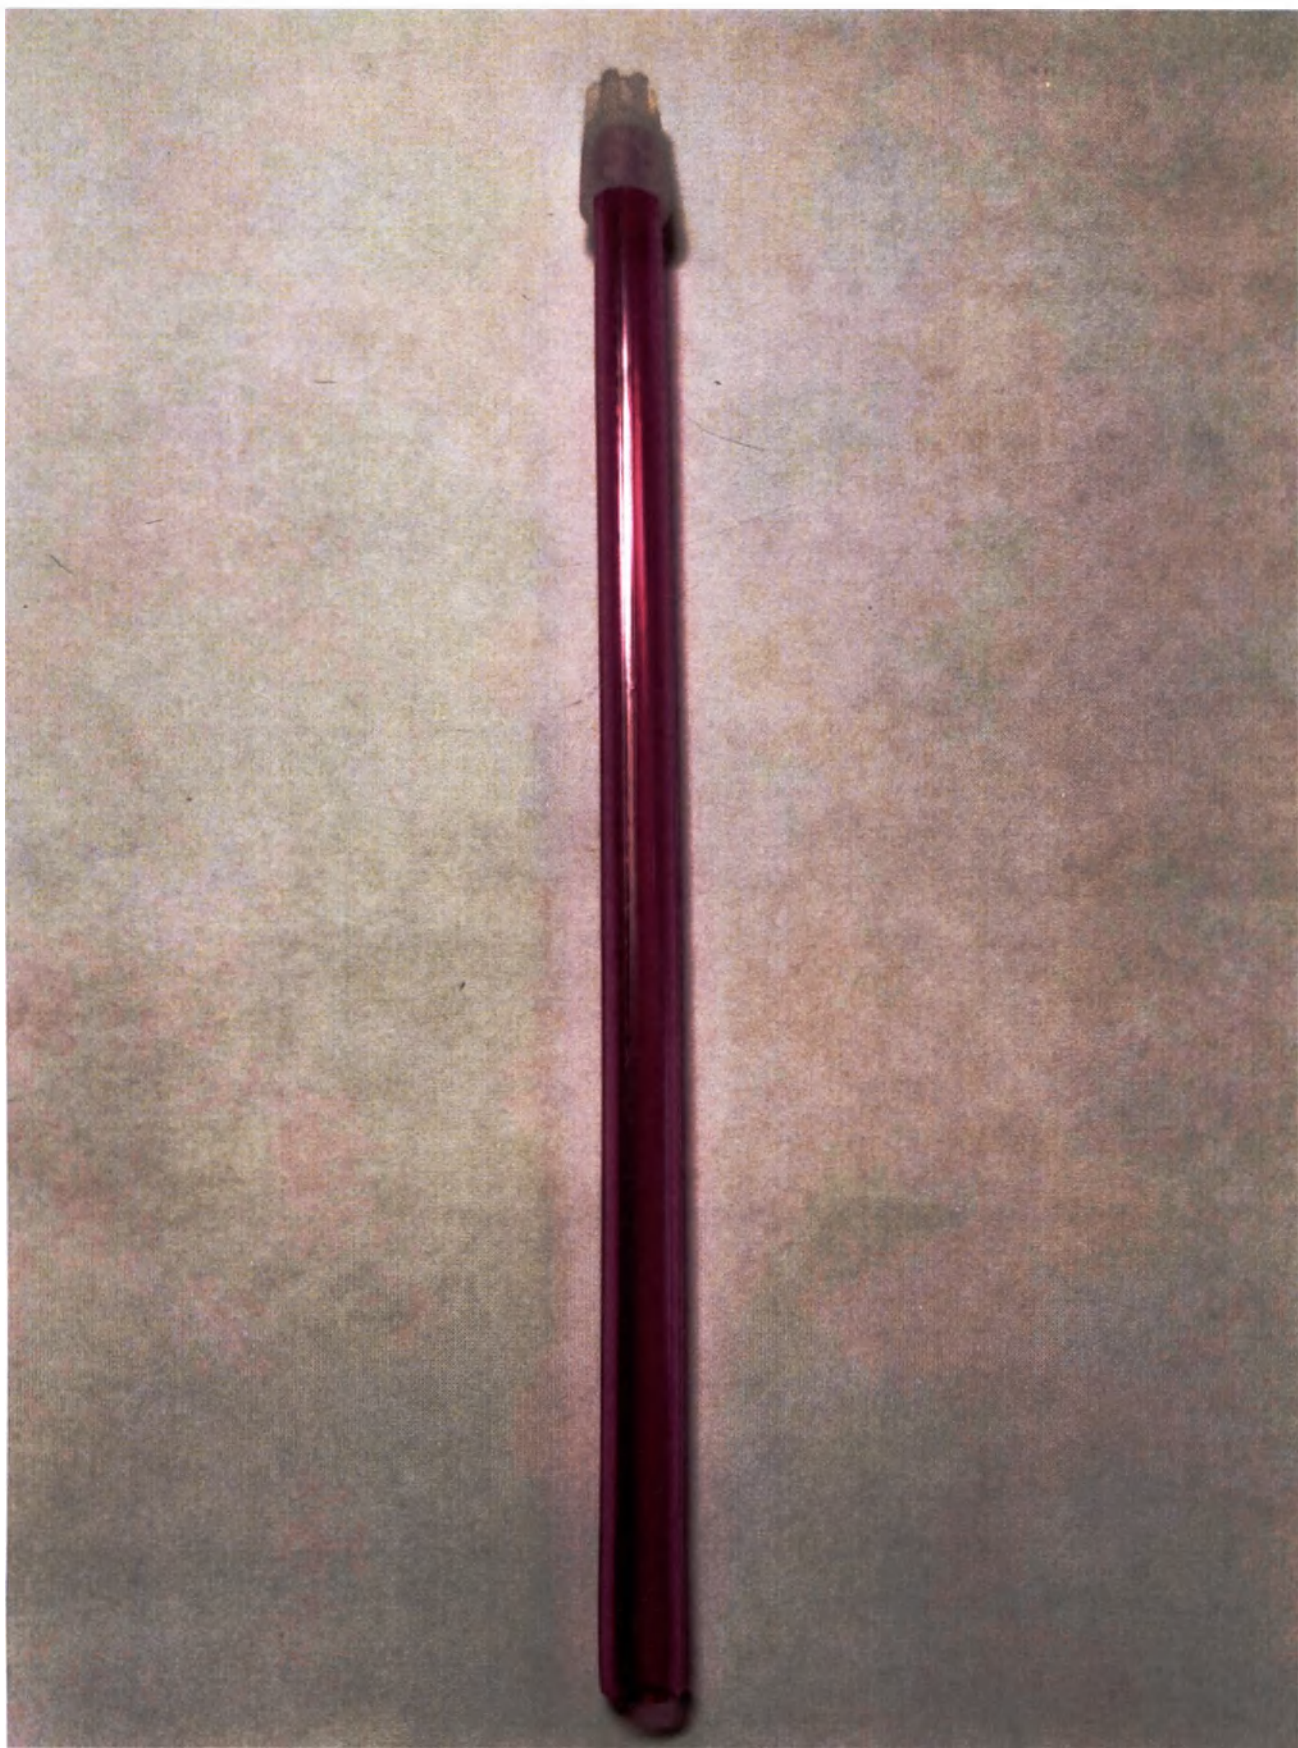


Наконечники для слюноотсосов стоматологические одноразовые DENTAL FORMULA® со съемным колпачком, длина 15 см, цвет: оранжевый.

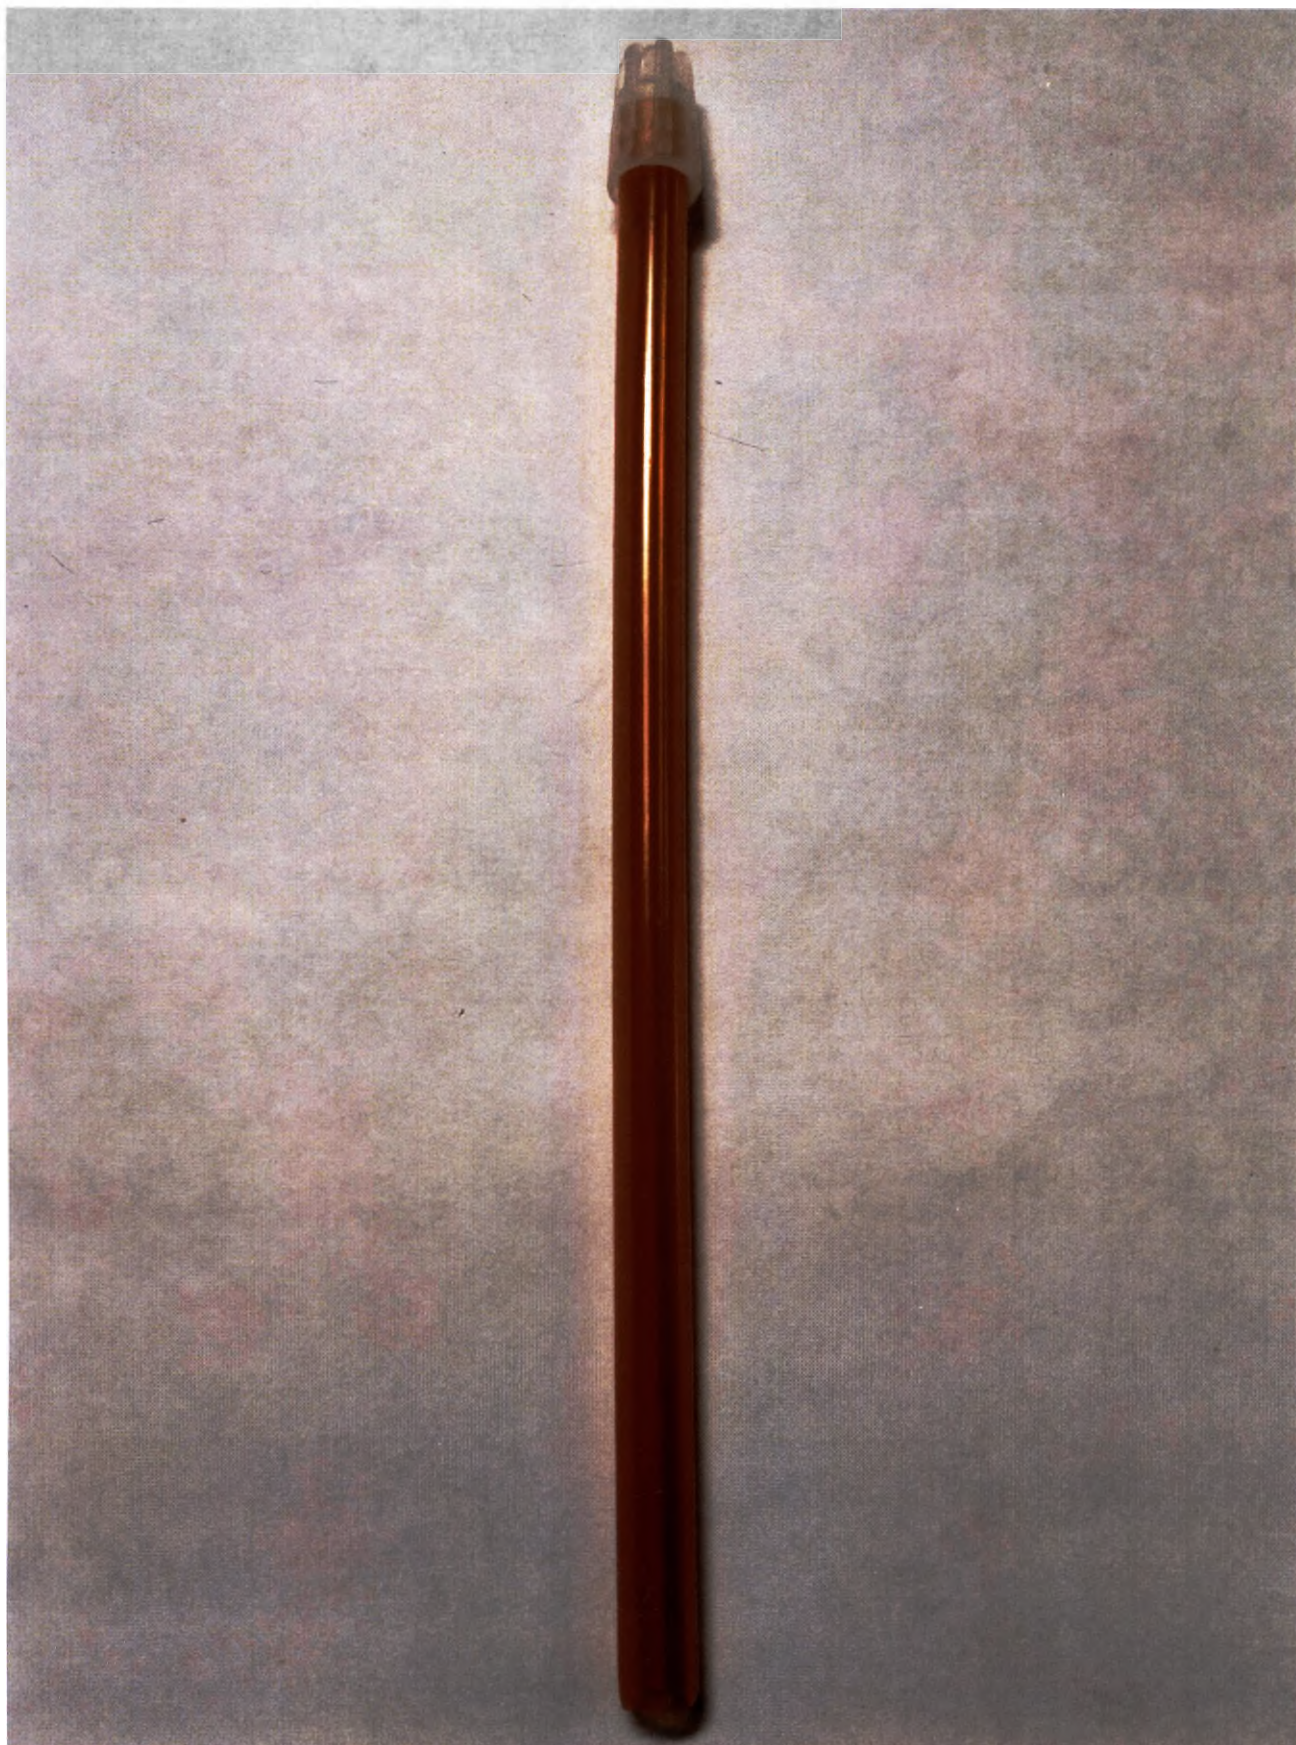

Наконечники для слюноотсосов стоматологические одноразовые DENTAL FORMULA® со съемным колпачком, длина 15 см, цвет: зеленый.

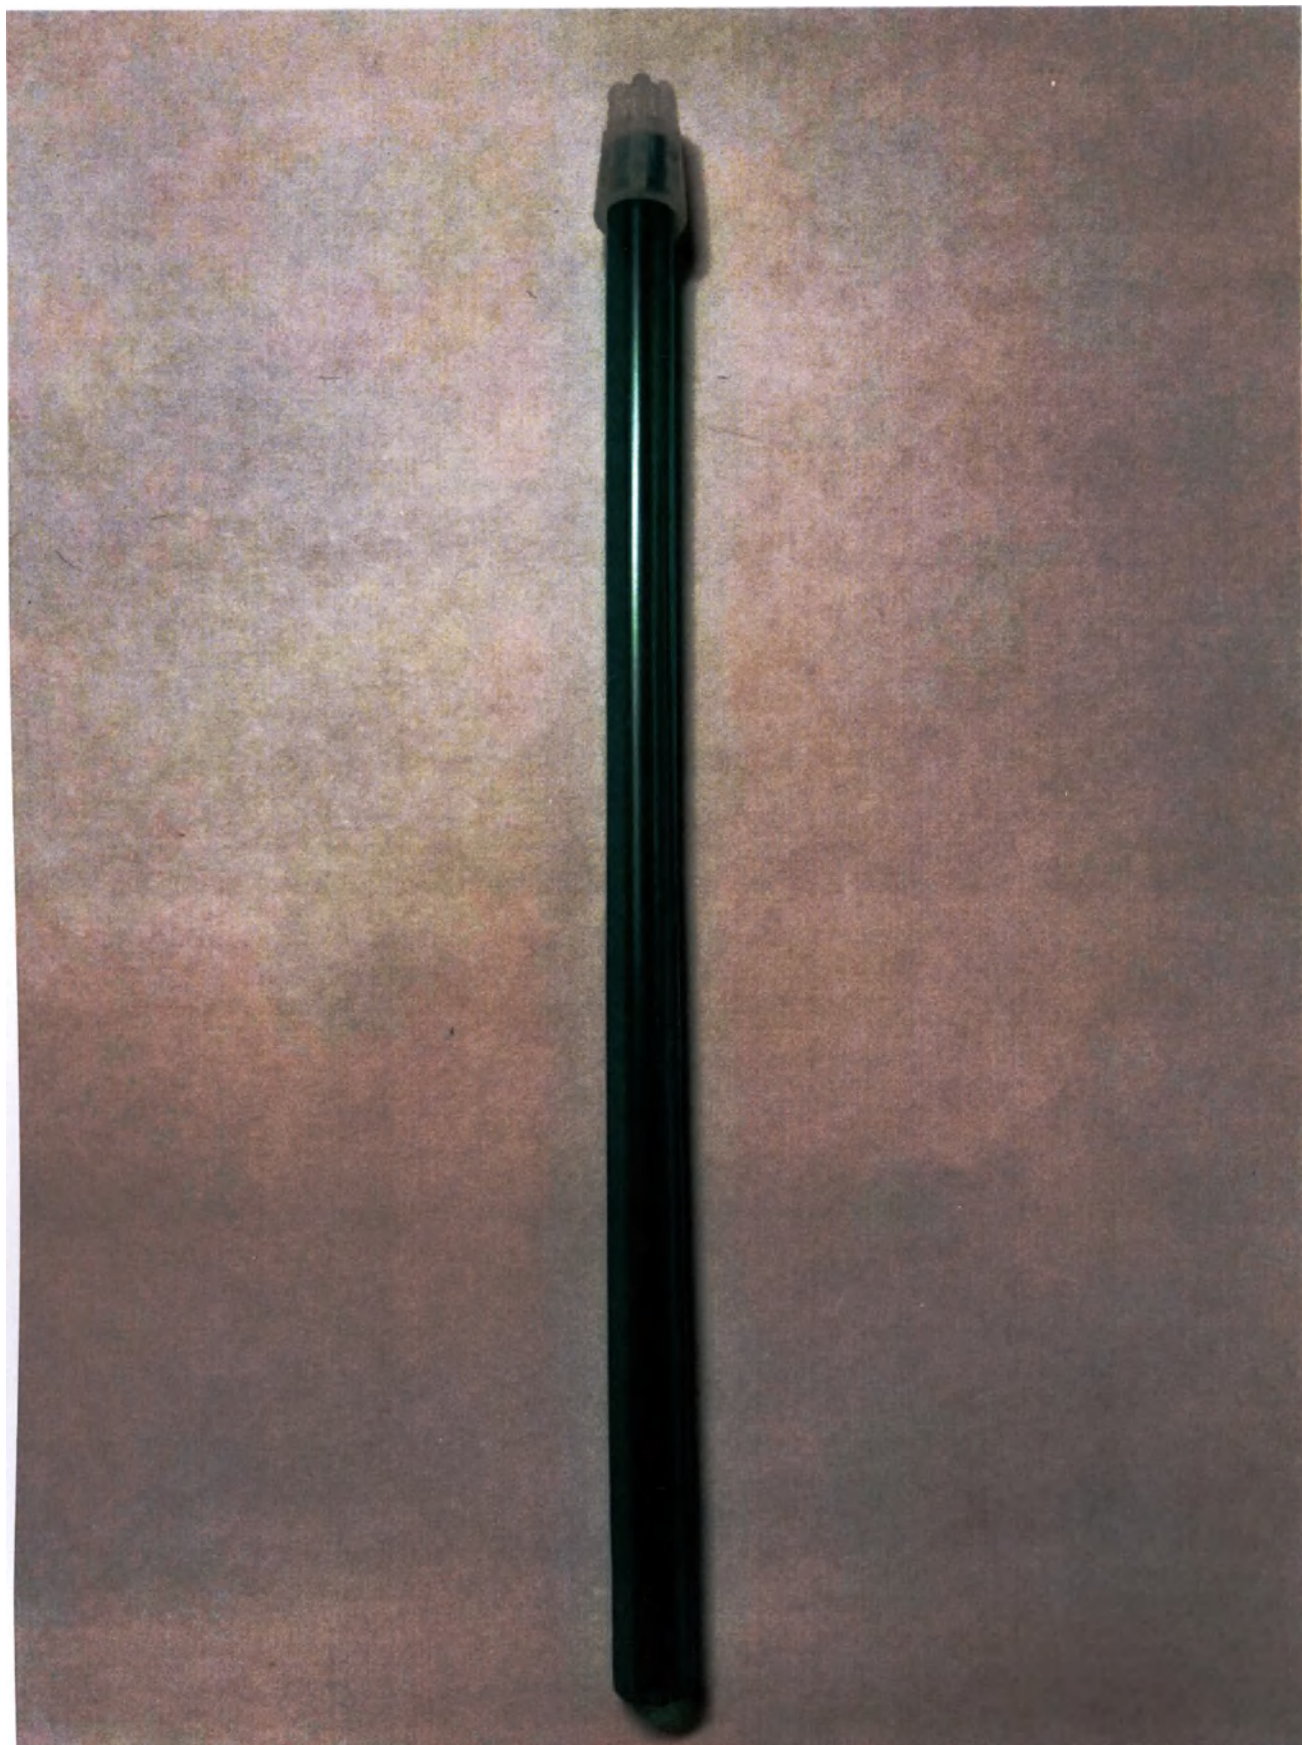

Наконечники для слюноотсосов стоматологические одноразовые DENTAL FORMULA® со съемным колпачком, длина 15 см, цвет: мятно-зеленый.

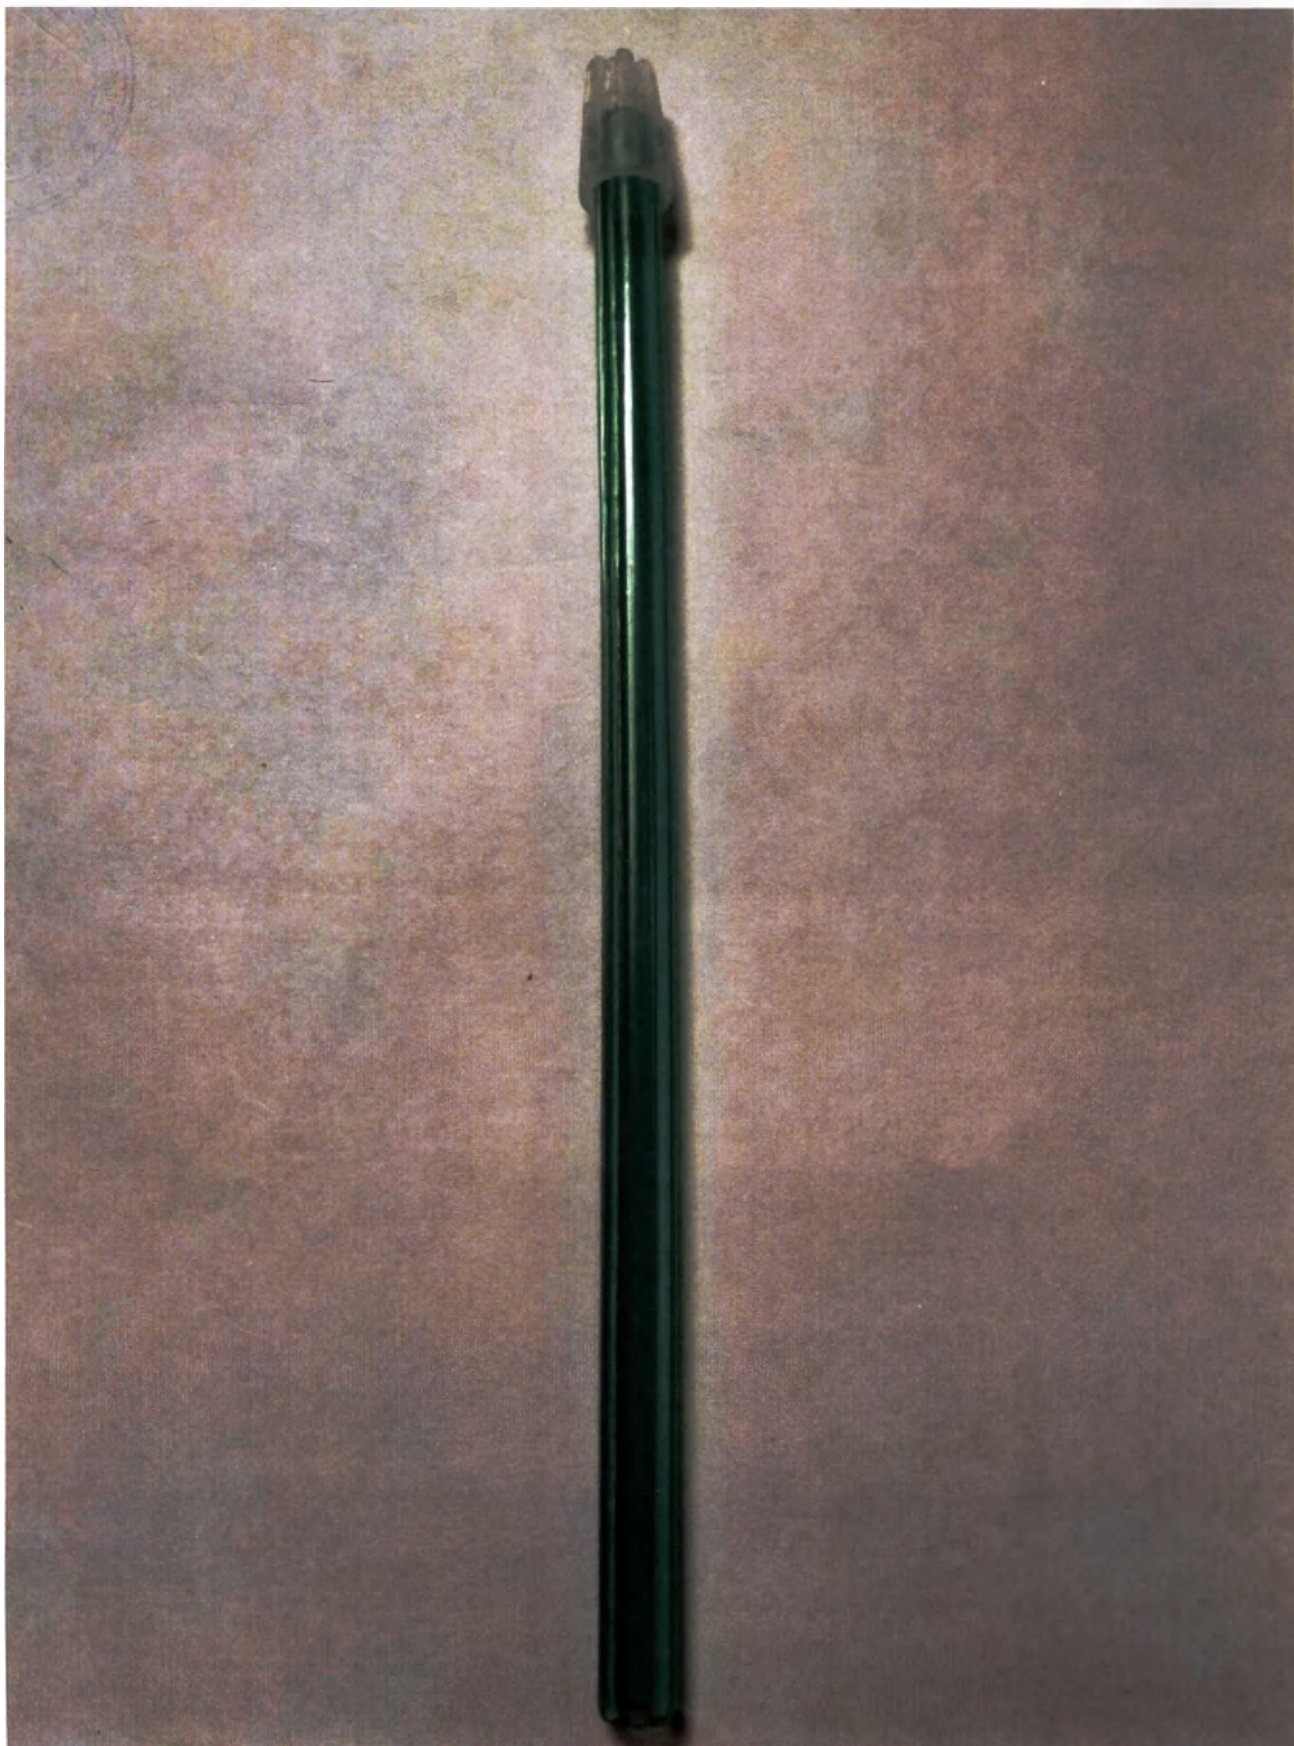

Всего прошито и скреплено

печатью 9 листа/об/

Управляющий Исполнительной

Потак В.В.

