

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО НТО «ИРЭ-Полус»

Евтихий Н.Н.

2022 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


на медицинское изделие

Аппарат лазерный медицинский «FiberLase DG» по ТУ 26.60.13-062-18003536-2021



Аппарат лазерный медицинский «FiberLase DG» по ТУ 26.60.13-062-18003536-2021

Вид спереди

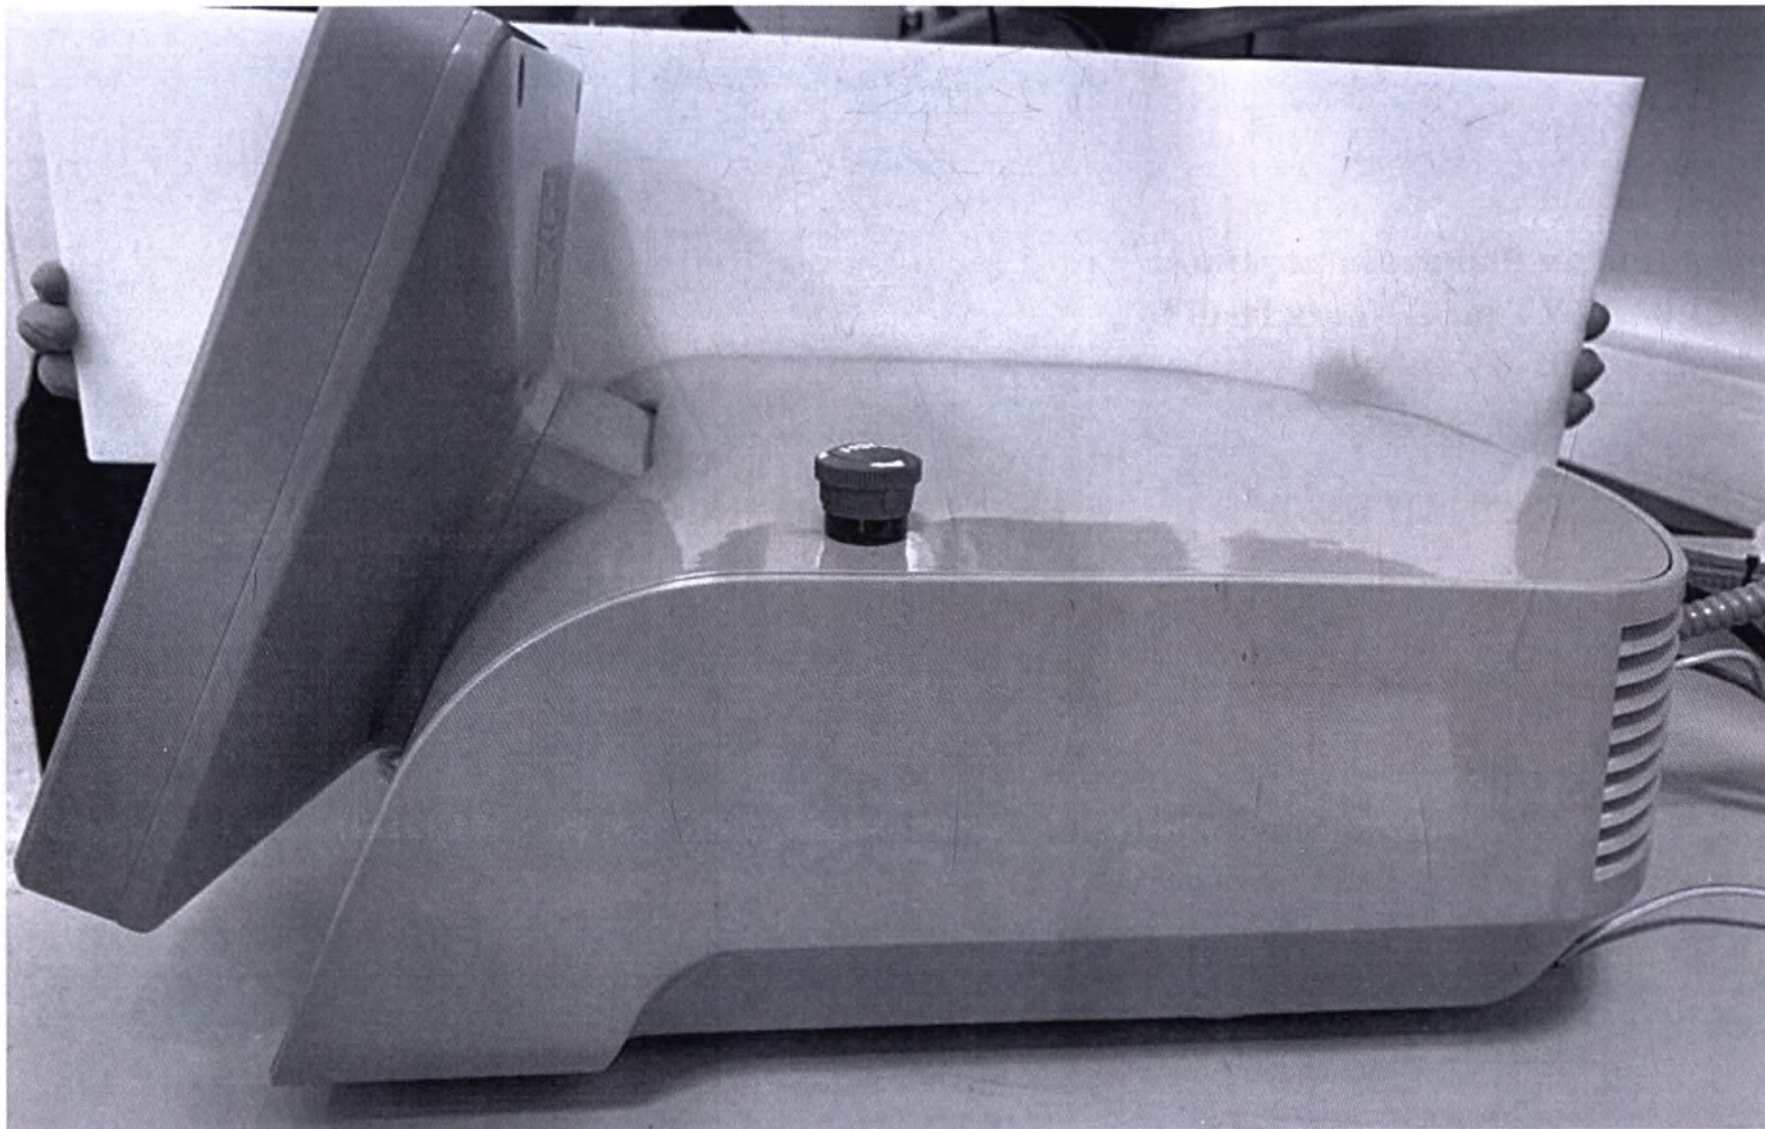


Аппарат лазерный медицинский «FiberLase DG» по ТУ 26.60.13-062-18003536-2021
Вид сбоку




**Аппарат лазерный медицинский
«FiberLase DG» по ТУ 26.60.13-062-
18003536-2021**

Вид сзади

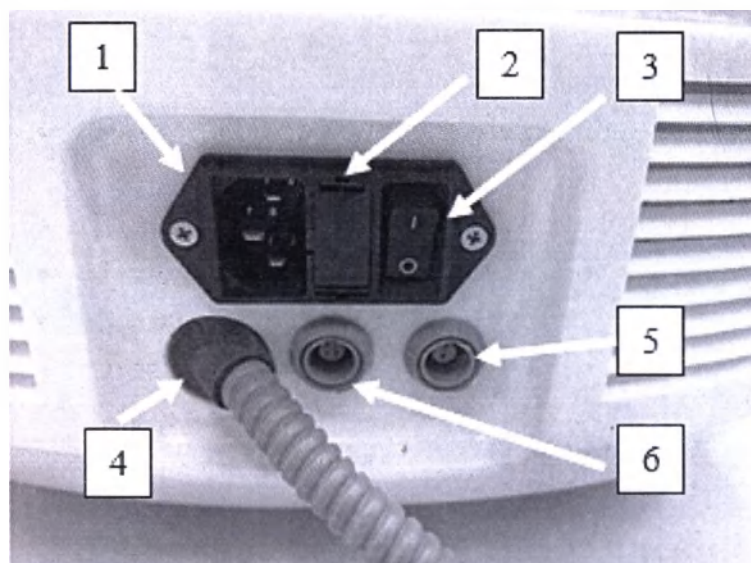


- Разъем подключения электропитания (1)
- Вставки плавкие (2);
- Тумблер включения (3);
- Место соединения Аппликатора (4);
- Разъем для подключения удаленной блокировки (5);
- Разъем подключения ножной педали (6).

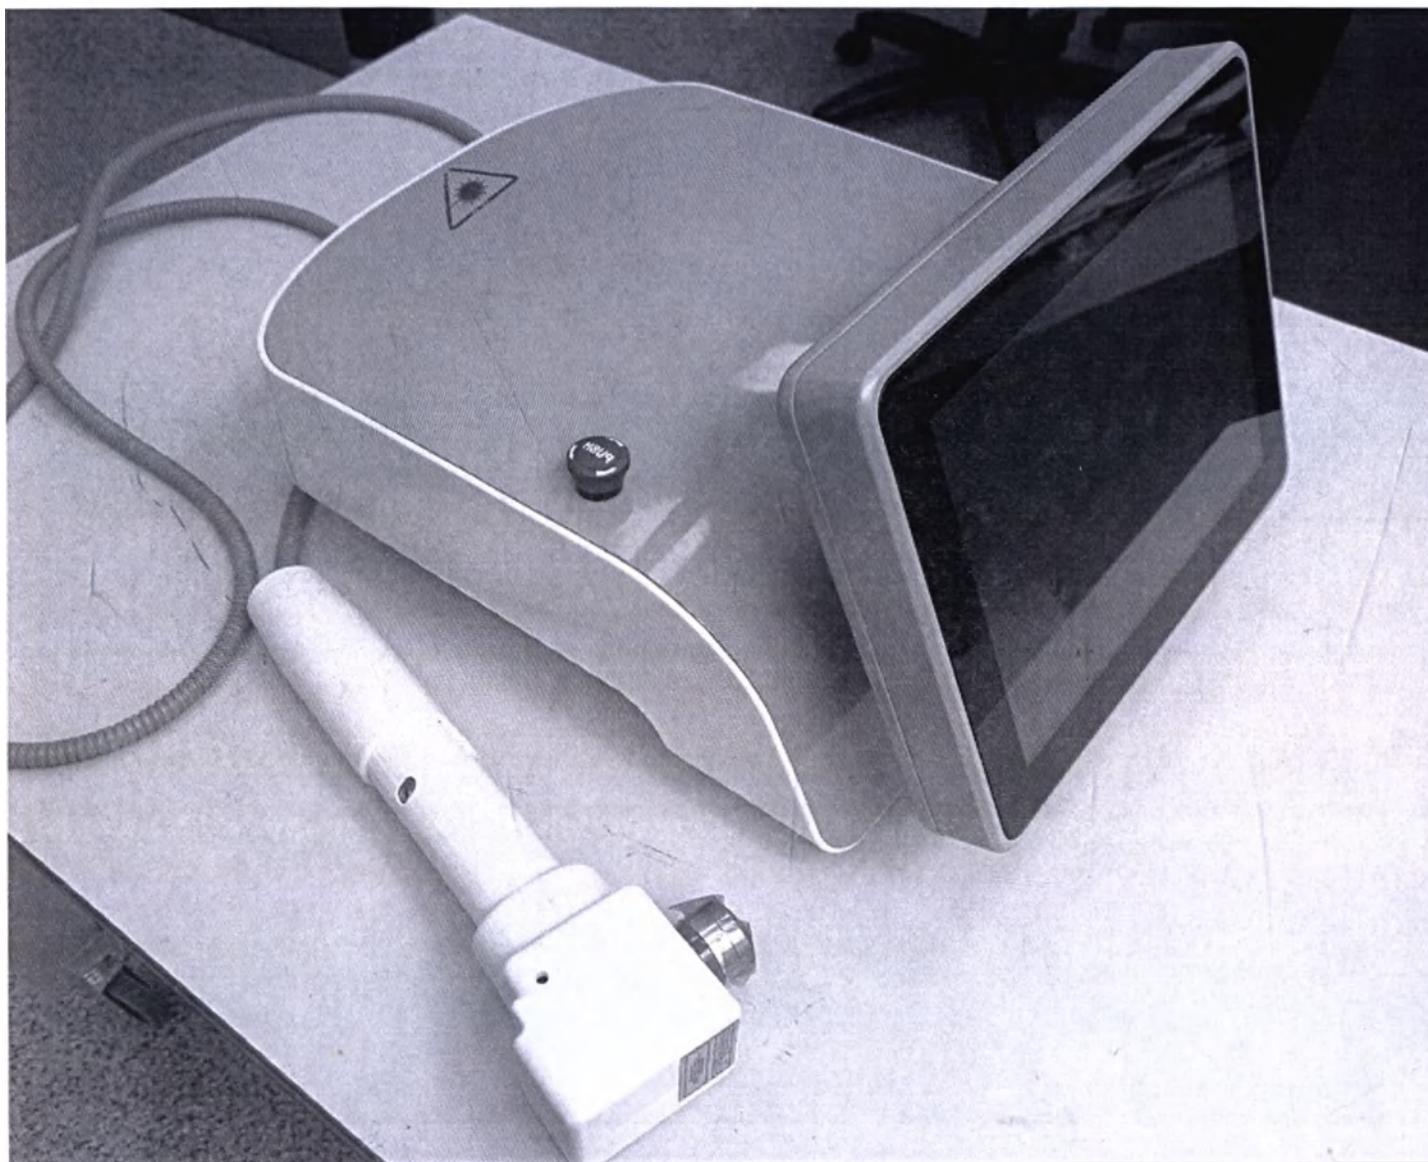

Аппарат лазерный медицинский «FiberLase DG» по ТУ 26.60.13-062-18003536-2021

Вид сверху

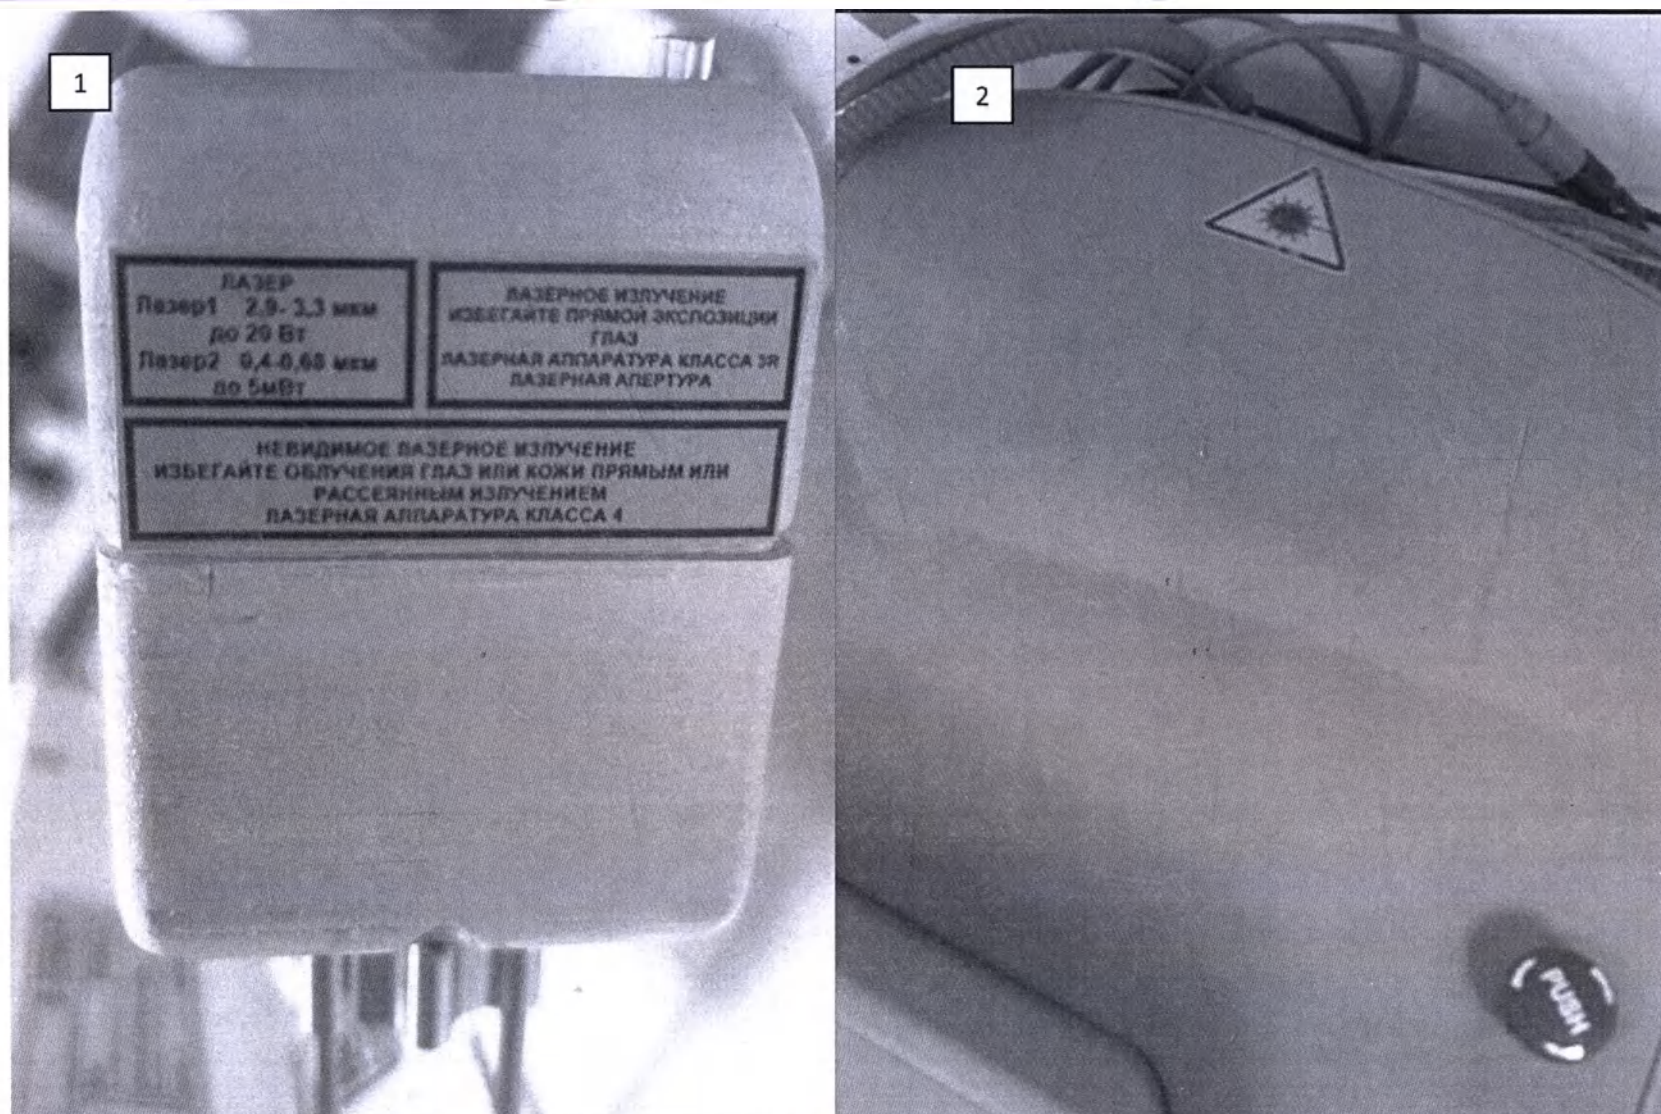


Аппарат лазерный медицинский «FiberLase DG» по ТУ 26.60.13-062-18003536-2021

Маркировка места вывода излучения (аппликатор) (1) и знака лазерной опасности (корпус) (2)

Аппарат лазерный медицинский «FiberLase DG»
по ТУ 26.60.13-062-18003536-2021



210701067




2022 г.

Параметры питания: $220 \pm 10\%$, 50_60 Гц, 400 ВА
Рабочий цикл: Непродолжительный
Вкл/Выкл: 60/15 мин




ООО «НТО ИРЭ-Полюс»
141195, Российская Федерация, Московская
область, городской округ Фрязино г. Фрязино,
пл. имени академика Б.А. Введенского, д.3, стр.5



IPX2

Аппарат лазерный медицинский «FiberLase DG» по ТУ 26.60.13-062-18003536-2021

Маркировка корпуса аппарата

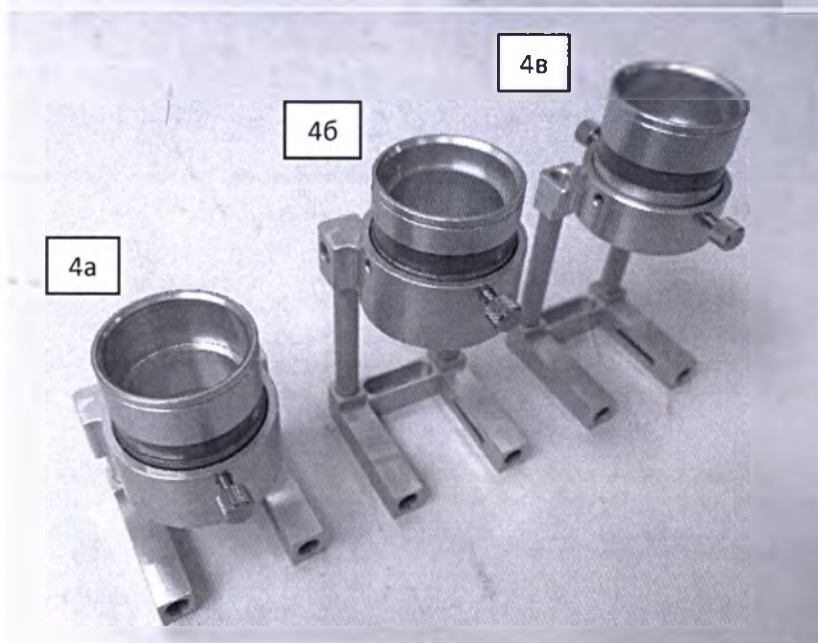

1. Педаль включения излучения
2. Заглушка внешней блокировки
3. Аппликатор гинекологический

- 4а Дистантер S
- 4б Дистантер М
- 4в Дистантер L
5. Очки защитные от воздействия лазерного излучения, LSM-ERL-2, в чехле



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 8



ГИСТАРХ
ОБО ИТО-ИРЭ-ПОЛЮС
ЕВТИХИЕВ Н.Н.

