

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Система для рентгенографии и рентгеноскопии с
дистанционным управлением ZEXIRA (DREX-
ZX80) с принадлежностями***

Производства

"Канон Медикал Системз Корпорейшн"

Canon Medical Systems Corporation

**1385 Shimoishigami, Otawara-shi, Tochigi, 324-8550,
Japan**




CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION

1385 SHIMOISHIGAMI, OTAWARA-SHI, TOCHIGI, 324-8550,
JAPAN


**Система для рентгенографии и рентгеноскопии с
дистанционным управлением ZEXIRA (DREX-ZX80) с
принадлежностями**

Уполномоченный представитель производителя в России:
ООО «АрПи Канон Медикал Системз»
119421, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Обручевский, Ленинский проспект, д. 111, к.1, этаж 5, ком. 129


Сделано в Японии

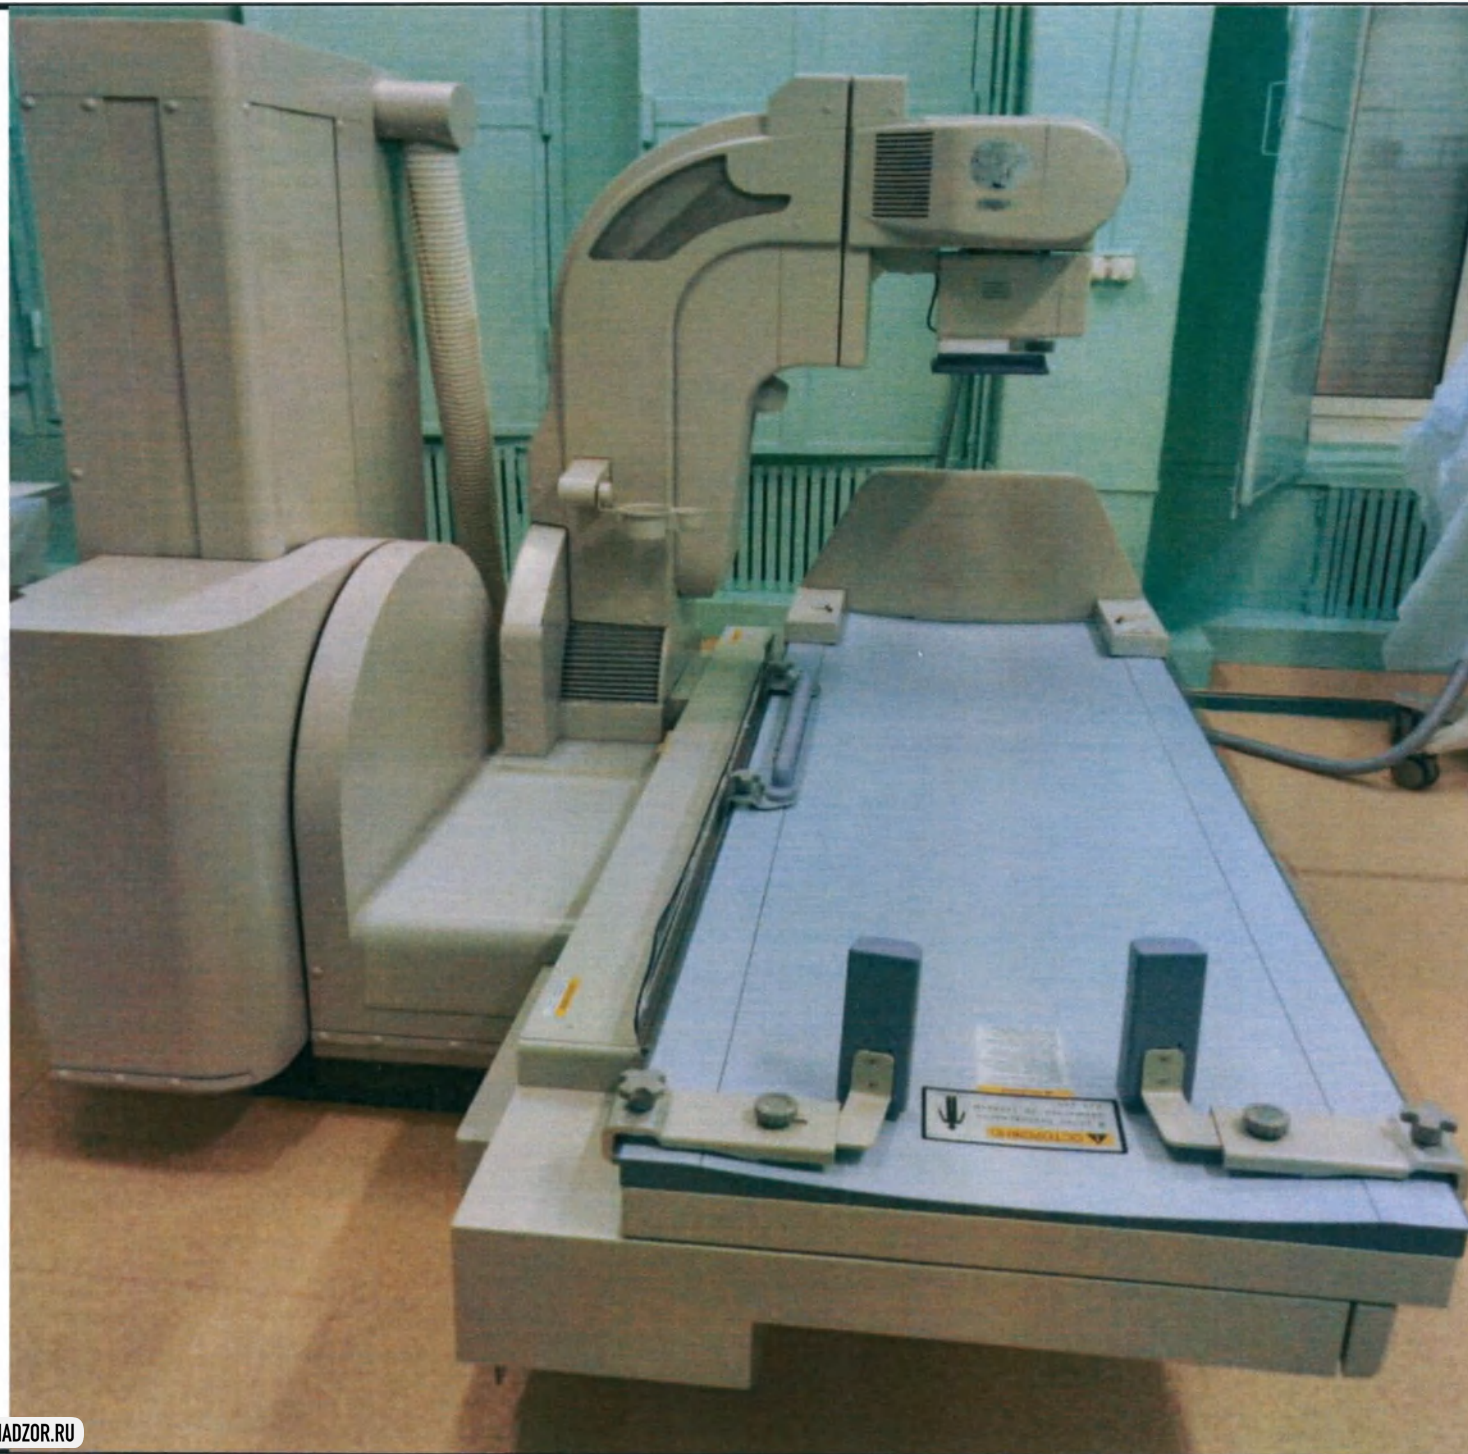


Основной состав: 1. Рентгеновский диагностический стол с дистанционным управлением (DBZ-8000A) производства Canon Medical Systems Corporation, Япония – 1 комплект: - Основной модуль рентгеновского диагностического стола, 1 шт.;

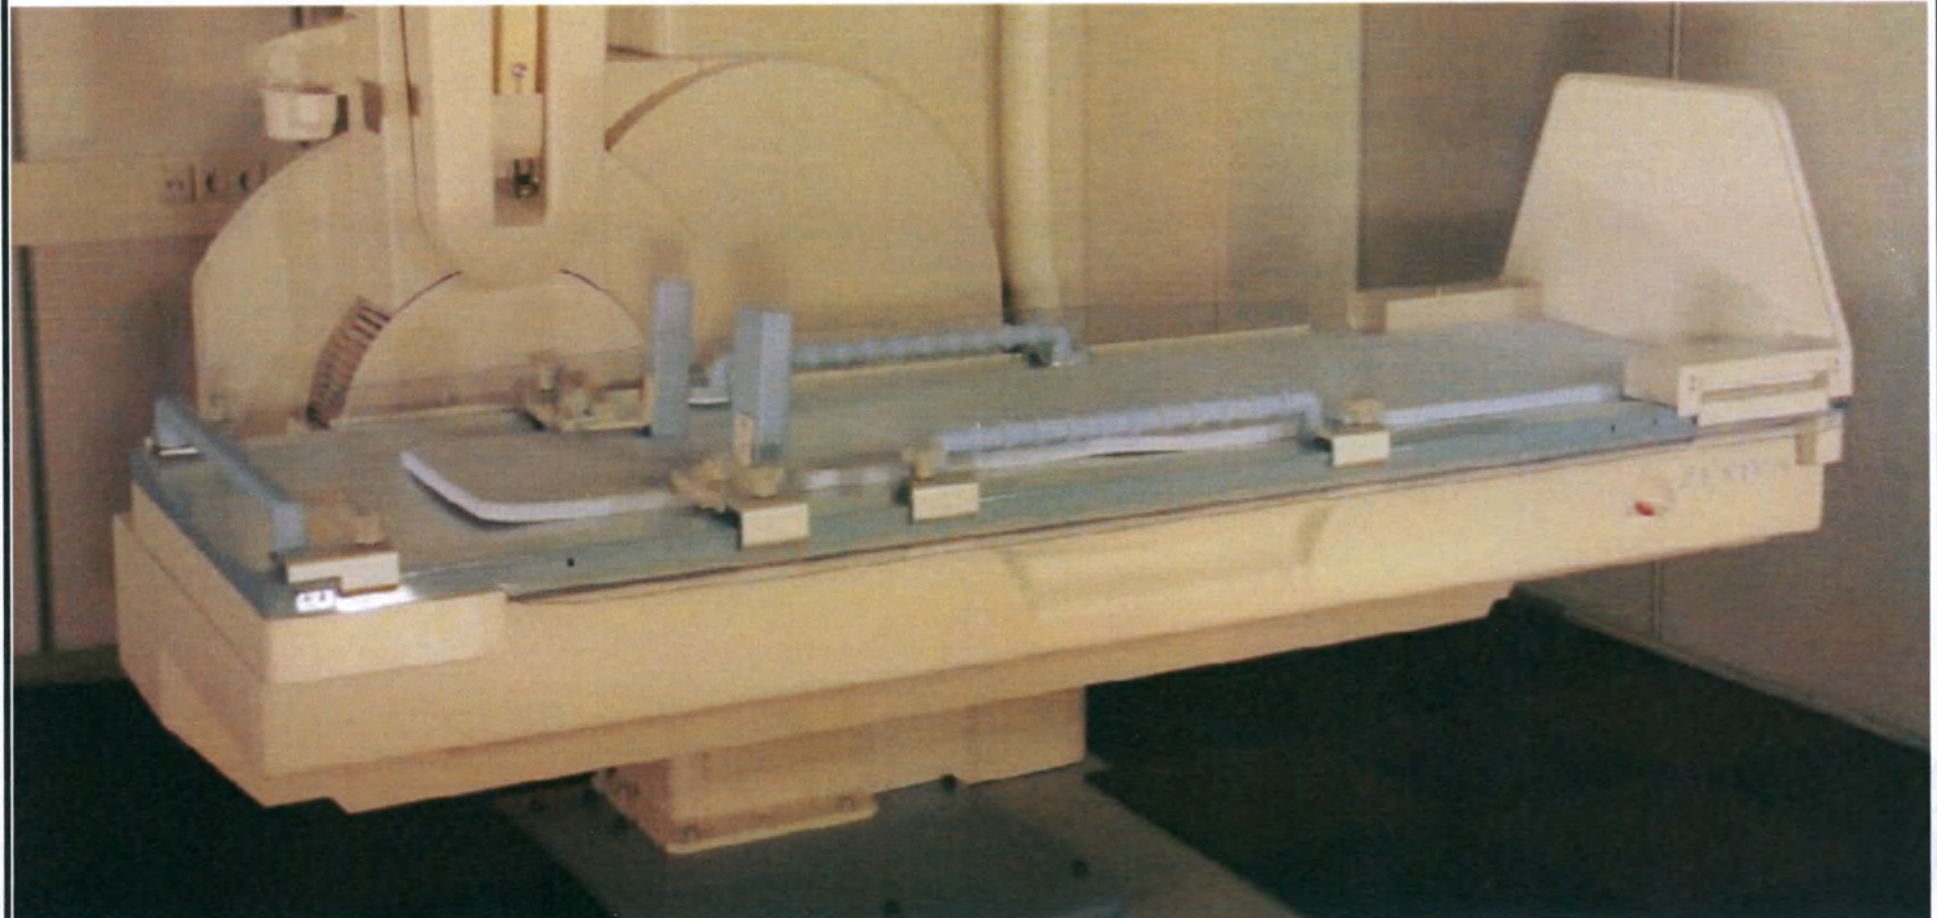


- Опора для ног, 1 шт.;

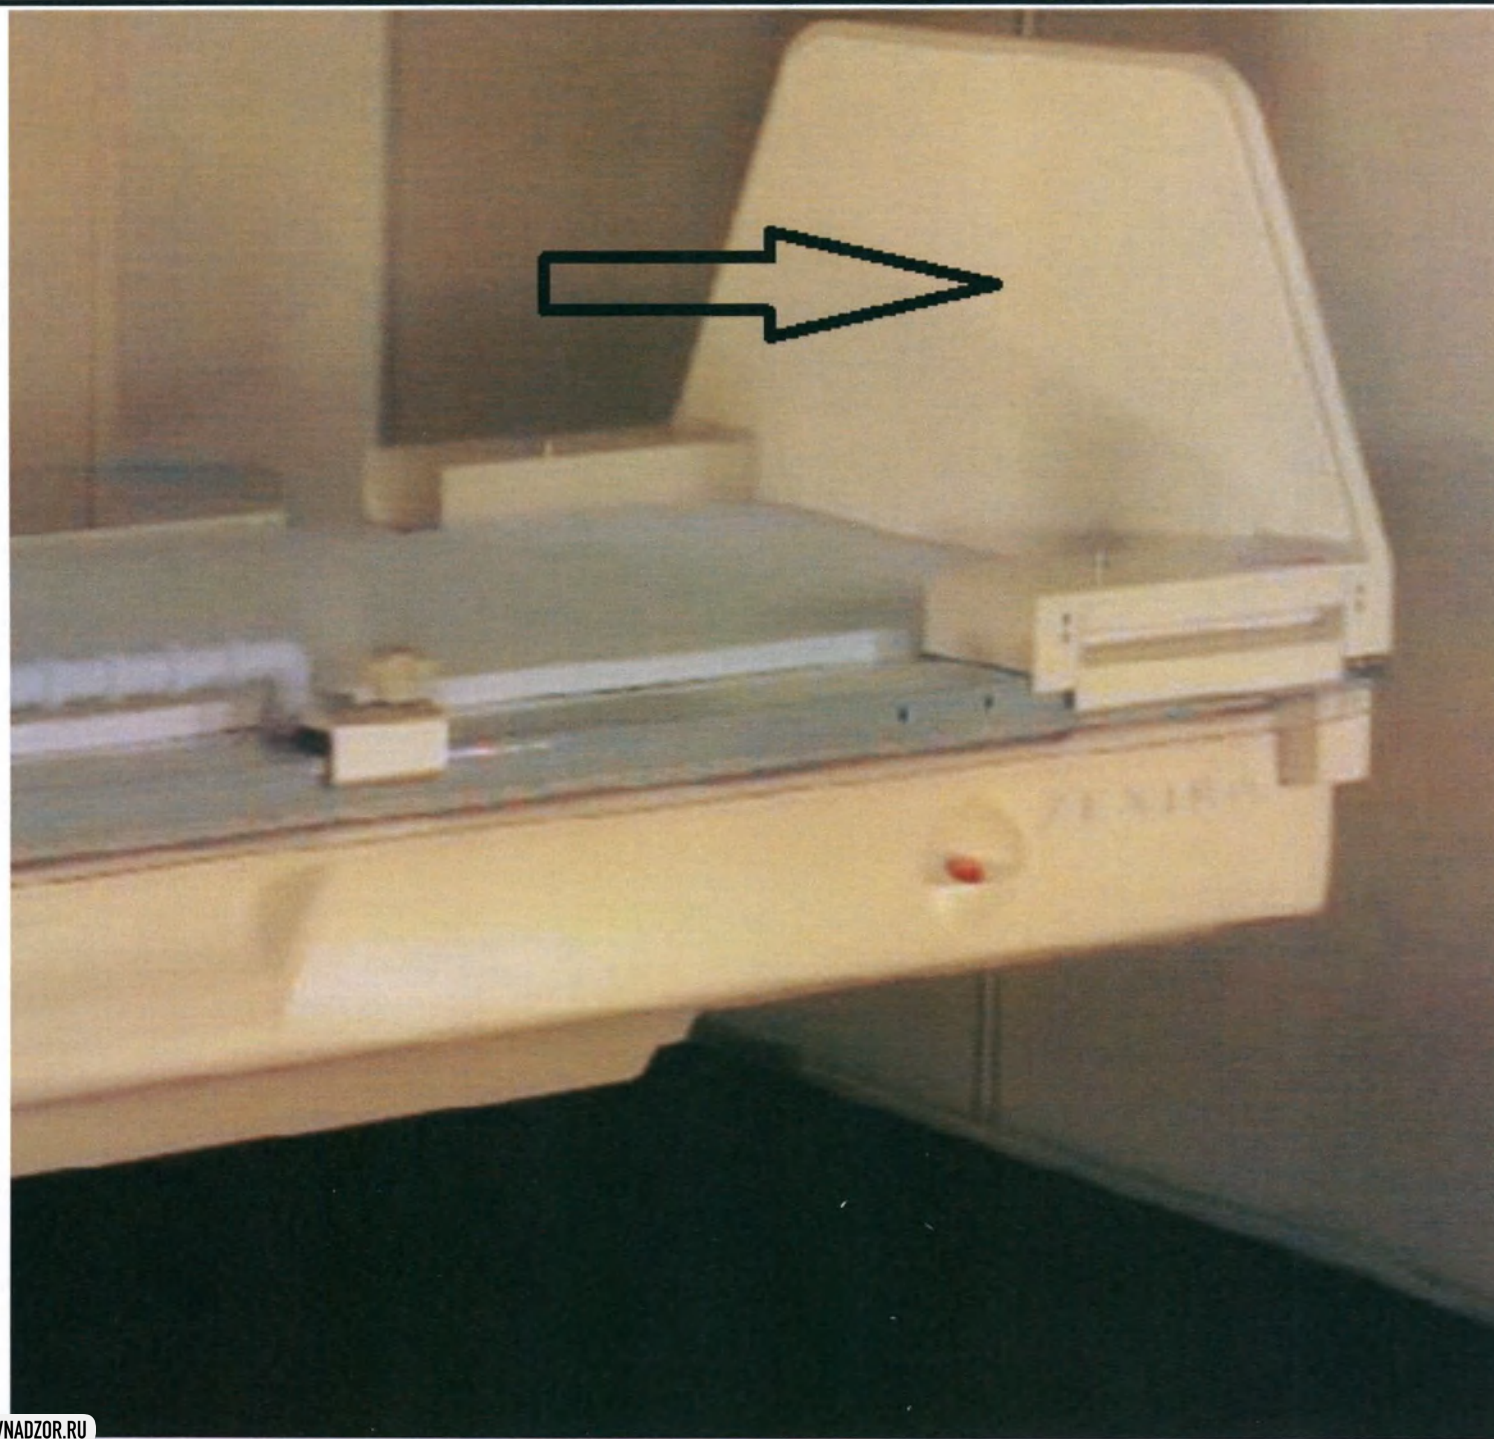


- Боковые поручни, 2 шт.;

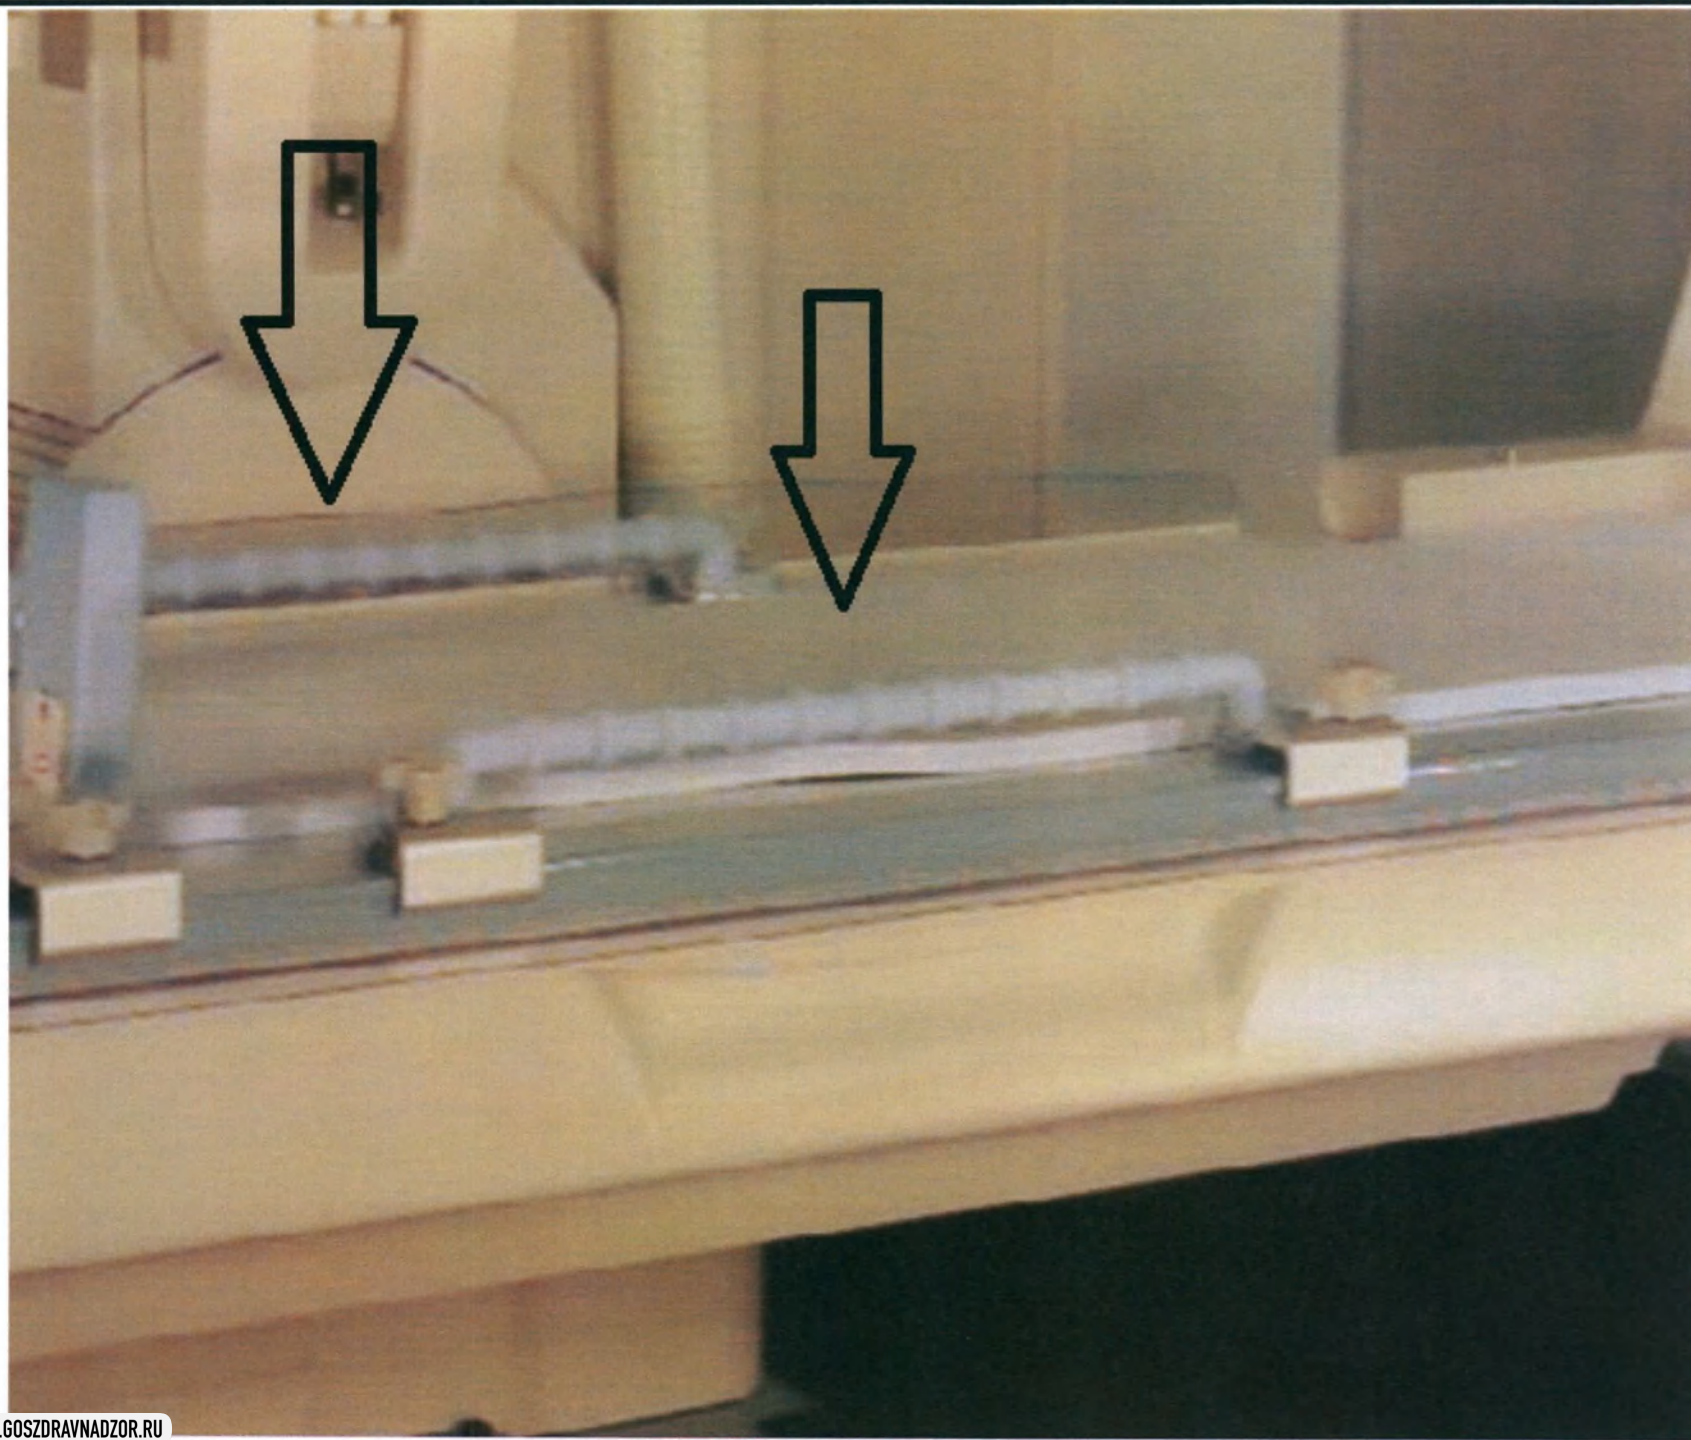


- Поручень в изголовье, 1 шт.;

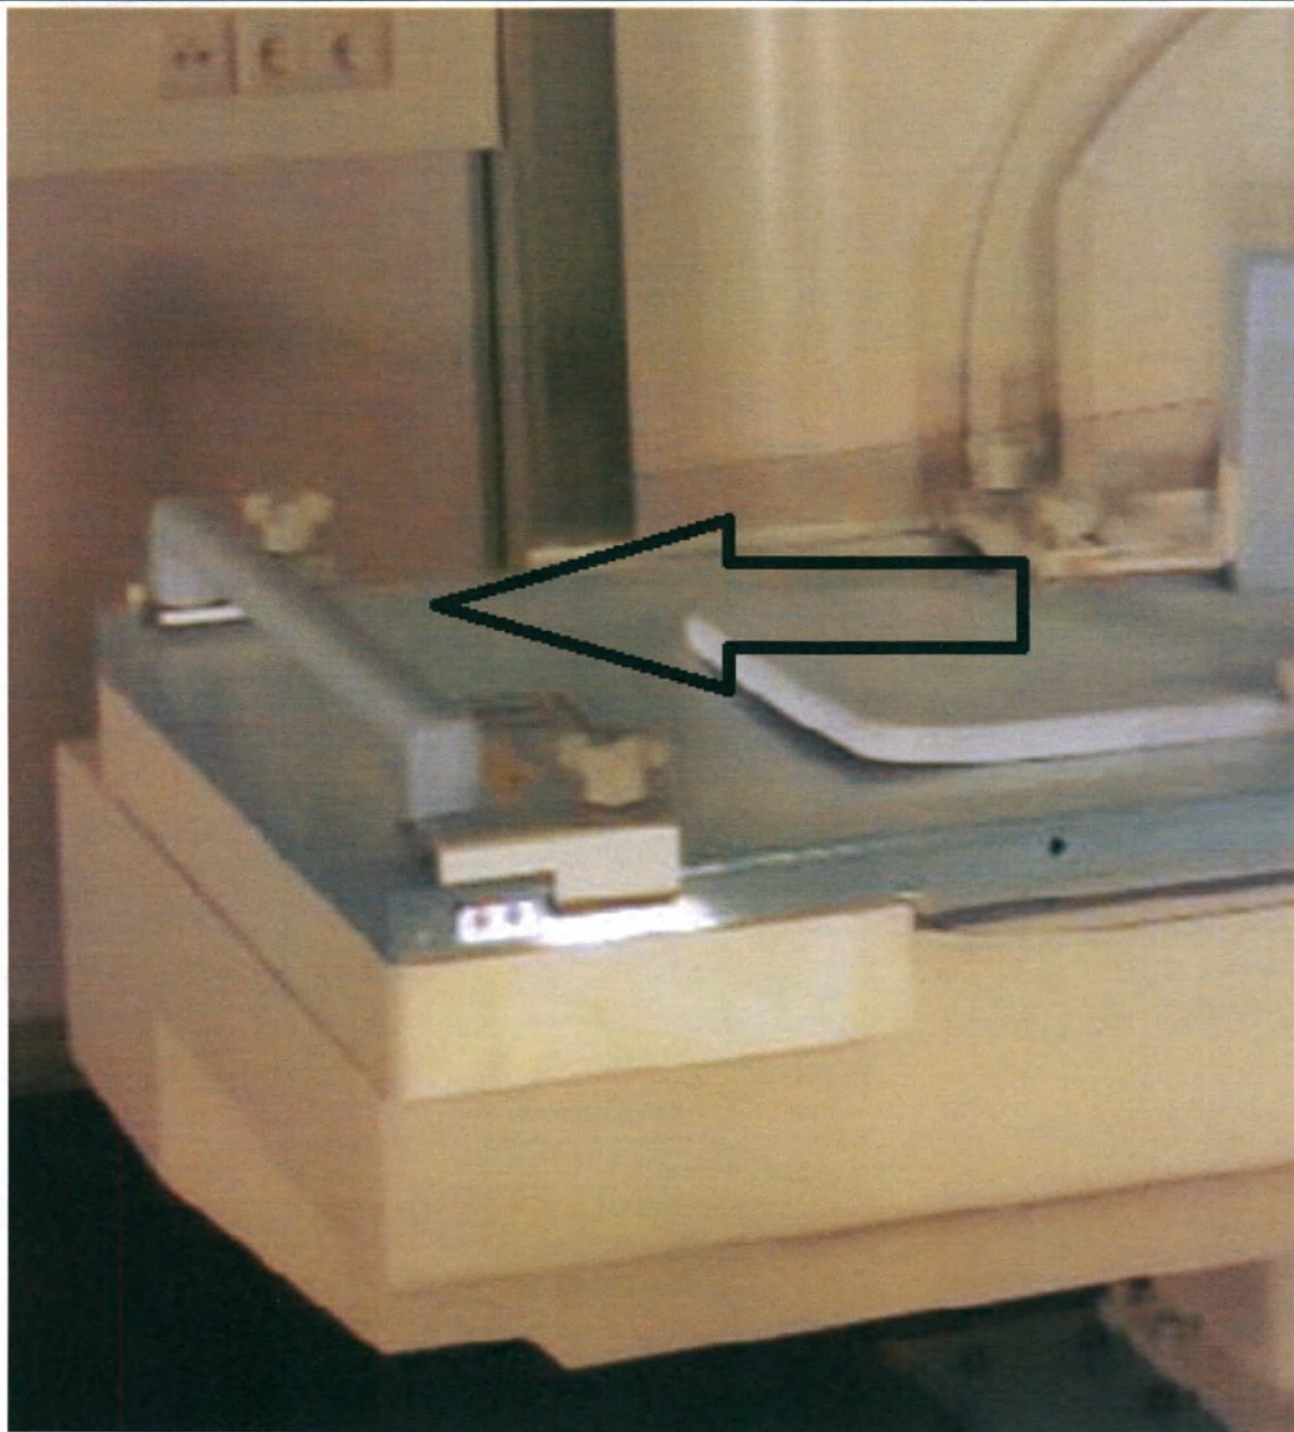


- Опоры для плеч, 2 шт.;

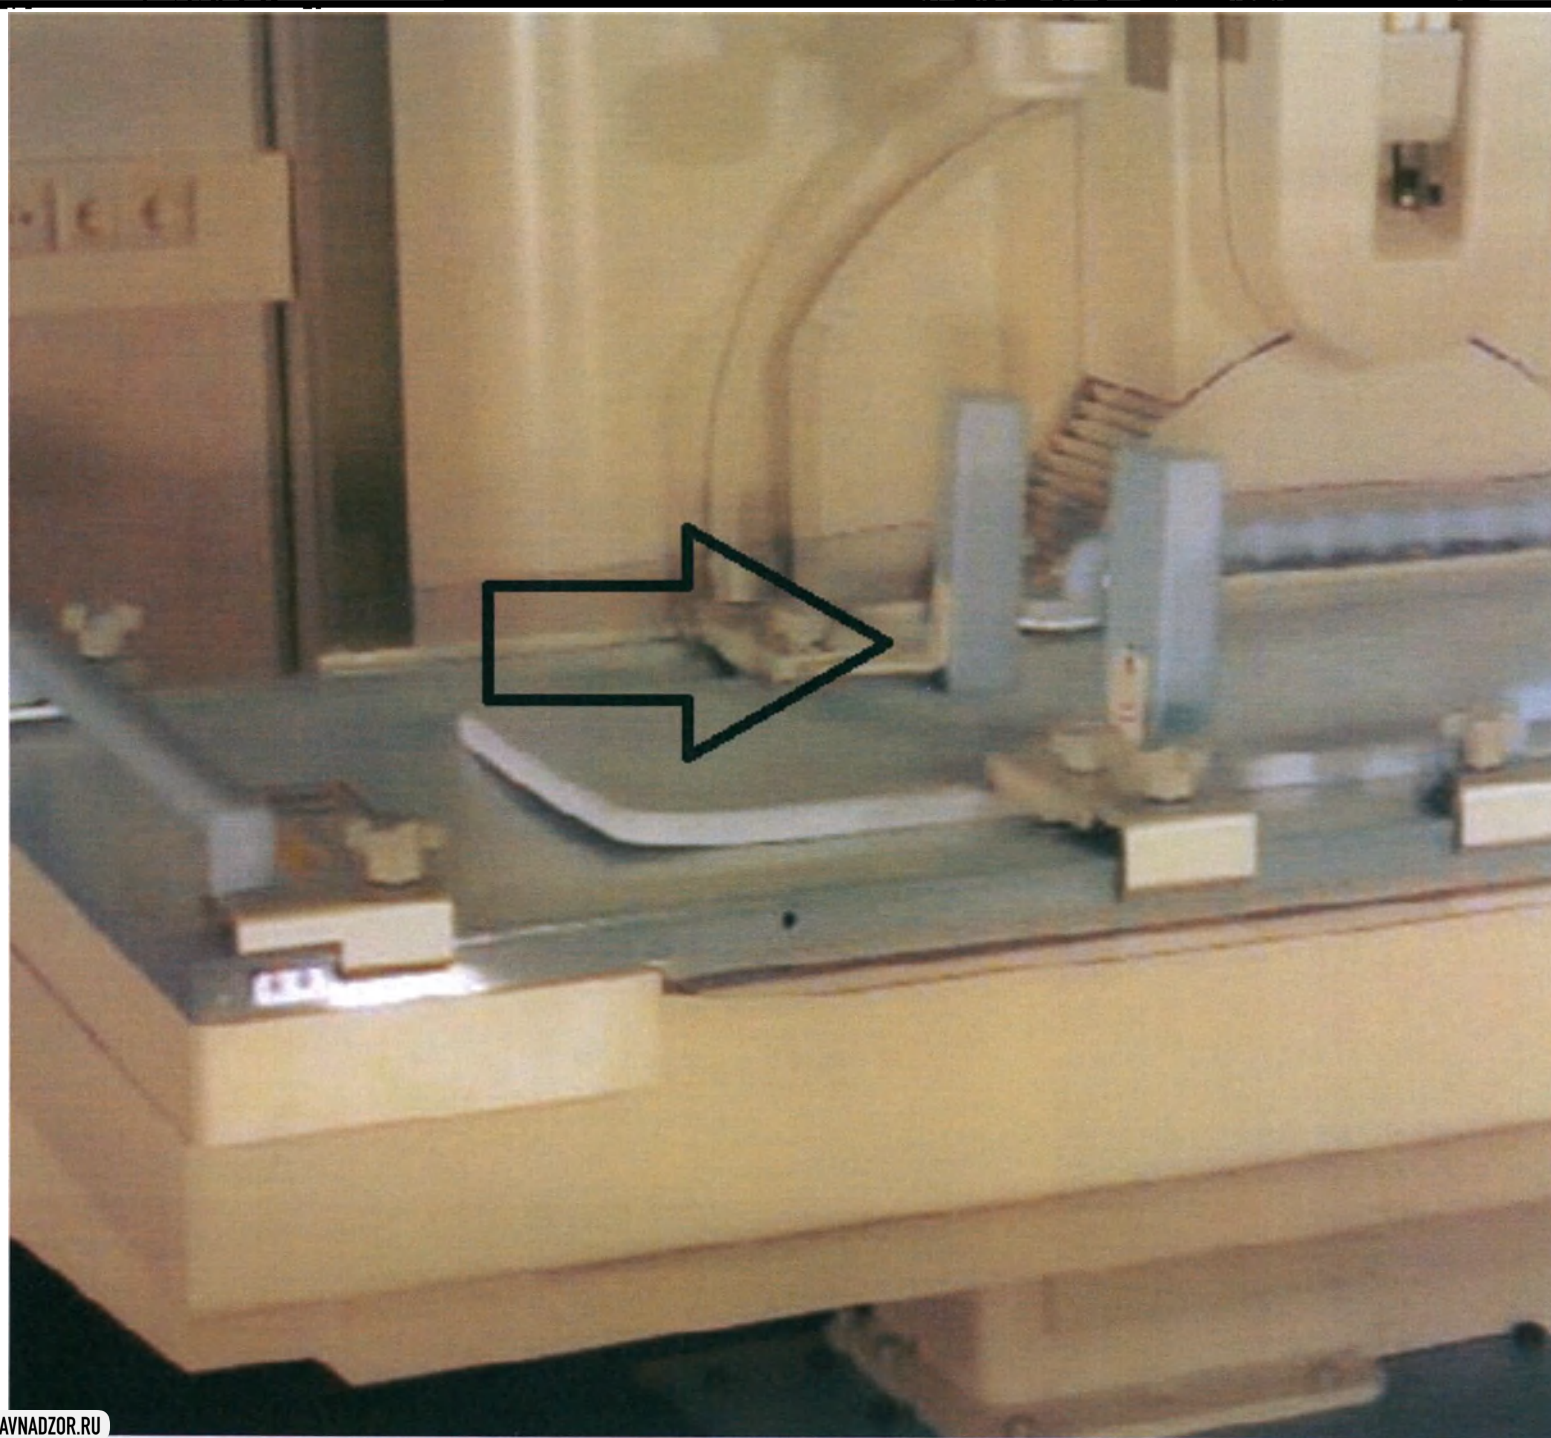

- Матрац для деки стола, 1 шт.;

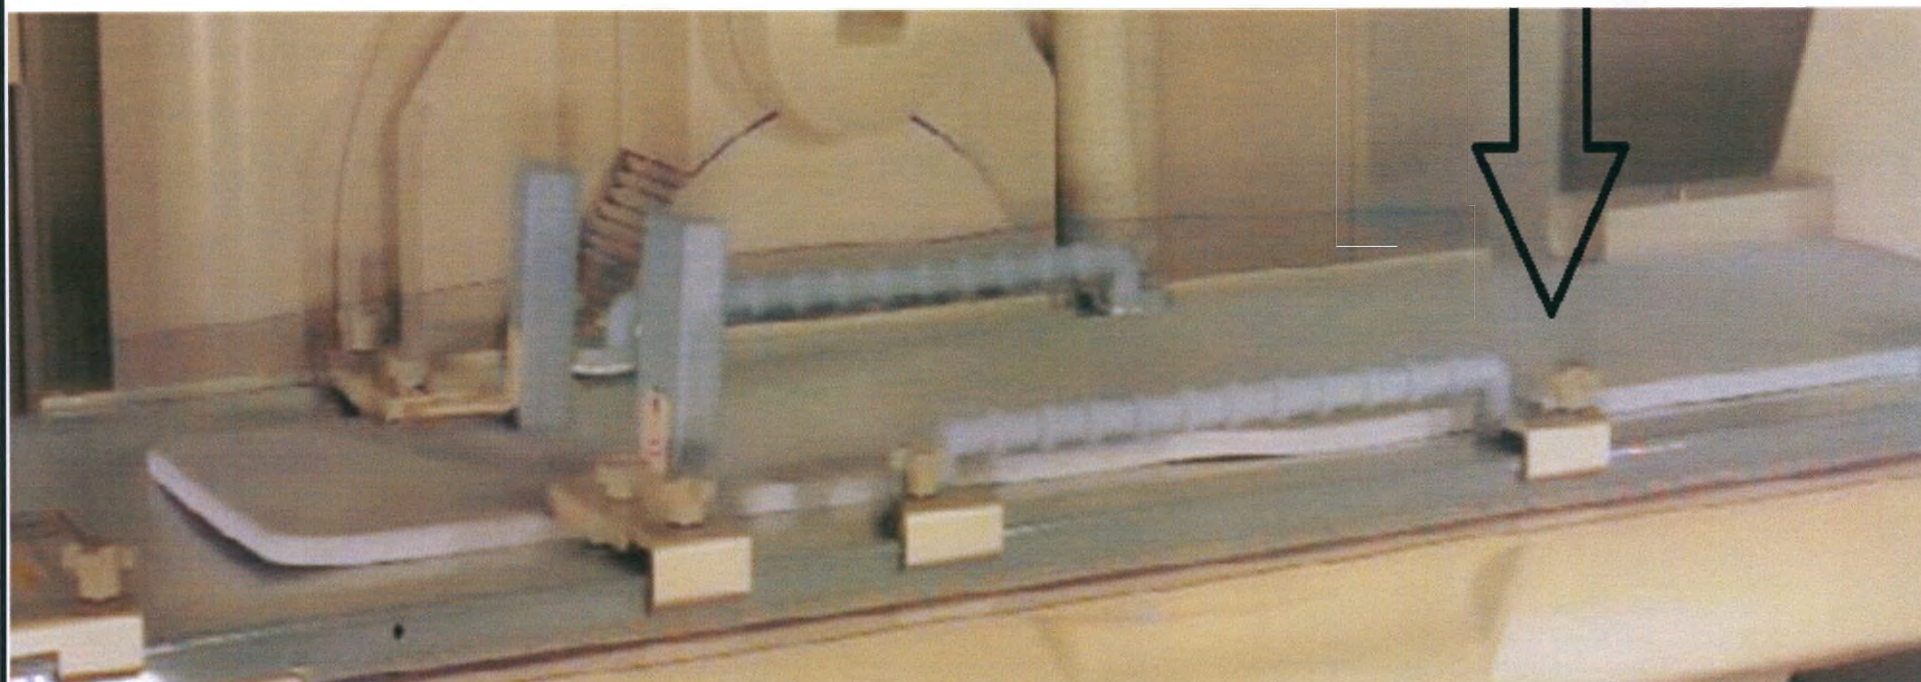


- Рентгеновский плоскостельный детектор (TFP-1700A), производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, 1 шт.;

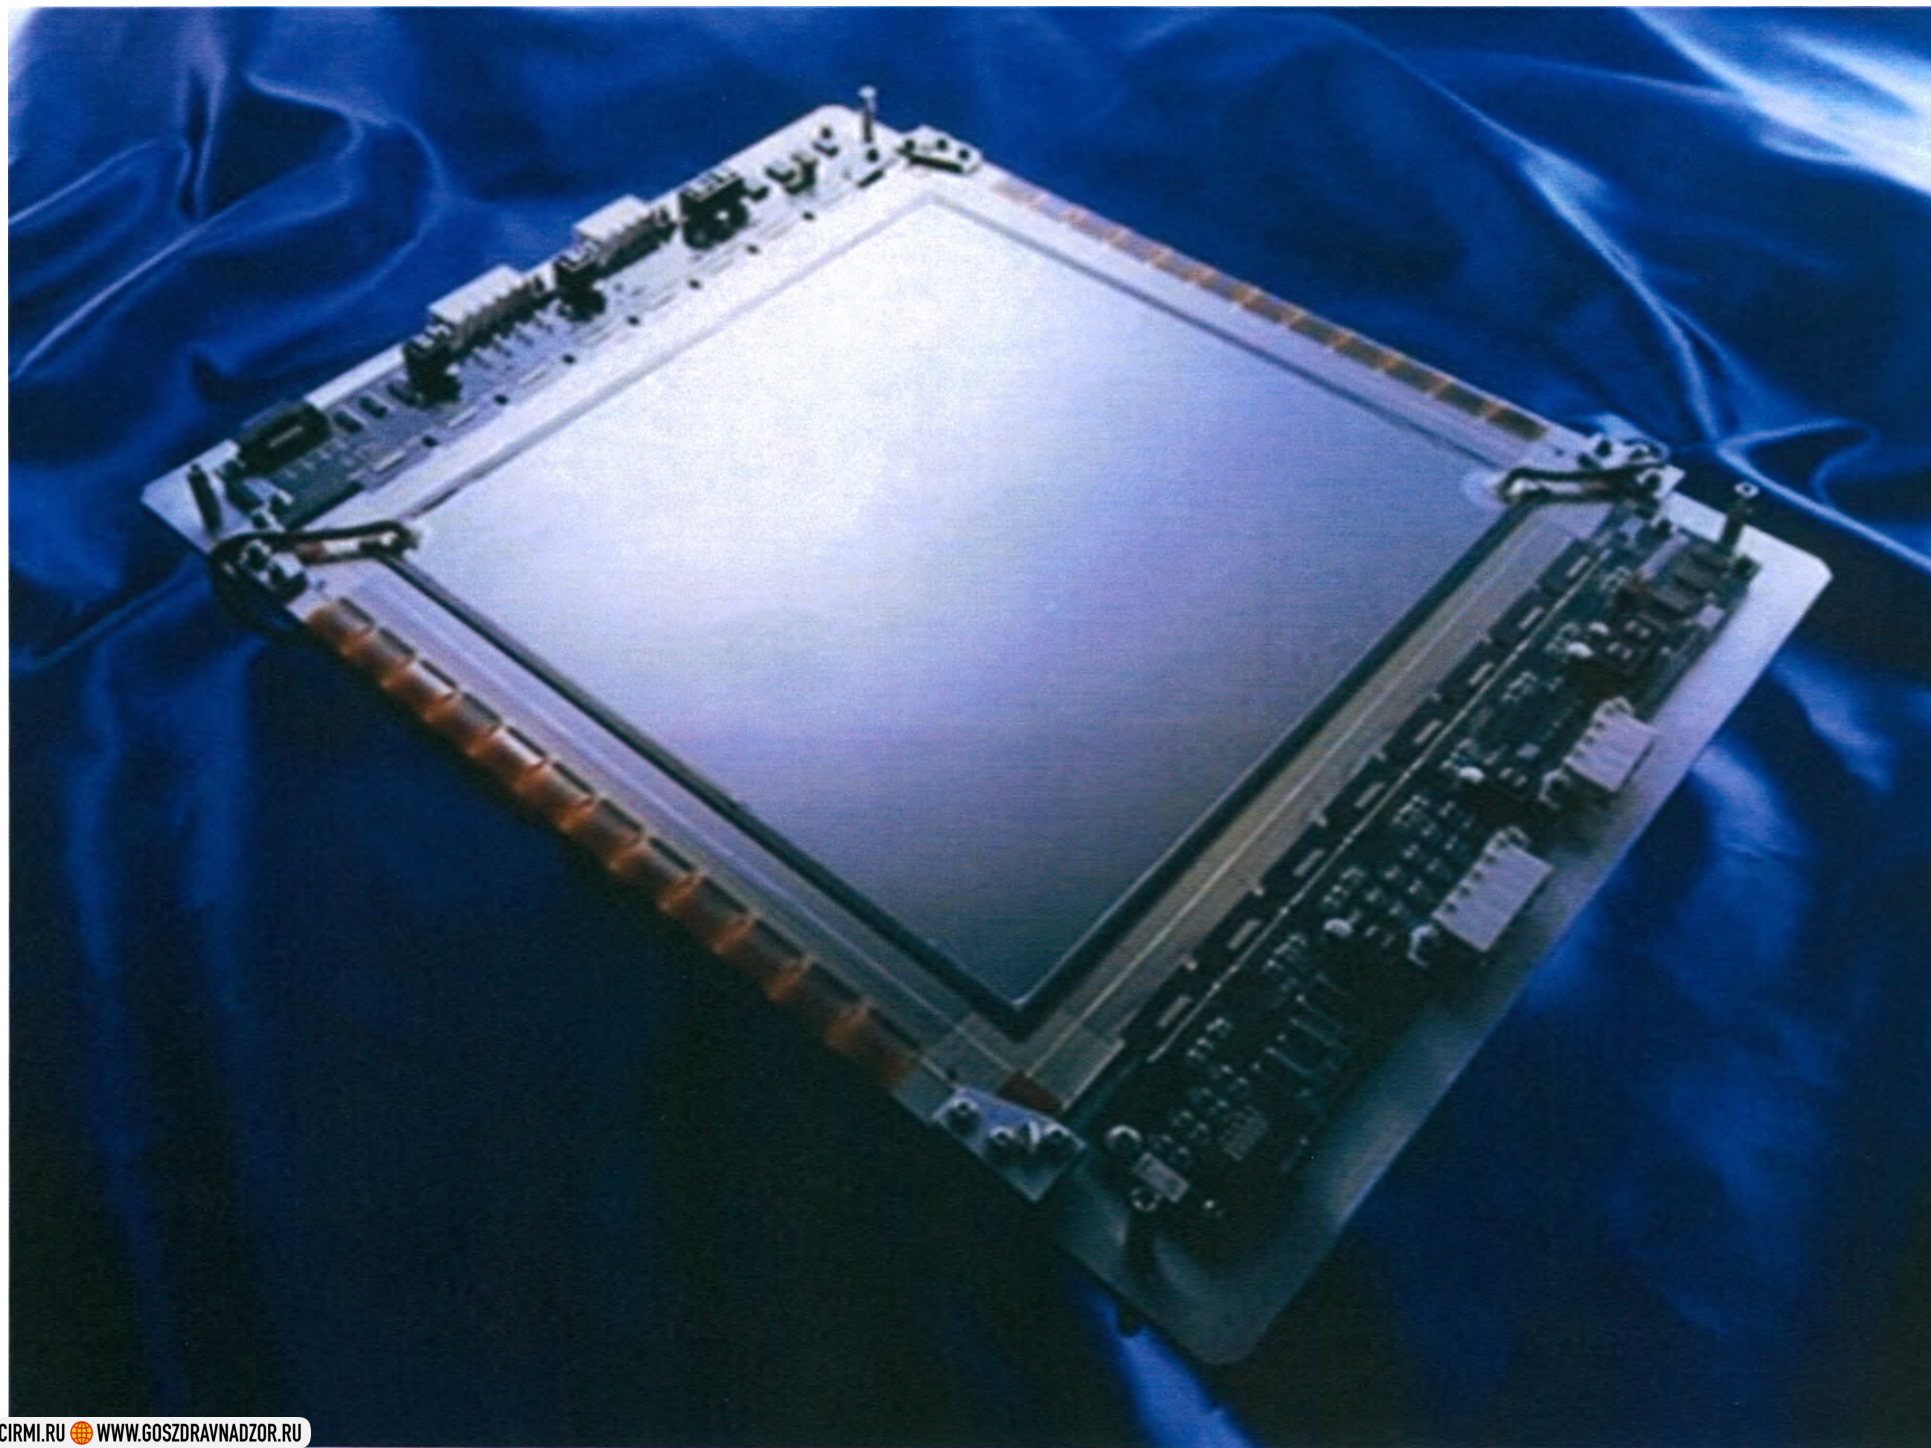


- Коллиматор пучка рентгеновского излучения (BLF-15B), производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, 1 шт.;


11

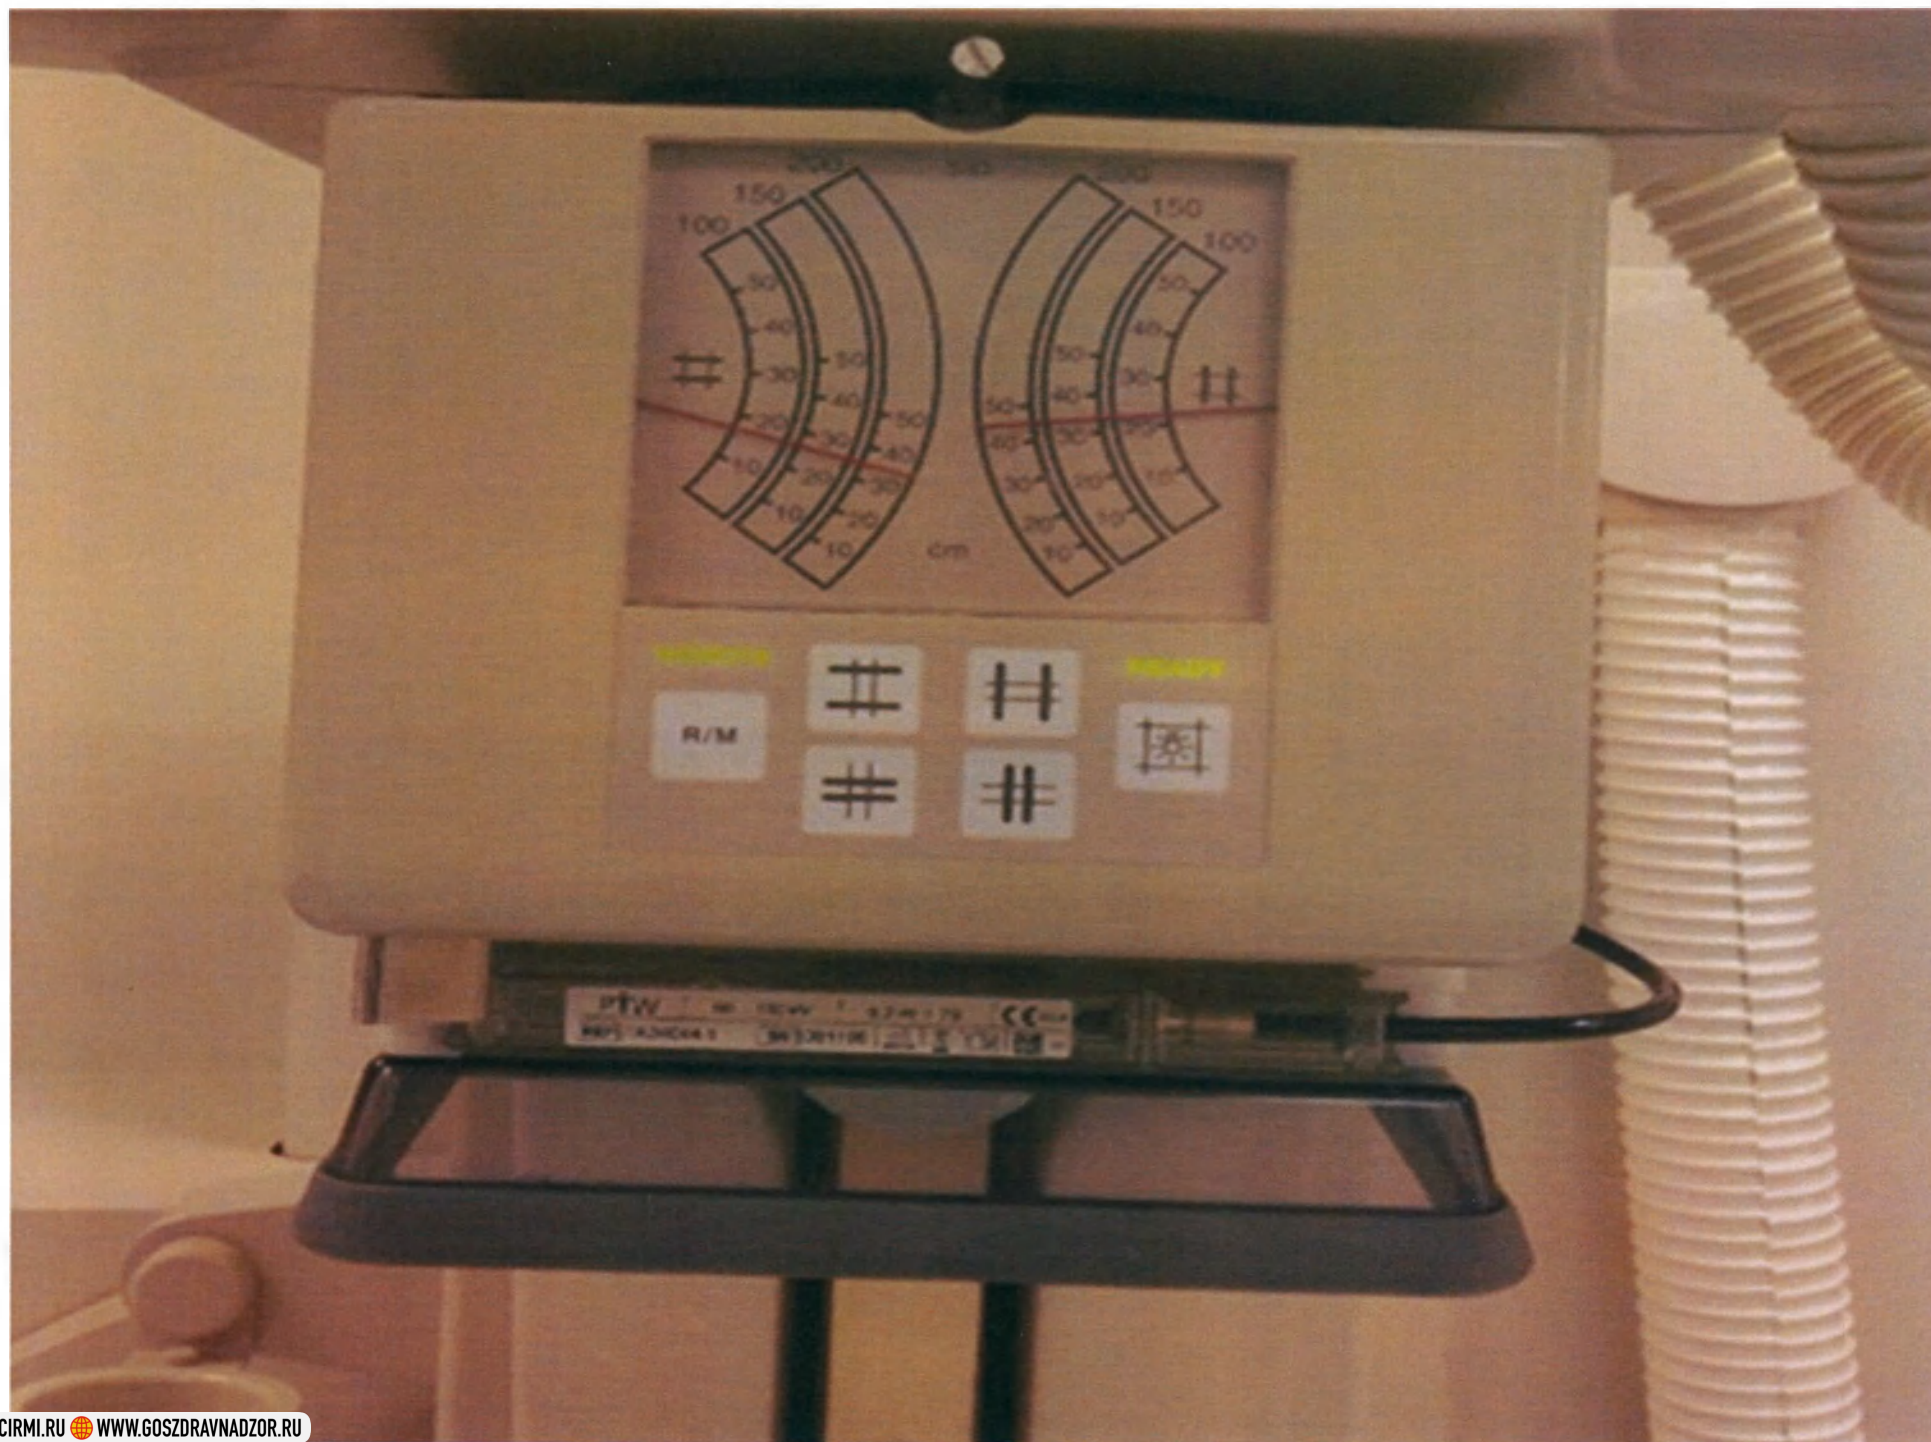


- Рентгеновский отсеивающий растр, 1 шт.;

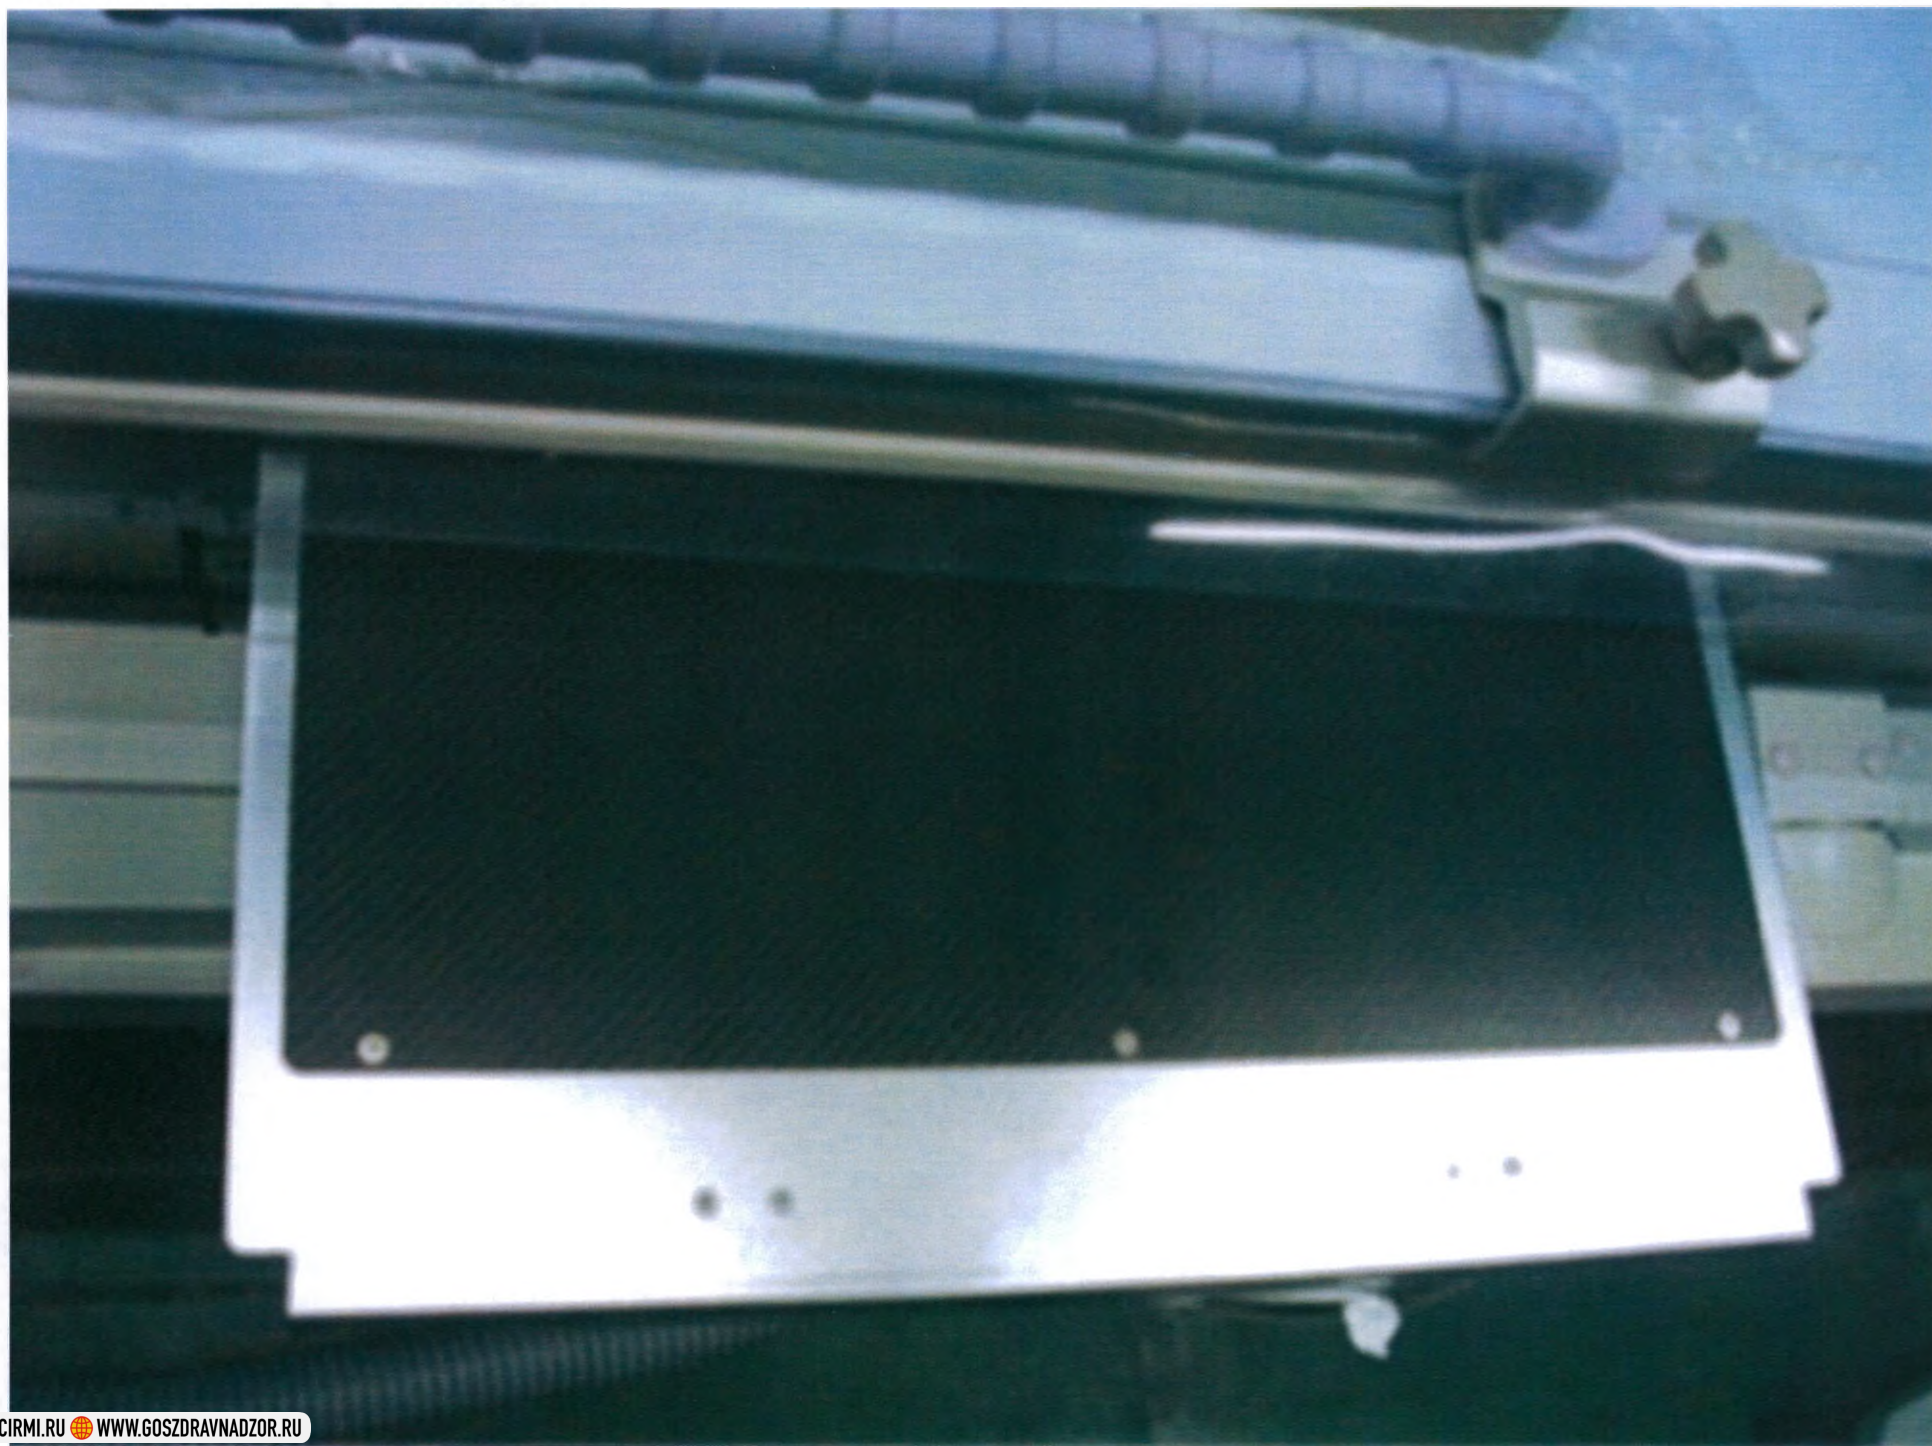


- Блок трехфокусной диагностической рентгеновской трубки (DXB-G14345), производства Varex Imaging Corporation, США, 1 шт.;

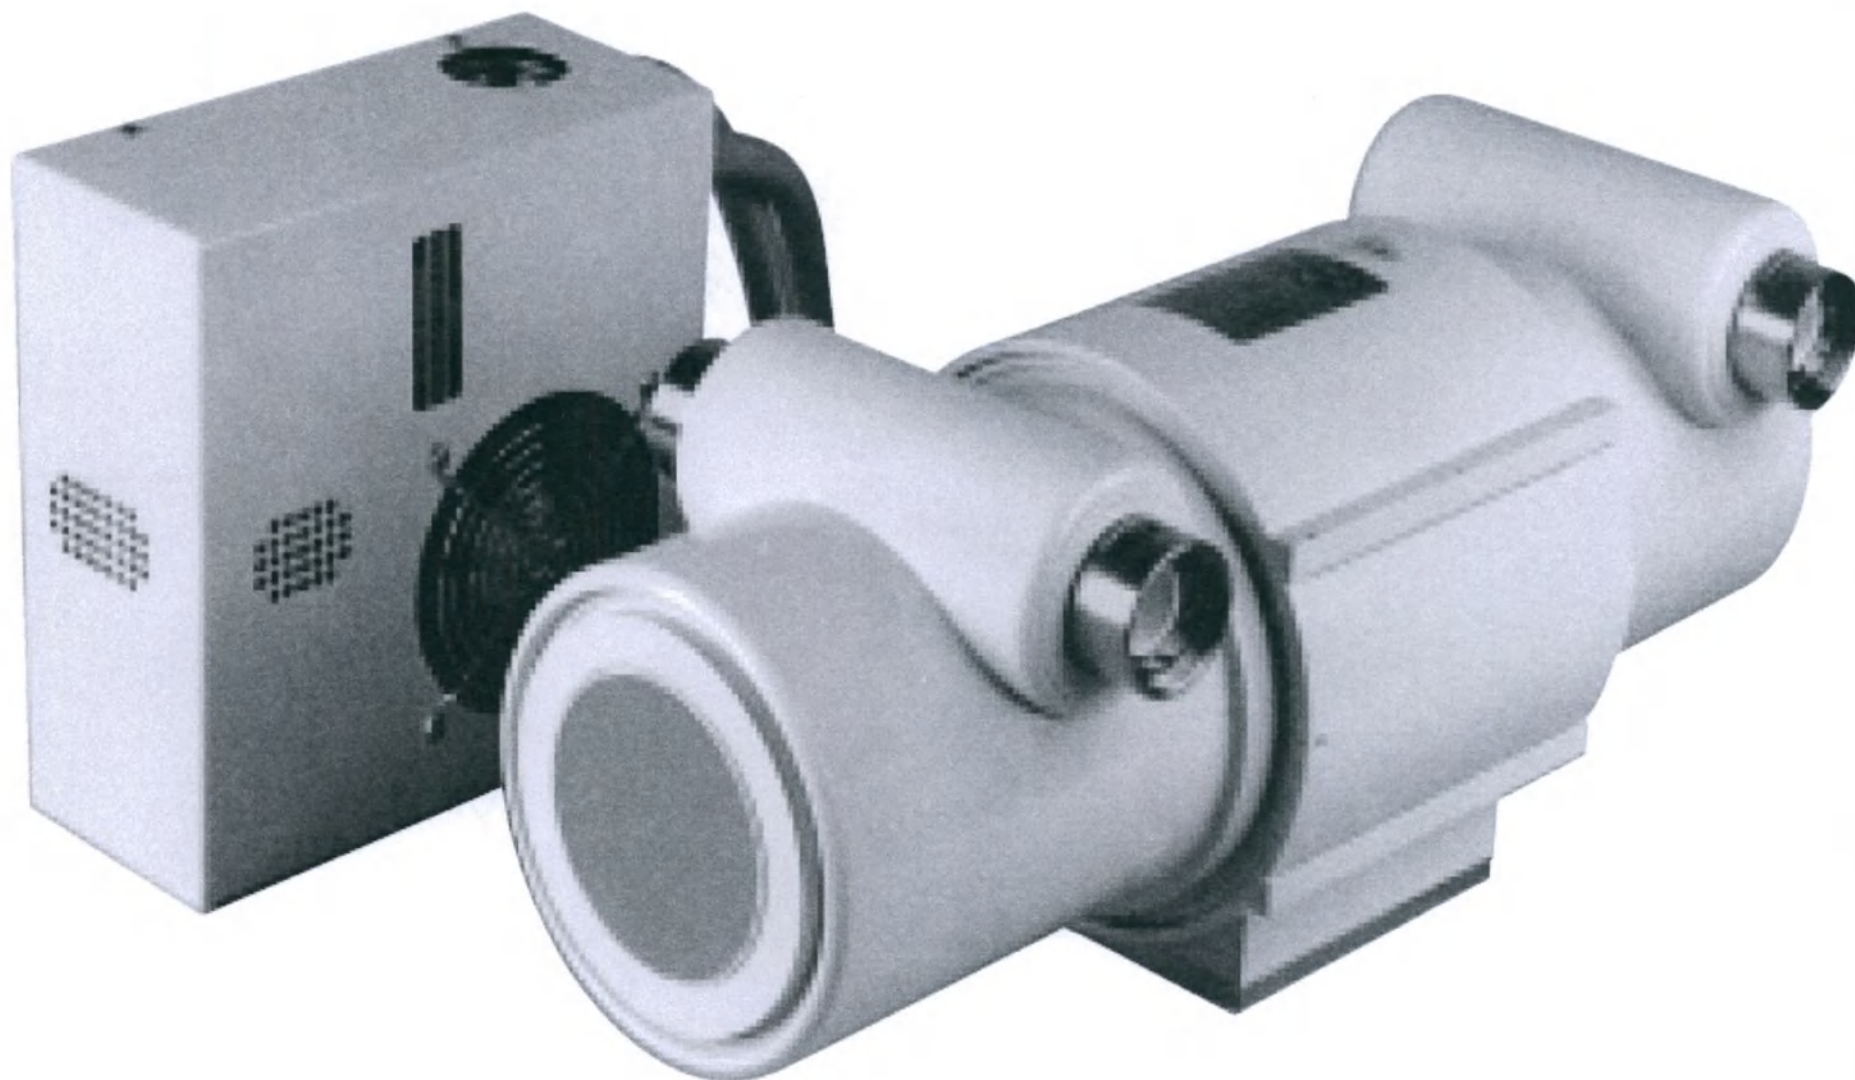

2. Высоковольтный рентгеновский генератор(КХО-80Z), производства Canon Medical Systems Corporation, Япония – 1 комплект.

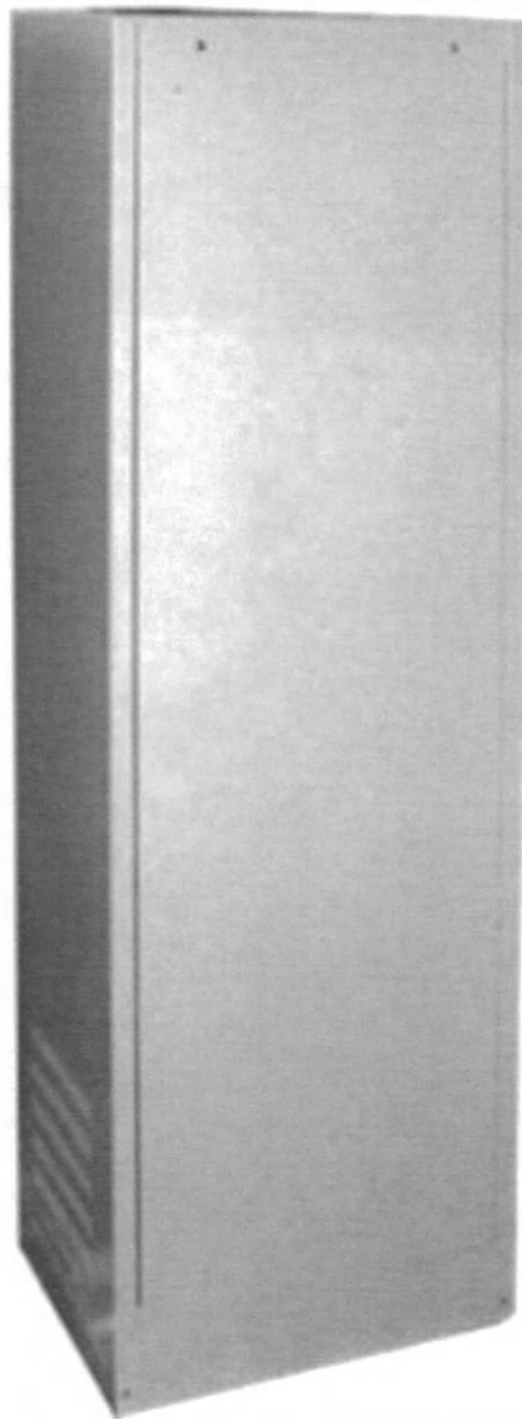


2. Высоковольтный рентгеновский генератор(КХО-80Z), производства Canon Medical Systems Corporation, Япония – 1 комплект.

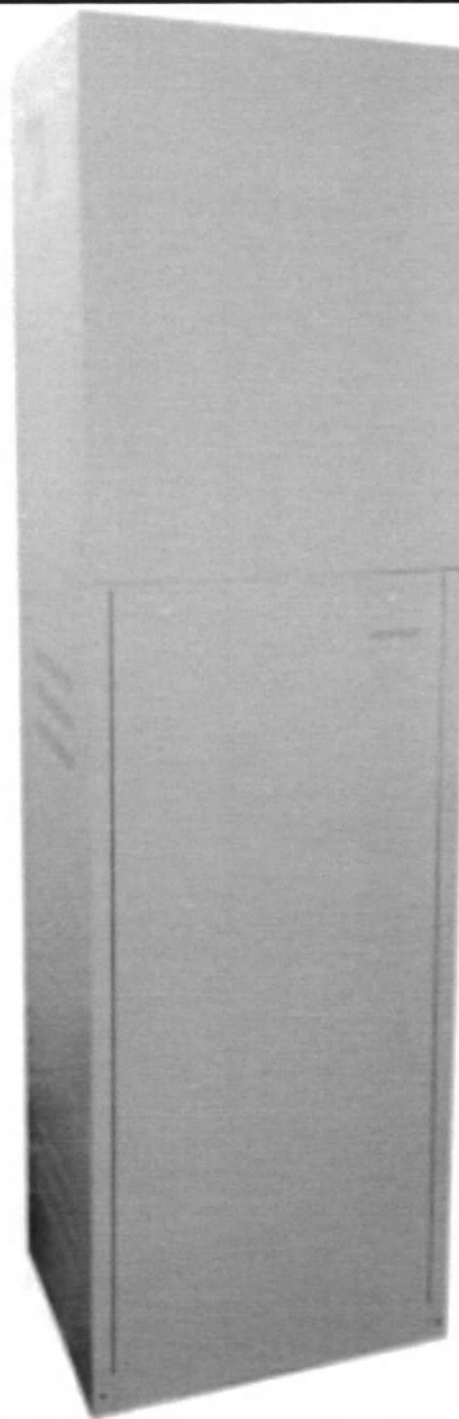

3. Процессор изображений (HDR-08A), производства Canon Medical Systems Corporation, Япония – 1 комплект.



4. Дистанционный пульт управления – 1 комплект:

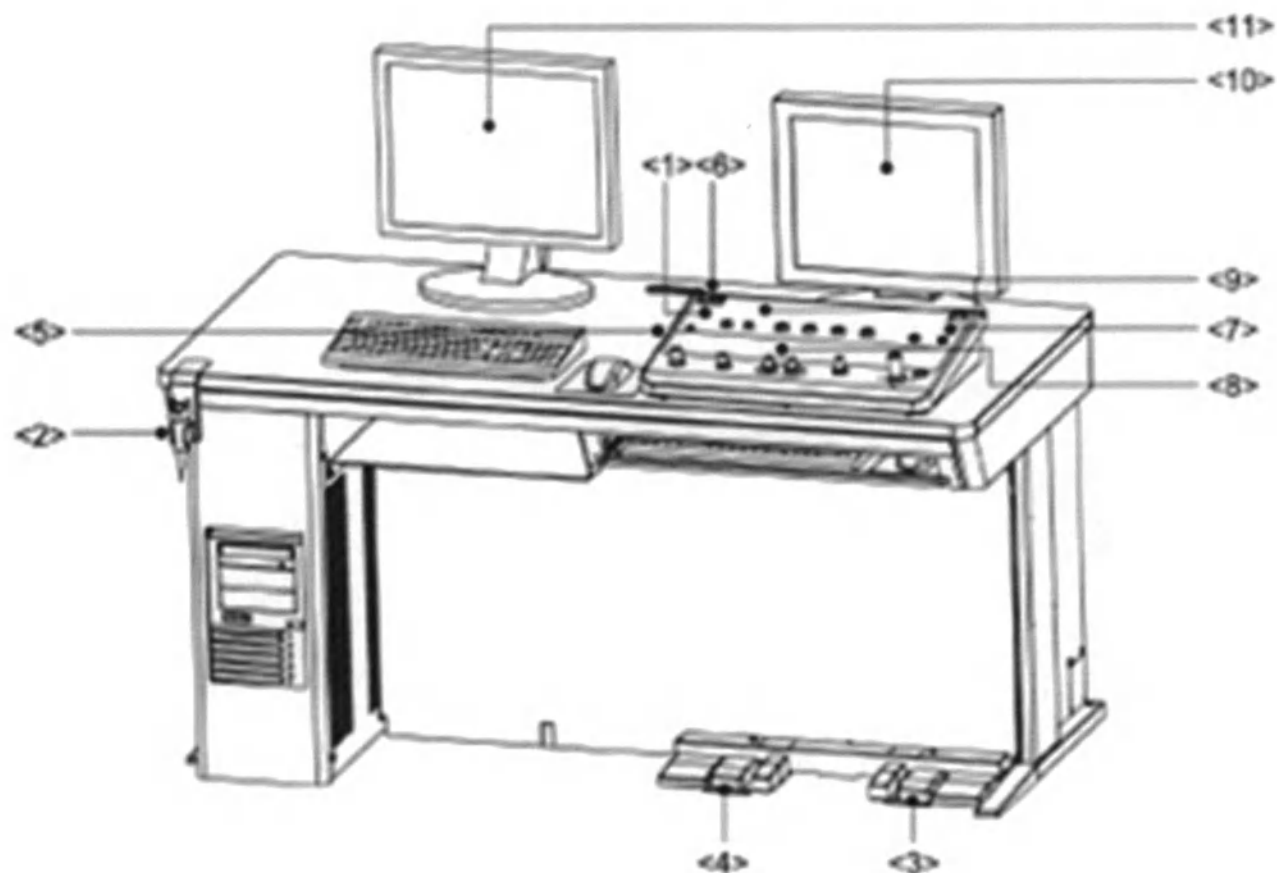


- | | |
|--|---|
| <1> Переключатели питания | <7> Панель сообщений |
| <2> Ручной переключатель рентгеновской экспозиции рентгеновского излучения | <8> Панель дистанционного управления рентгеновским диагностическим столом |
| <3> Педальный блок рентгеновской | <9> Панель управления рентгеновской установкой |
| <4> Педальный блок внутренней связи | <10> Монитор активного изображения |
| <5> Регуляторы громкости внутренней связи | <11> Системный монитор |
| <6> Микрофон | |

- Настольная панель управления, 1 шт.;



- Монитор активного изображения, 1 шт.;

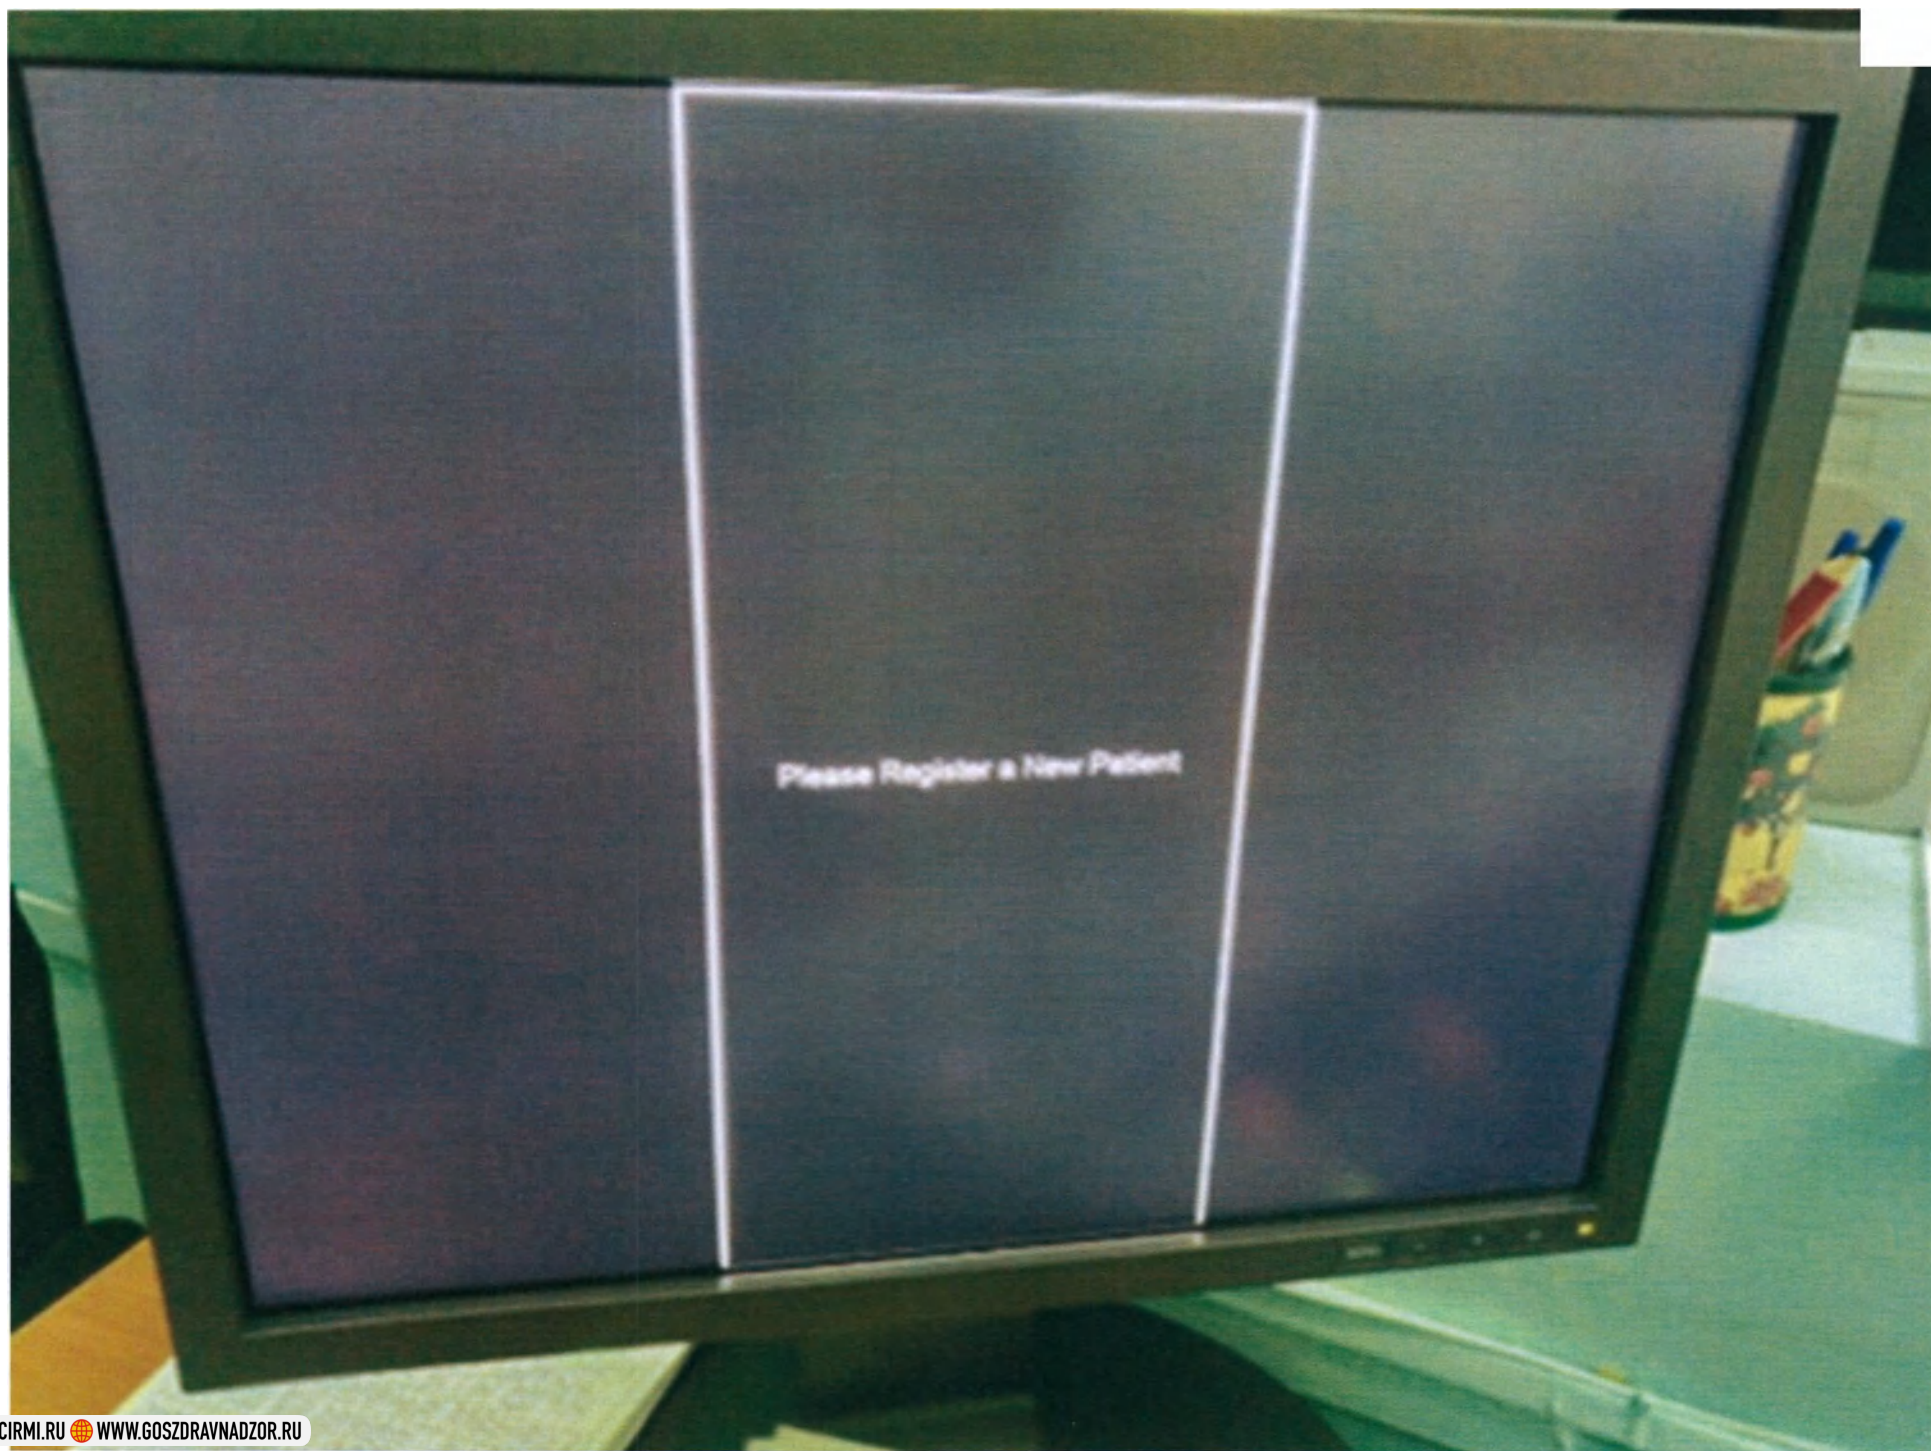


- Пульт блока управления, 1 шт.;




- Педальный блок, 1 шт.;




- Динамики (для пультовой и процедурной), 2 шт.;

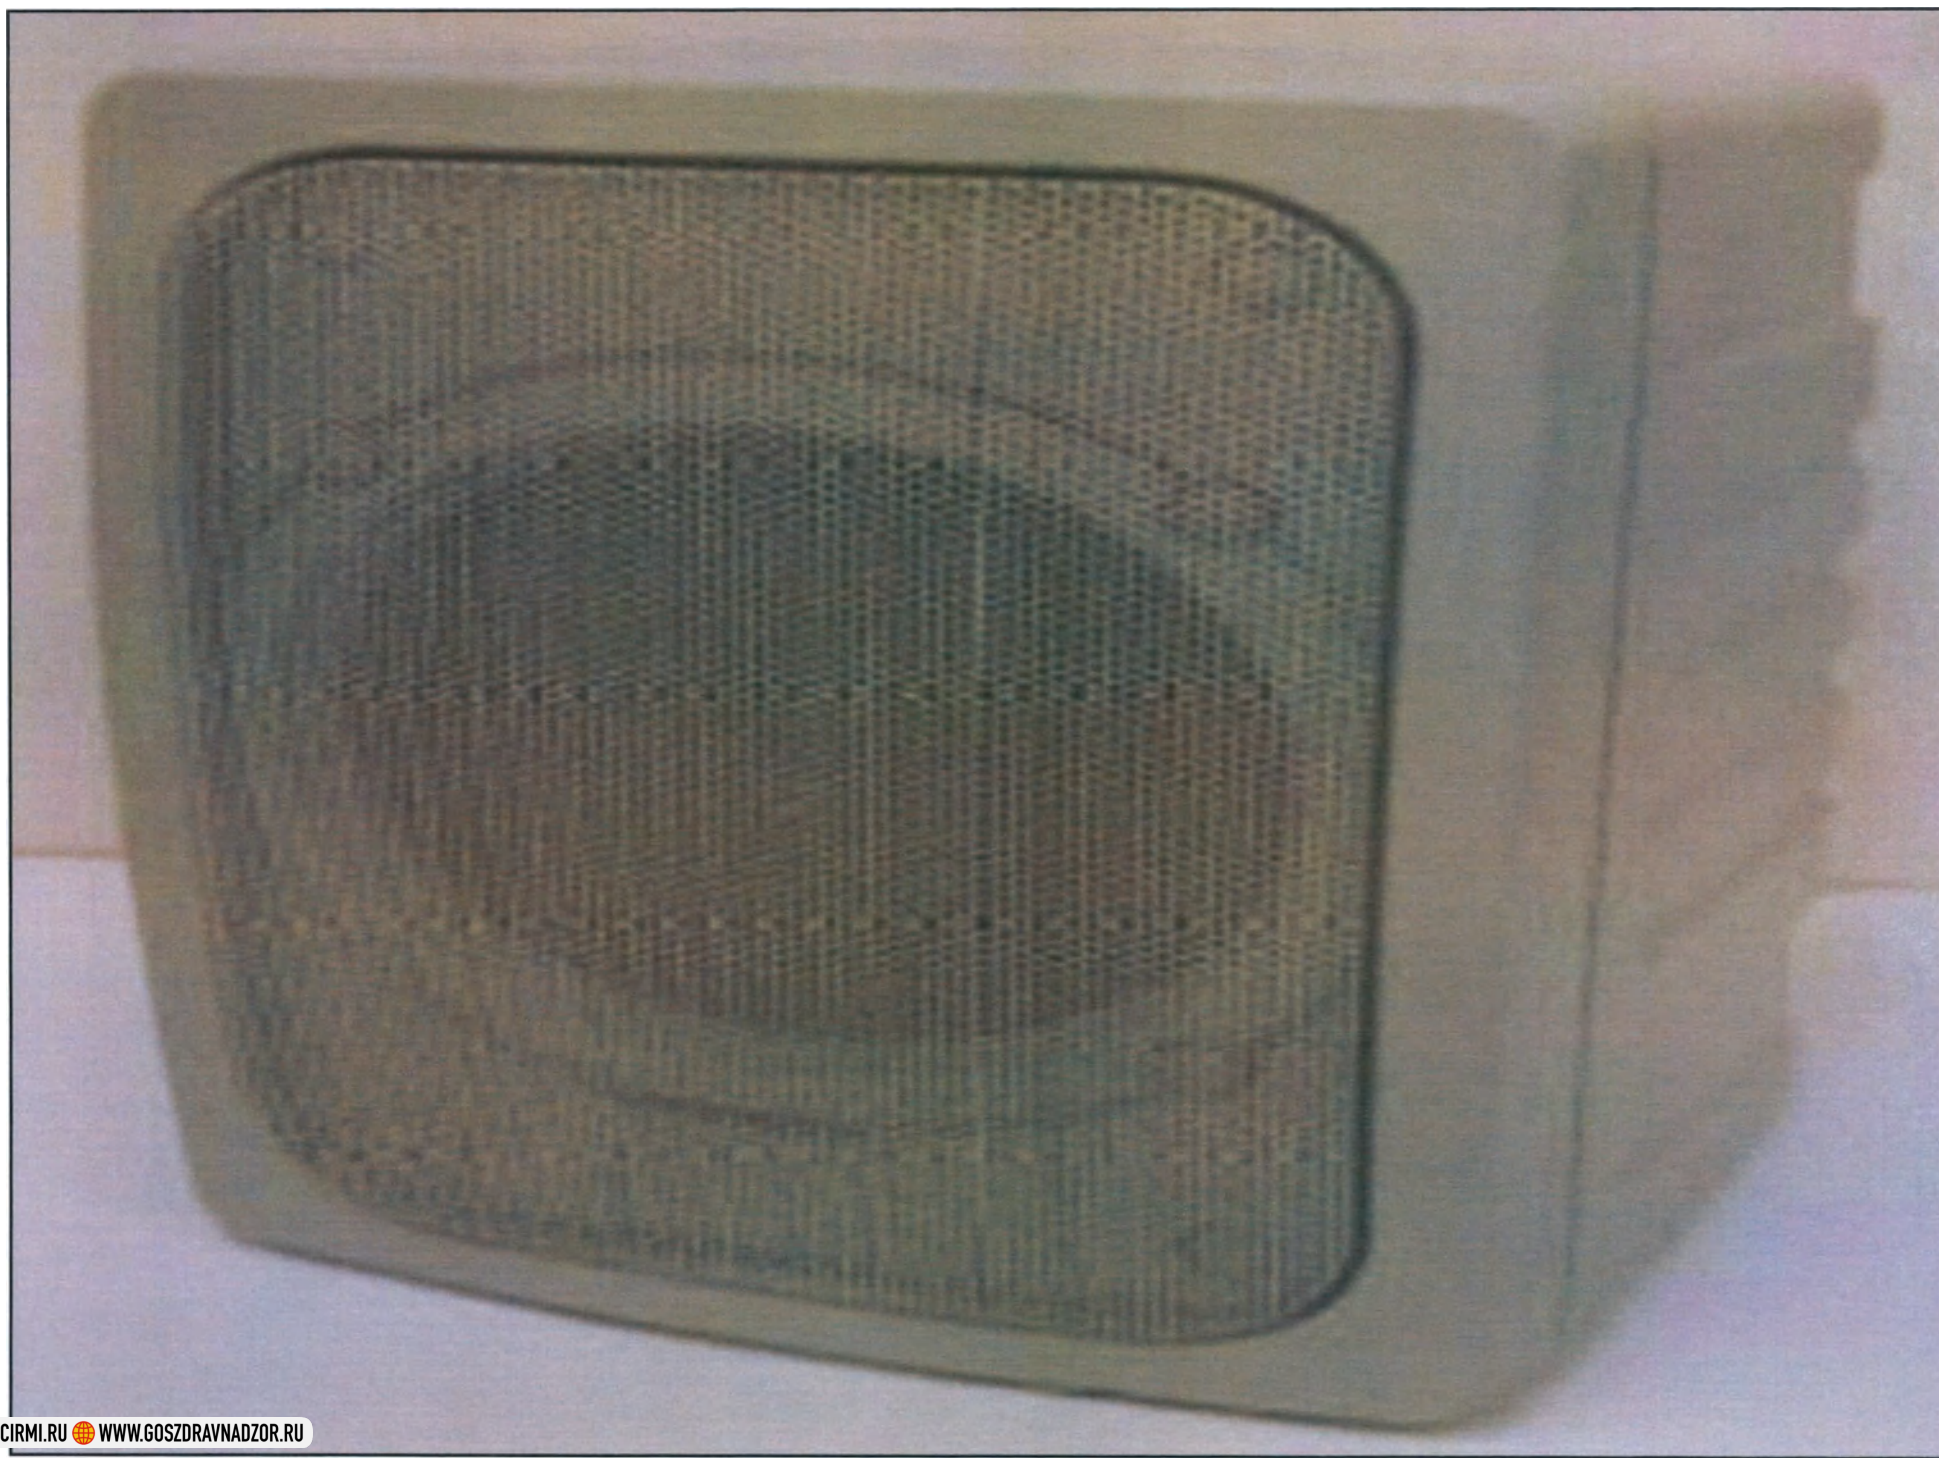

- Ручной переключатель рентгеновской экспозиции, 1 шт.

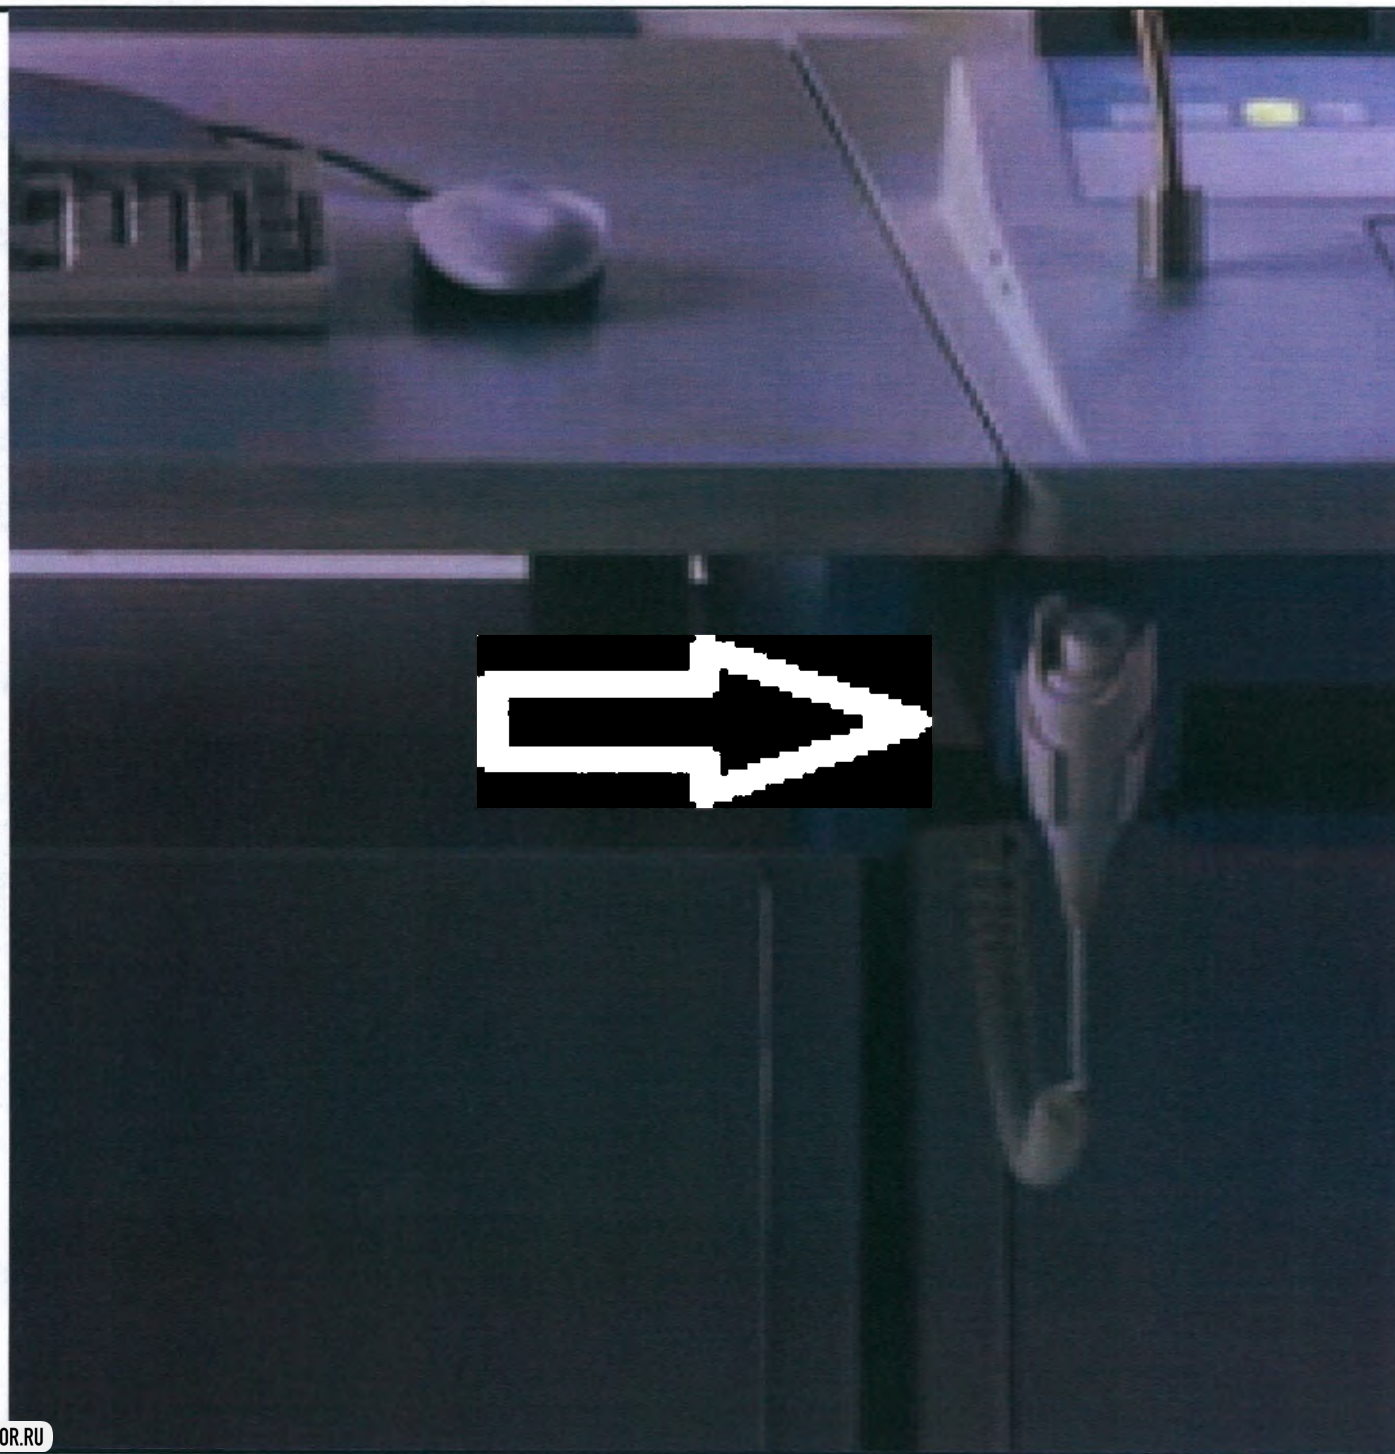

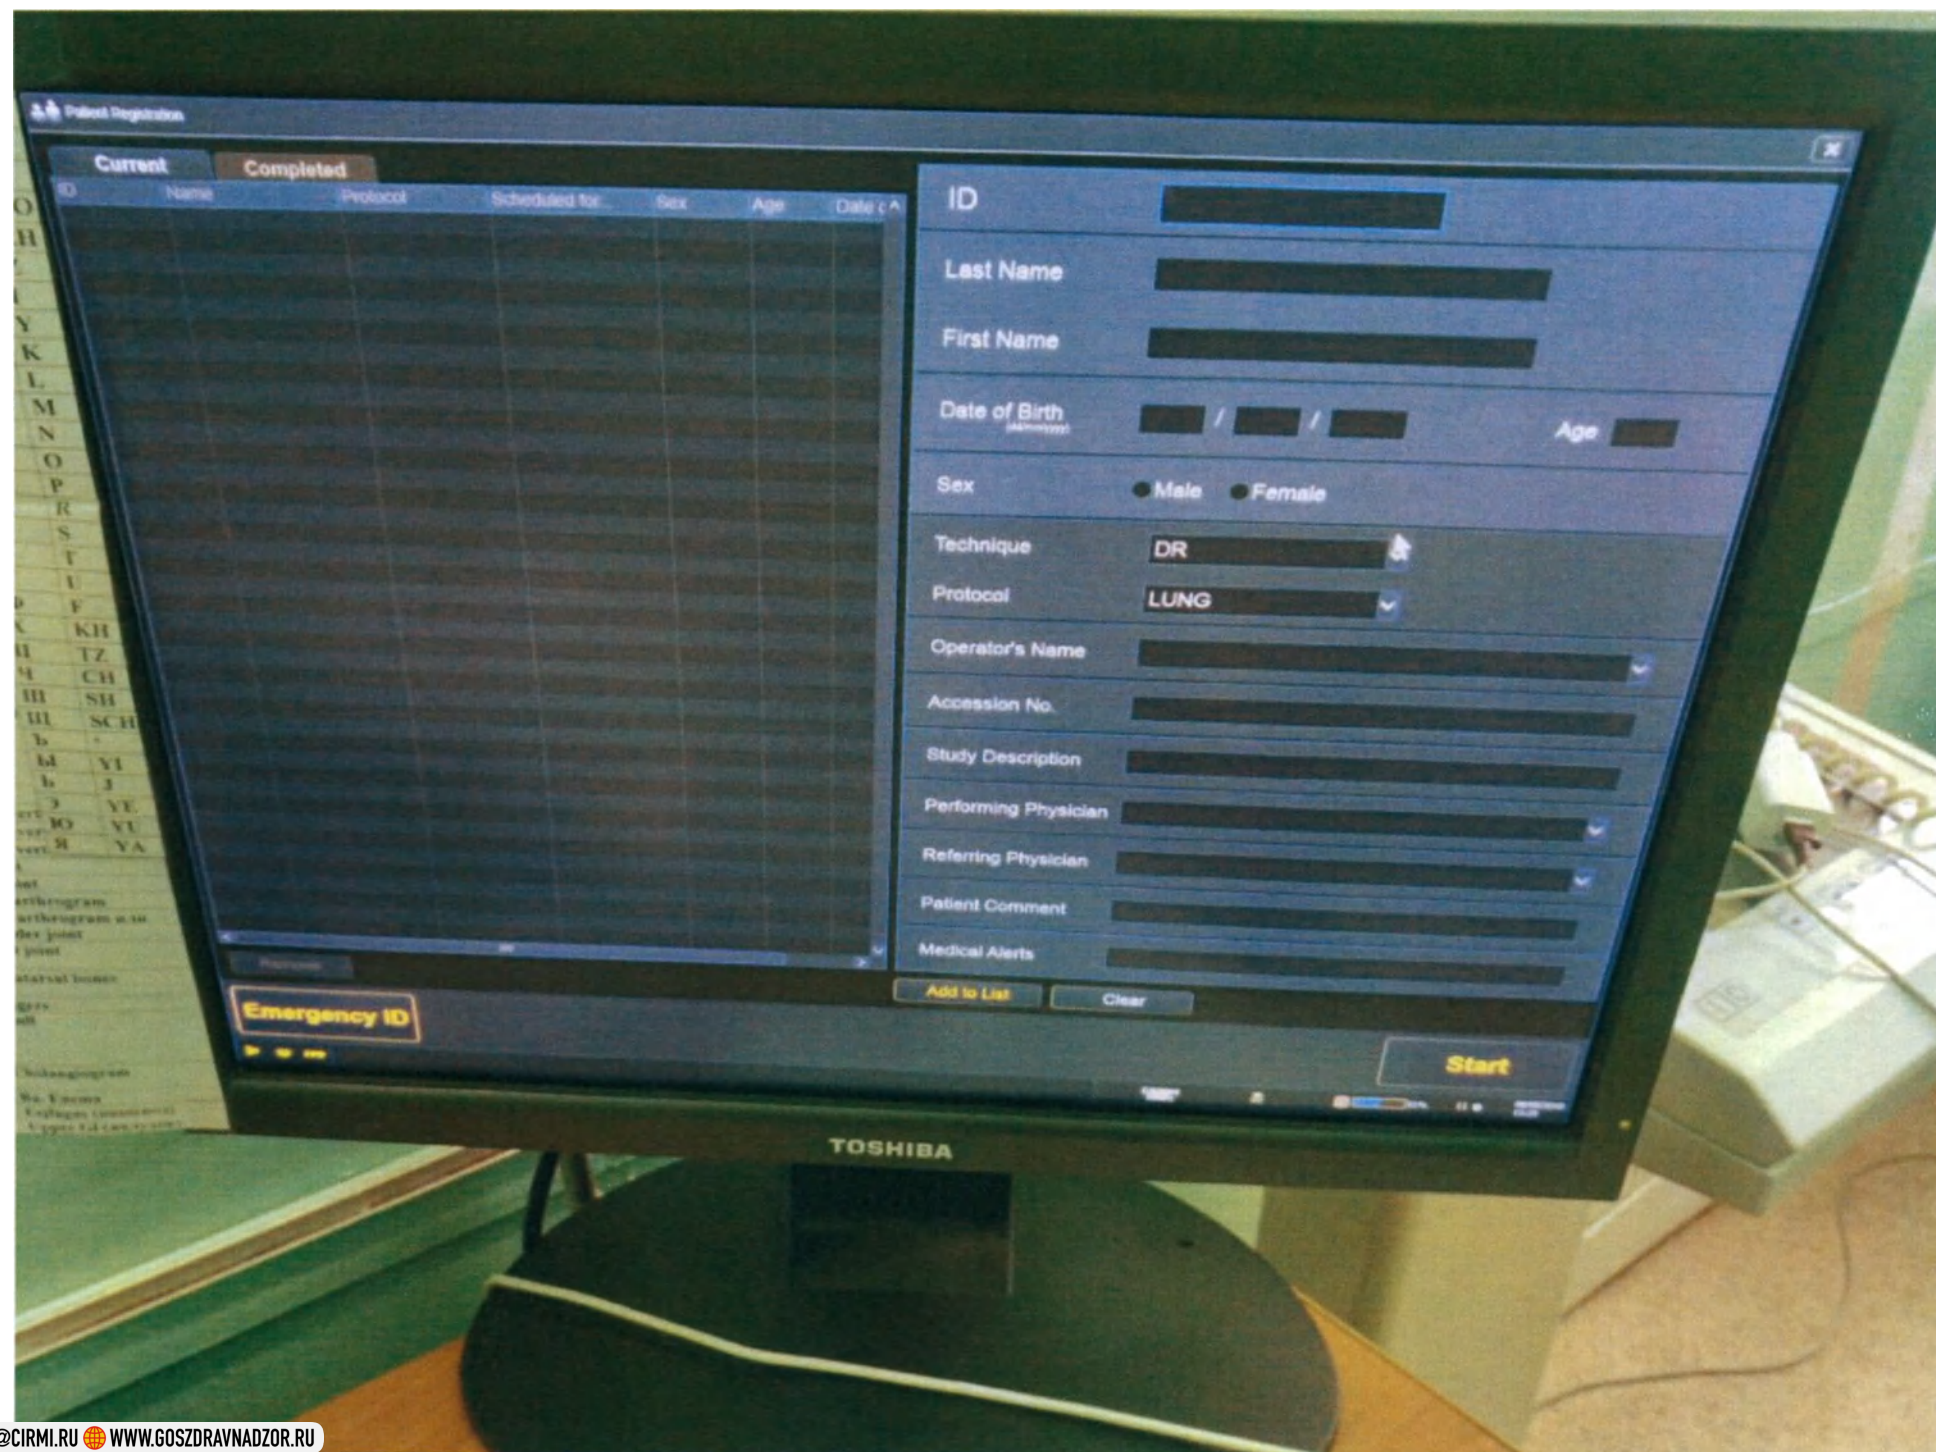

6. Цифровой компенсационный фильтр —1 шт.

DCF

Filter Type

MEDIUM

Low Dose Compression

OFF

High Dose Compression

OFF

OK

Close

Apply

Canon

№ 2B305-796RU*V

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕНТГЕНОГРАФИИ И РЕНТГЕНОСКОПИИ
С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ZEXIRA
МОДЕЛЬ DREX-ZX80
(2B305-796RU*V)



ВАЖНО!

Перед работой с оборудованием изучите и усвойте настоящее руководство. После прочтения держите руководство в легкодоступном месте.


CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION

© CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, 2009–2020


ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Принадлежности:


1. Модуль скоростной записи рентгеноскопии и рентгенографии.

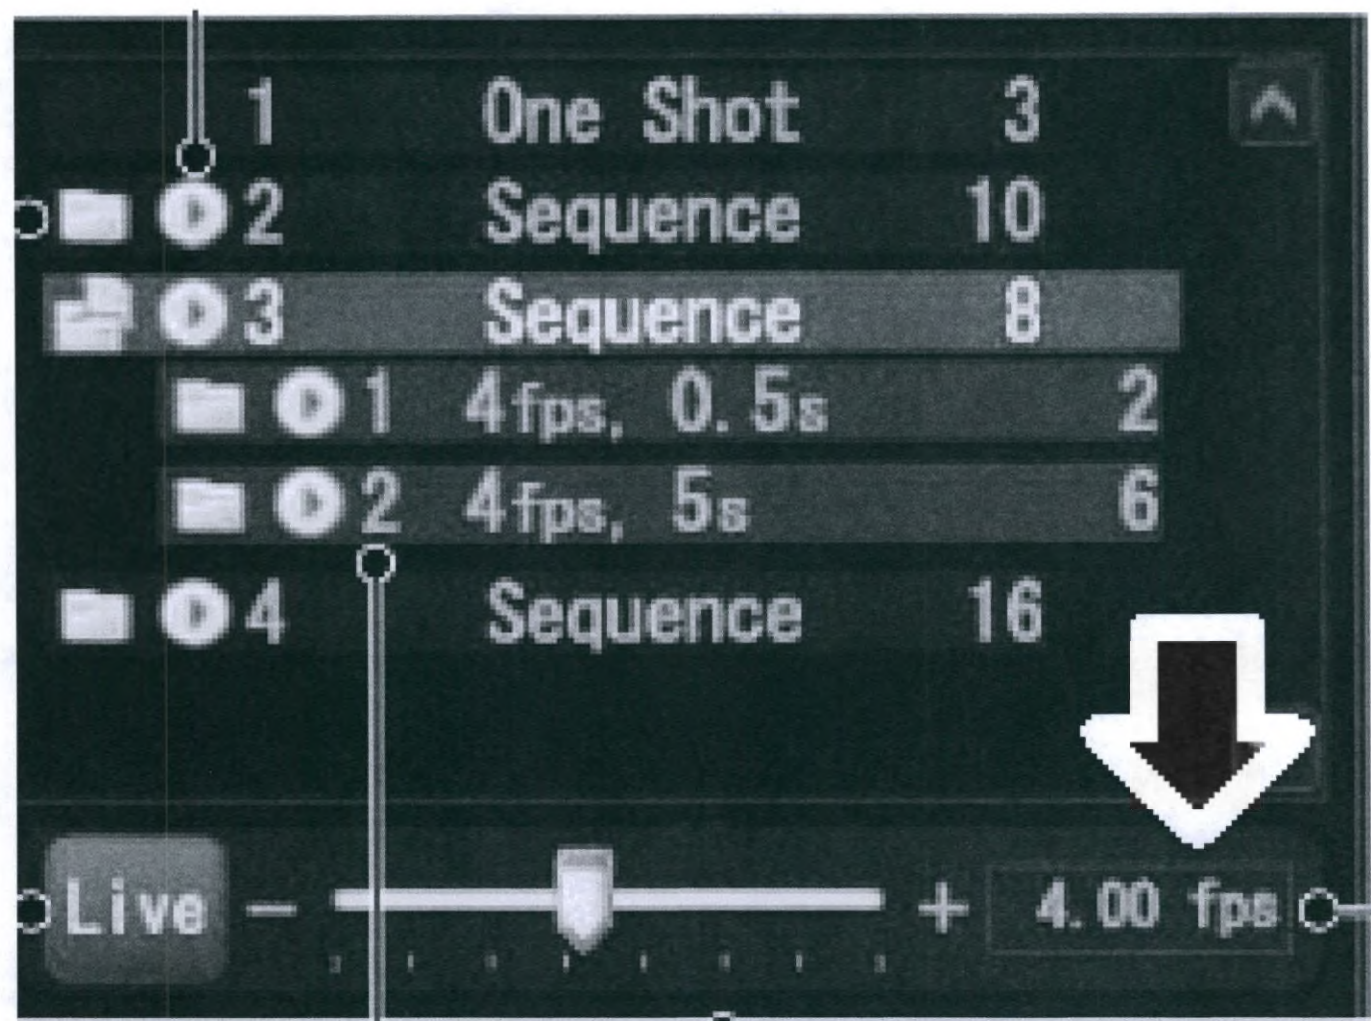

2. Пакет для сохранения последнего рентгеноскопического изображения, 1 вариант исполнения

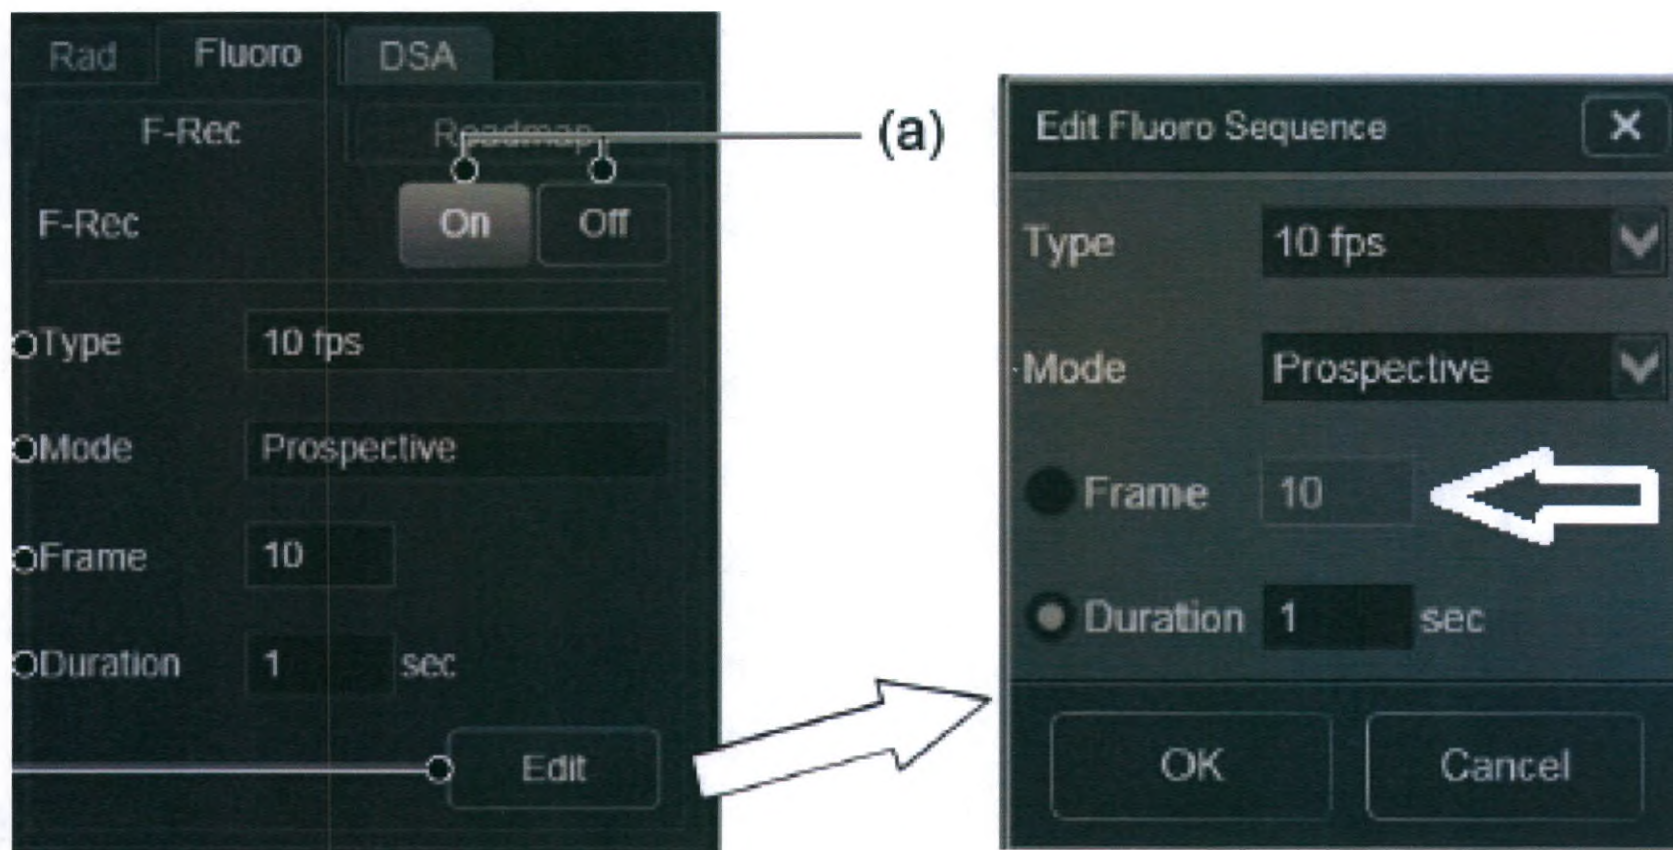

3. Пакет для сохранения последнего рентгеноскопического изображения, 2 вариант исполнения

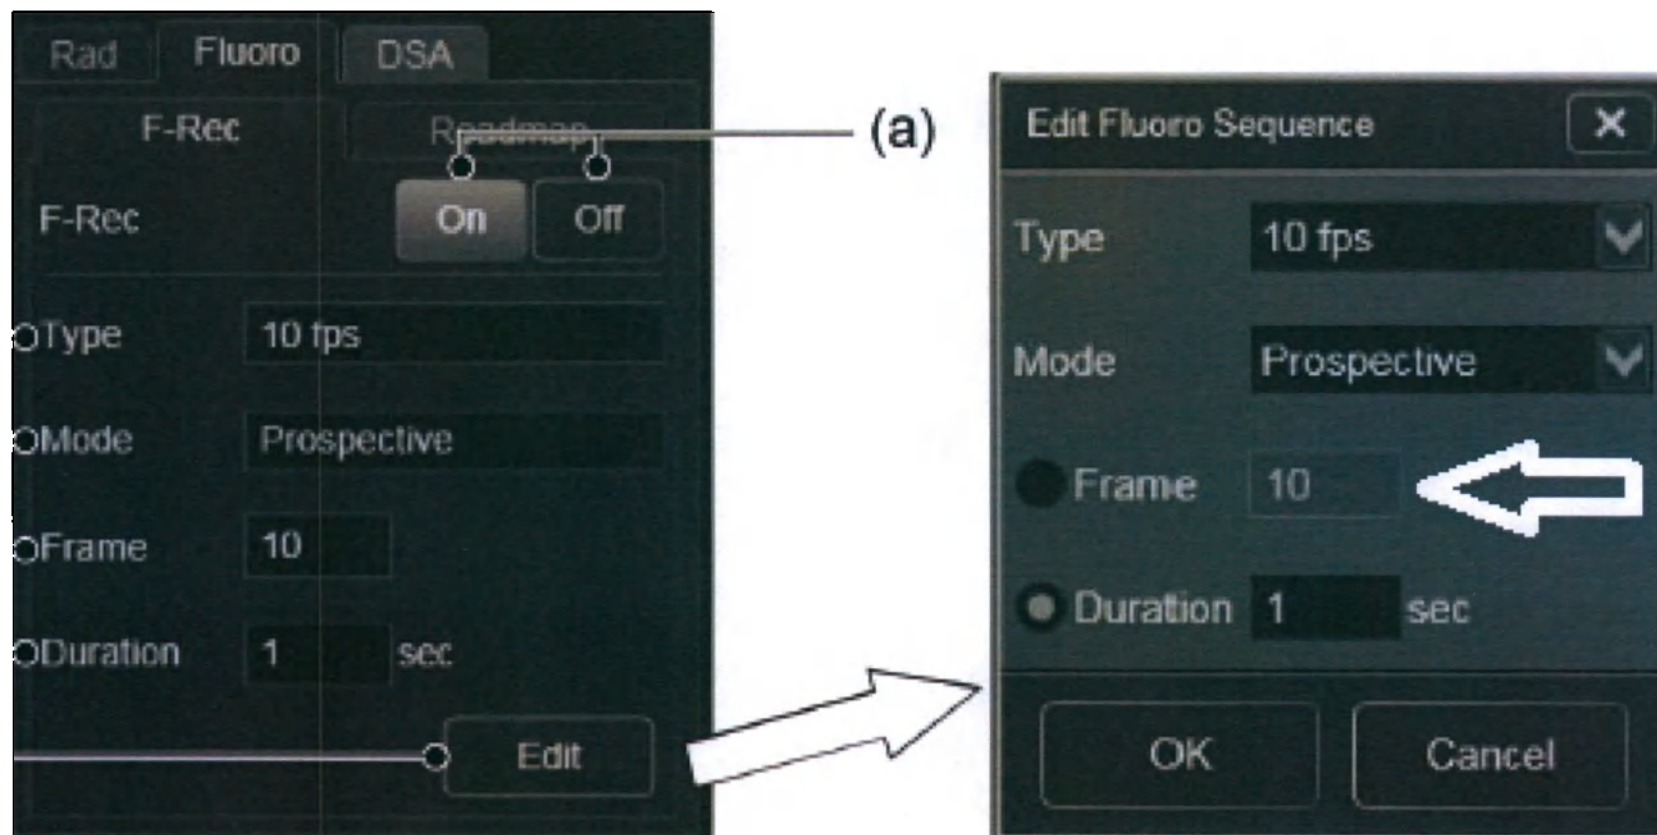

4. Программное обеспечение для записи изображений на CD/DVD.

Burn CD/DVD

Burn CD/DVD

Name	ID	Exam Date	No. of images
Toshiba Taro	20090518002	2009/05/19	5

Total Number of Images: 5

Used Space: 43 MB

Free Space: 607 MB

Capacity: 650 MB

Media Type:
☒ CD ☐ DVD

☒ Include DICOM Viewer

0 MB 650 MB

Burn Cancel

5. Панель анатомических программ, 1 шт.



5. Модуль шумоподавления на изображении, в составе: - Модуль шумоподавления на изображении, 1 шт.;




- Отсеивающий растр, 1 шт.




7. Модуль для ангиографии, 1 шт.

ID	0123456-789		
Last Name	Last Name	Title	Title
Middle Name	Middle Name		
First Name	First Name	Suffix	Suffix
Date of Birth (yyyy/mm/dd)	1980 / 11 / 1	Age	28 Y
Sex	☒ Male ☐ Female ☐ Other		
Technique	DSA ▼		
Protocol	DSA STANDARD ▼		
Operator's Name	DSA STANDARD DSA STANDARD1 DSA STANDARD2		

8. Монитор активного изображения для процедурной, не более 3 шт.

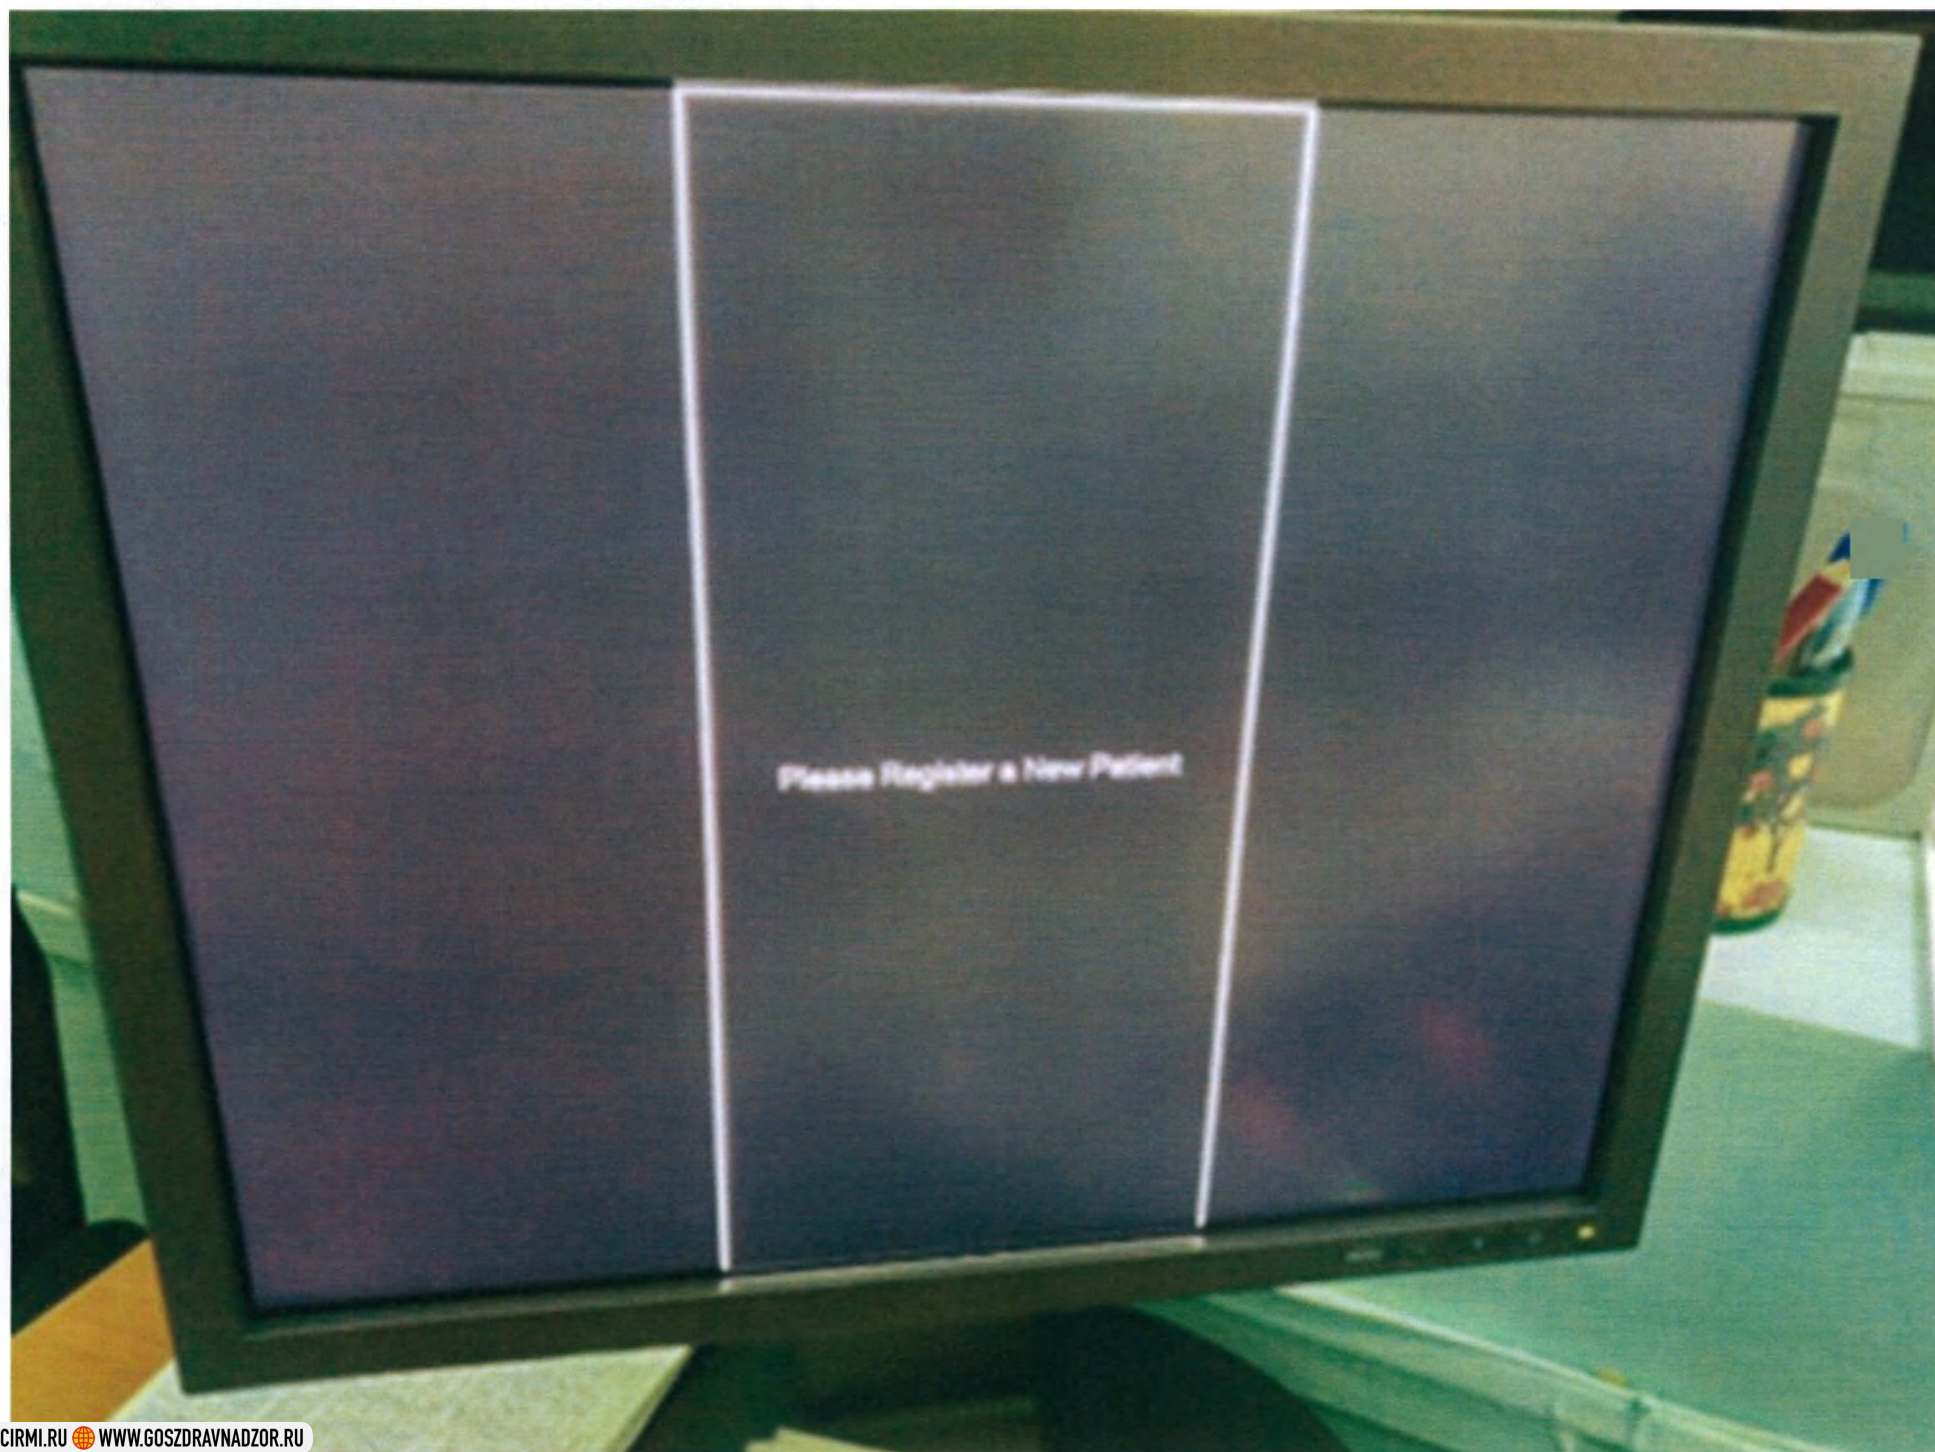


9. Модуль референтного монитора, 1 шт.

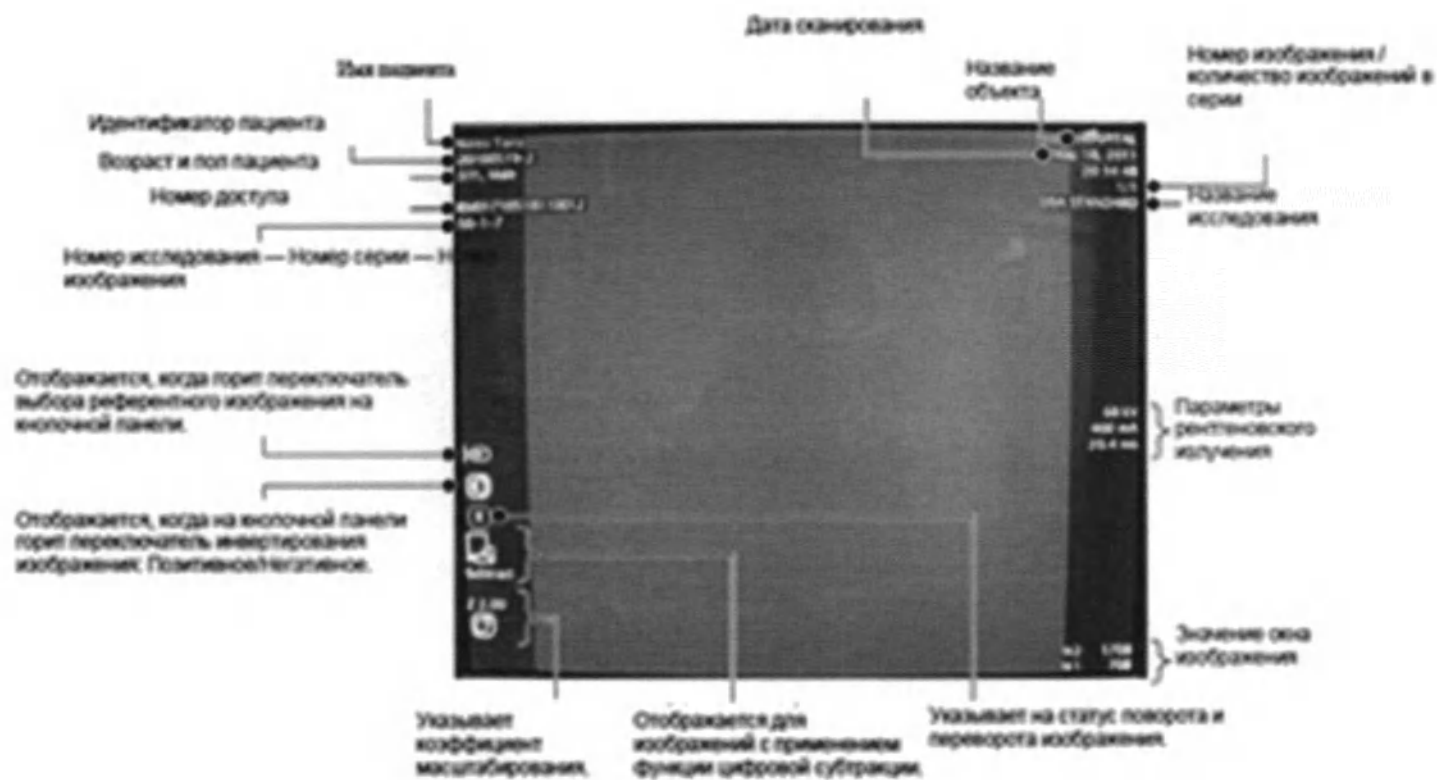


3/

10. Дополнительные контрольные средства (XDRK-EREF), в составе: - персональный компьютер (Lenovo, Словакия ThinkStation P330) – 1 шт;

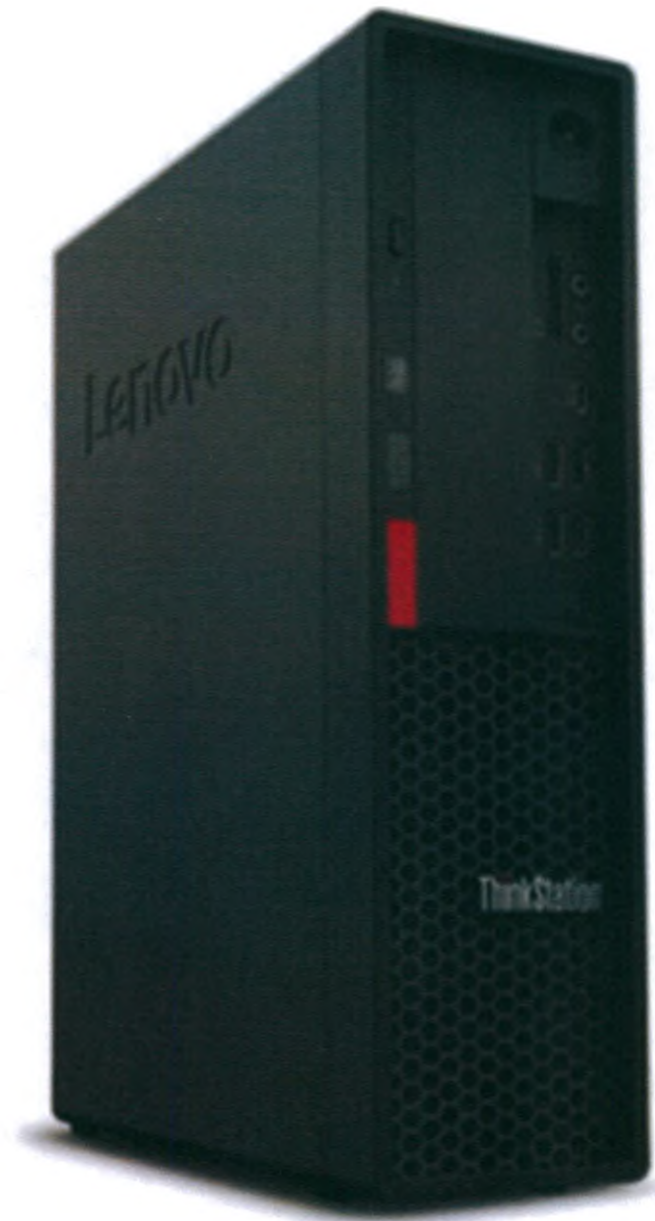

10. Дополнительные контрольные средства (ХДРК-ЕРЕР), в составе: - персональный компьютер (OptiPlex XE3 SFF производства DELL, США) – 1 шт;


30

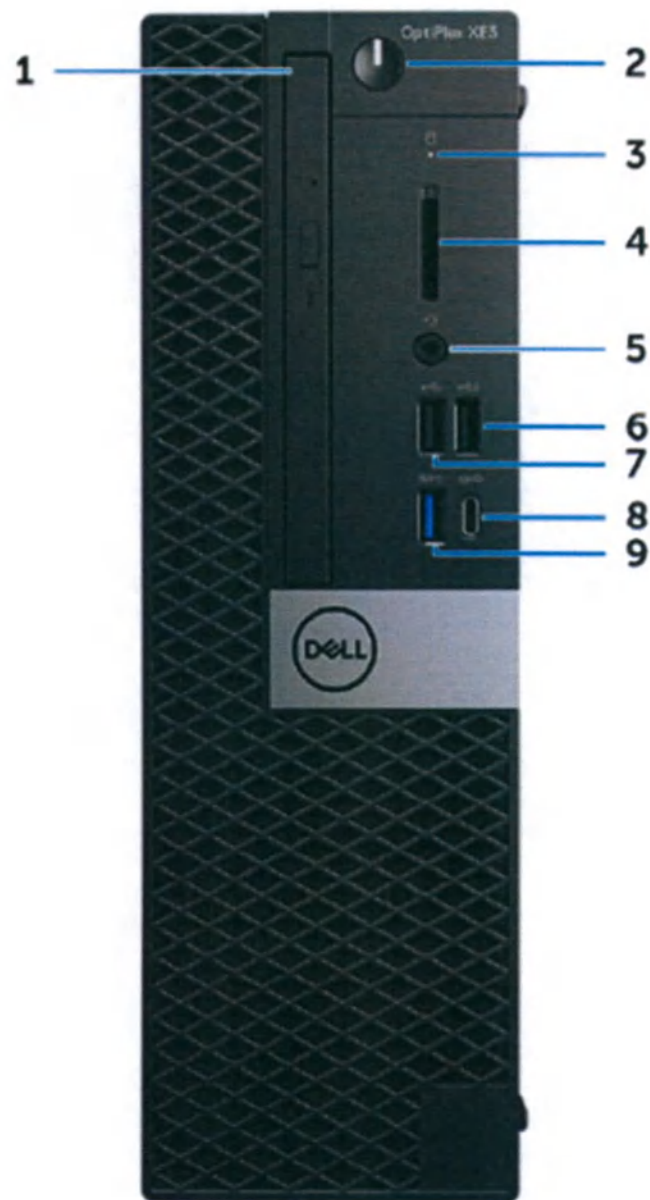

- монитор (Lenovo ThinkVision LT1913p) – 1 шт;



- монитор (P1917S производства DELL, США) – 1 шт;

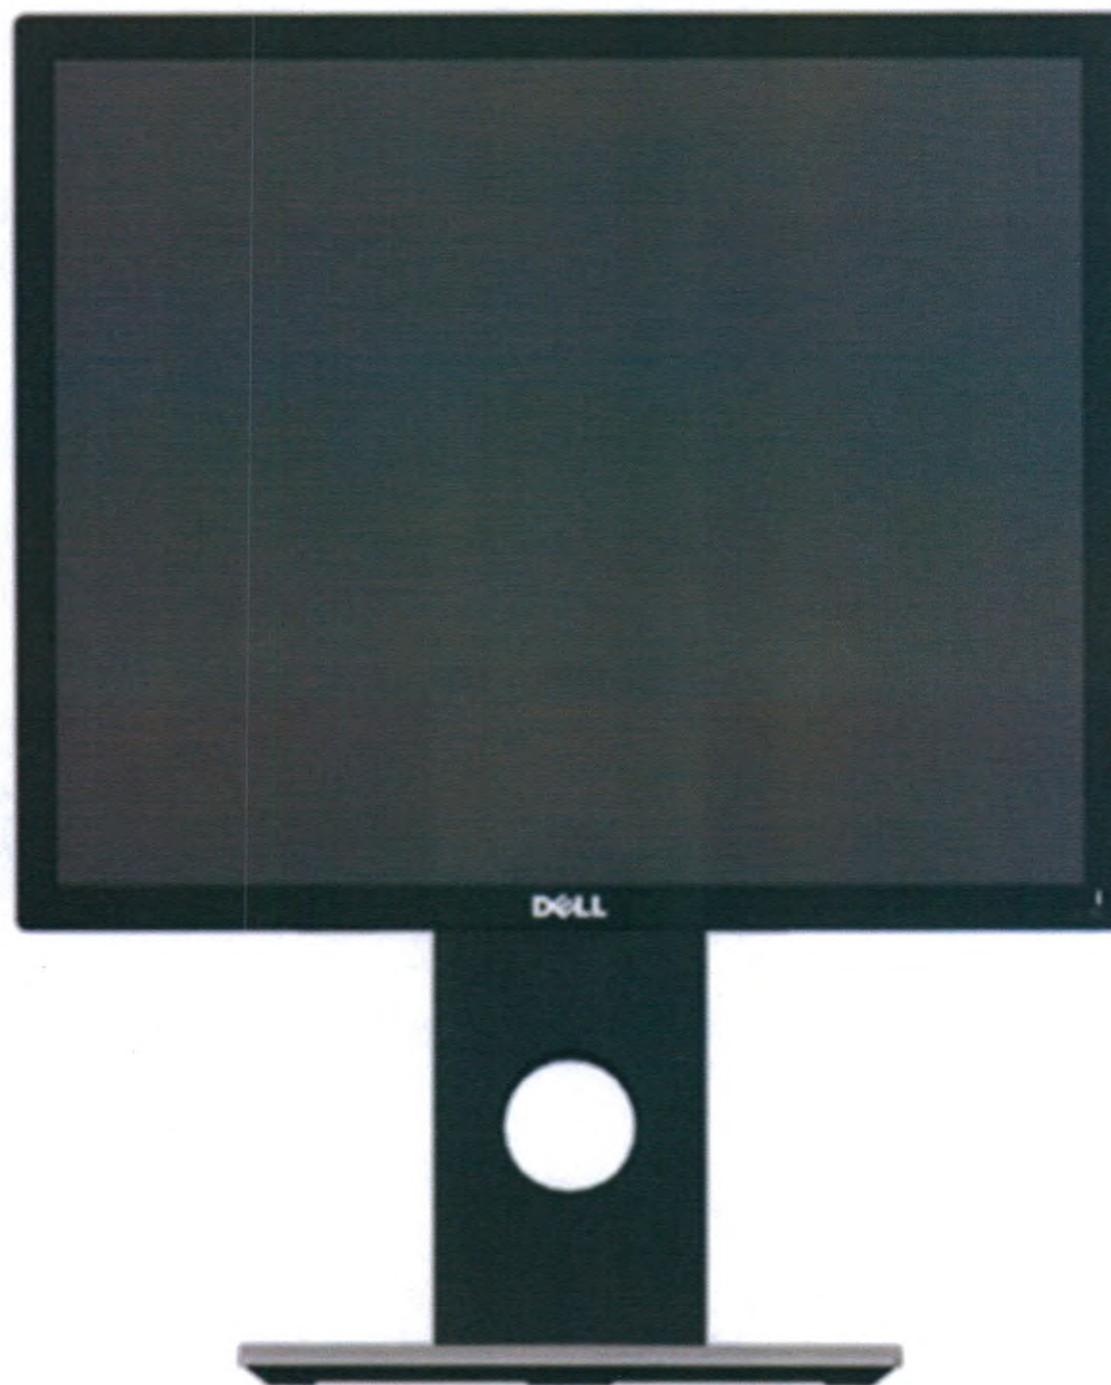

- клавиатура – 1 шт.;




- мышь компьютерная – 1 шт;



- программное обеспечение – не более 10 шт.




11. Подставка под руку, не более 2 шт.

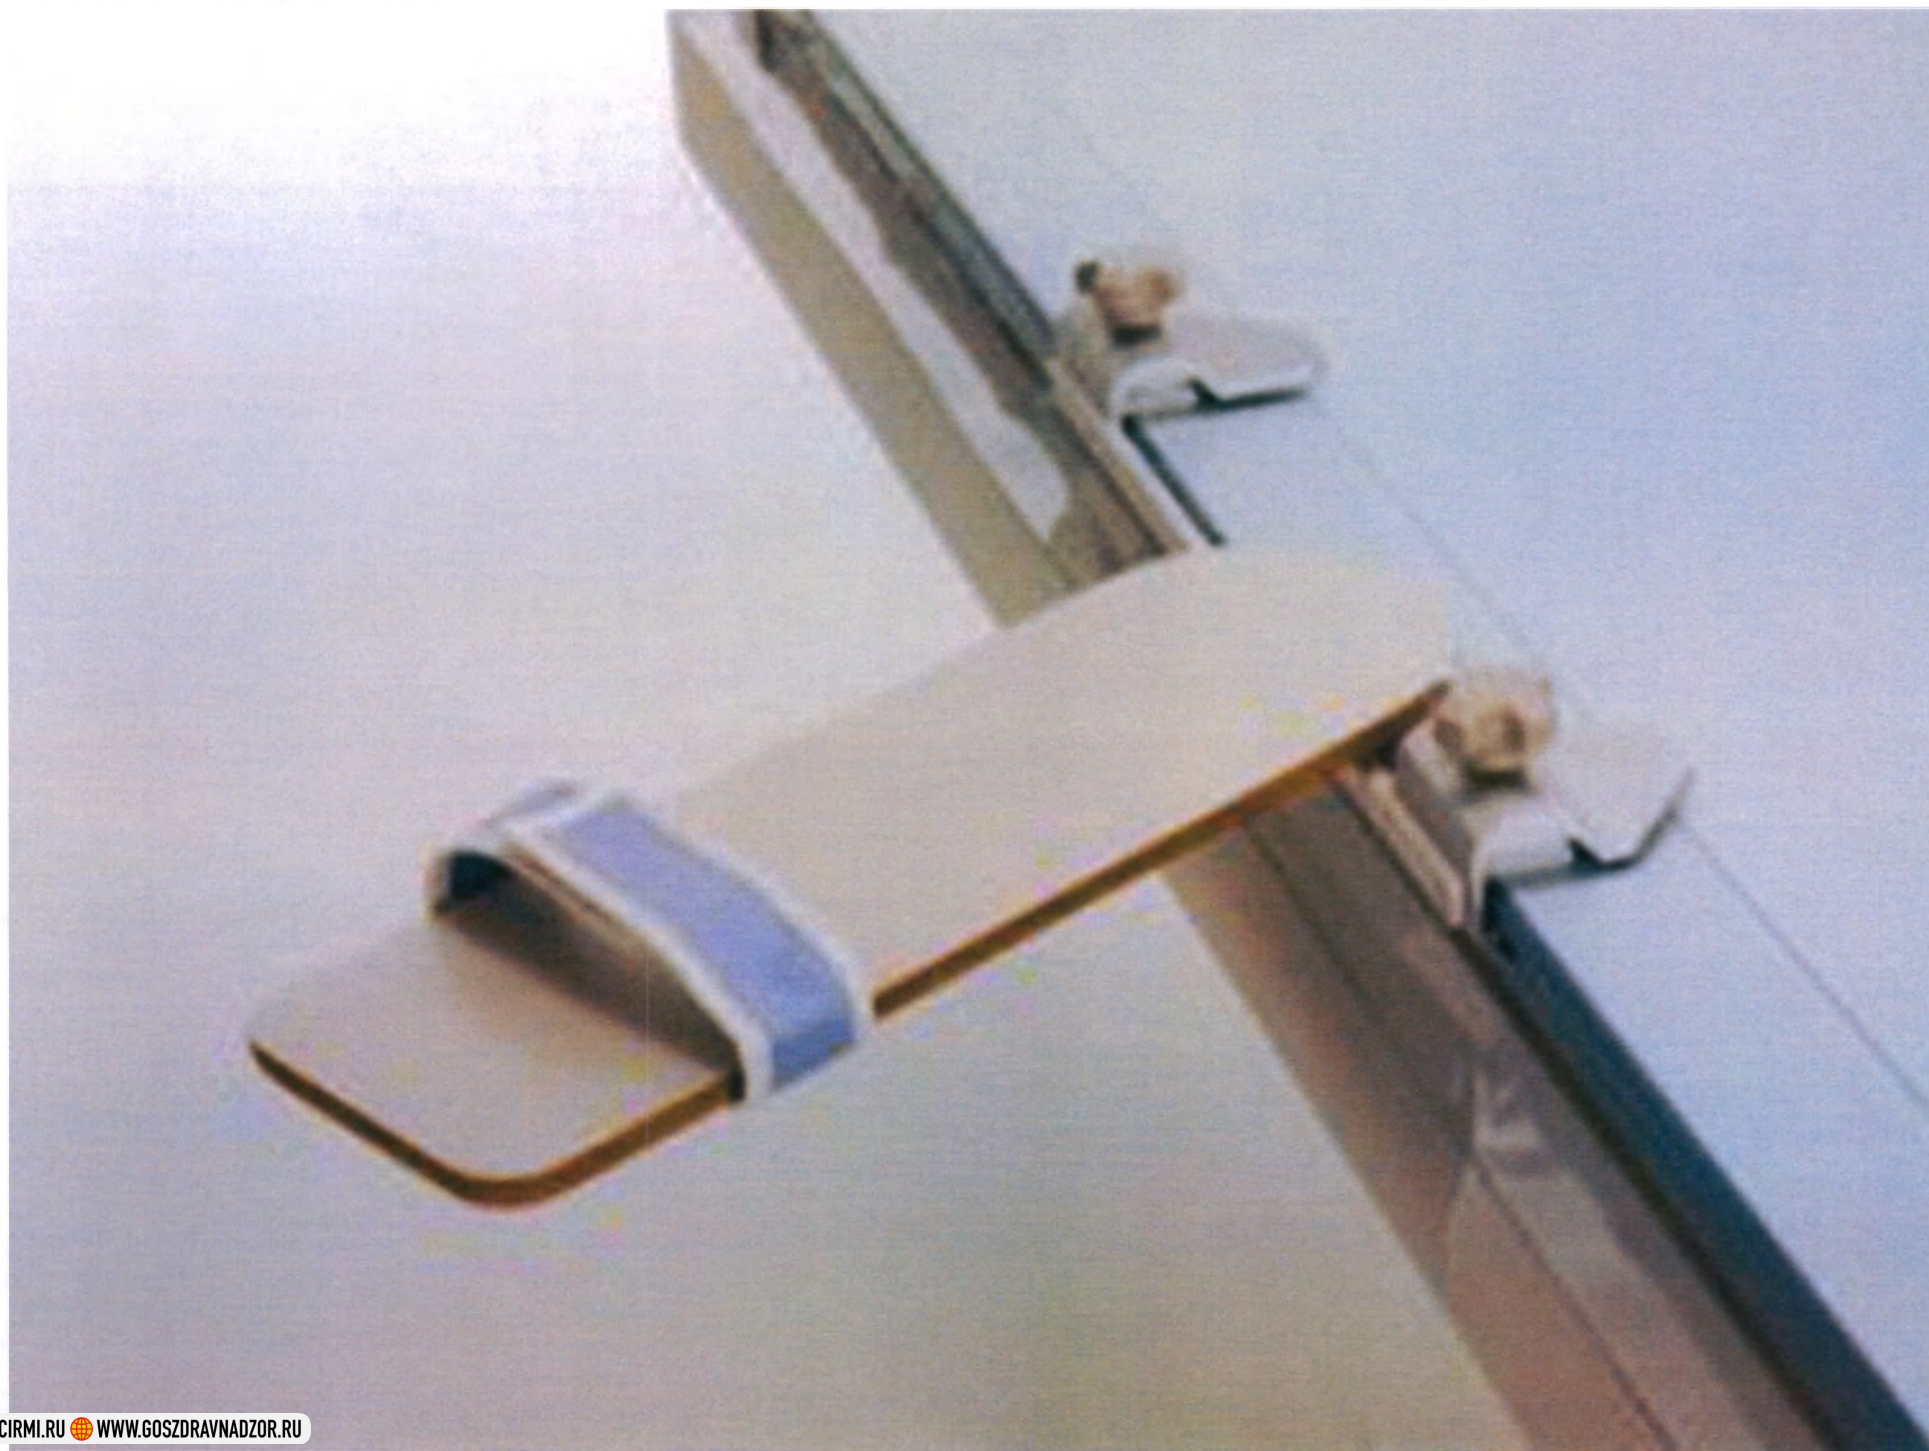

12. Компрессионный ремень для пациента, не более 2 шт.



13. Коленодержатель, не более 2 шт.

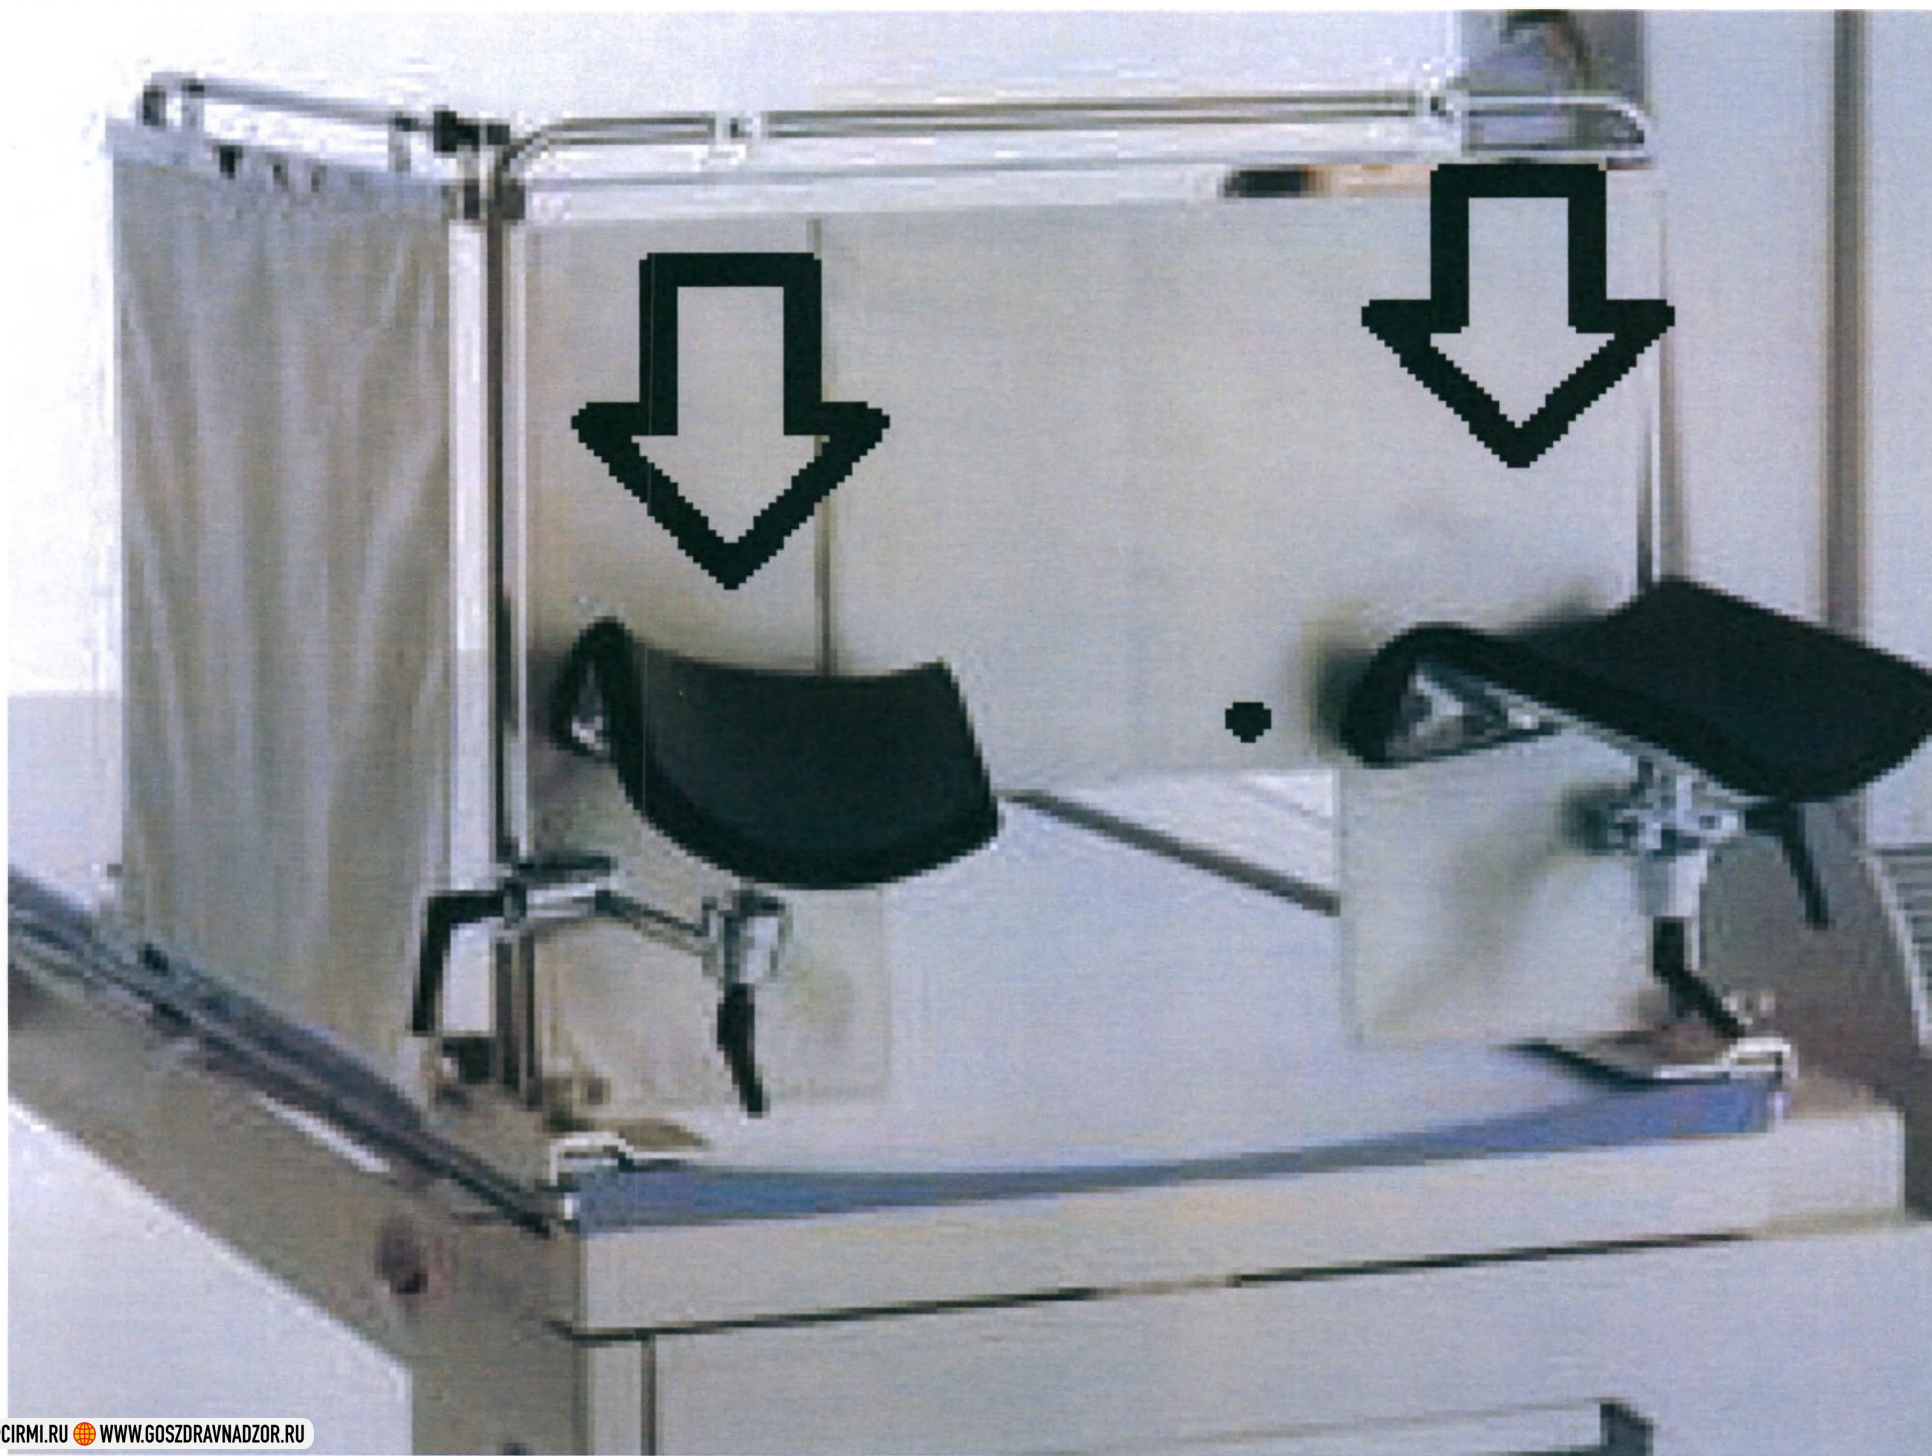

14. Сиденье для цистоскопии, 1 шт.



15. Матрац плоской формы, 1 шт.




16. Дополнительный педальный блок, 1 шт.



16. Дополнительный pedalный блок, 1 шт.




17. Матрац треугольной формы, не более 2 шт.

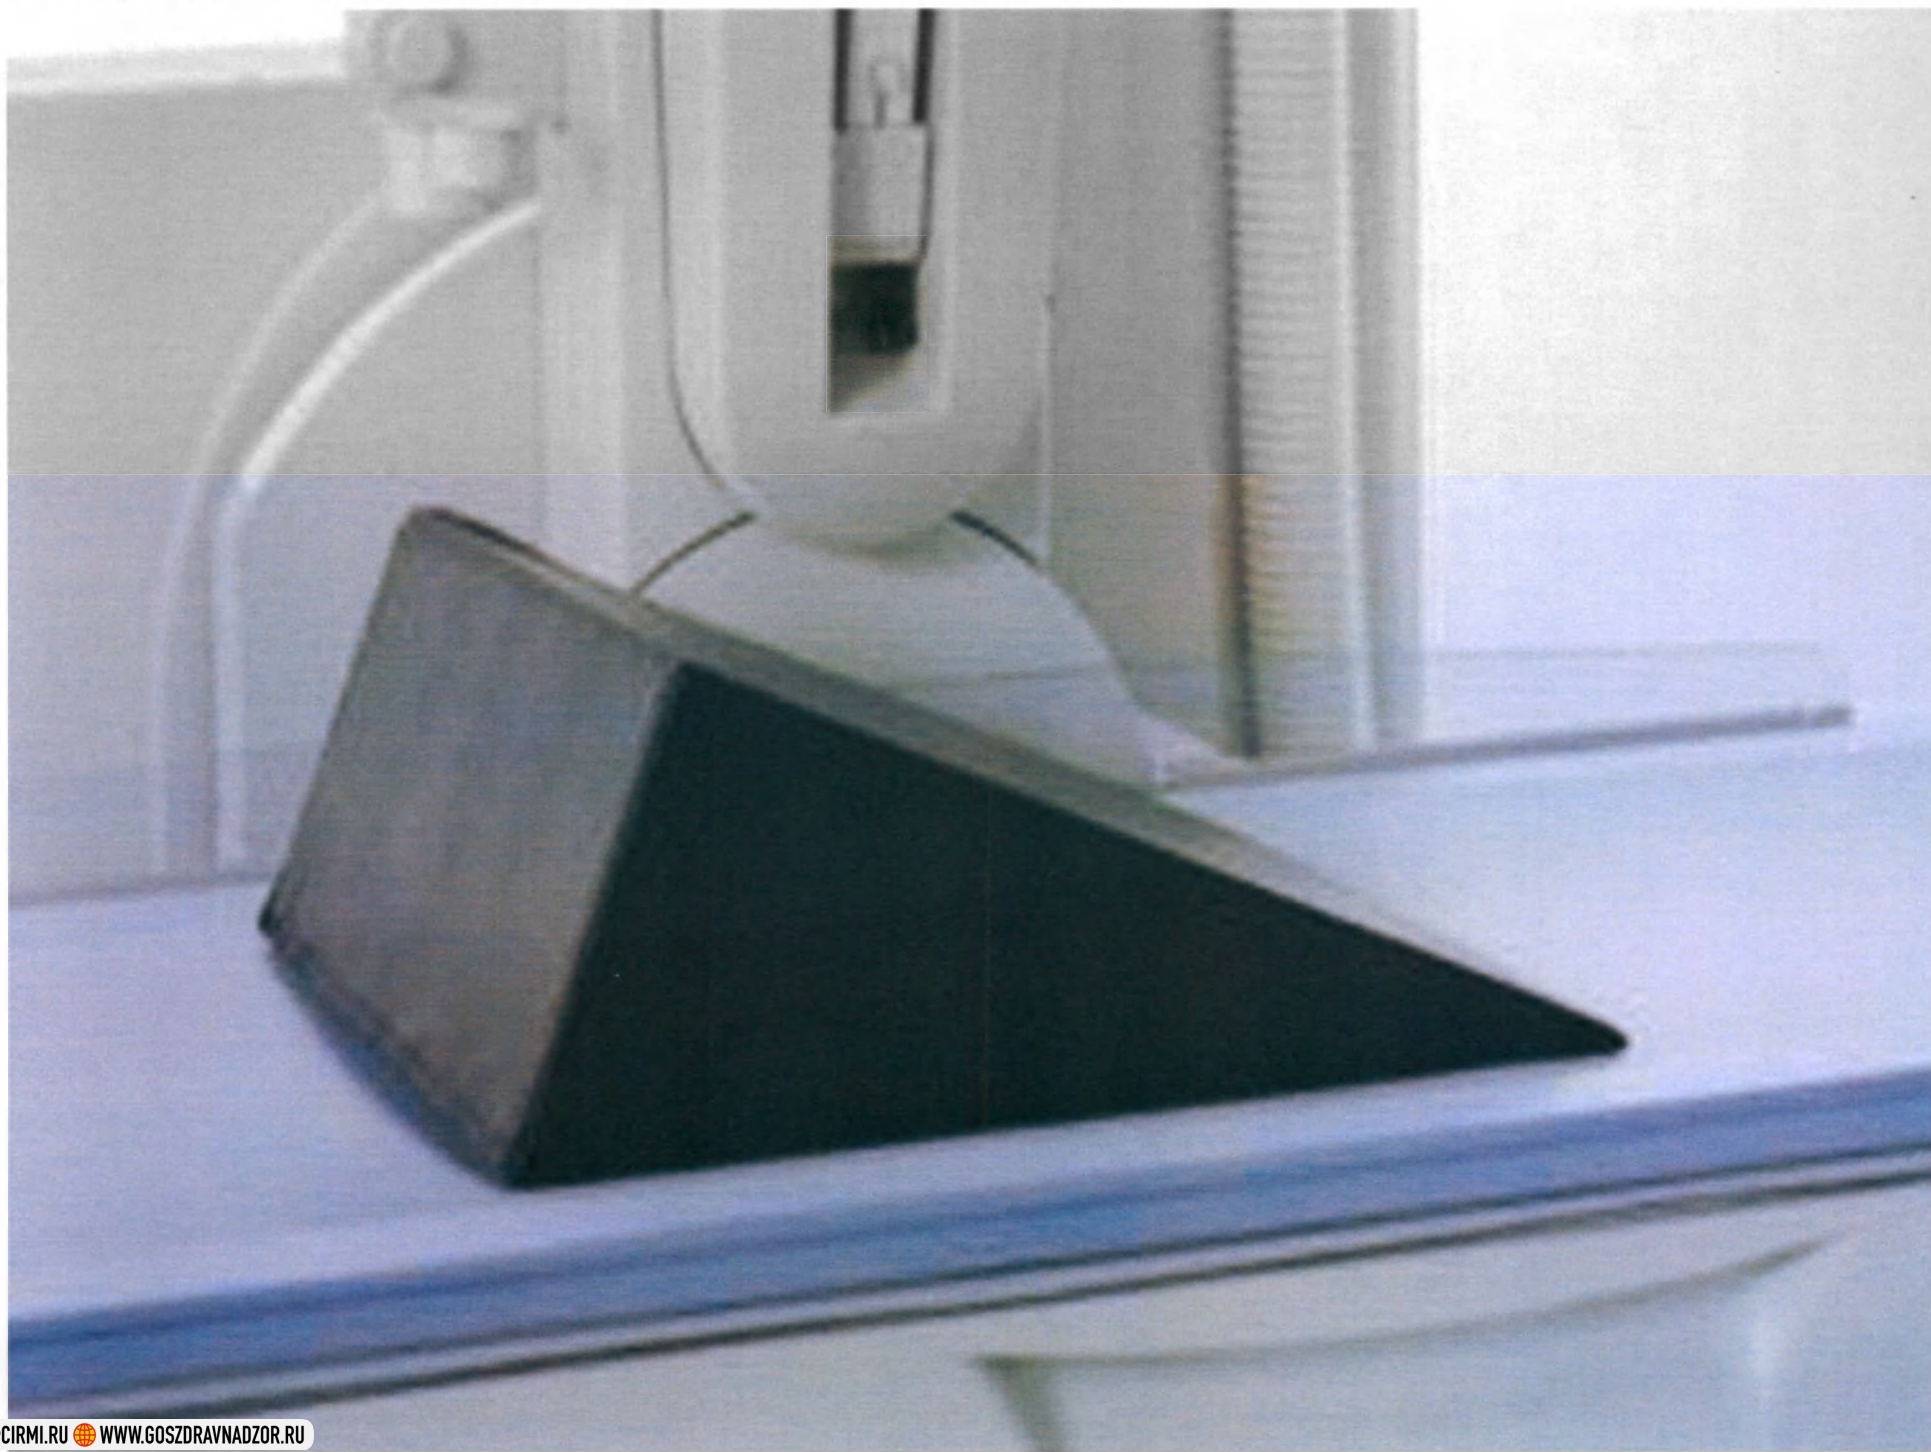

18. Держатель шторки, не более 2 шт.




19. Монтажный крепеж для урологических приспособлений, 1 шт.

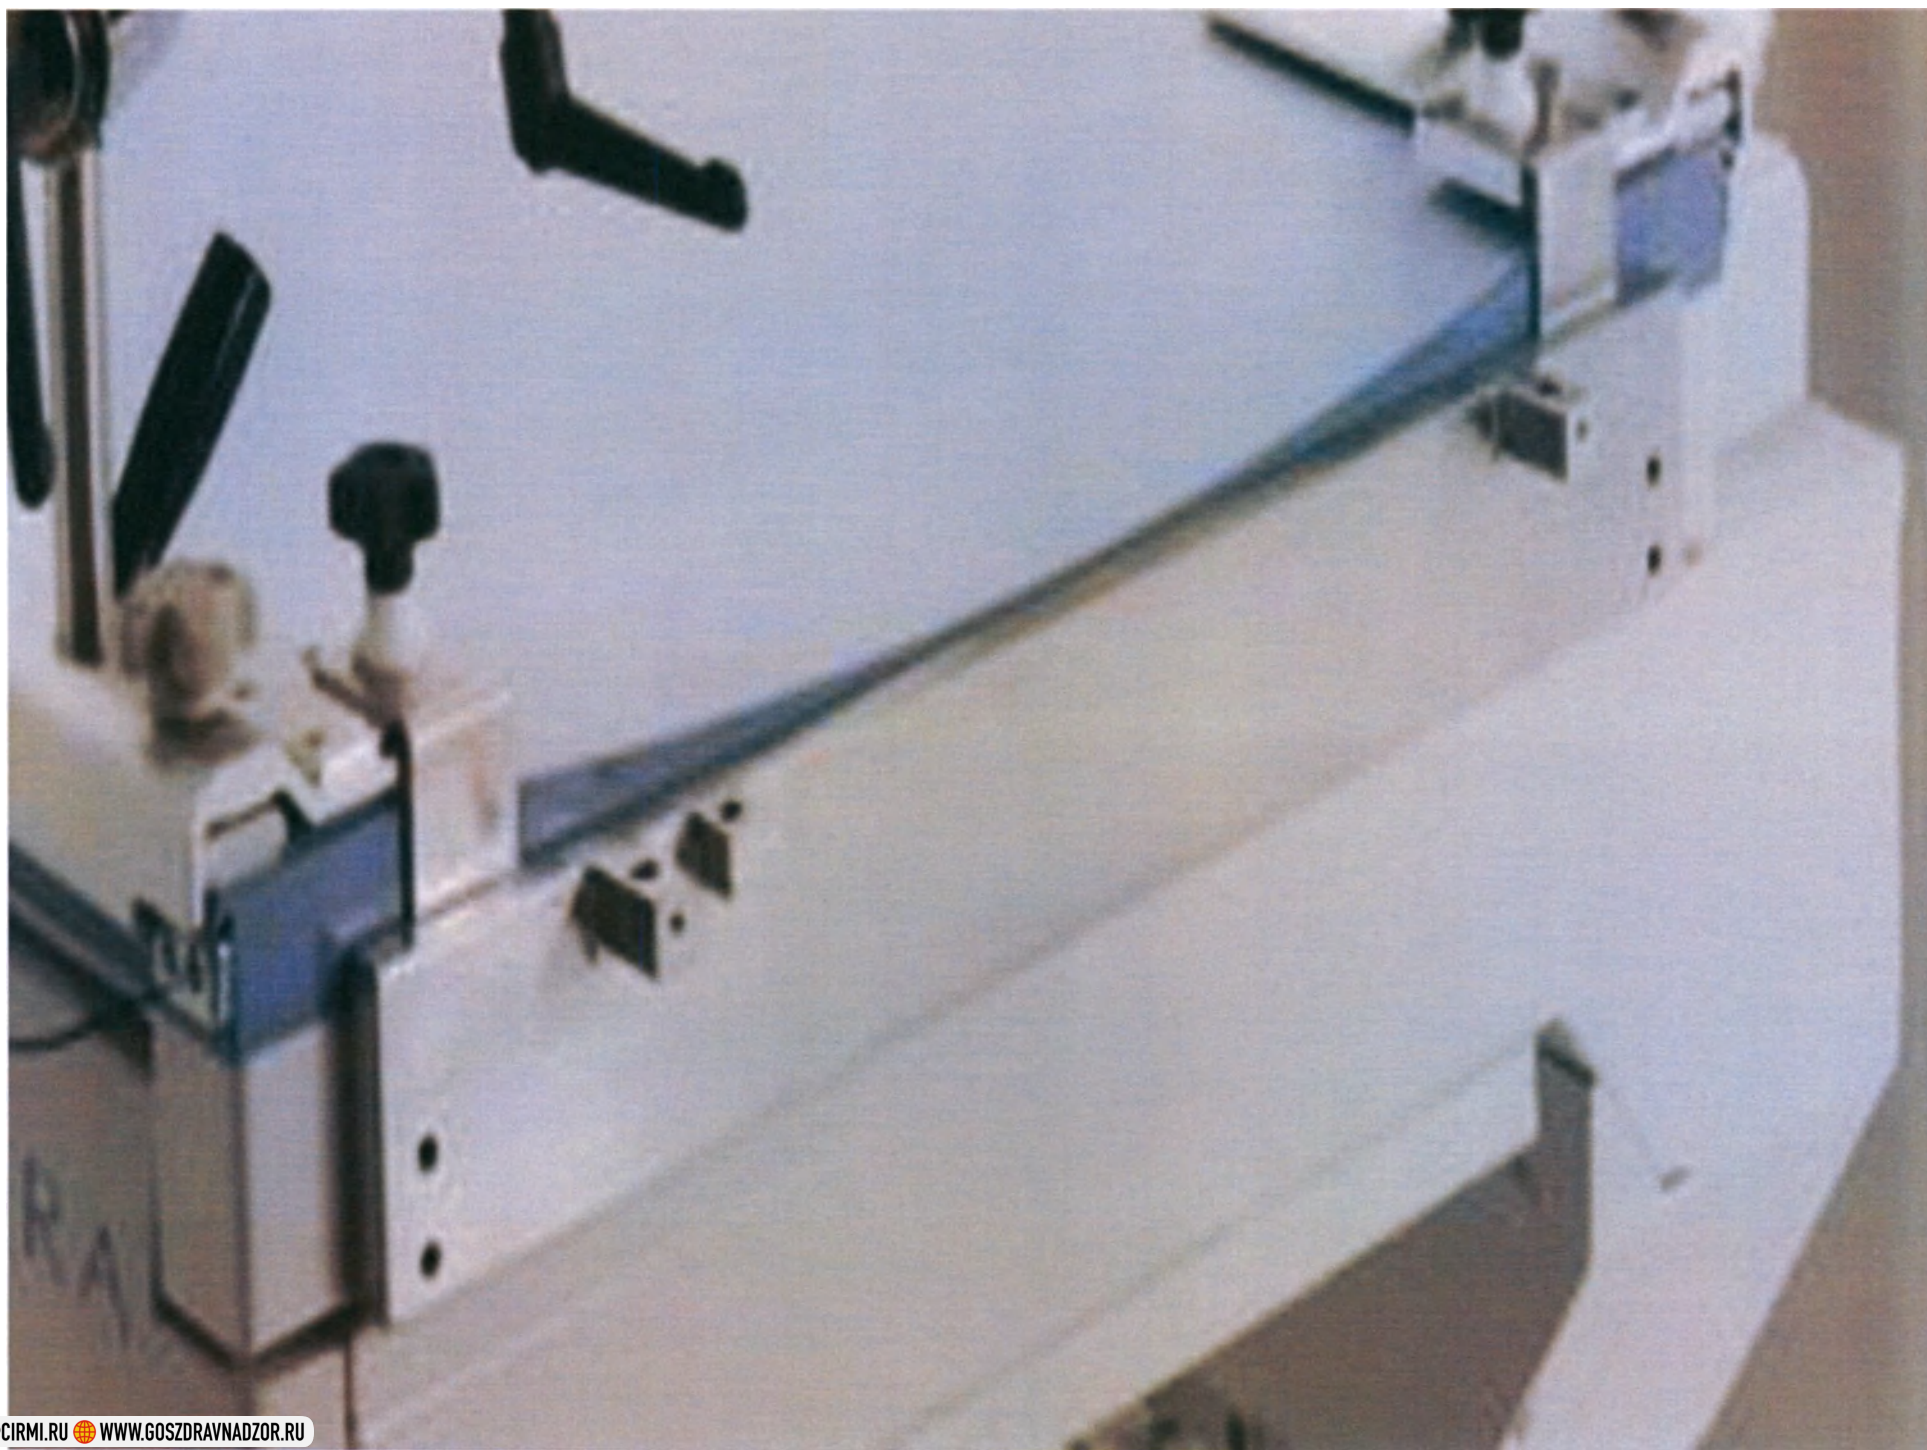


20. Рентгенозащитная шторка, 1 шт.



21. Поддон, 1 шт.

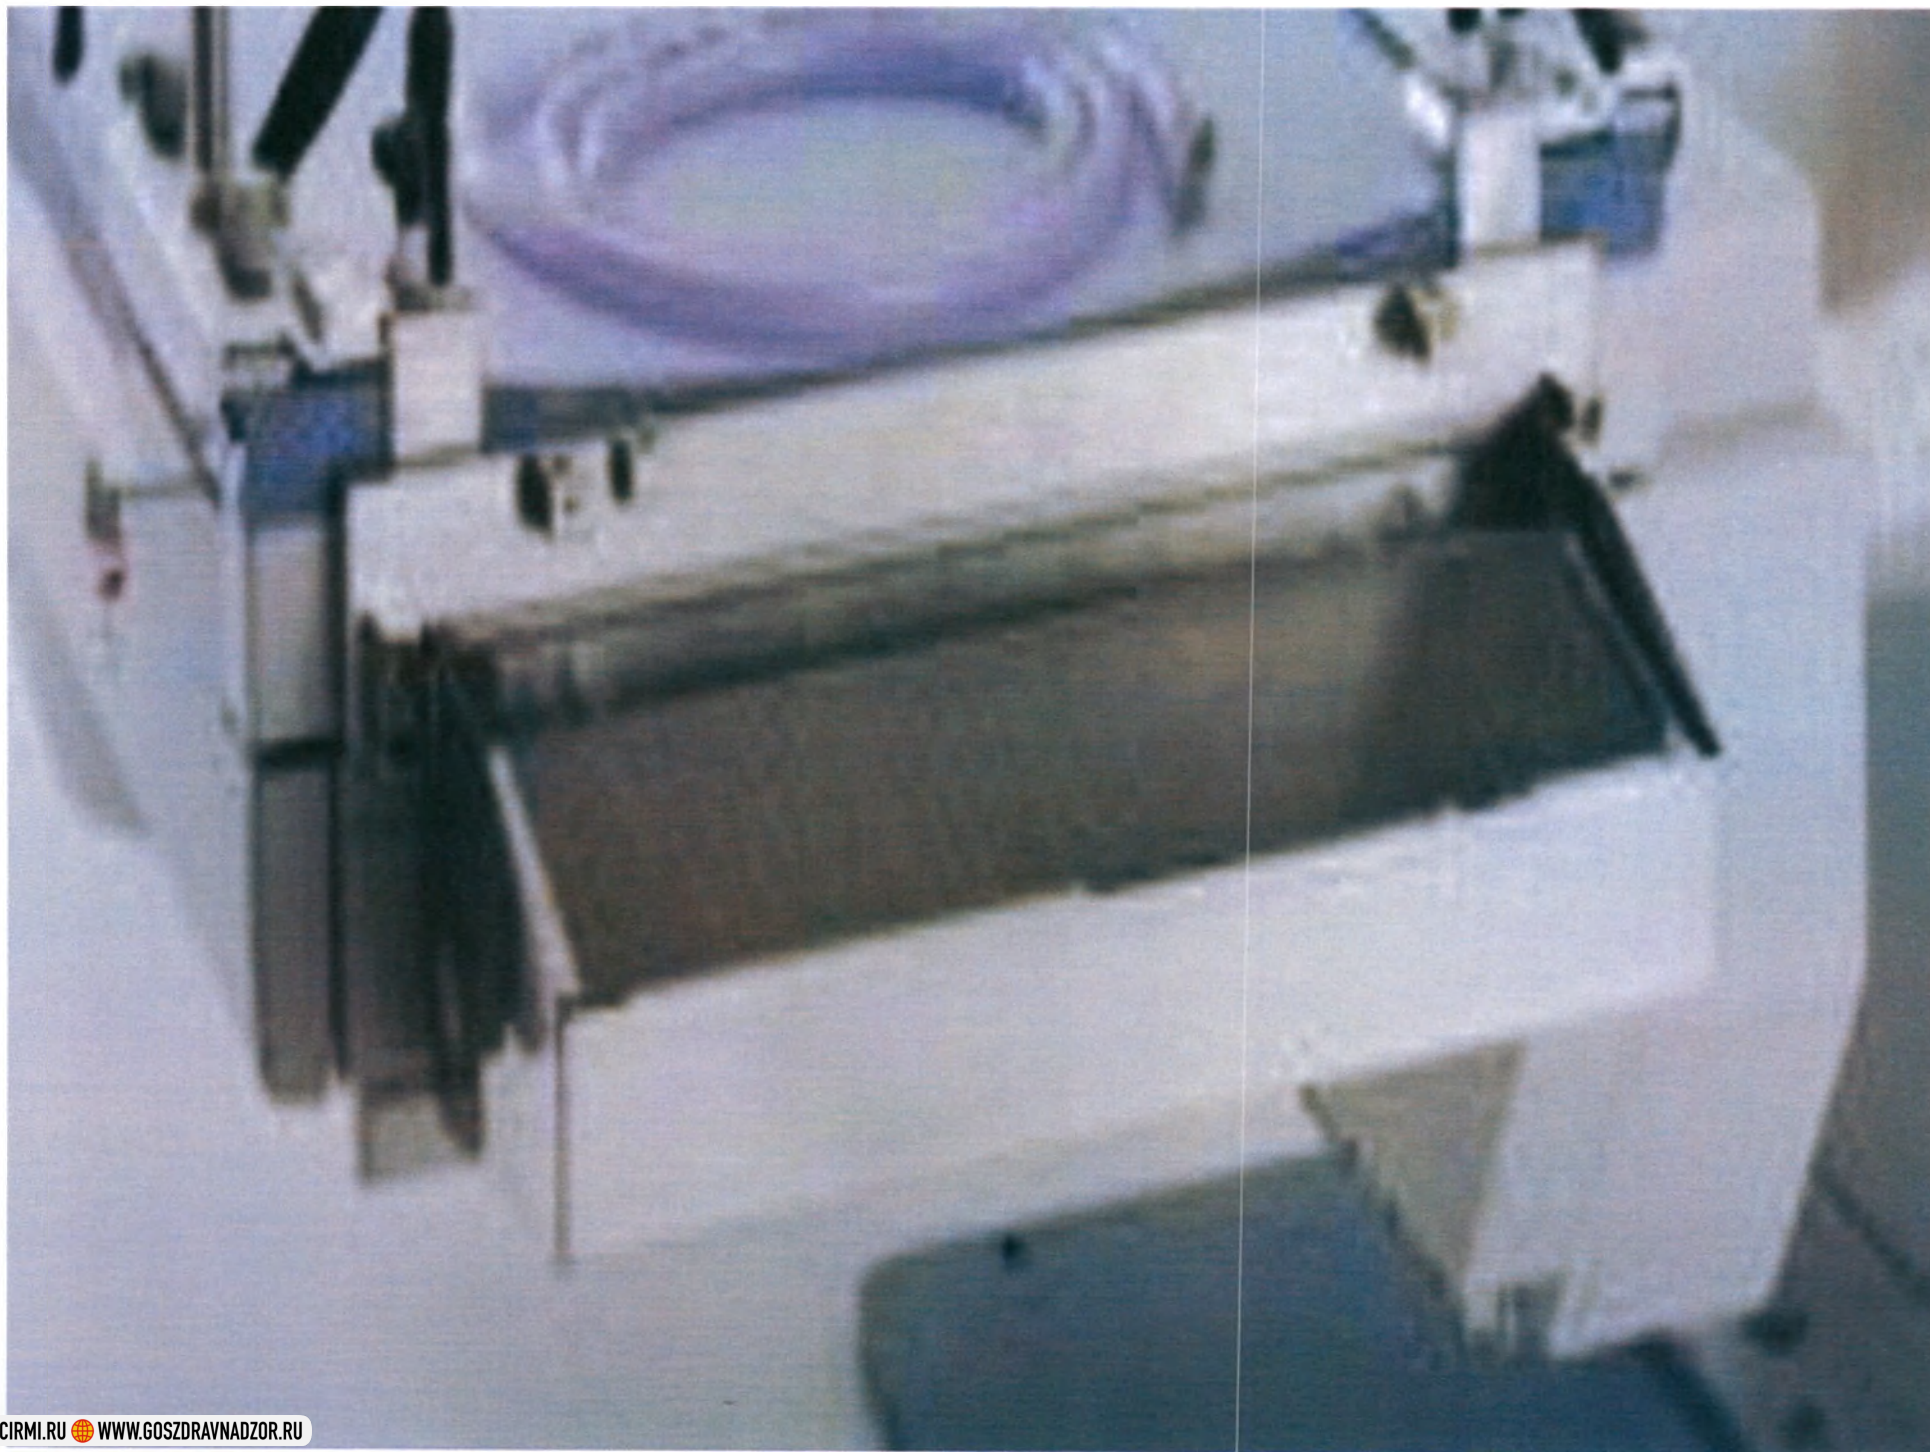


22. Подлокотник, 1 шт.

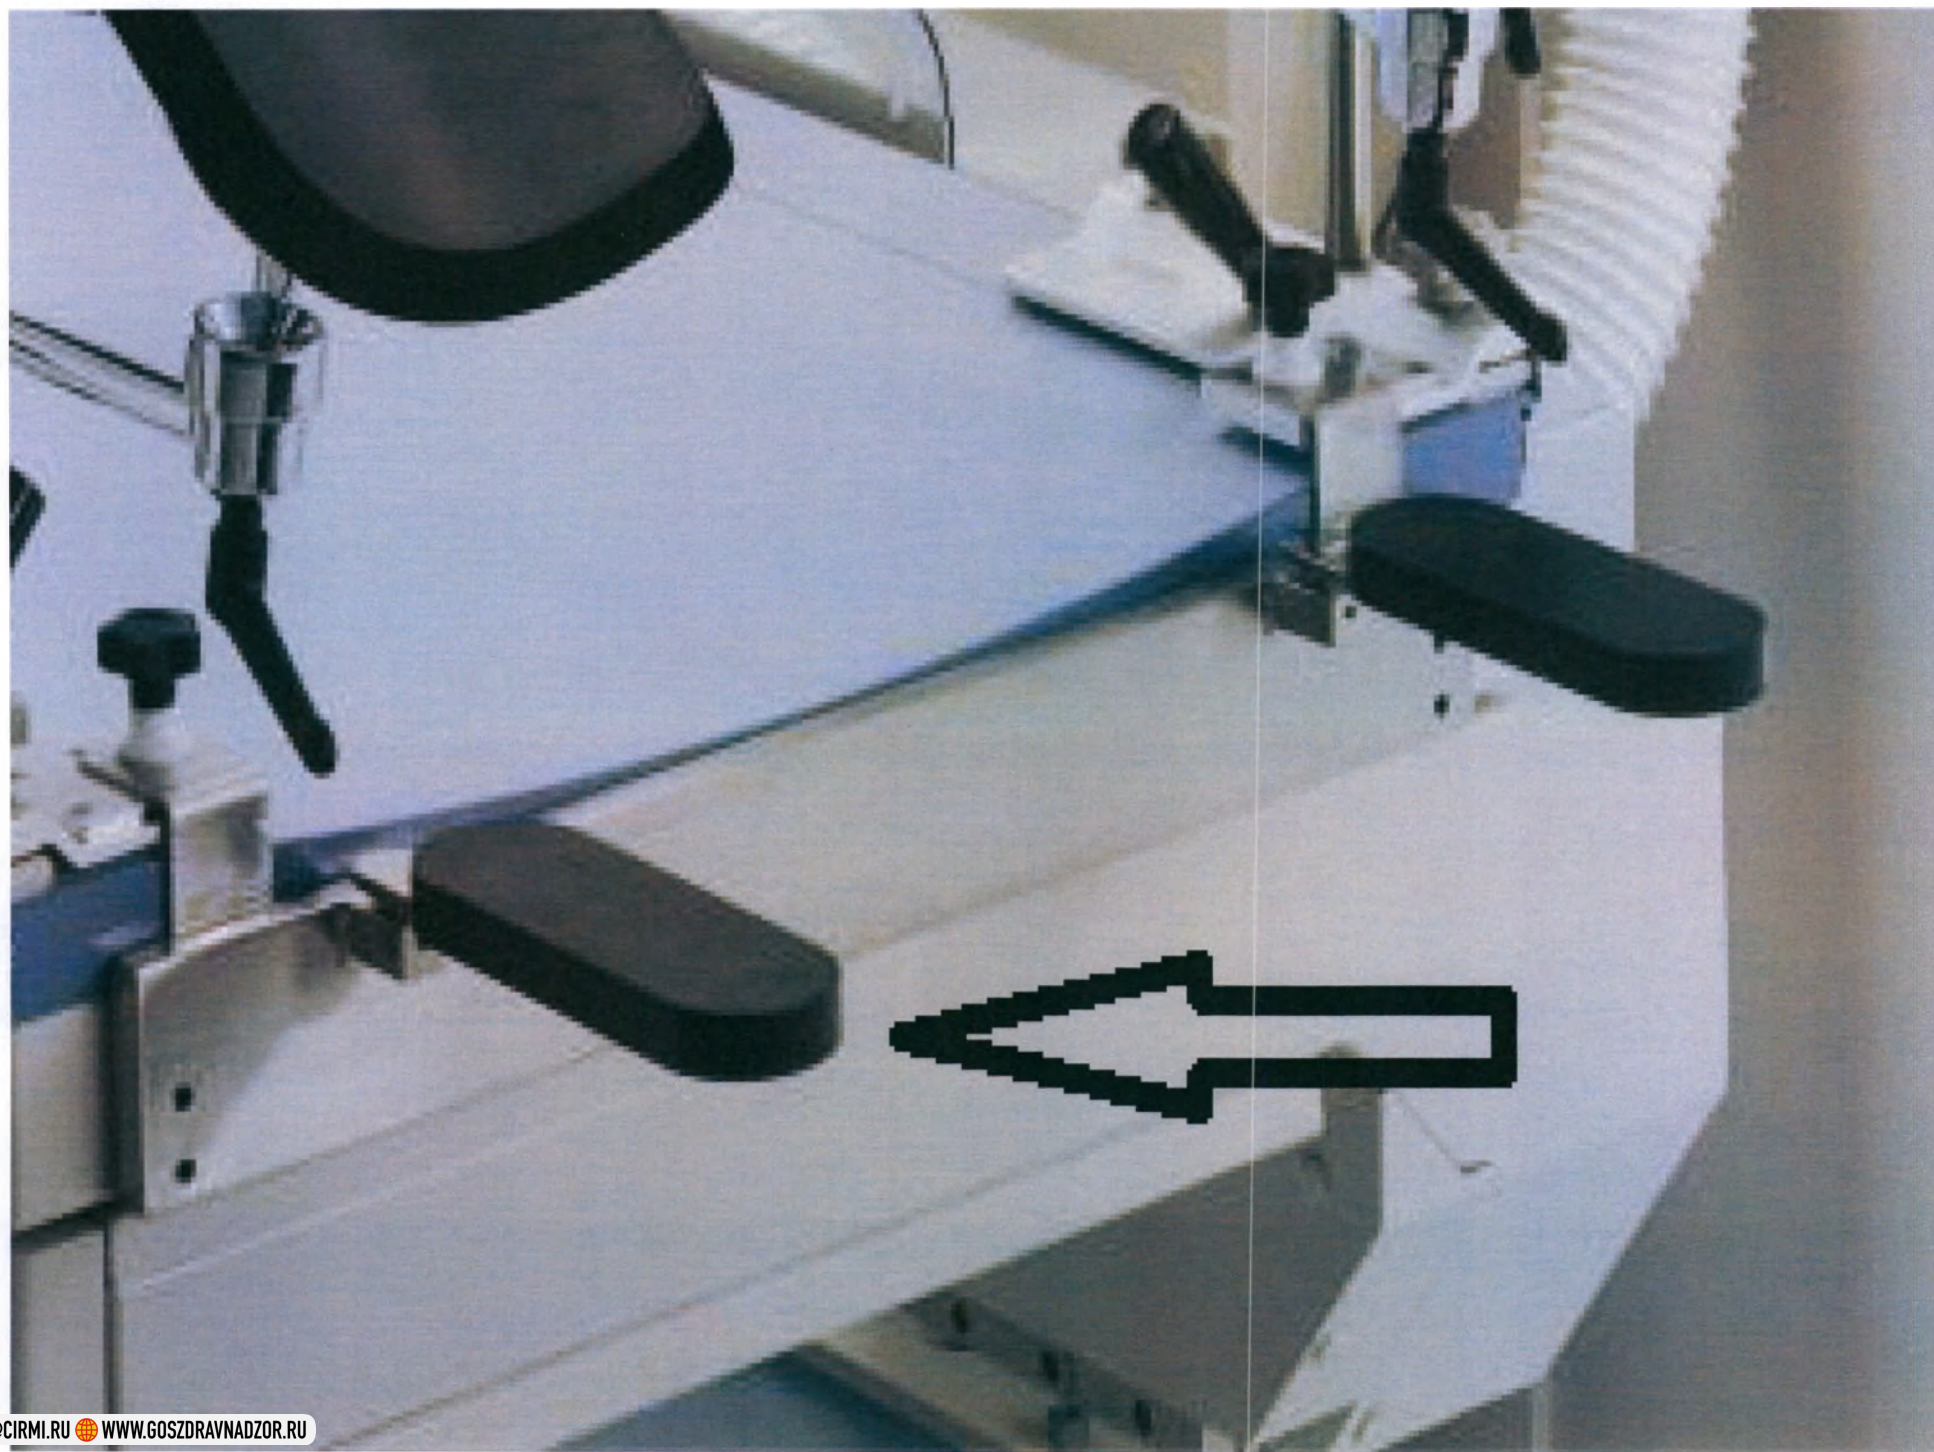


23. Крепеж-держатель для сливного мешка, 1 шт.




24. Держатель цистоскопа, 1 шт.

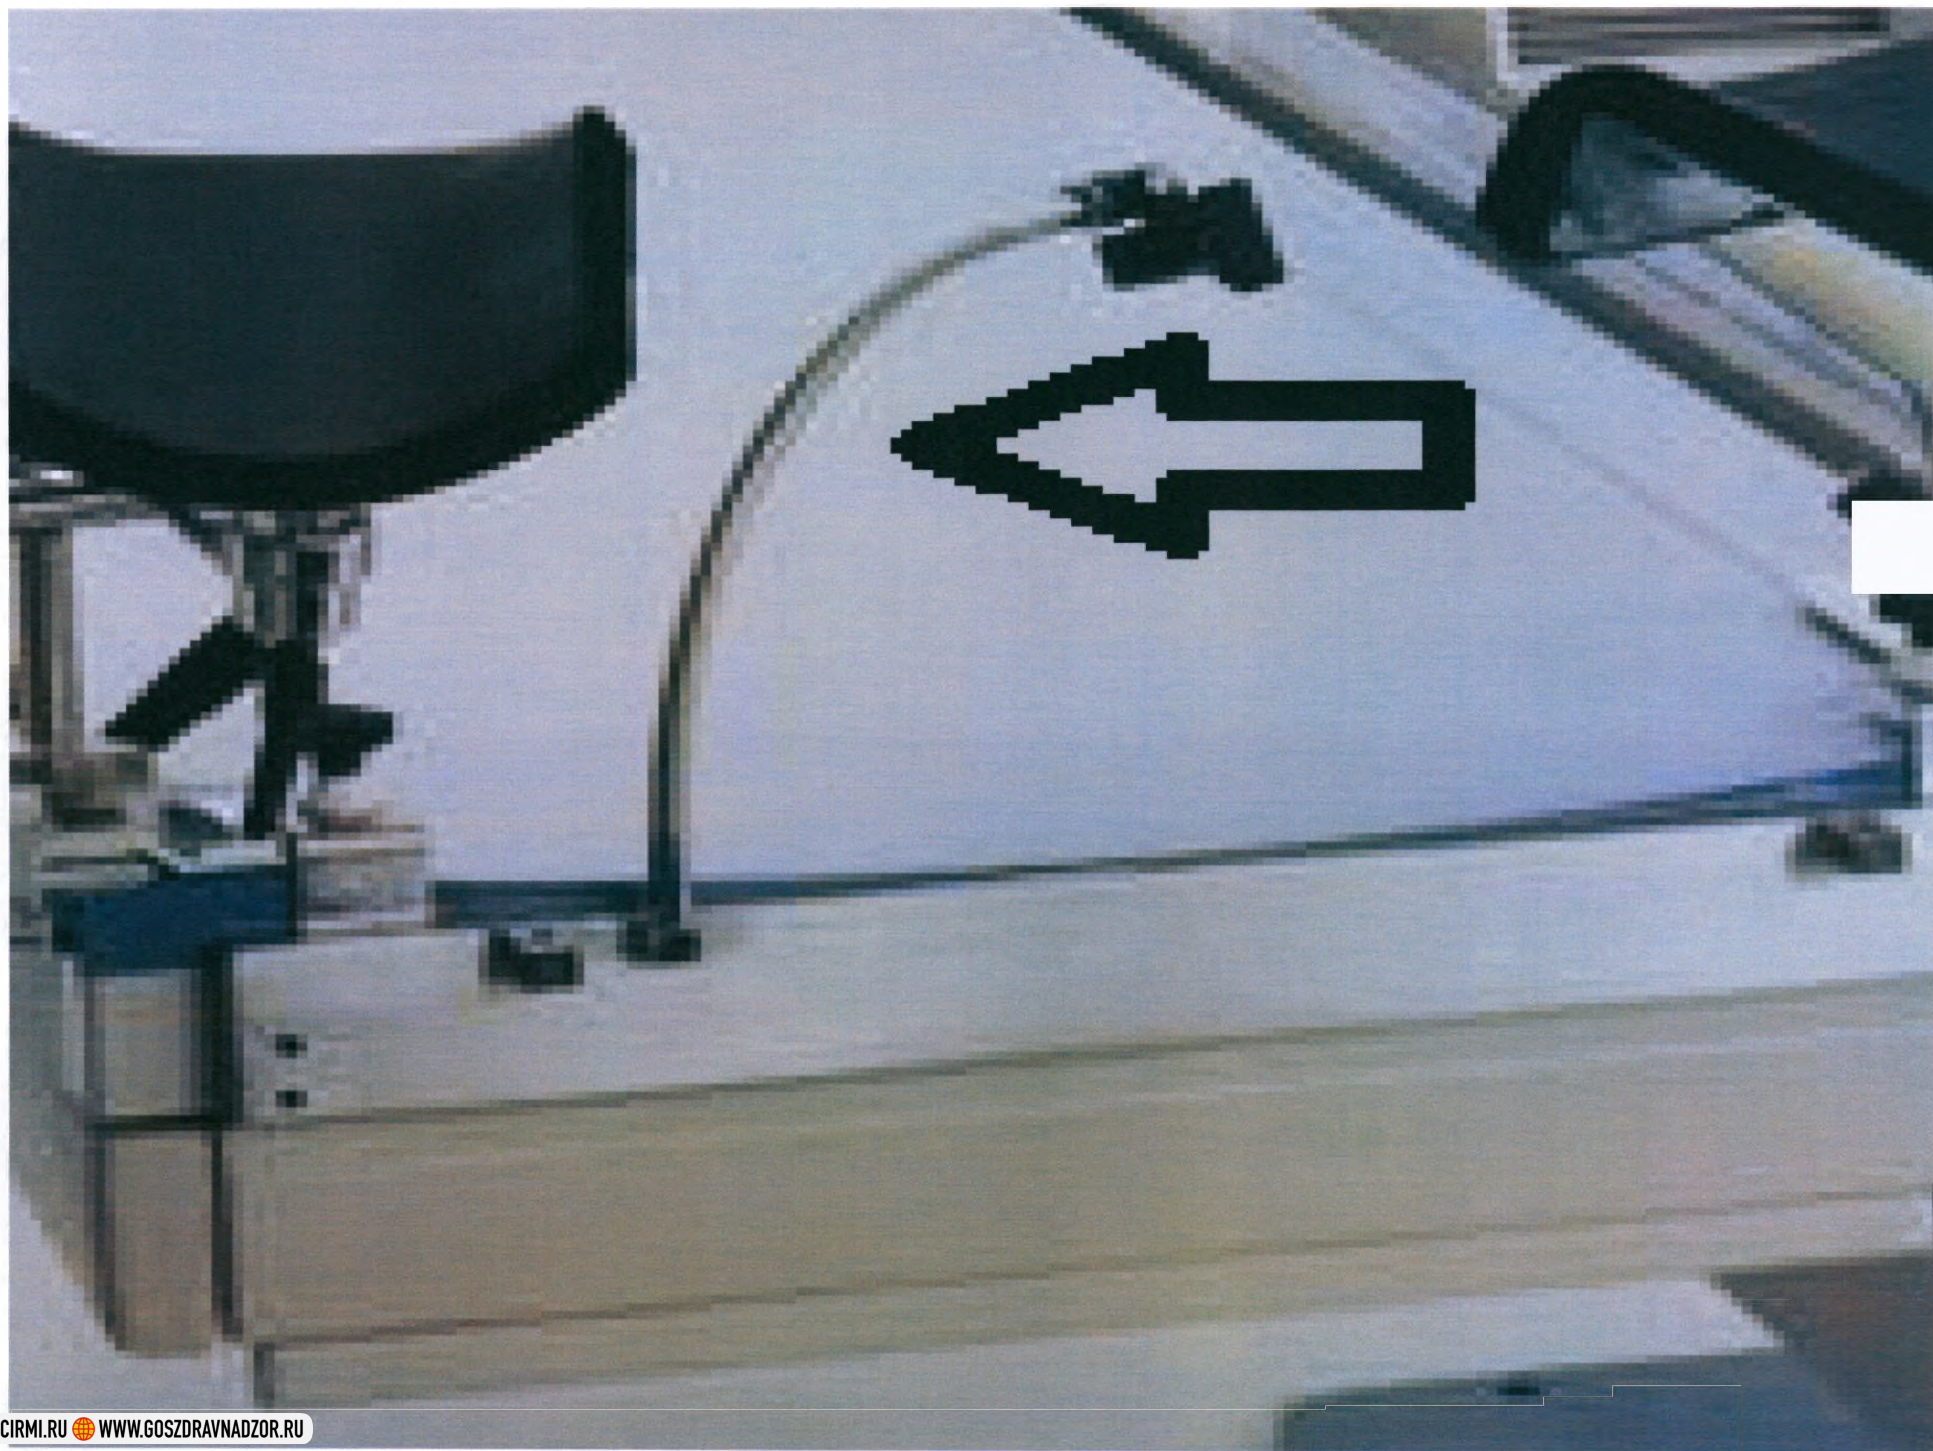


25. Тележка для одного монитора, 1 шт.

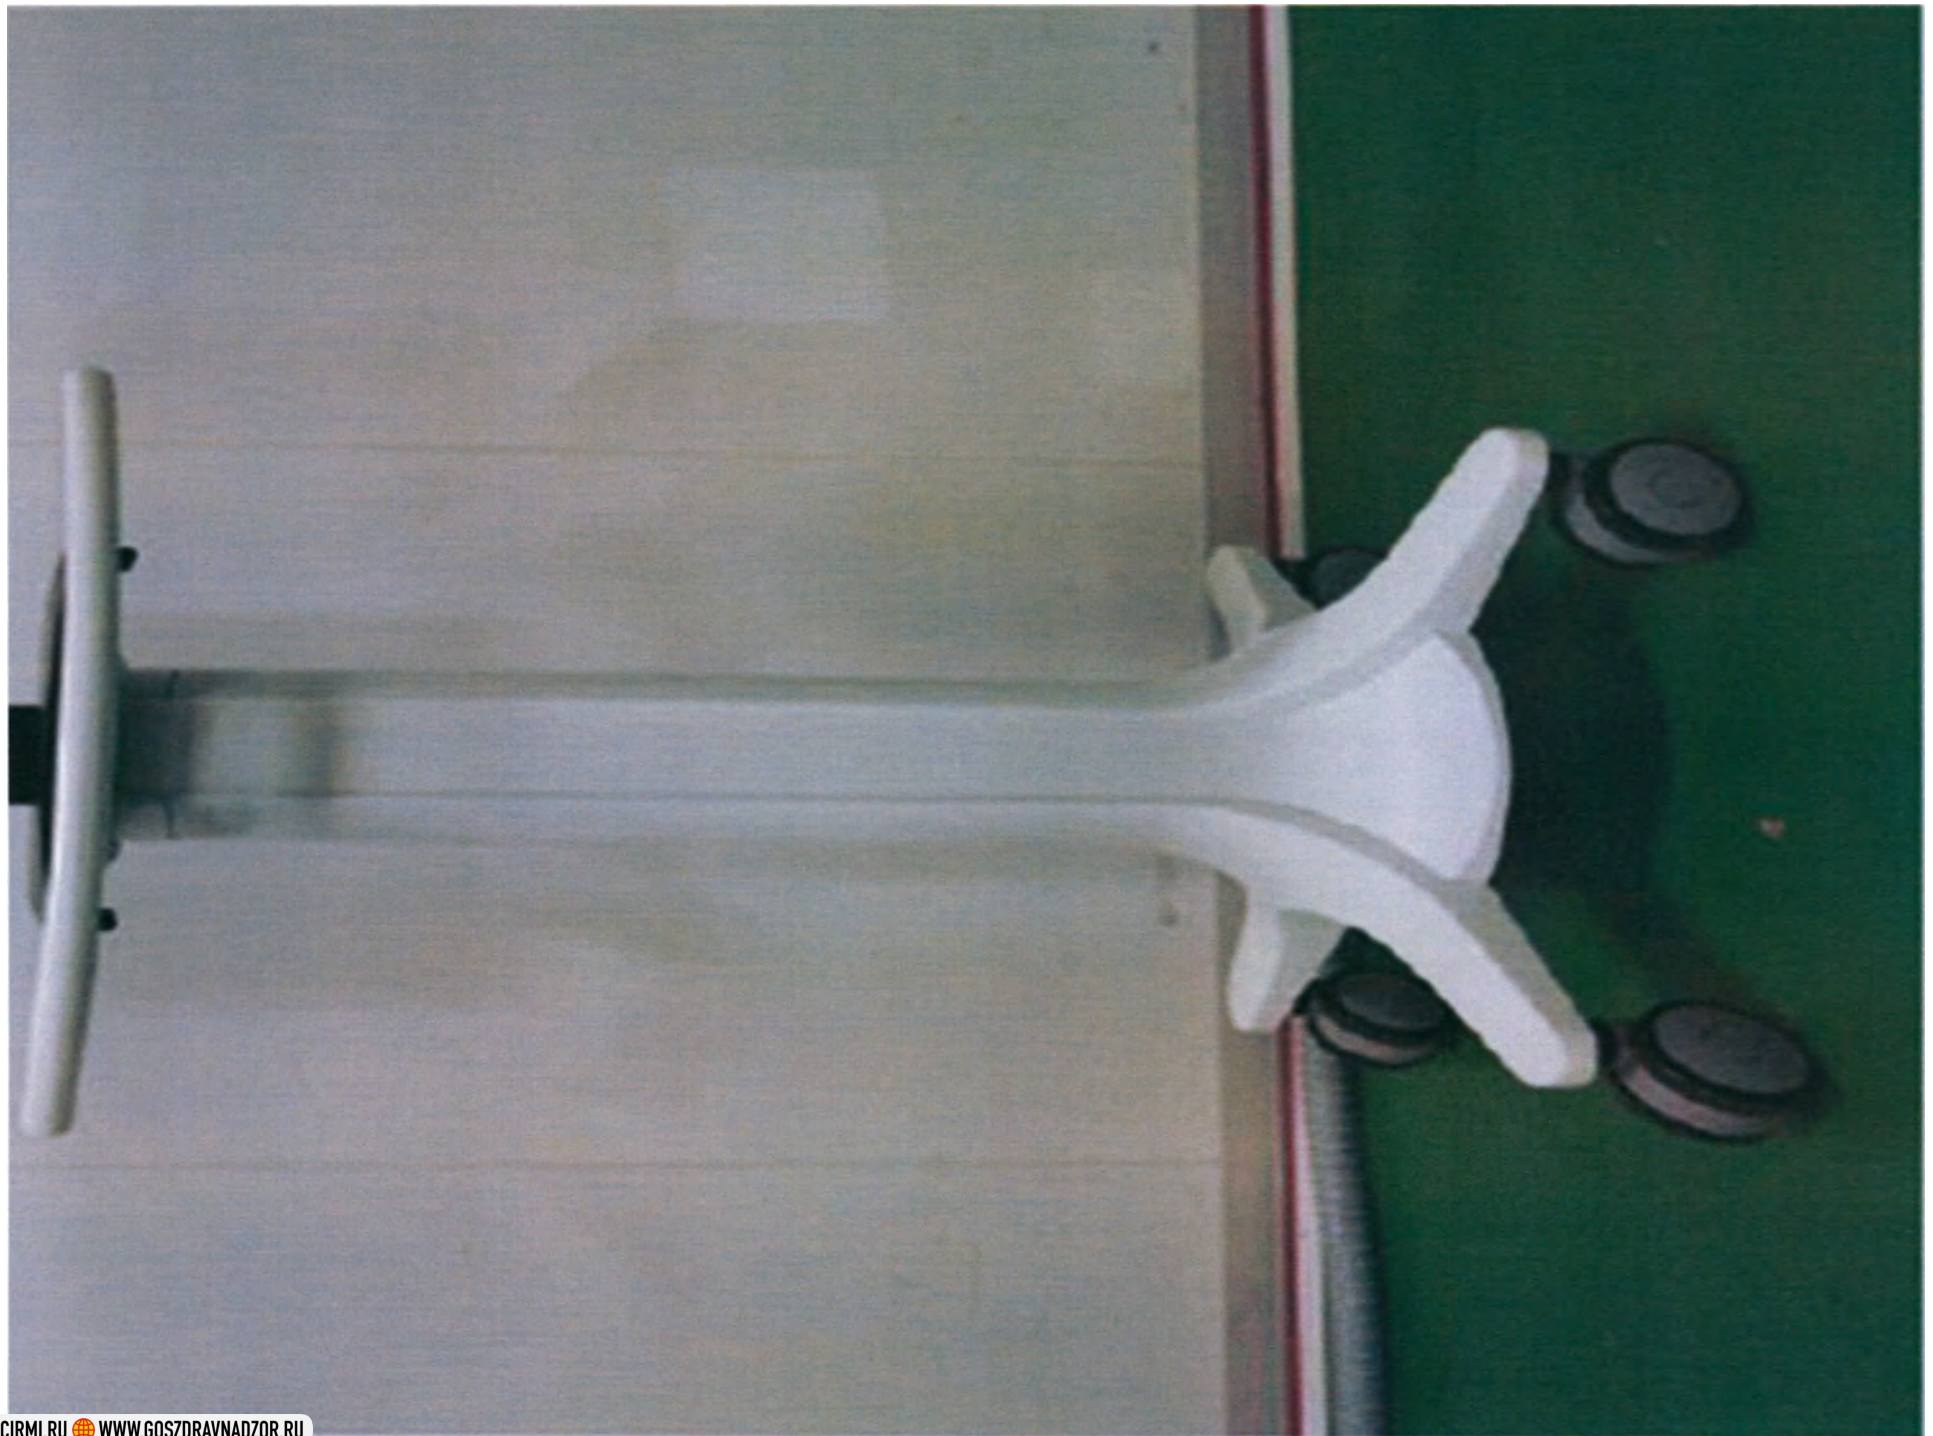


26. Тележка для двух мониторов, 1 шт.

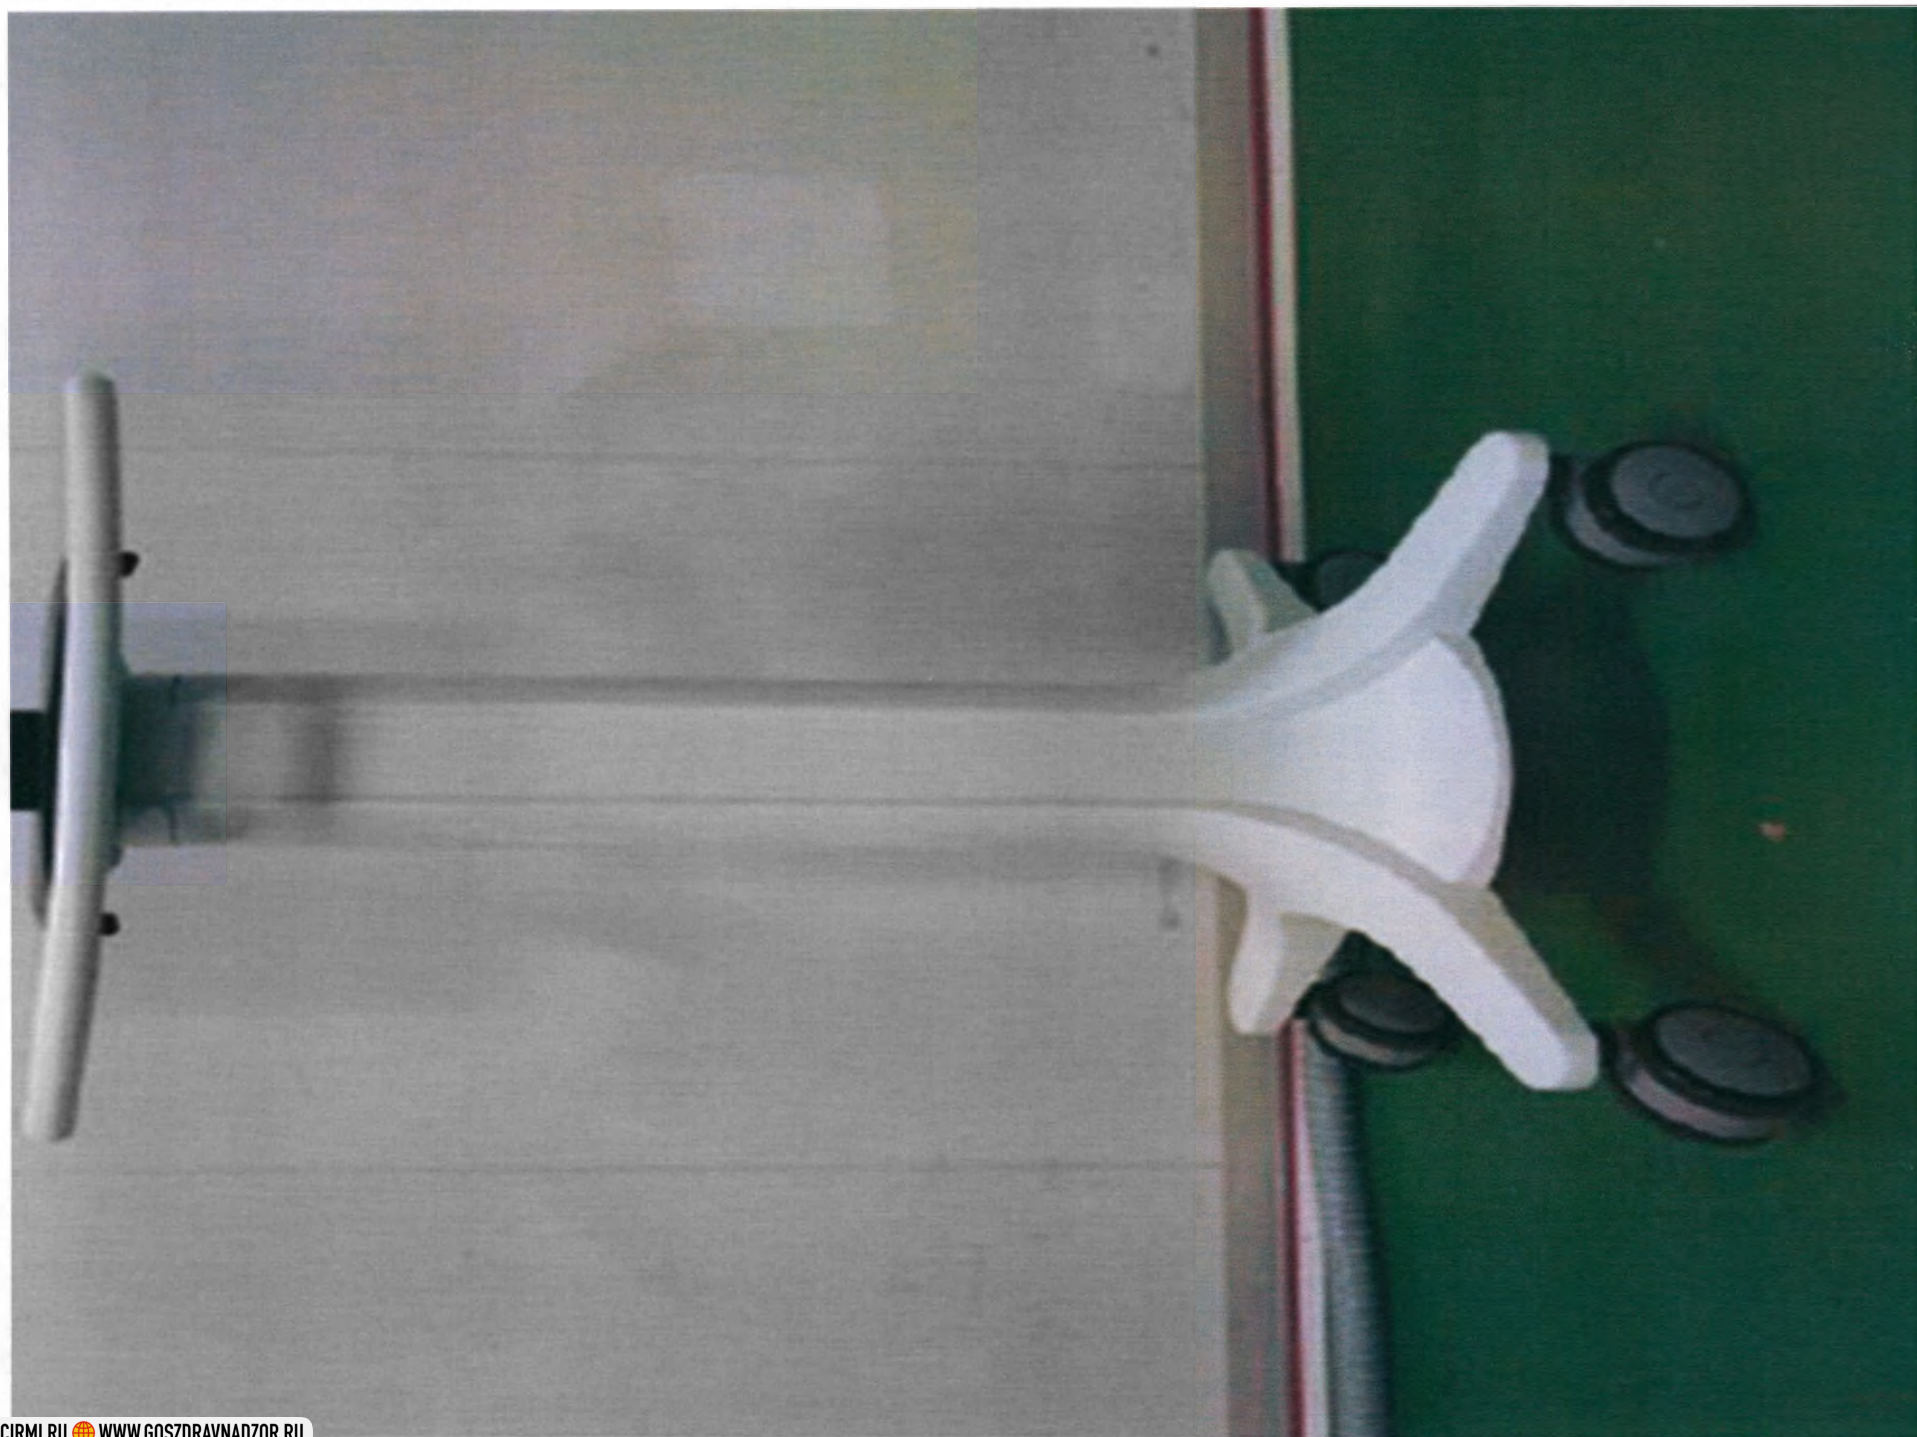


27. Локальный пульт управления, в составе: - Локальный пульт управления, 1 шт.;

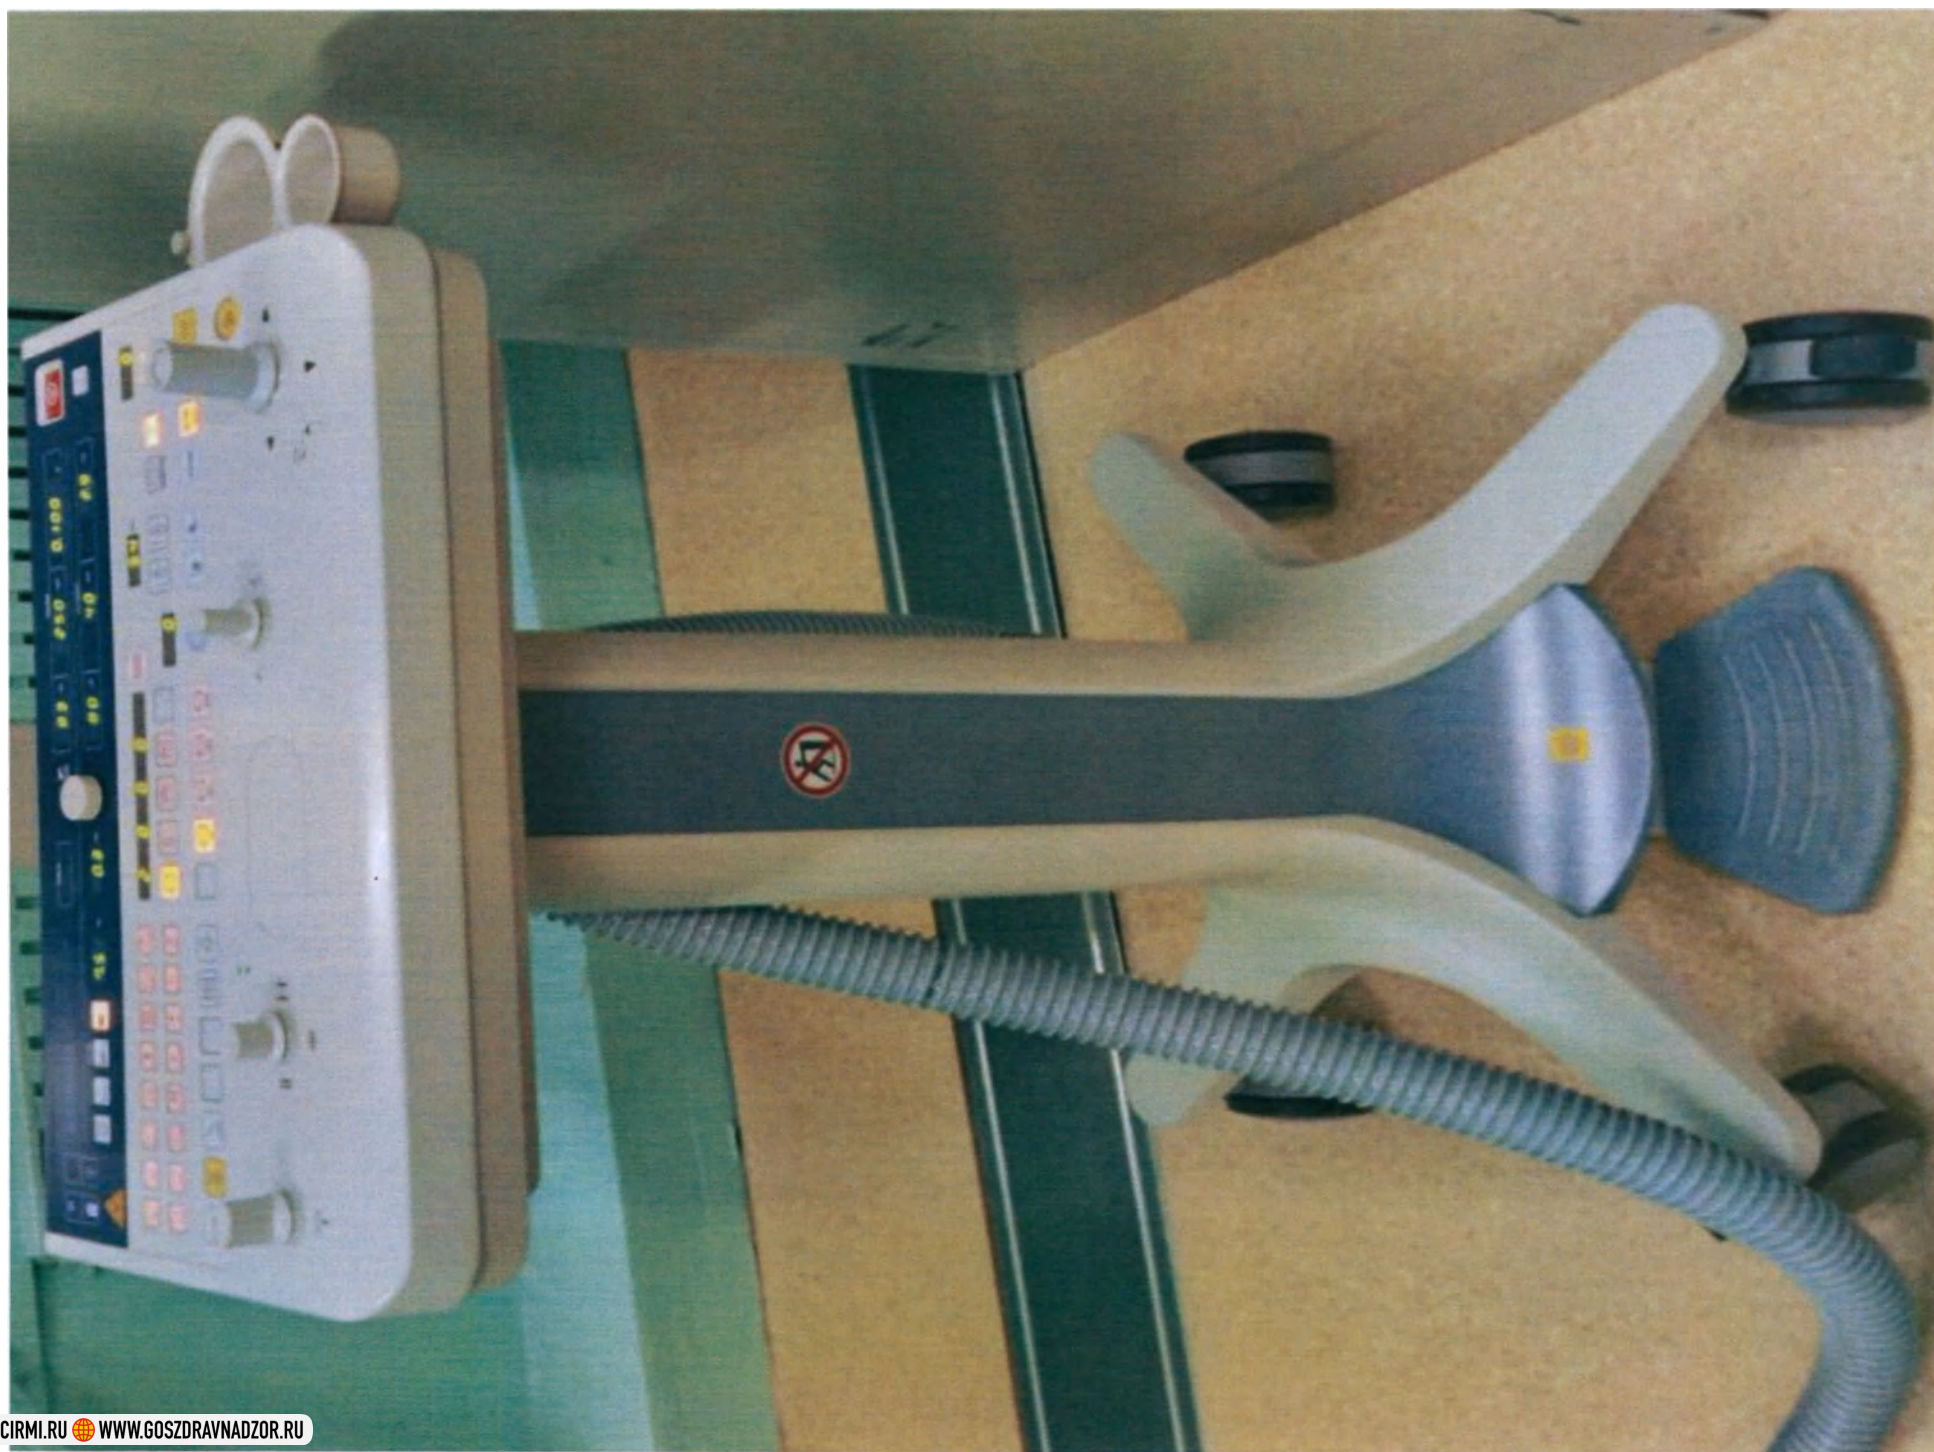


- Клавиатура для локального пульта управления, 1 шт.

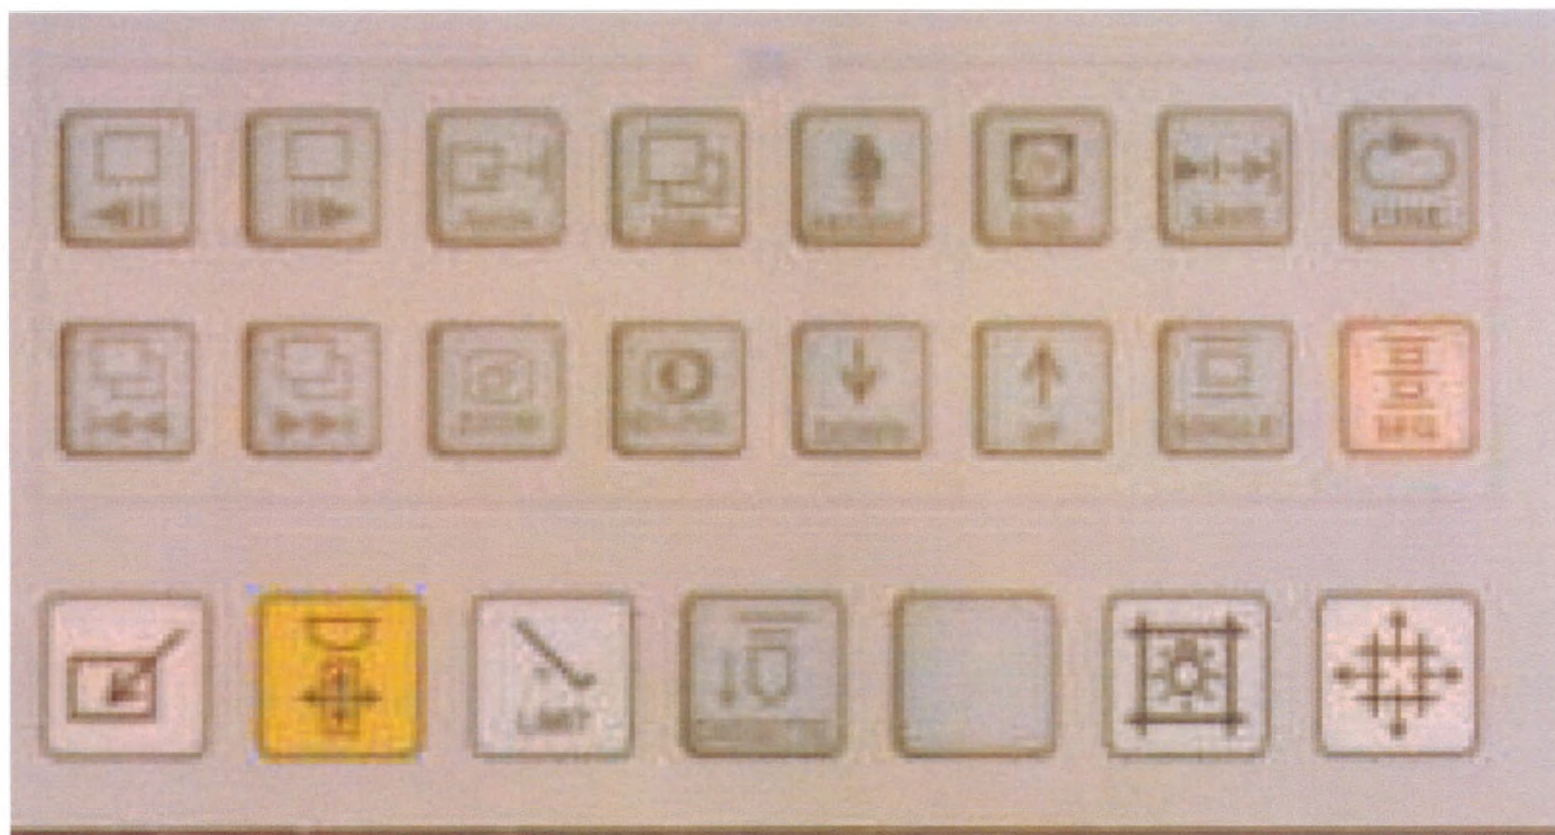

28. Блок перемещения рентгеновской трубки в направлении пациента (второго типа), 1 шт.

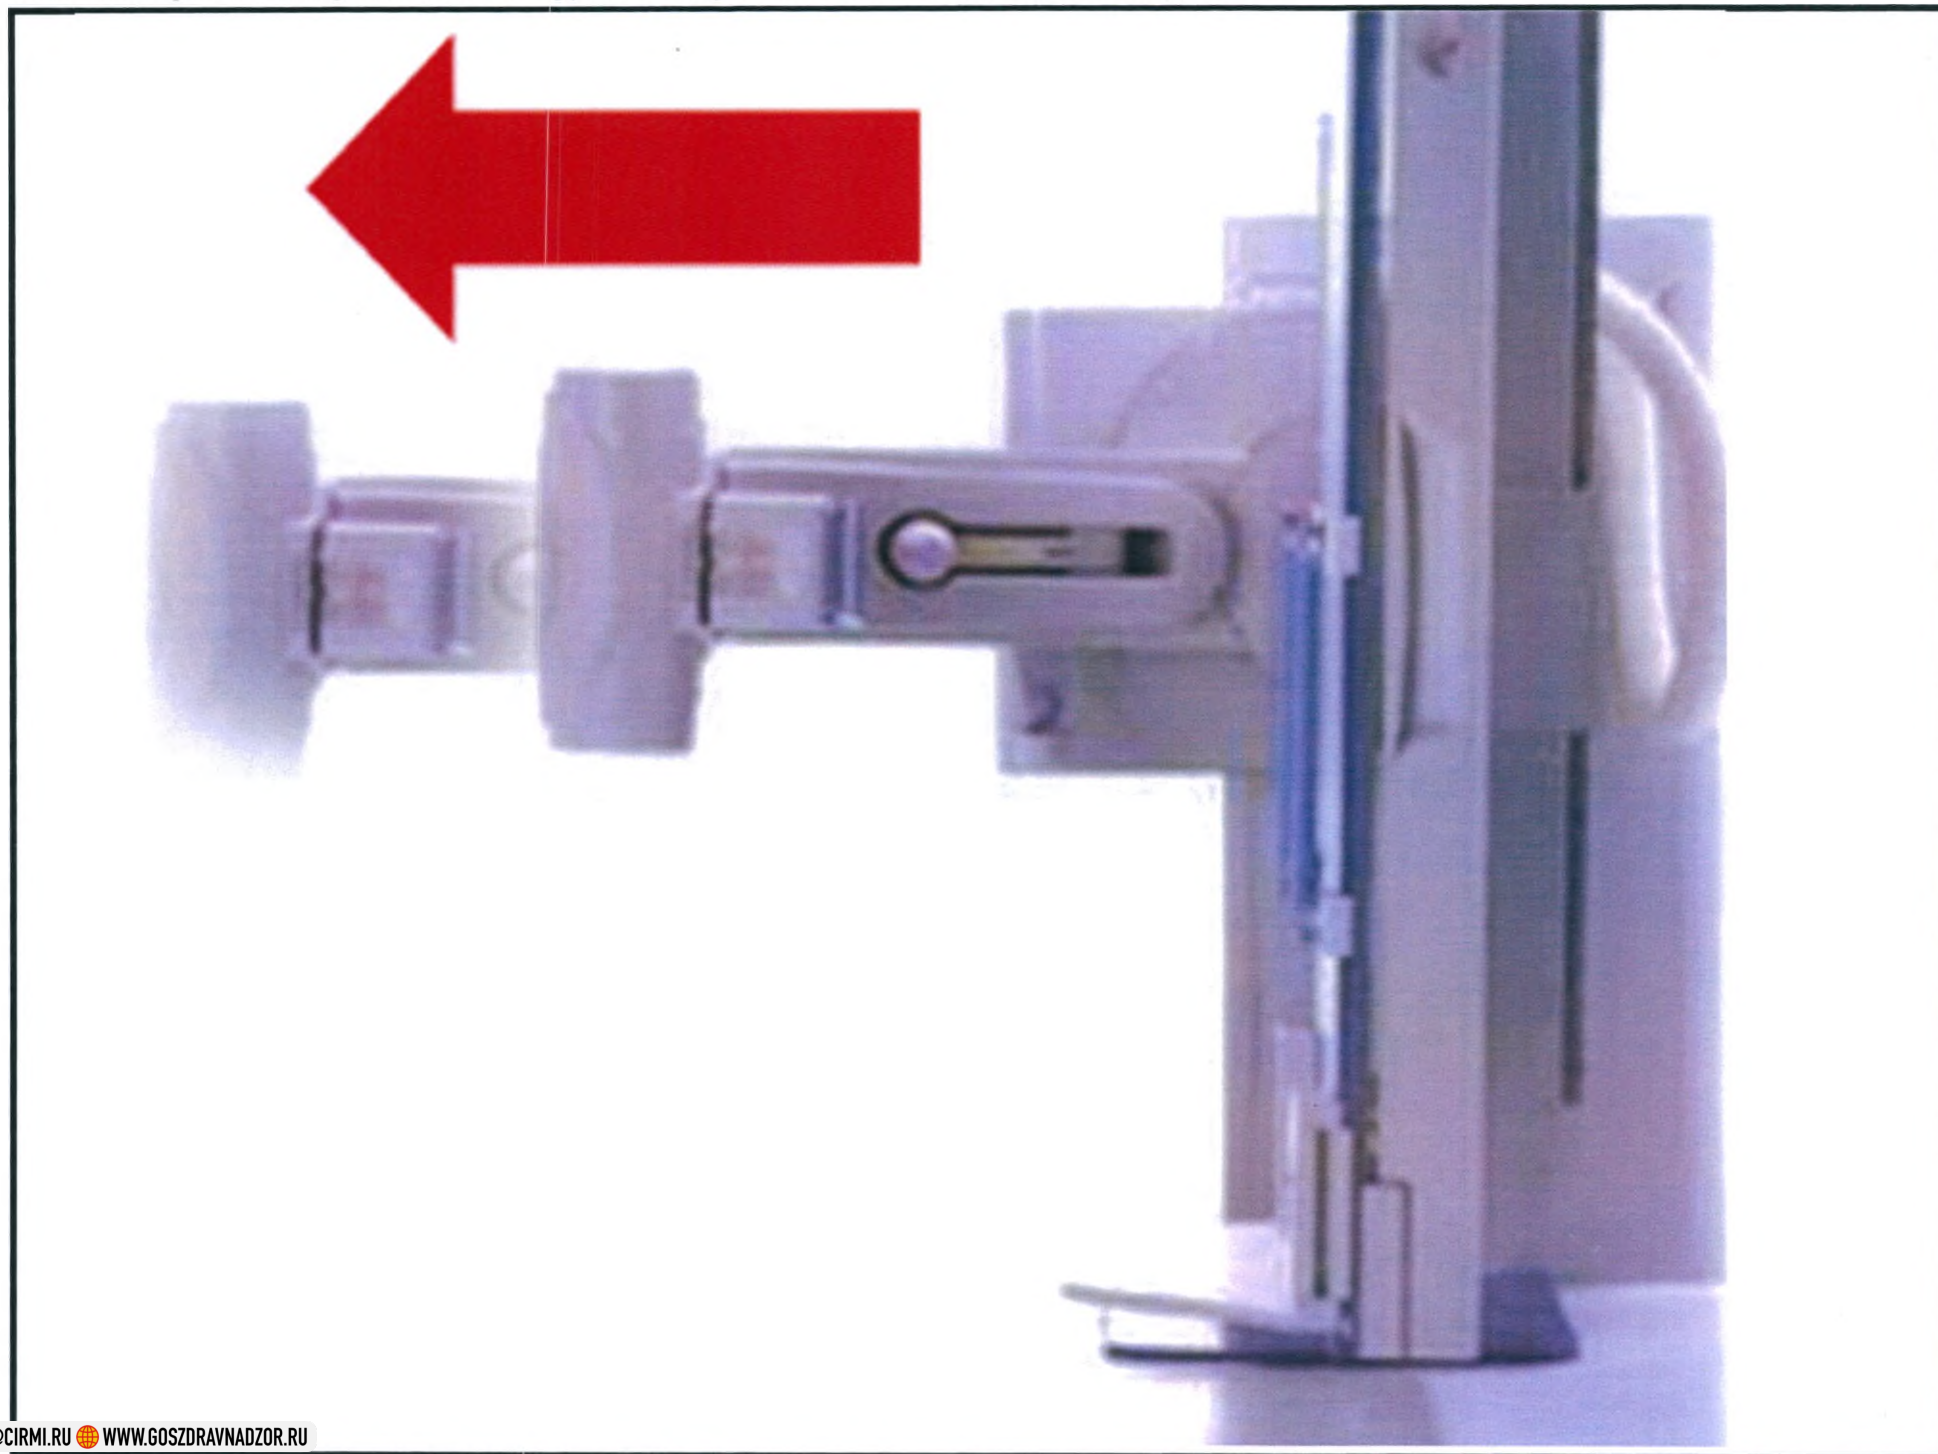

29. Программное обеспечение DICOM MPPS.

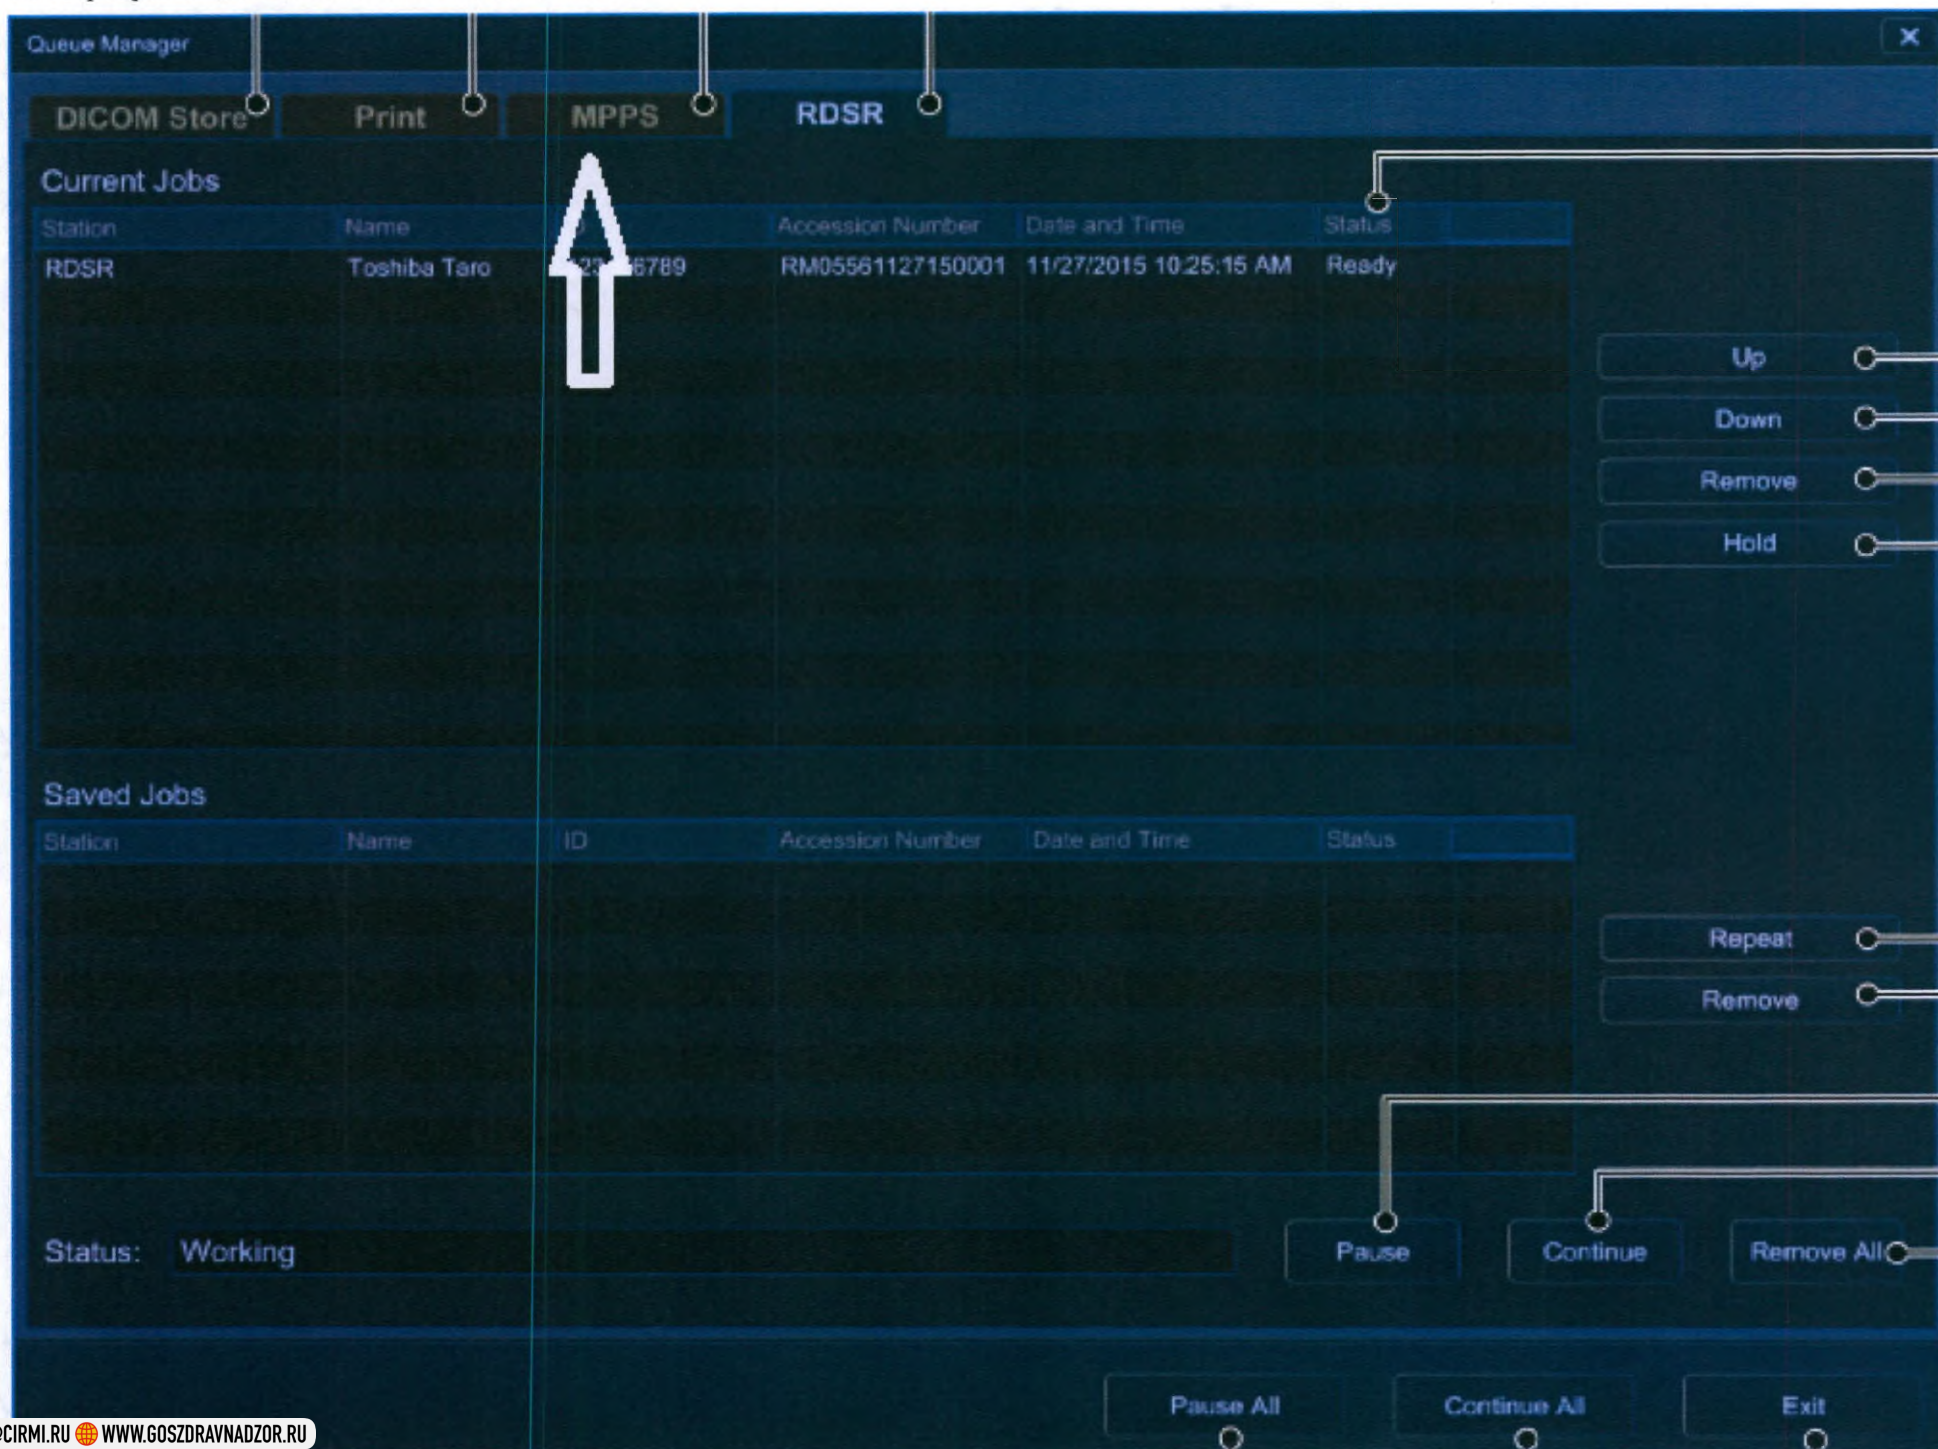

30. Программное обеспечение DICOM MWM.

Patient Examination Details

ID	UG_111111_175927		
Last Name		Title	
Middle Name			
First Name		Suffix	
Date of Birth (yyyy/mm/dd)		Age	
Sex	☐ Male ☐ Female ☐ Other		
Operator's Name			
Accession No.			
Study Description			
Performing Physician			
Referring Physician			
Patient Comment			
Medical Alerts			

Modality Work List

Search Range: Today

Station ID: ALL

Modality: All Modalities

Date Range: To

Patient ID:

Patient Name: Last Name First Name

Accession No.:

Case No.:

Clear Get Work List

ID	Accession No.	Name
----	---------------	------

OK Cancel


31. Программное обеспечение DICOM MEDIA Storage.



32. Модуль для удаленной сервисной диагностики, 1 шт.




33. Рентгенозащитная пластина, 1 шт.

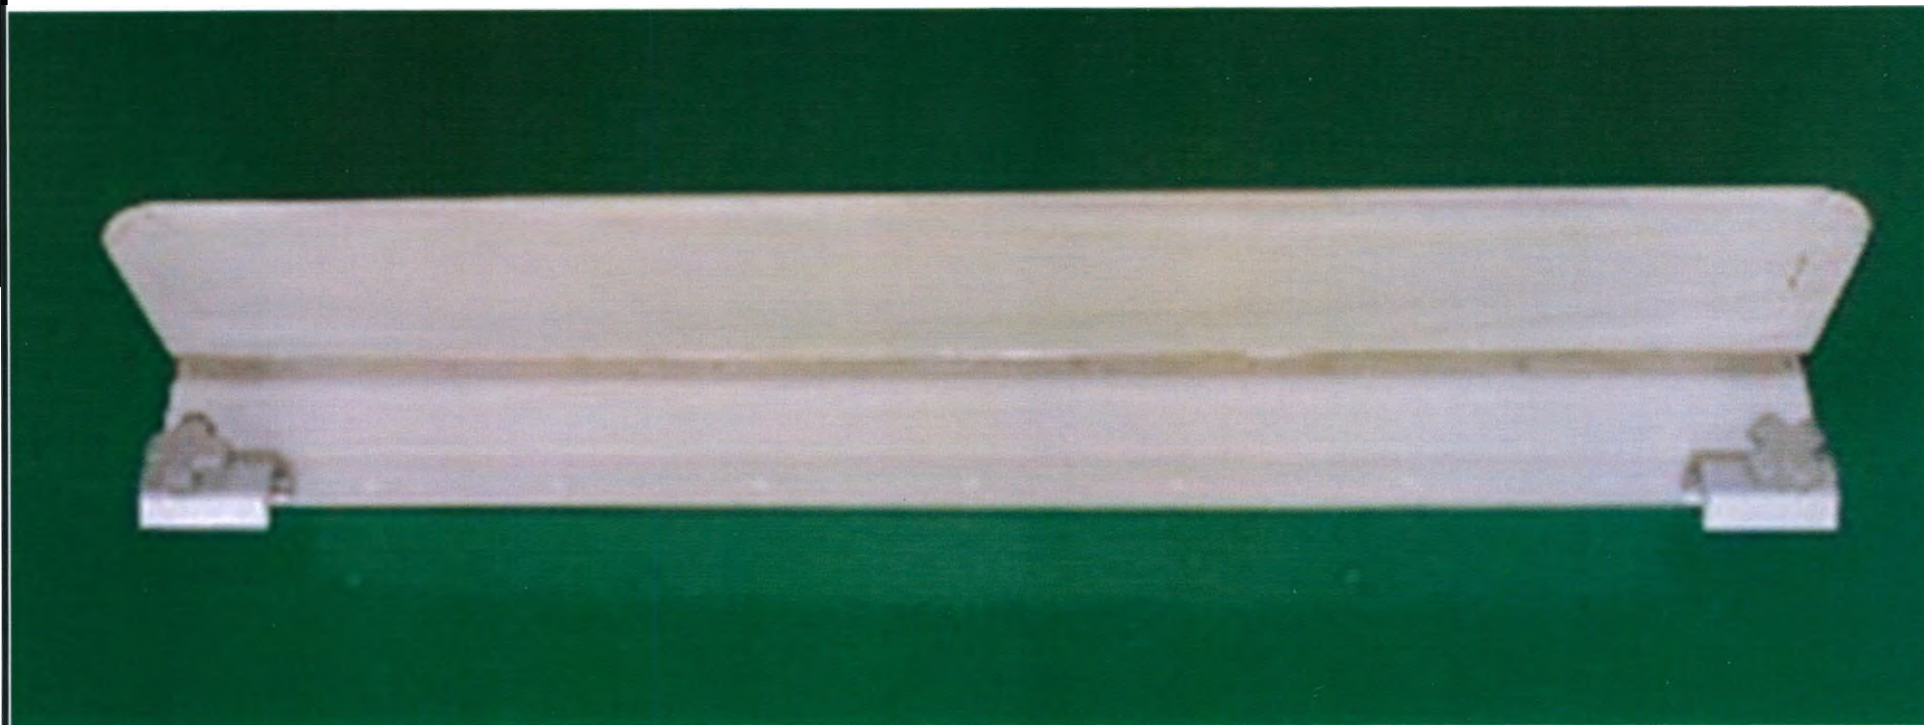

34. Дополнительная защита коллиматора, 1 шт.



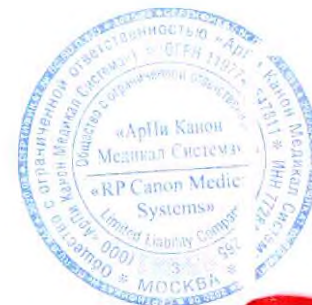

Всего прошито, пронумеровано
скреплено печатью 6/9 листов
Подпись [Signature]