

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Пенткрофт Фарма»

Кочев Д.М.



2021 г.

ШАБЛОНЫ МАРКИРОВКИ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система Кармана для мануальной вакуумной аспирации в составе

Макет маркировки первичной упаковки для Аспиратора вакуумного мануального двухклапанного и одноклапанного

300 mm

medbar

EN Karman Cannula Injector Single Valve (Manual Vacuum Aspirator)
TR Tek Valfli Karmen Kanül Enjektör (Manuel Vakum Aspiratörü)

REF 209 04

CE 2292
STERILE EO

Caution: To use only by or under the supervision of a physician.
 Compatible with Medbar Karman Cannula.
 Uyarı: Sadece doktor tarafından ya da doktor gözetimi altında kullanılmalıdır.
 Medbar Karmen Kanül ile uyumludur.

Medbar Tıbbi Malzemeler Turizm San. Tic. A.Ş.
 1142 Sk. No:35 Samsat Gazetesi-İzmir/Turkey
 T: +90 232 2816003 - F: +90 232 2816648
www.medbar.com.tr - info@medbar.com.tr

22°C'de veya aşağıda saklayınız.
Store at or below 22°C.


TD-07-ETK-04 V1/YT-11.05.2018/Rev0/RT-



125mm



C: 100
M: 0
Y: 60
K: 0



Lot XXXX
XXXX

300mm

medbar

EN Karman Cannula Injector Double Valve (Manual Vacuum Aspirator)
TR Çift Valfli Karmen Kanül Enjektör (Manuel Vakum Aspiratörü)

REF 209 05

CE 2292
STERILE EO

Caution: To use only by or under the supervision of a physician.
 Compatible with Medbar Karman Cannula.
 Uyarı: Sadece doktor tarafından ya da doktor gözetimi altında kullanılmalıdır.
 Medbar Karmen Kanül ile uyumludur.

Medbar Tıbbi Malzemeler Turizm San. Tic. A.Ş.
 1142 Sk. No:35 Samsat Gazetesi-İzmir/Turkey
 T: +90 232 2816003 - F: +90 232 2816648
www.medbar.com.tr - info@medbar.com.tr

22°C'de veya aşağıda saklayınız.
Store at or below 22°C.


TD-07-ETK-05 V1/YT-11.05.2018/Rev0/RT-



125mm




C: 100
M: 0
Y: 60
K: 0



Lot XXXX
XXXX


Макет маркировки на первичной упаковке Канюли Кармана

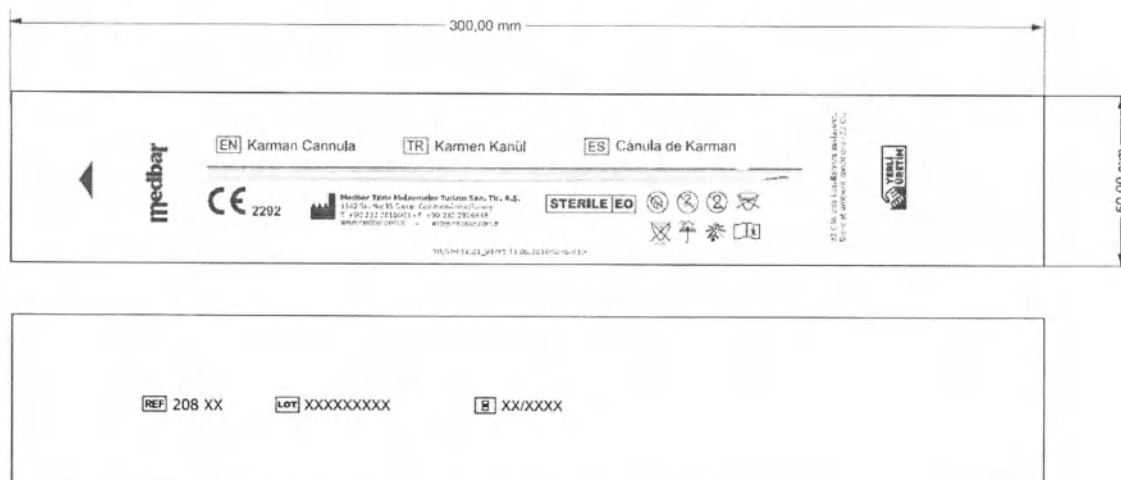

Макет маркировки на вторичной упаковке Канюли Кармана



Макет первичной упаковки адаптеров на примере Адаптера диаметром 6 мм

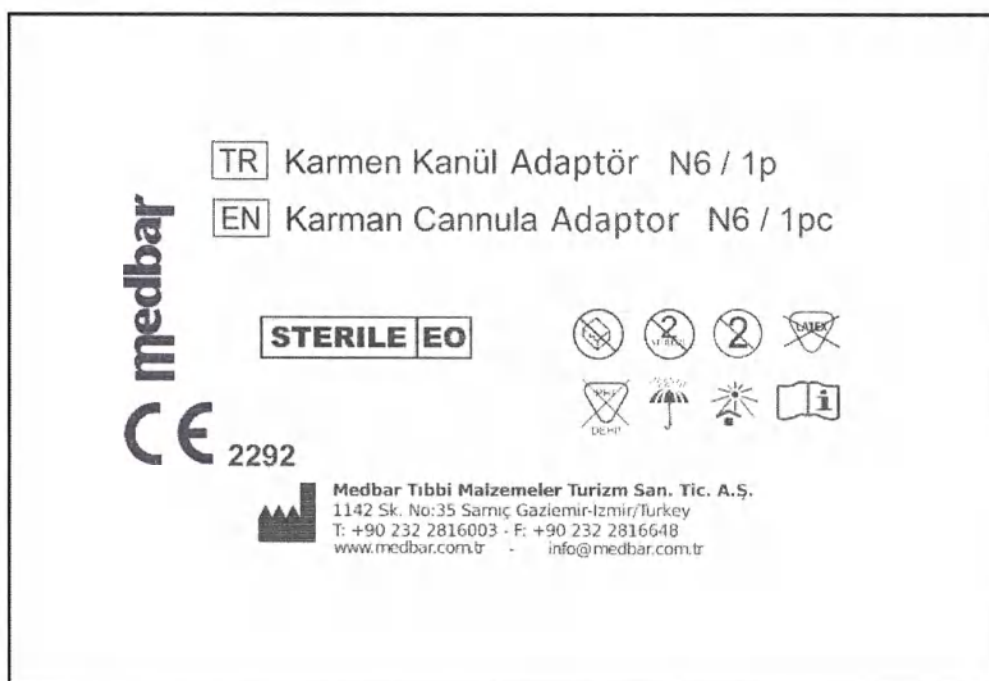

Макет маркировки транспортной упаковки



Дополнительные маркировки-стикеры для поставки в РФ
-стикер вторичной упаковки канюли Кармана

Наименование изделия

Размер:

Кол-во:

Производитель:

Уполномоченный представитель на территории РФ:

Стерильно. Нетоксично.



РУ № _____ от _____ г.

-стикер первичной упаковки аспиратора

Наименование изделия

Размер:

Производитель:

Уполномоченный представитель на территории РФ:

Стерильно. Нетоксично.



РУ № _____ от _____ г.

-стикер первичной упаковки адаптеров

Наименование изделия

Размер:

Производитель:

Уполномоченный представитель на территории РФ:

Стерильно. Нетоксично.

Кол-во: 5 шт



РУ № _____ от _____ г.

-стикер транспортной упаковки

Наименование изделия

Кол-во:

Производитель:

Уполномоченный представитель на территории РФ:



РУ № _____ от _____ г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Пенткрофт Фарма»

Кочев Д.М.

«01» декабря 2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система Кармана для мануальной вакуумной аспирации в составе


1- Общий вид Аспиратор вакуумный мануальный одноклапанный в первичной упаковке



2-Общий вид Аспиратор вакуумный мануальный одноклапанный




3- Общий вид Канюли Кармана диаметром 3 мм

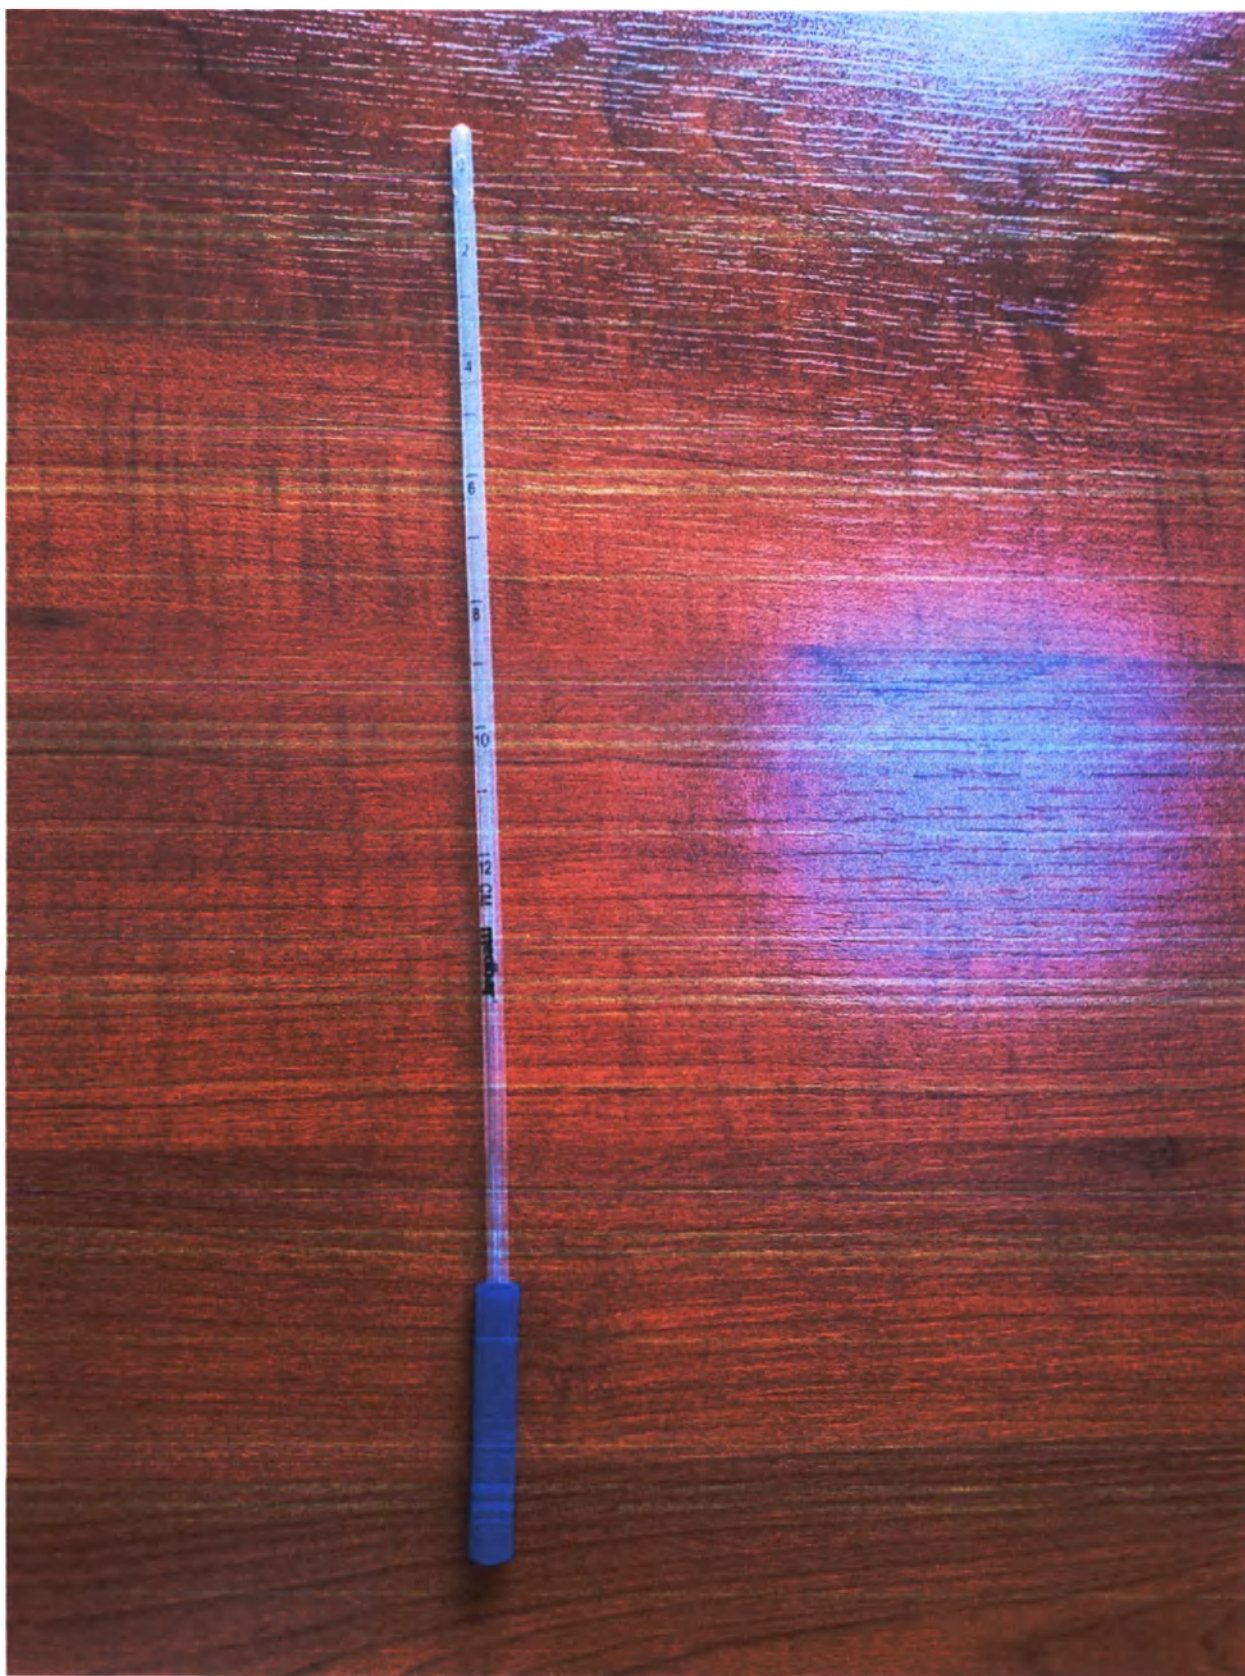


4- Общий вид Канюли Кармана диаметром 4 мм



5- Общий вид Канюли Кармана диаметром 5 мм

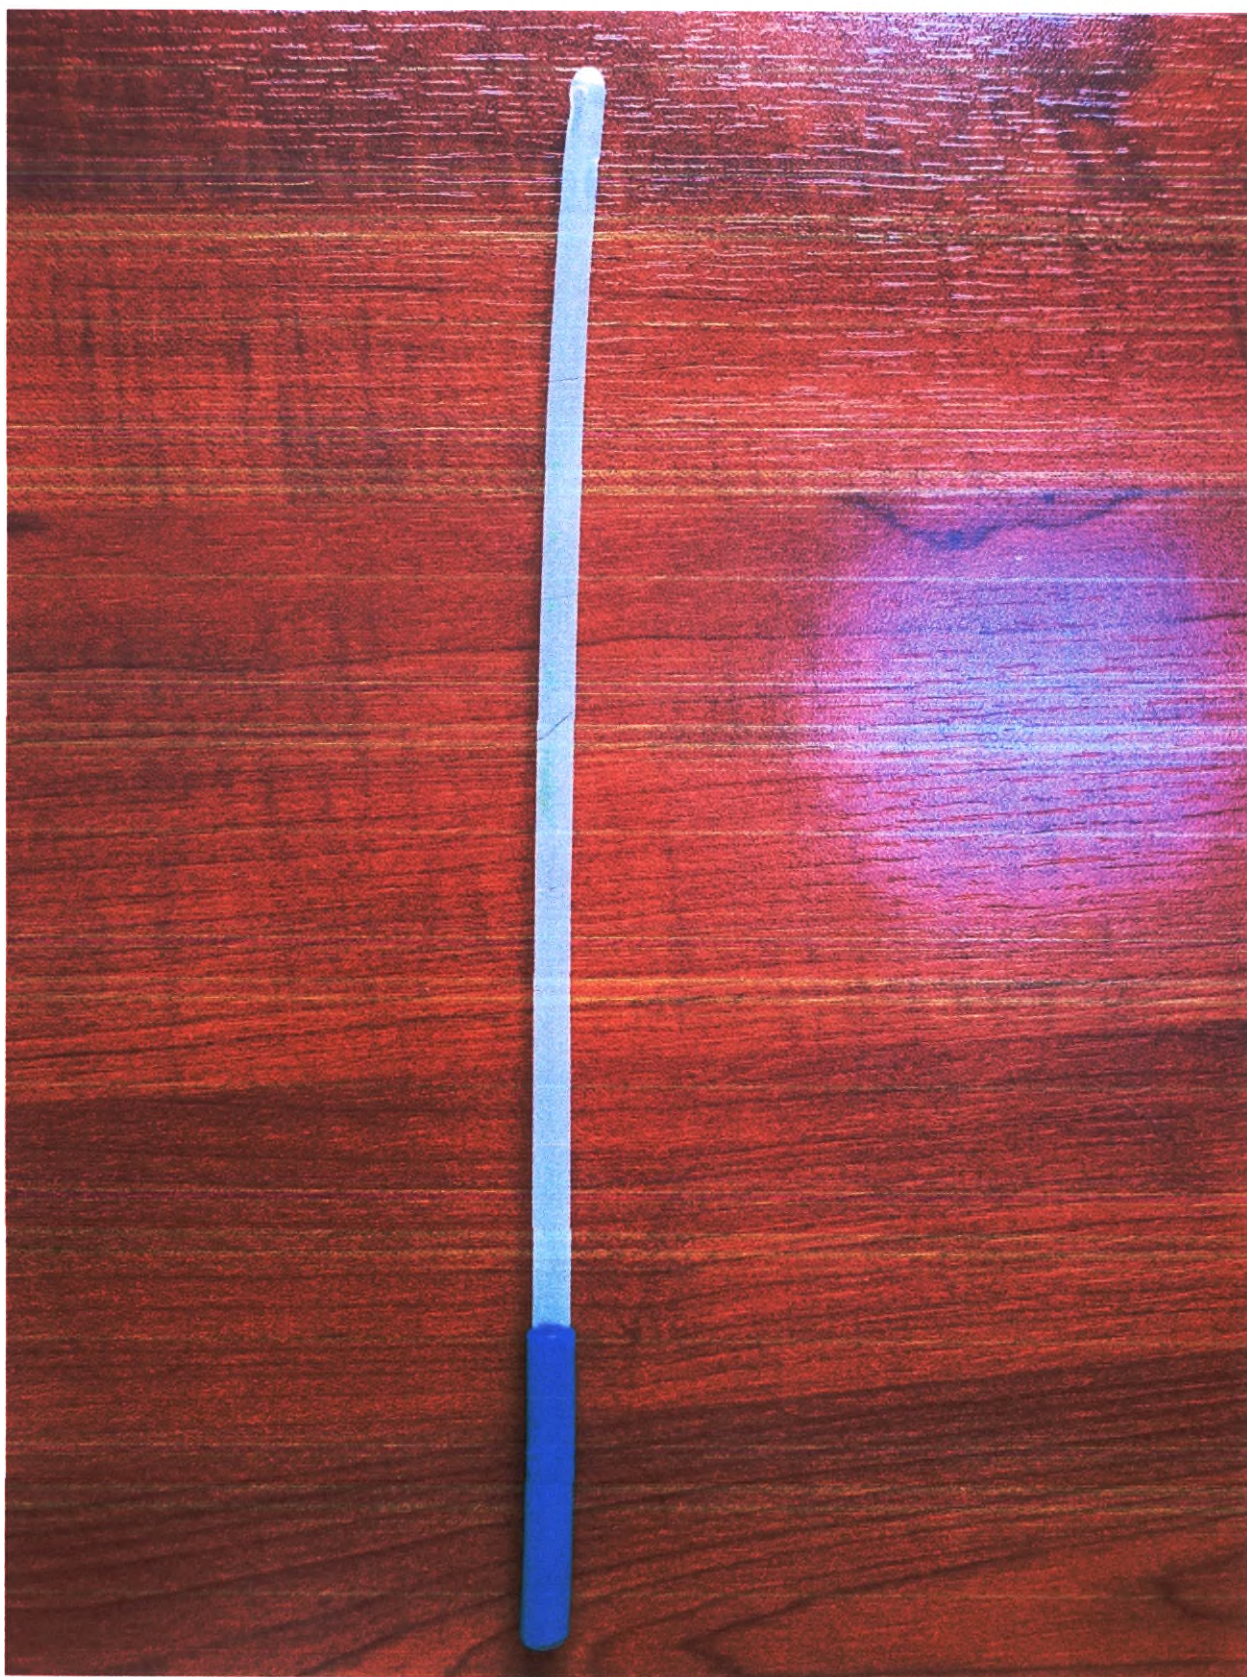


6- Общий вид Канюли Кармана диаметром 6, 7, 8, 9, 10, 12 мм на примере Канюли Кармана 12 мм

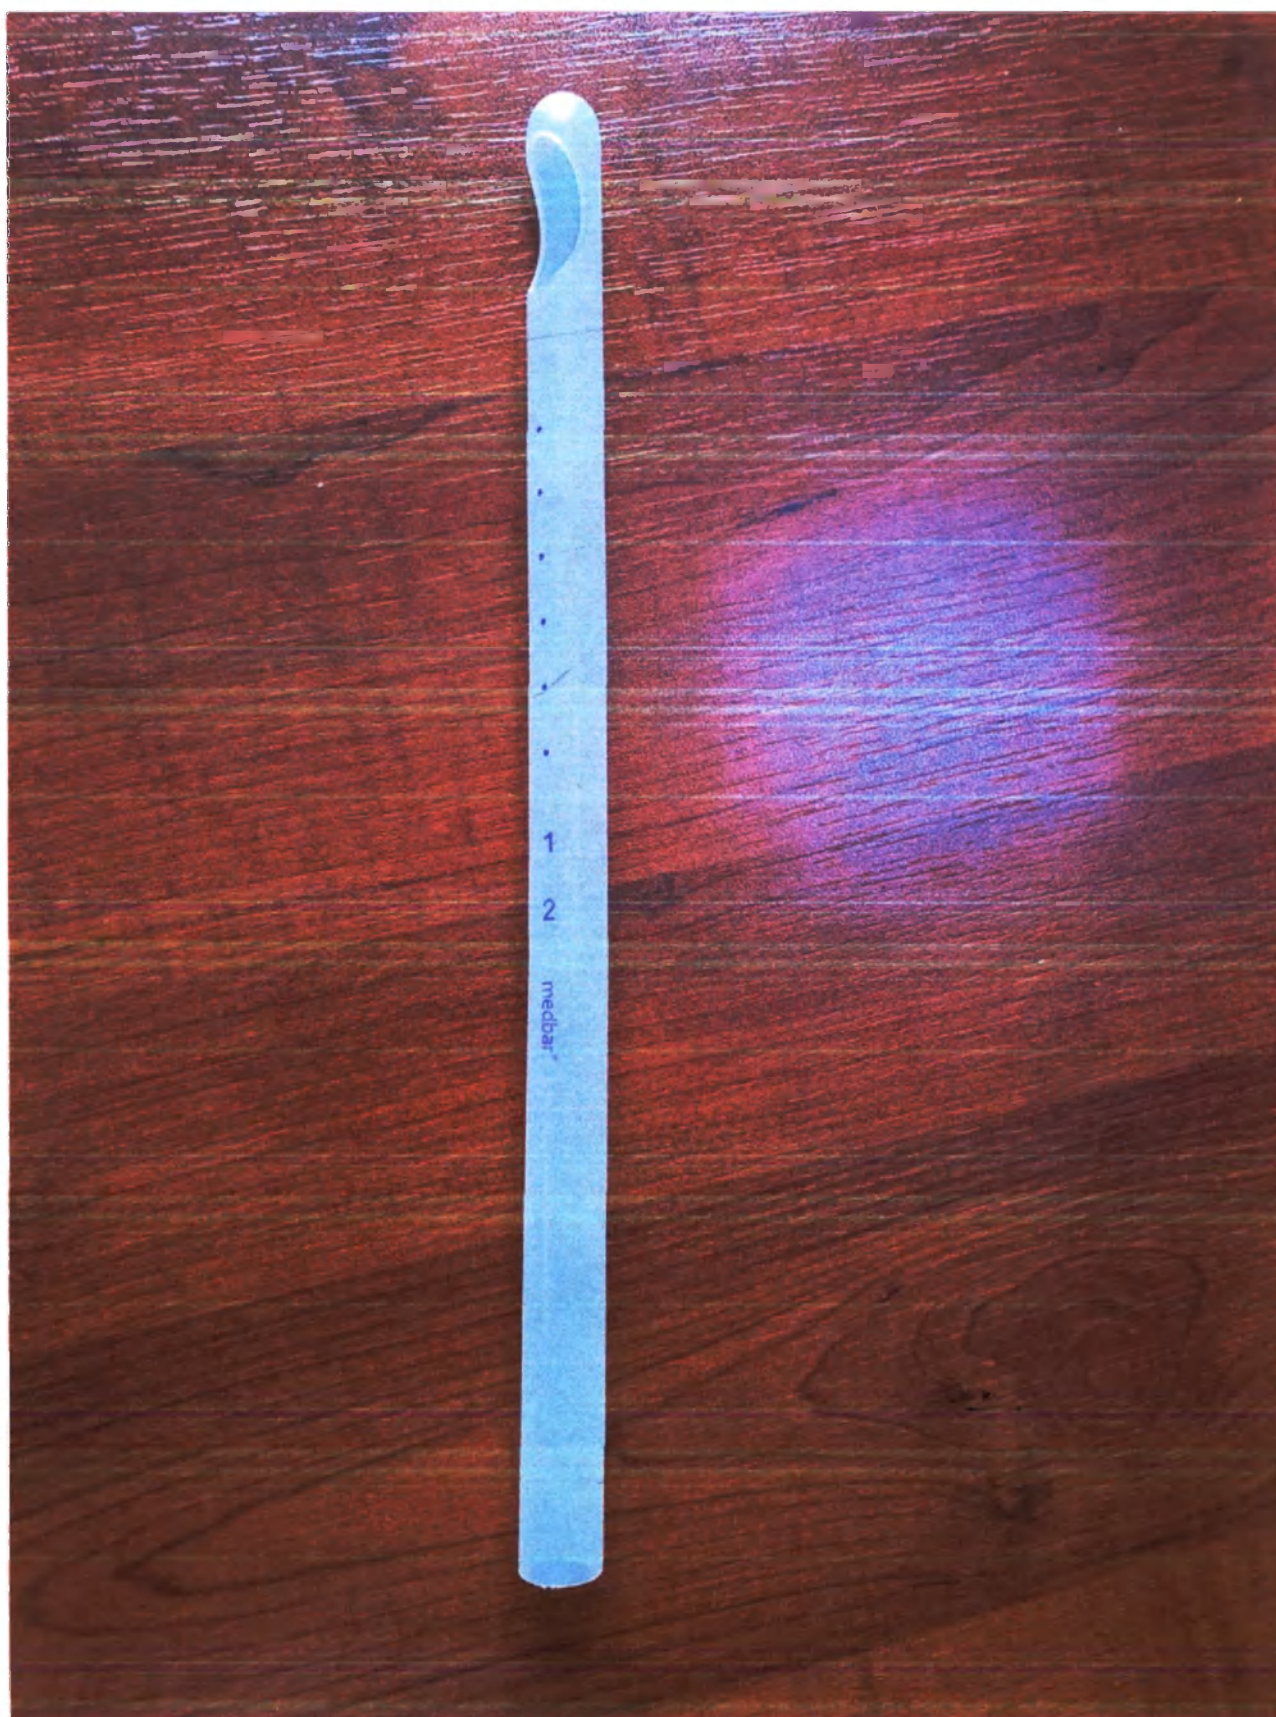

7- Общий вид Канюли Кармана с адаптером на примере канюли Кармана 7 мм и адаптера 7 мм



8-Общий вид Канюли Кармана в первичной упаковке на примере Канюли Кармана диаметром 4 мм

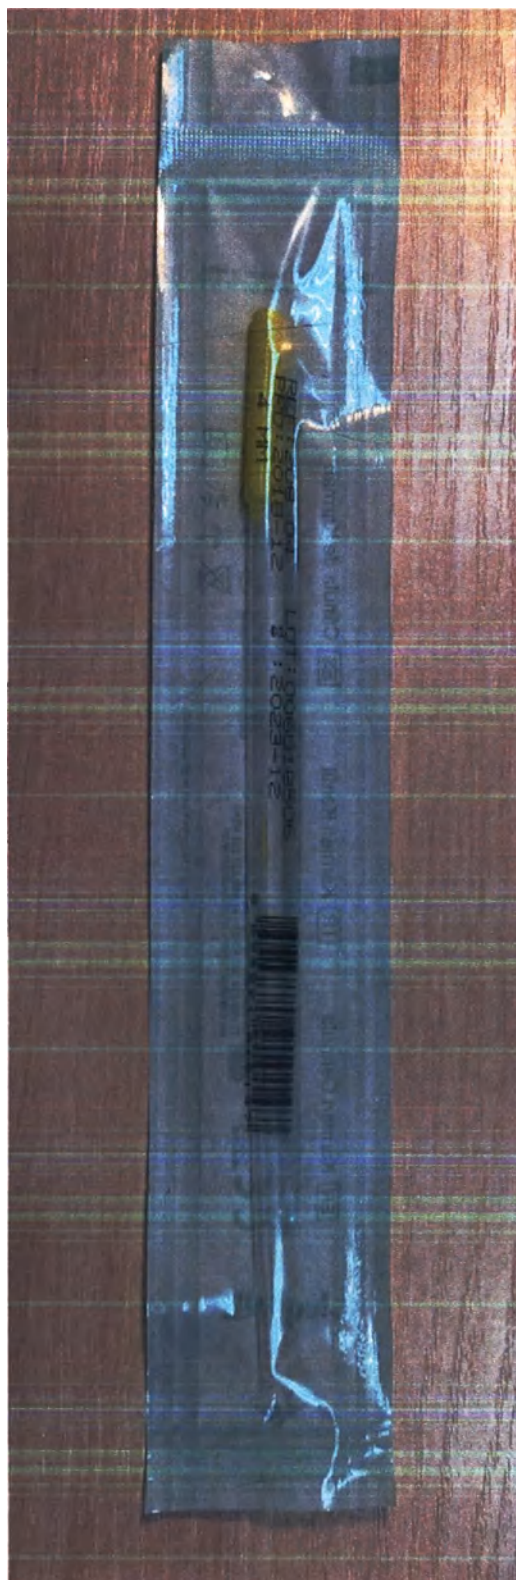


9-Общий вид Канюли Кармана в первичной упаковке на примере Канюли Кармана диаметром 6 мм





10- Общий вид Аспиратор вакуумный ручной двухклапанный в первичной упаковке




11- Общий вид Адаптер диаметром 6 мм

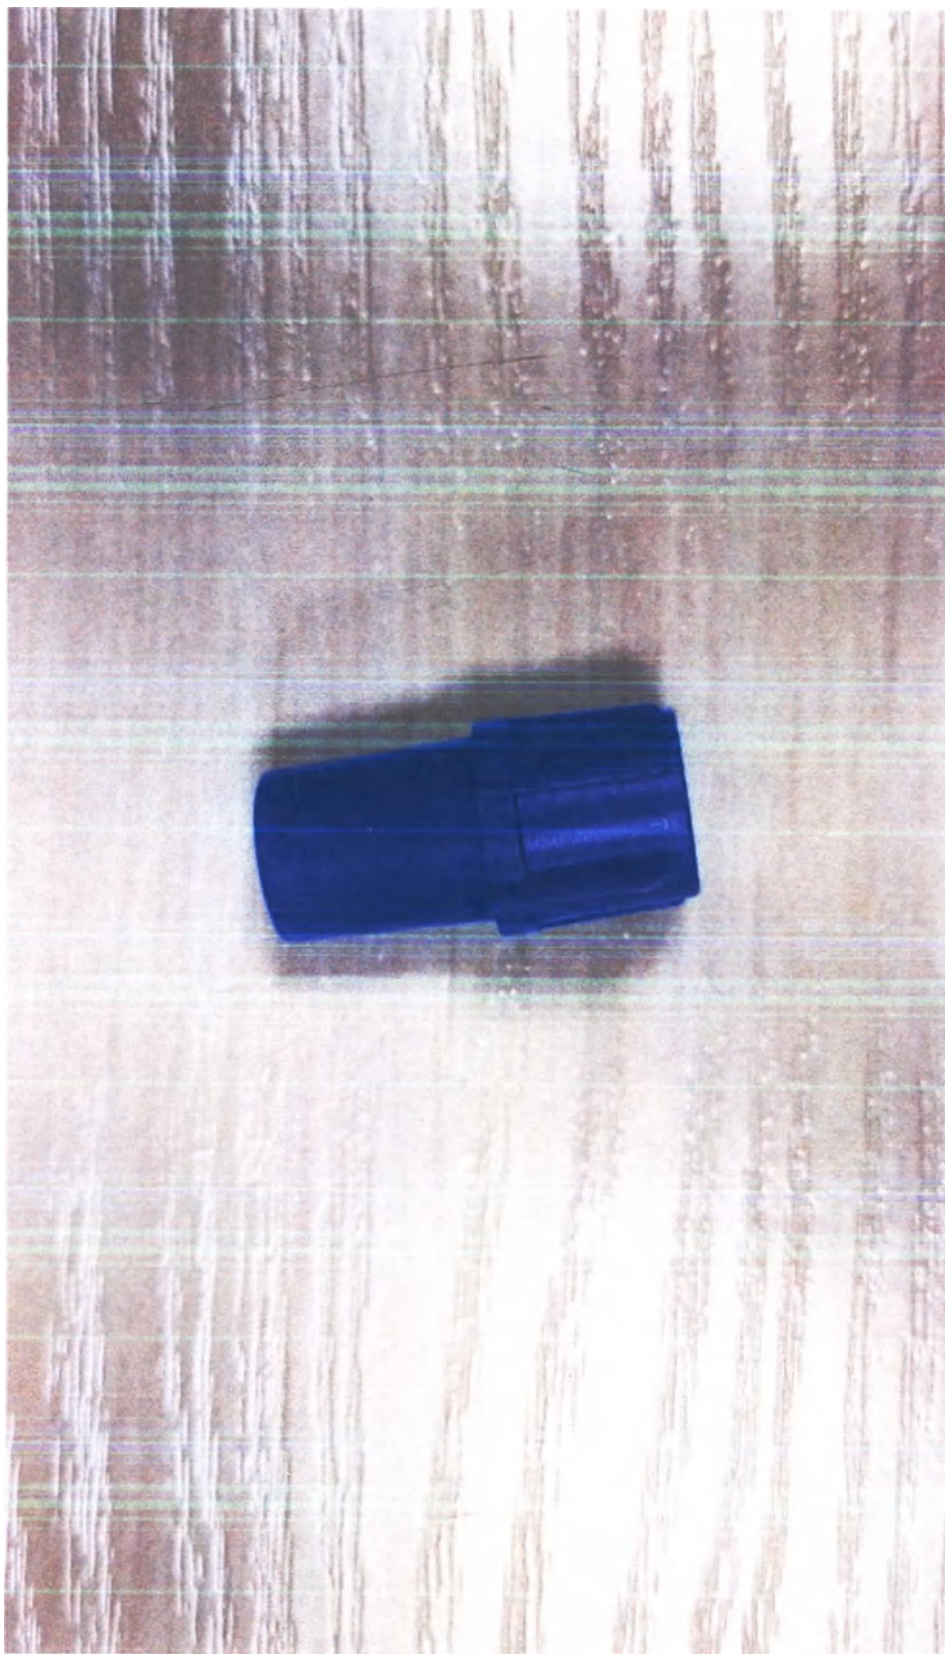


12- Общий вид Адаптер диаметром 7 мм

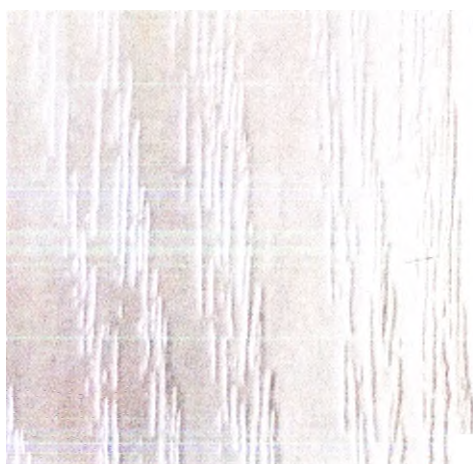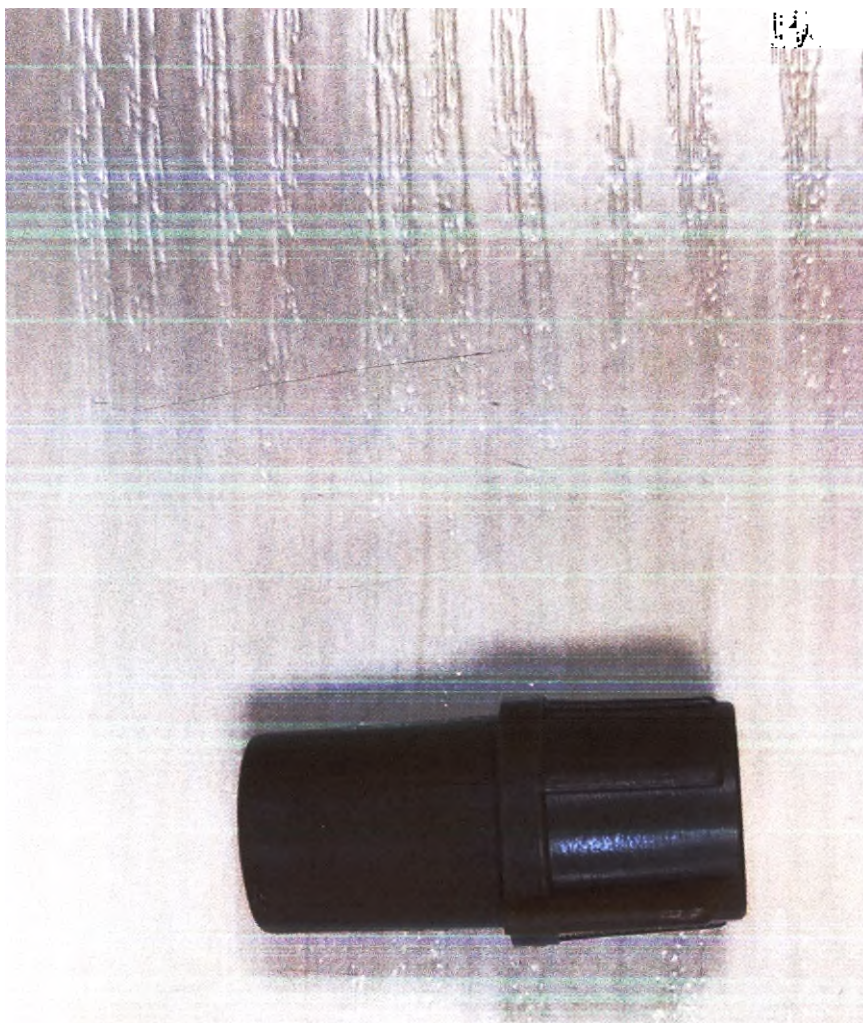


13- Общий вид Адаптер диаметром 8 мм

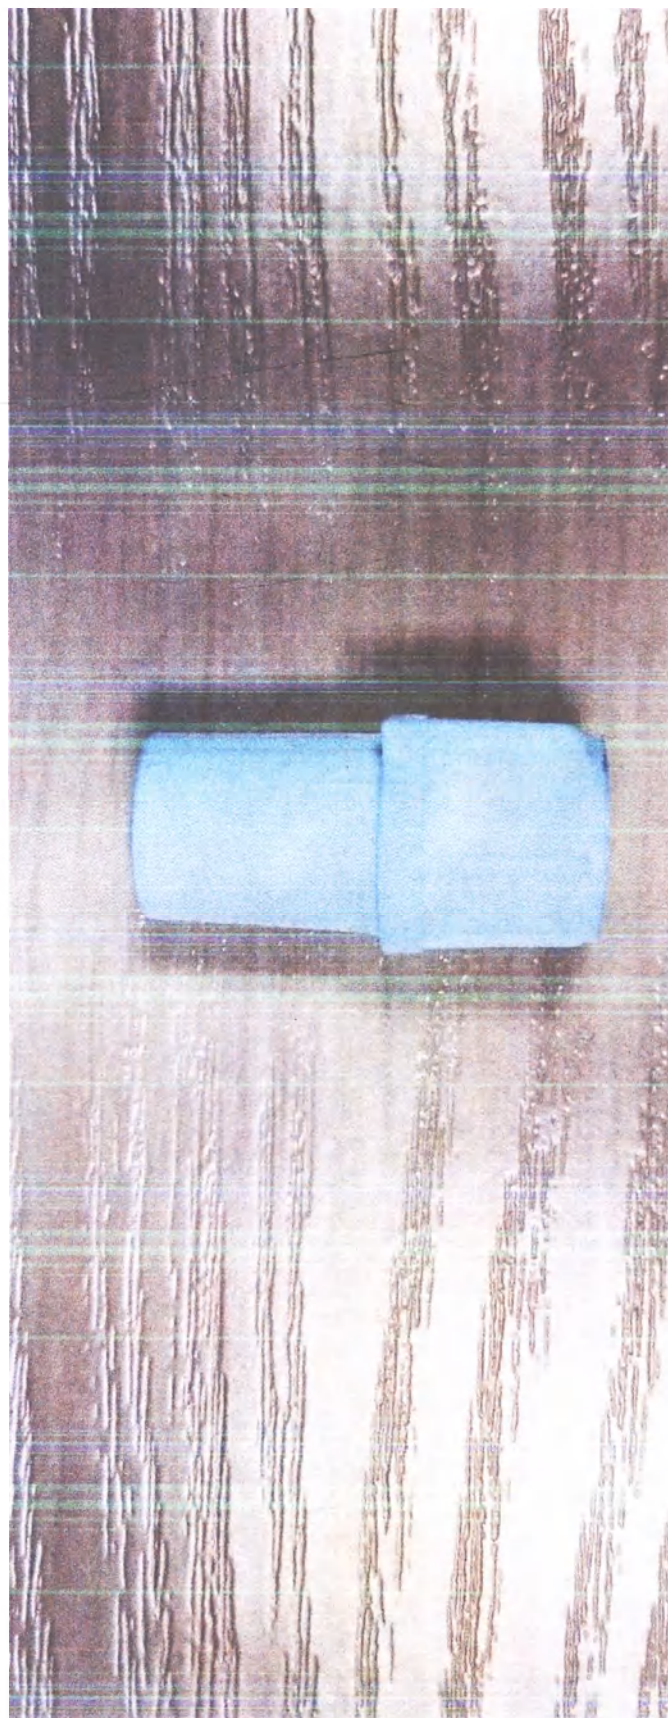

14- Общий вид Адаптер диаметром 9 мм

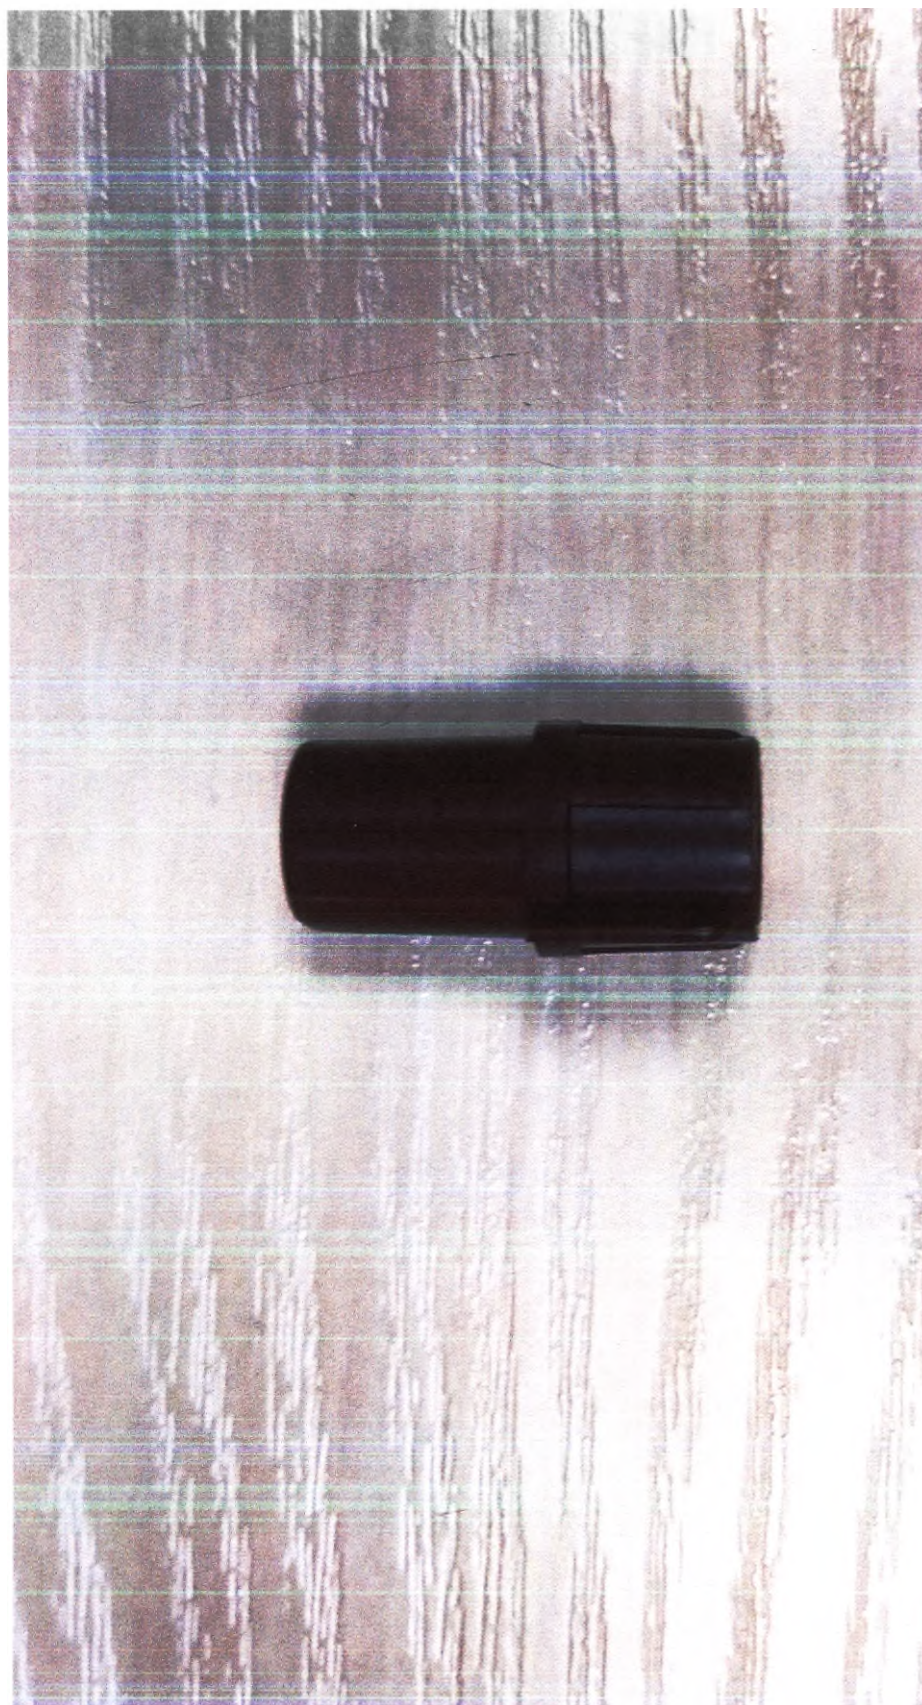


15- Общий вид Адаптер диаметром 10 мм

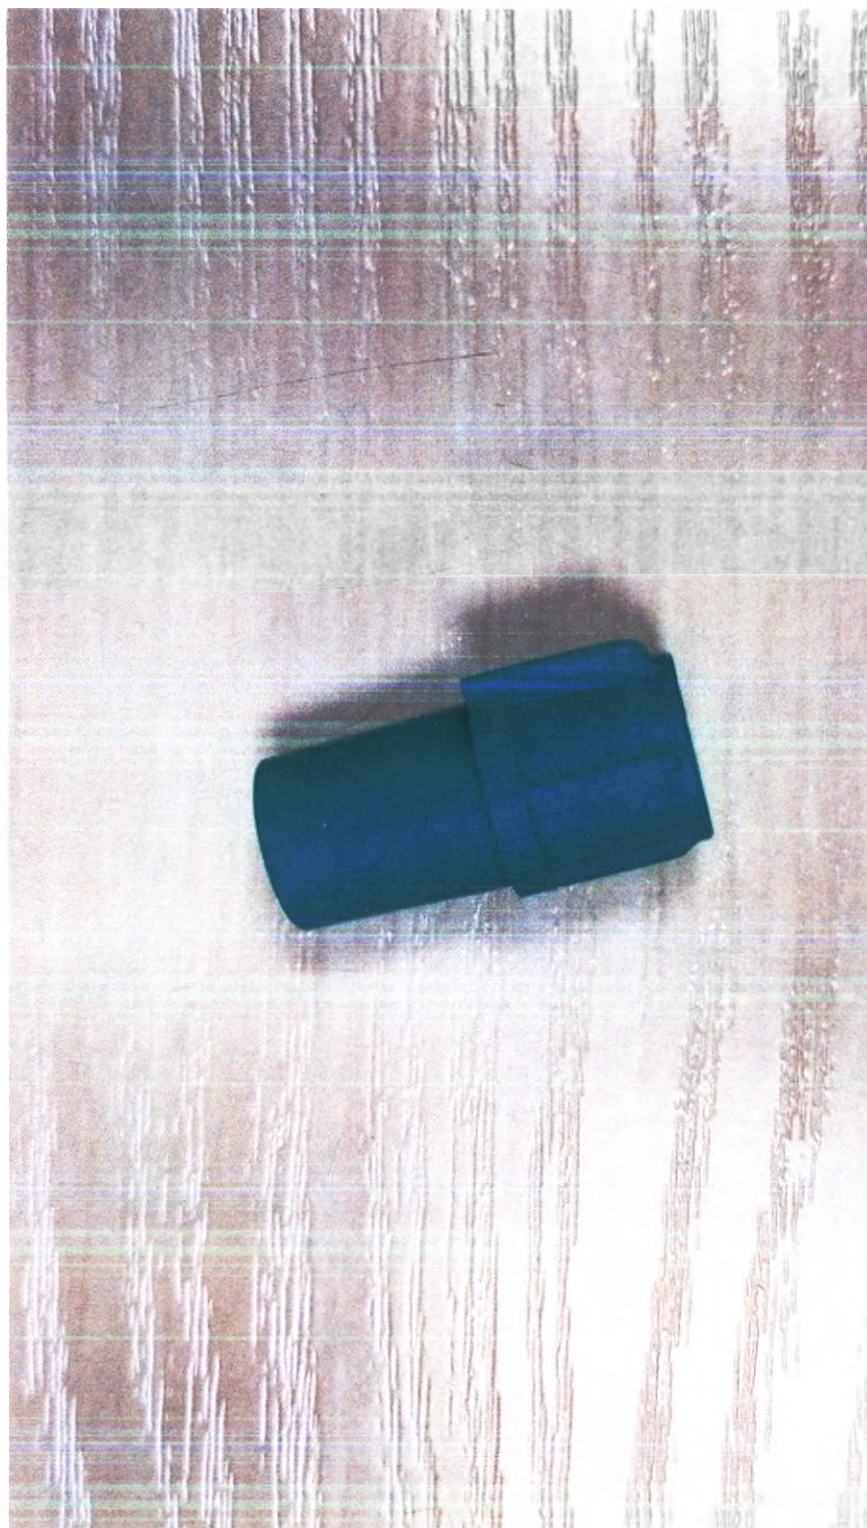

16-Общий вид адаптера в первичной упаковке на примере адаптера 6 мм



17-Общий вид транспортной упаковки

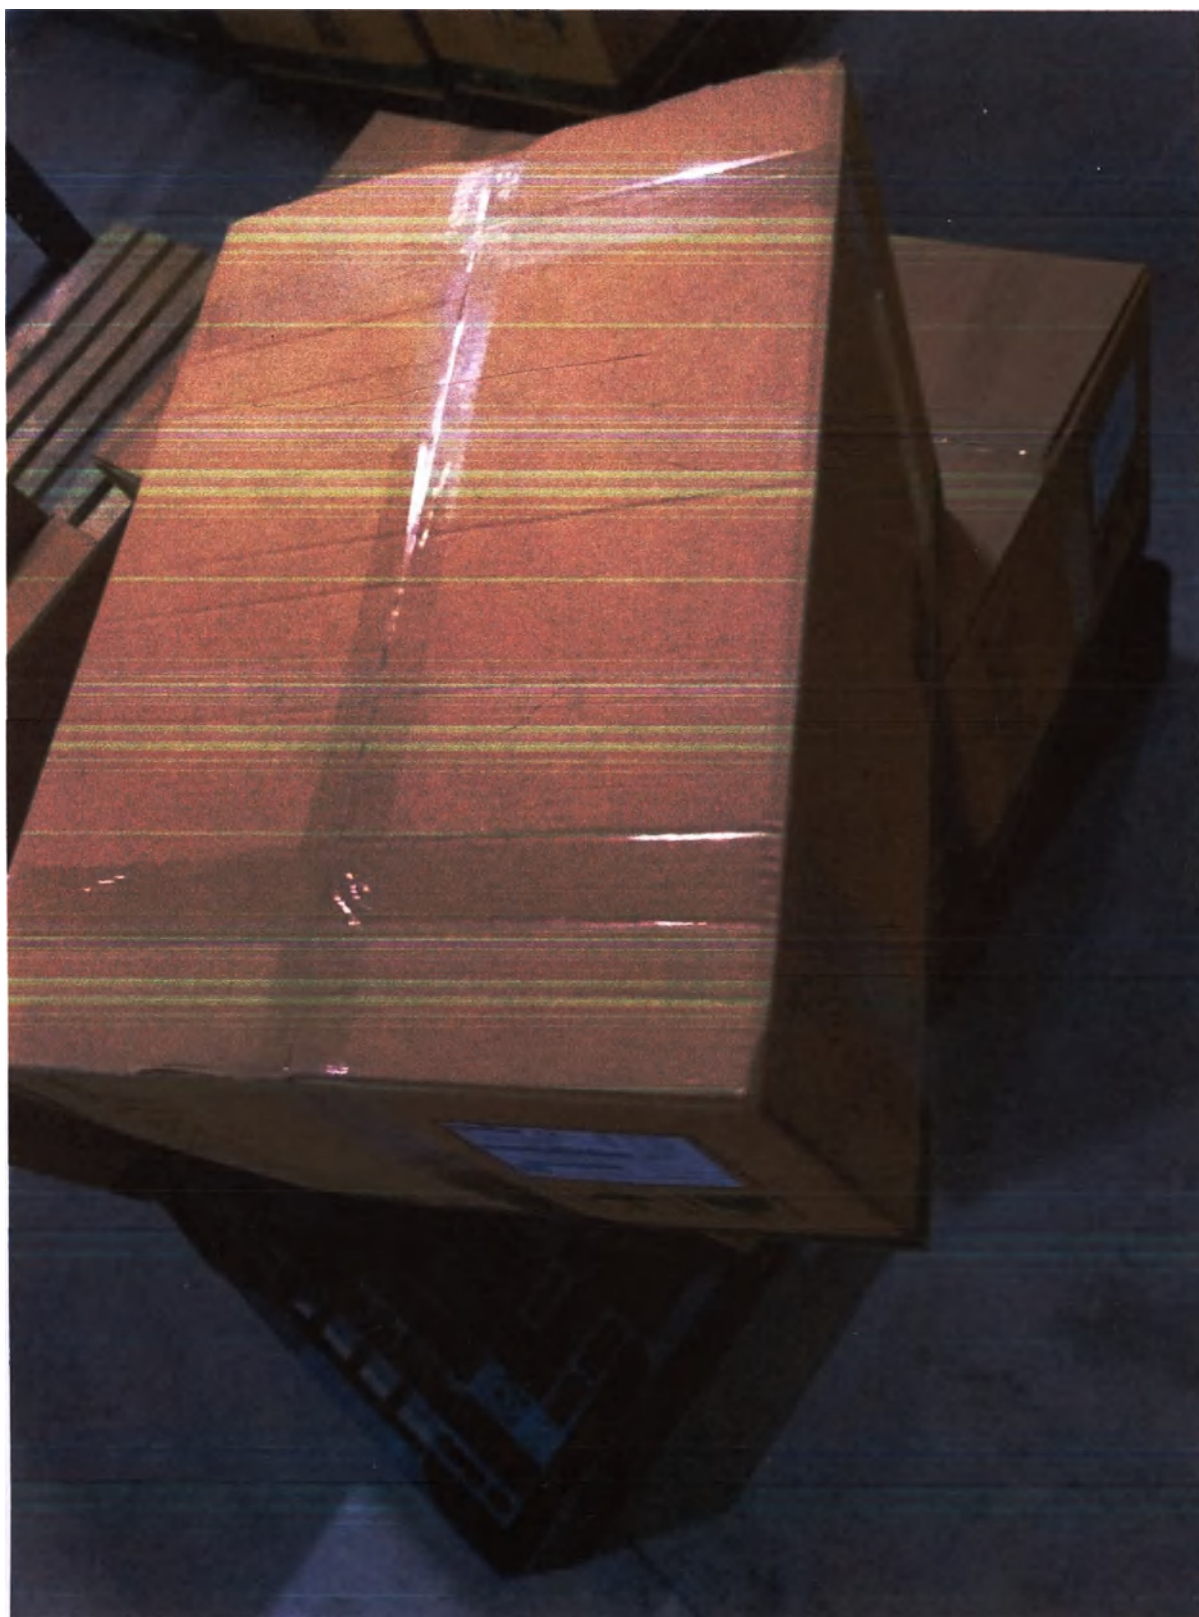



19 листов

