




Фотографии медицинского изделия
Аппарат рентгенографический палатный
передвижной разборный портативный
Р-600 «Мобикомпакт»,
производства ООО «ВКО Медпром», Россия

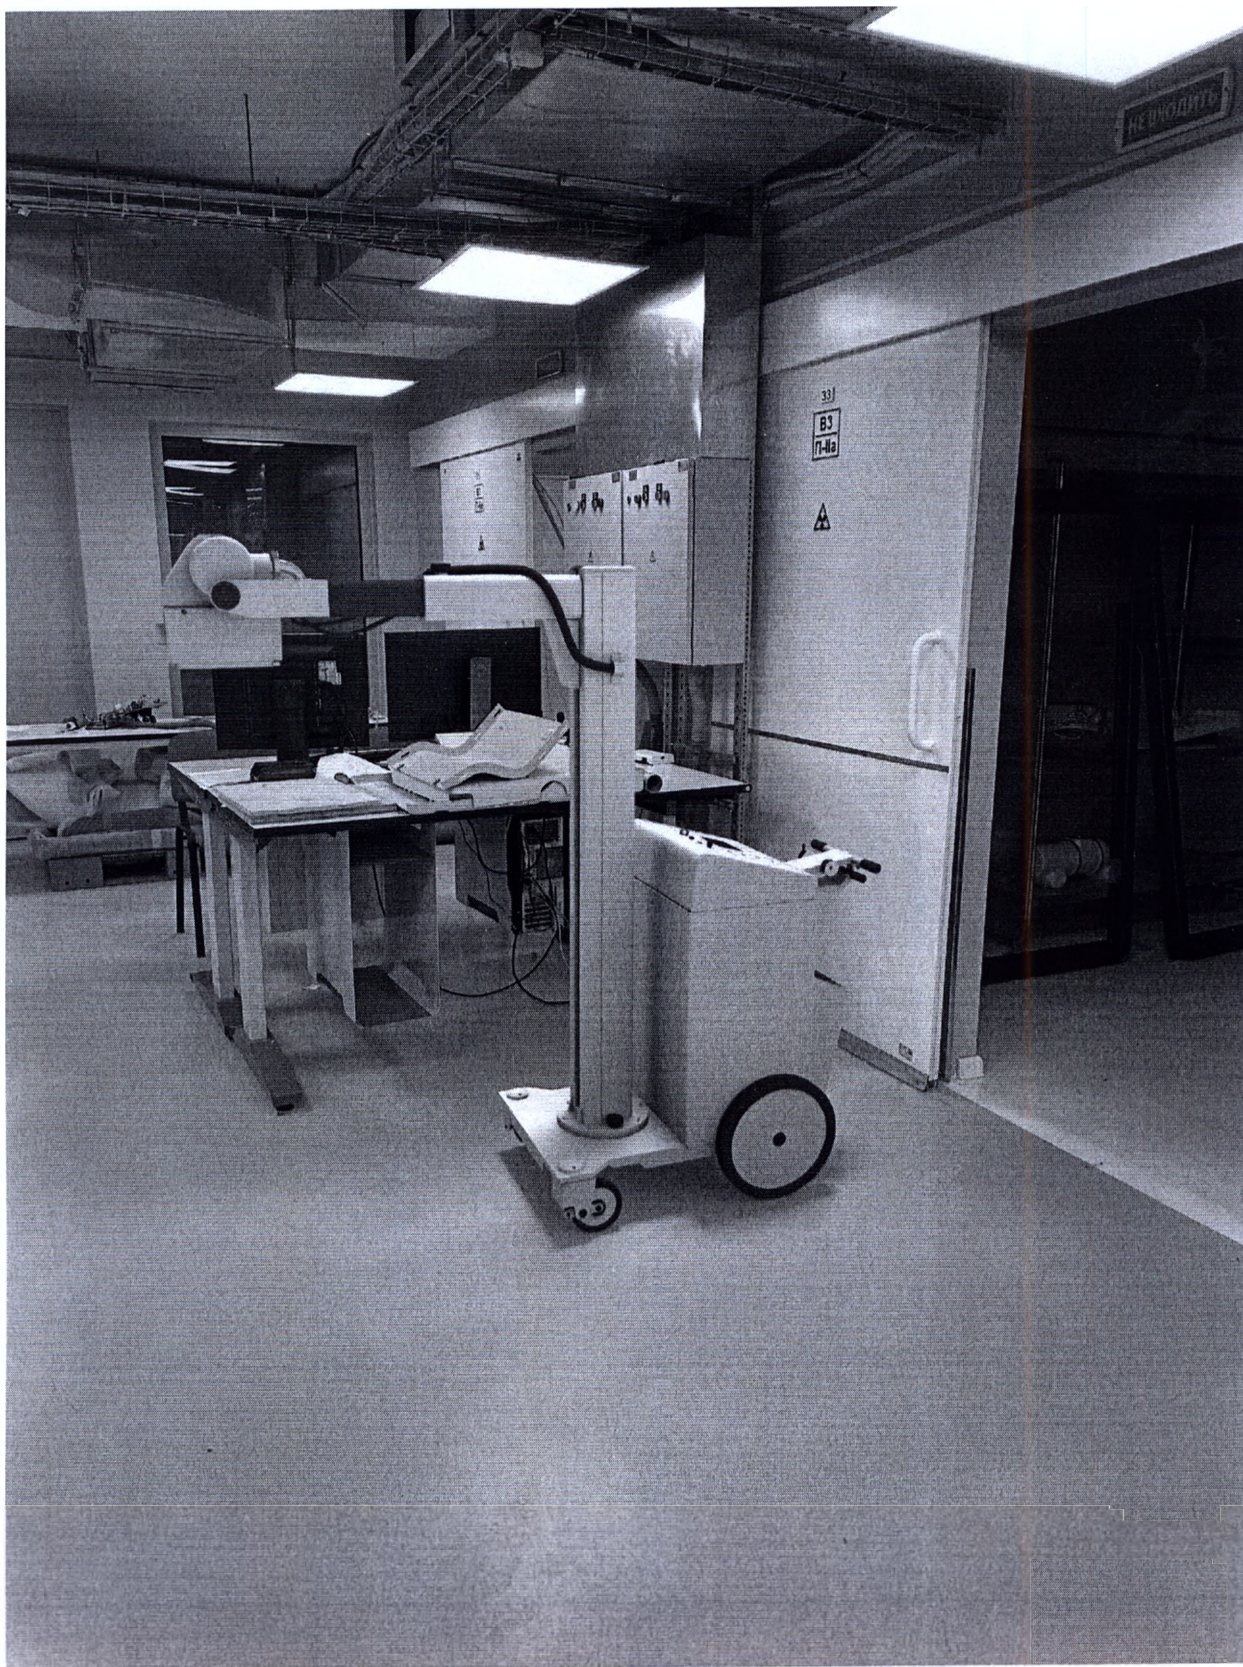


Штатив М1-В0100, производства ООО «ВКО Медпром», Россия

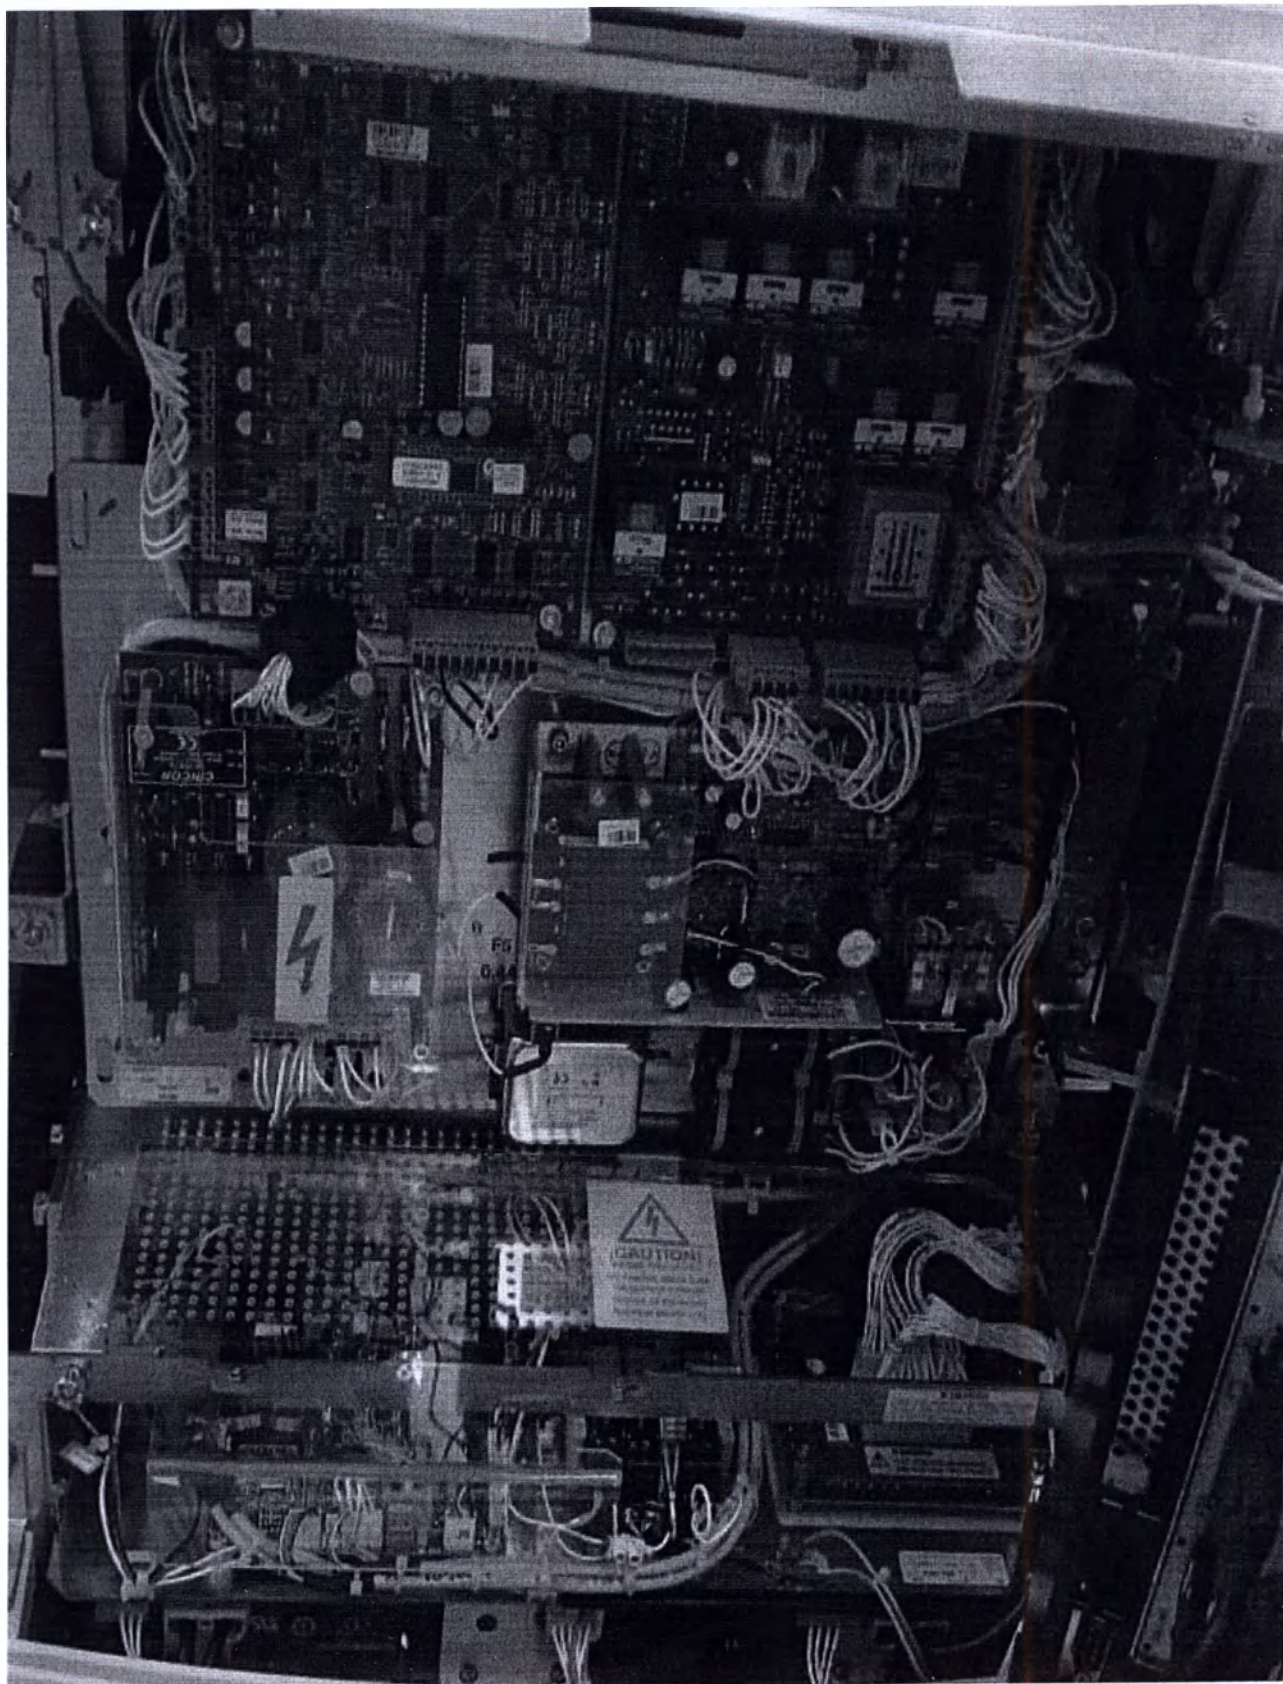


Рентгеновское питающее устройство SHFM-C Sedecal S.A.,
Испания

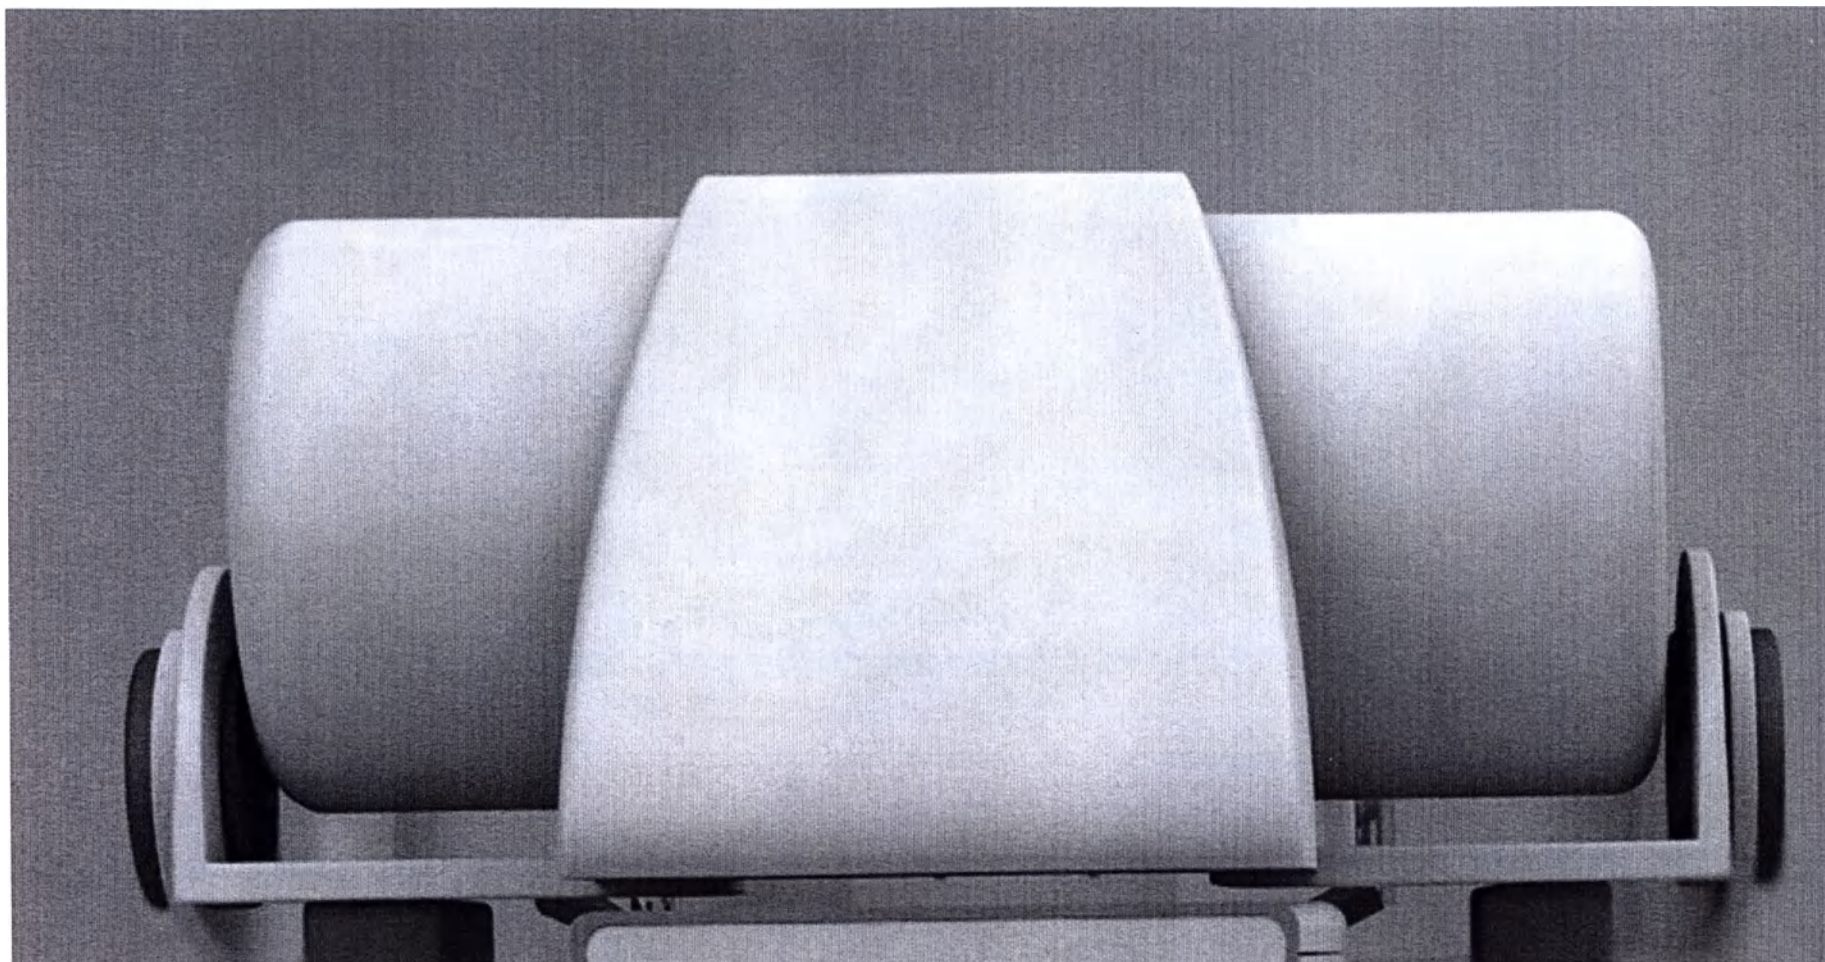


Моноблок Sedecal S.A., Испания

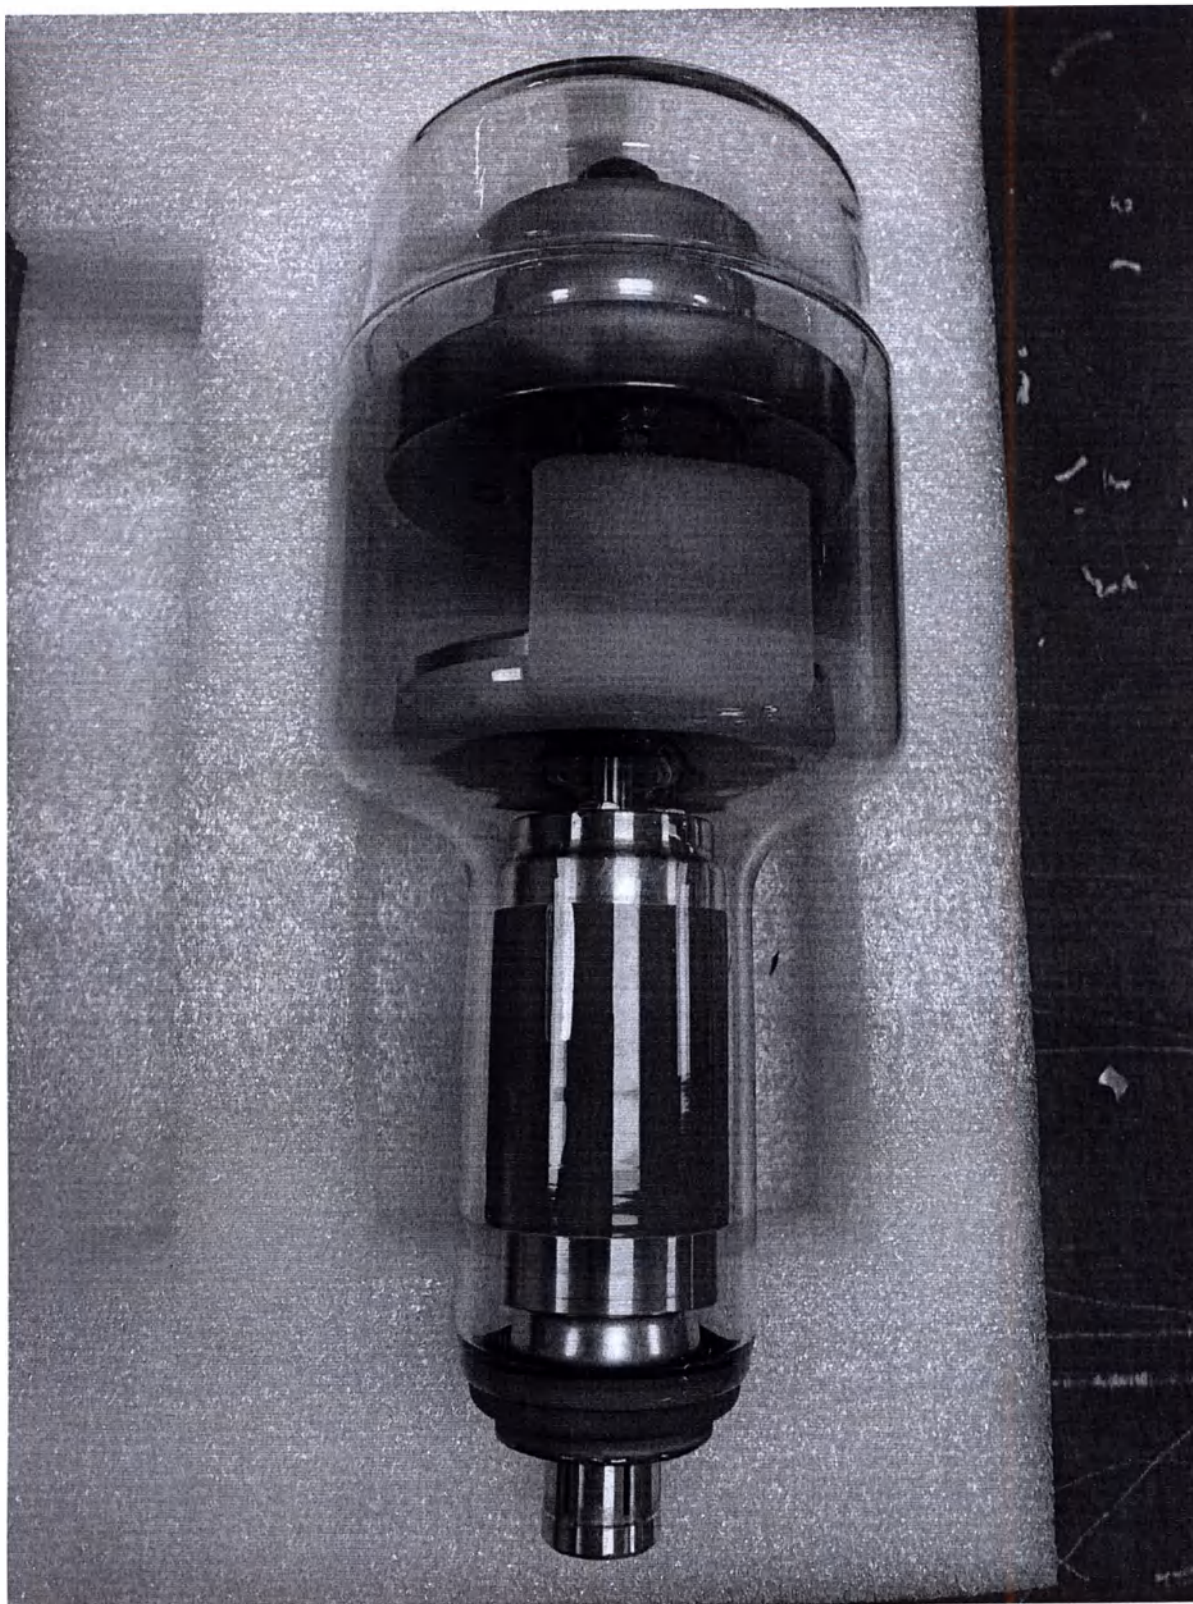

Рентгеновская трубка Canon XRR, производства Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd, Япония

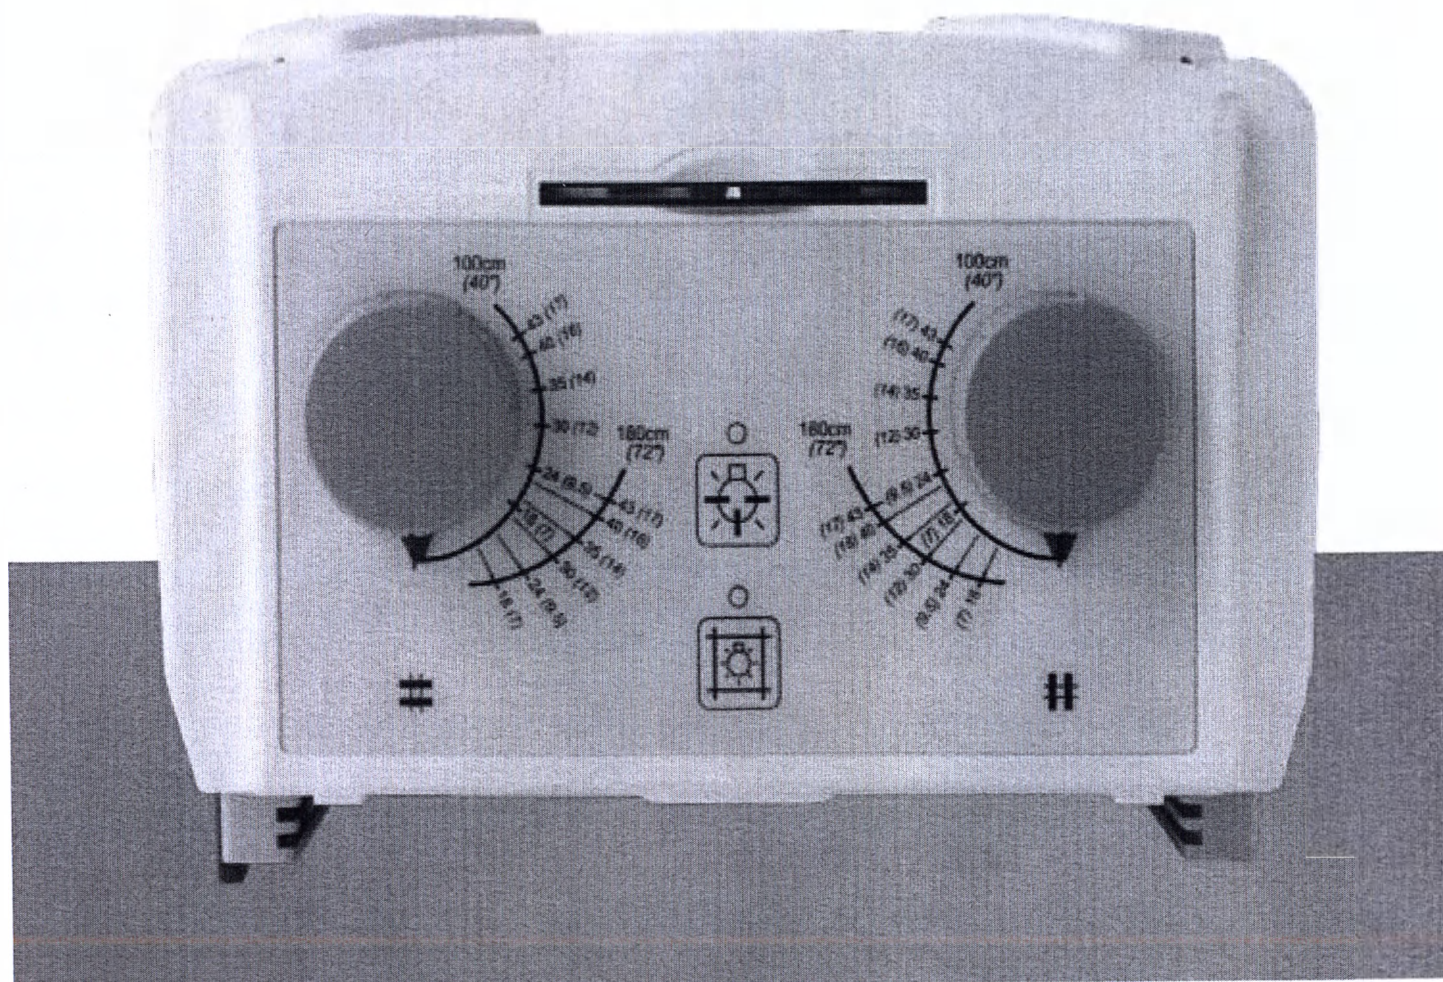


Коллиматор серии Optica 10 или серии Optica 20, производства Varex Imaging Corporation, Нидерланды

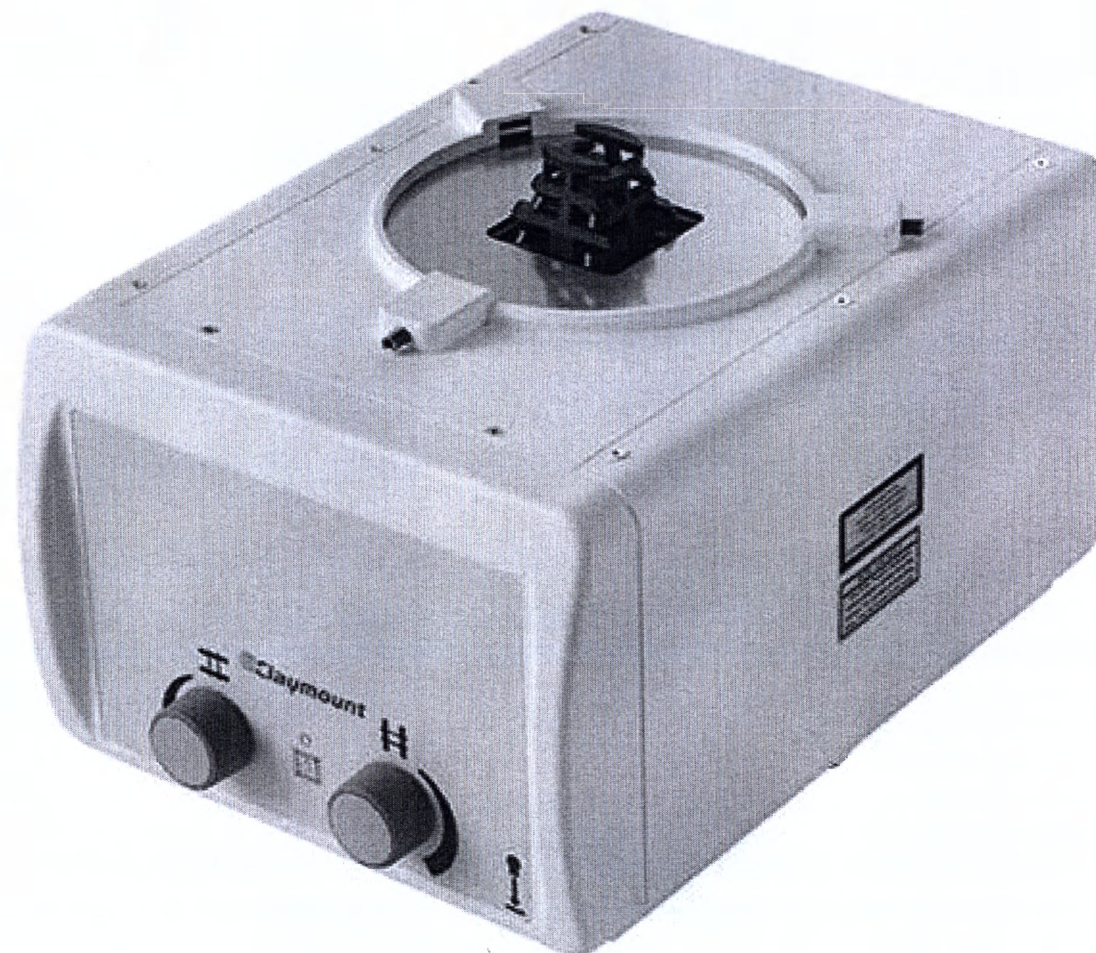


Коллиматор серии Optica 30, производства Varex Imaging Corporation,
Нидерланды




Коллиматор серии R 221, производства Ralco srl., Италия

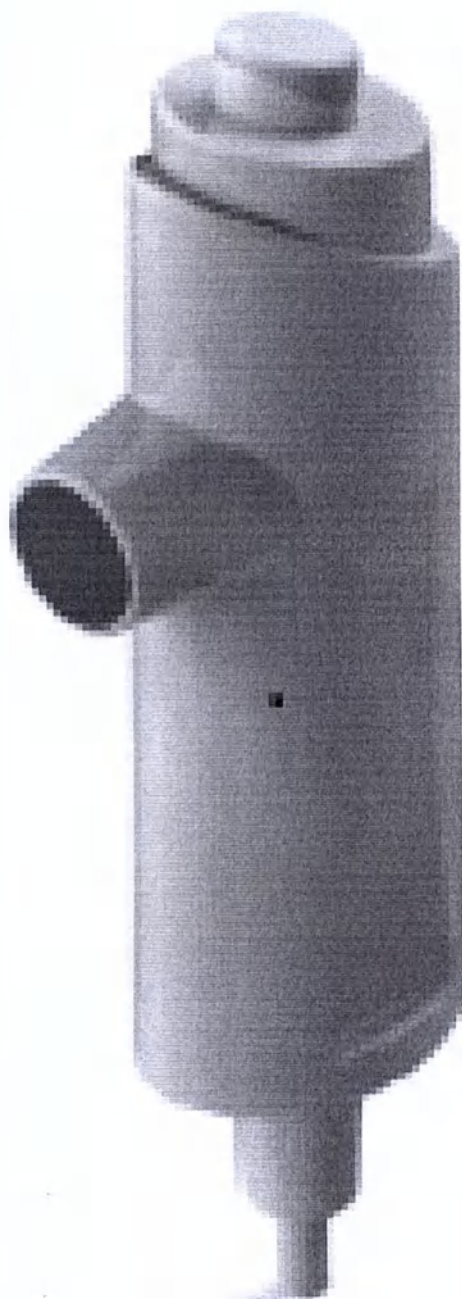


Устройство включения экспозиции, производства Sedecal S.A.,
Испания

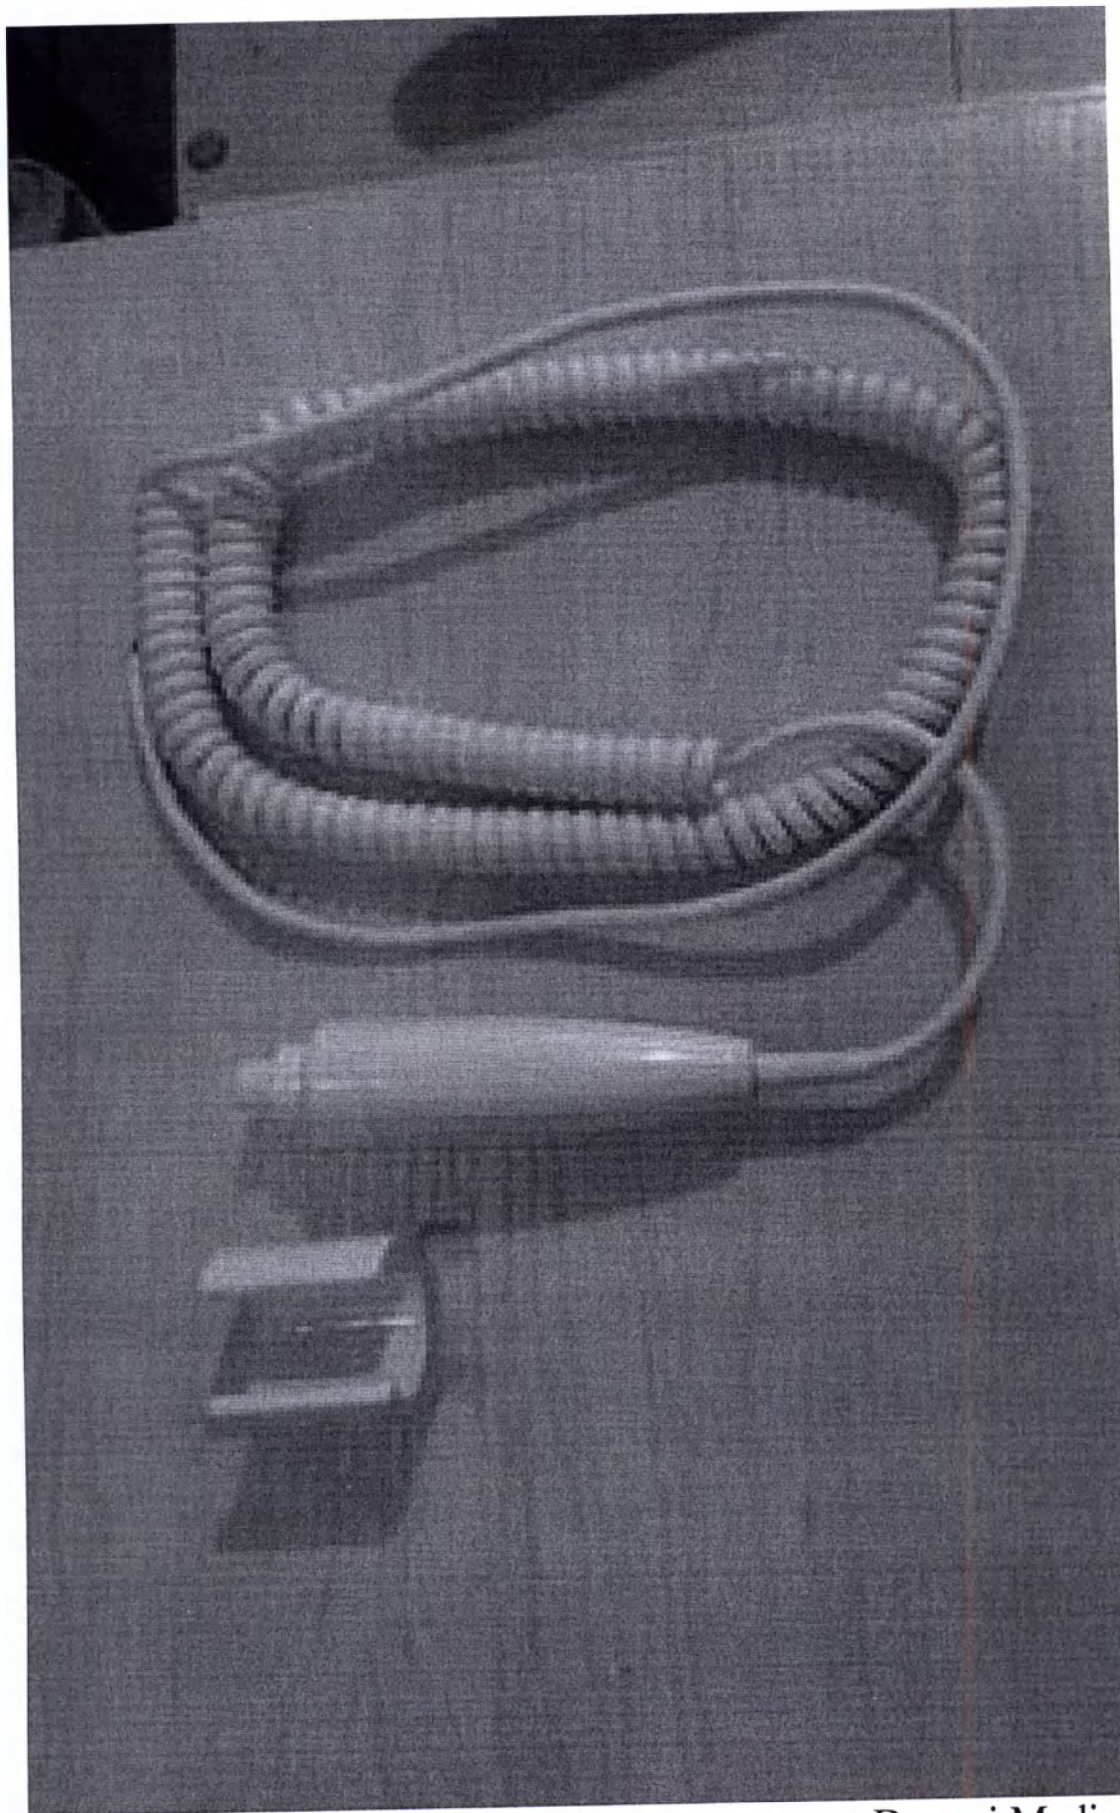


Устройство включения экспозиции, производства Dongzi Medical System Co., Китай

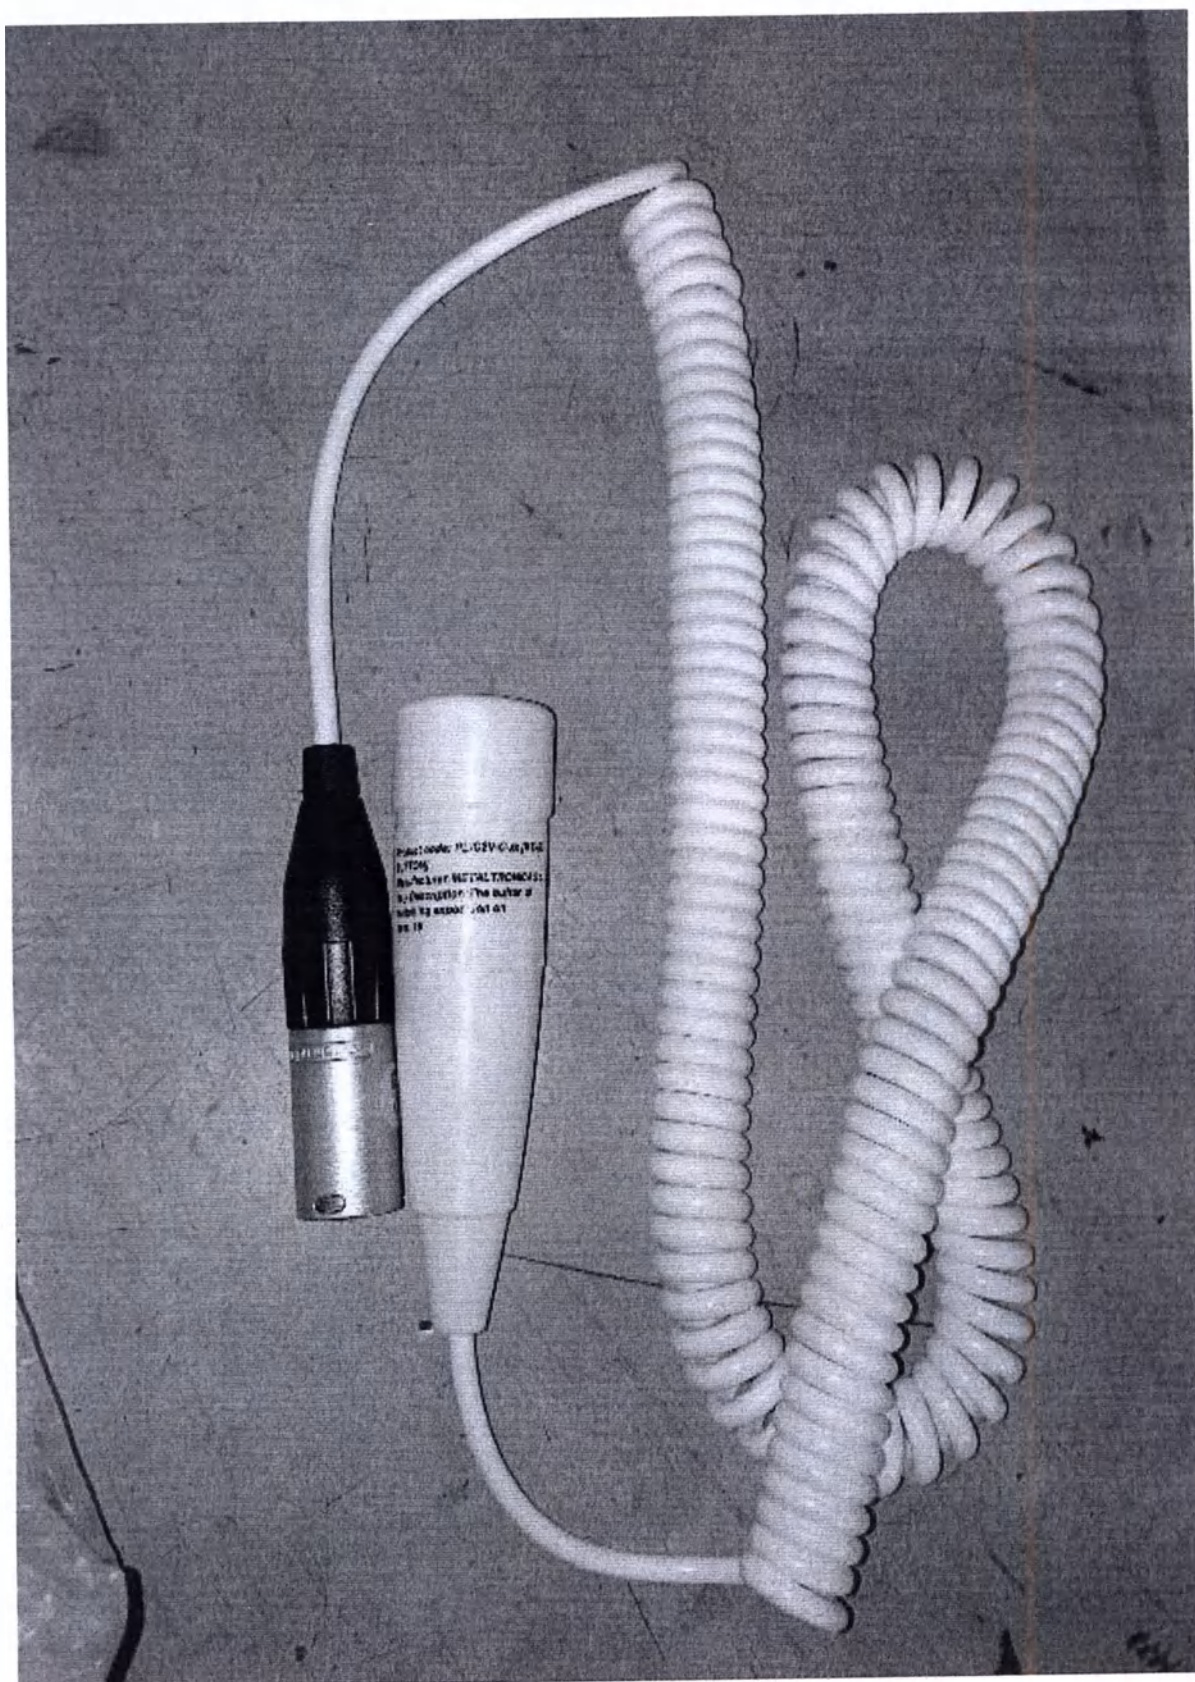


Устройство включения экспозиции, производства OMRON Corporation, Япония

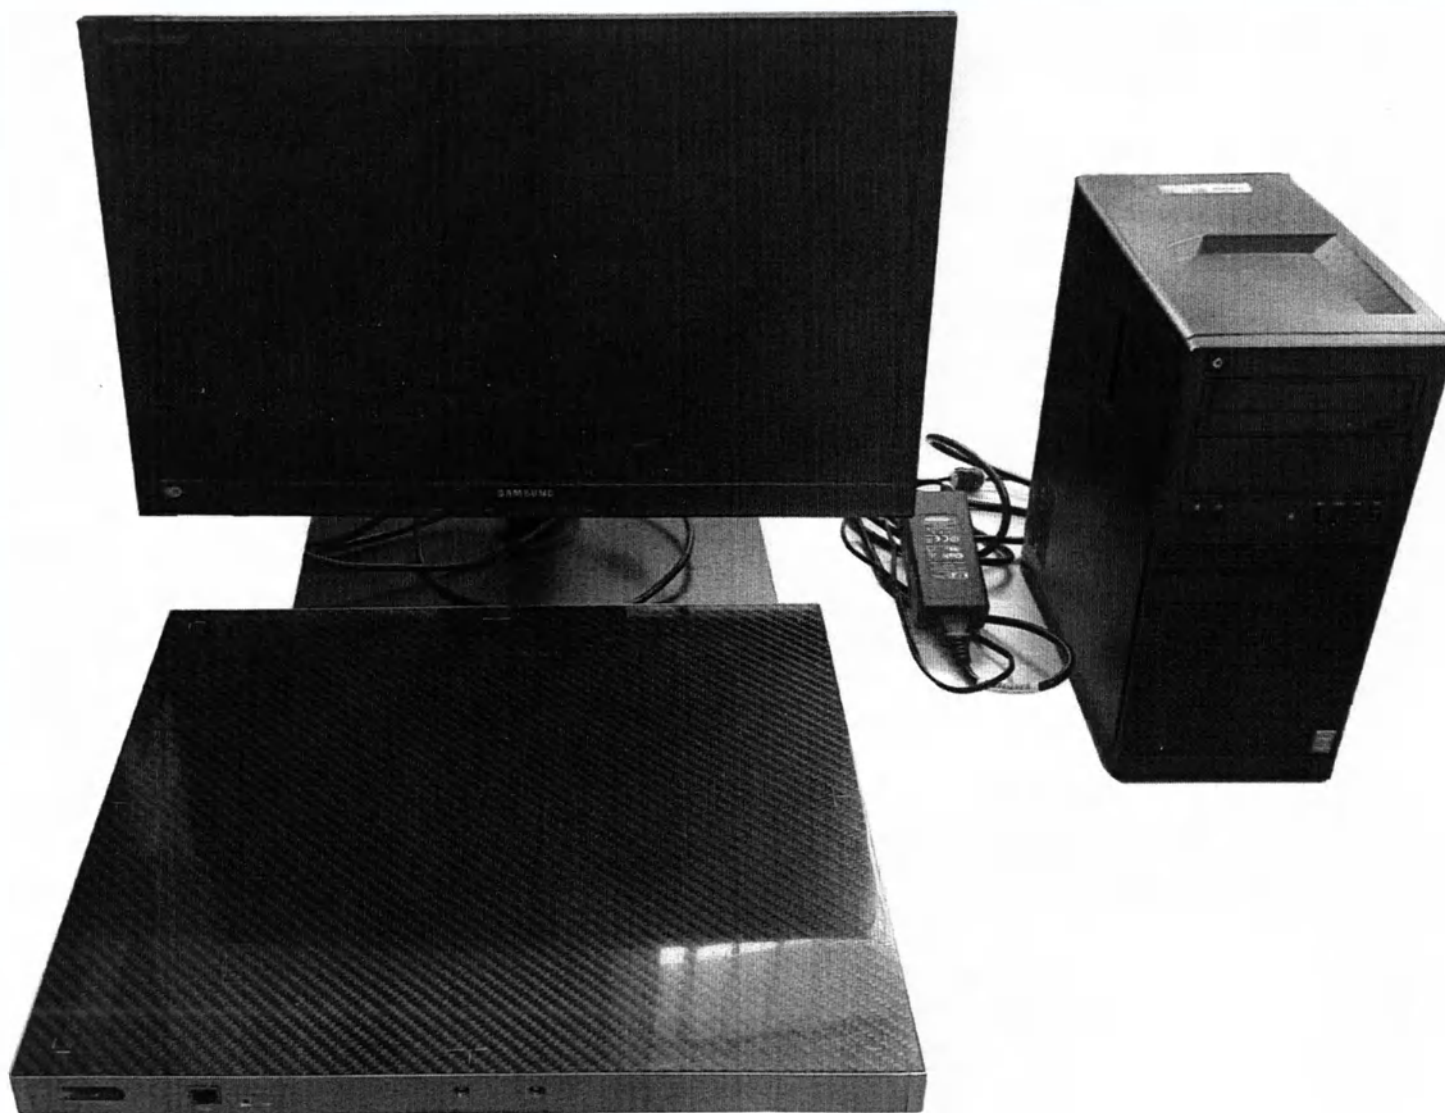


Комплекс аппаратно-программный для регистрации и обработки рентгеновских изображений
«СОЛО ДР-МТ», производства АО «МТЛ», Россия

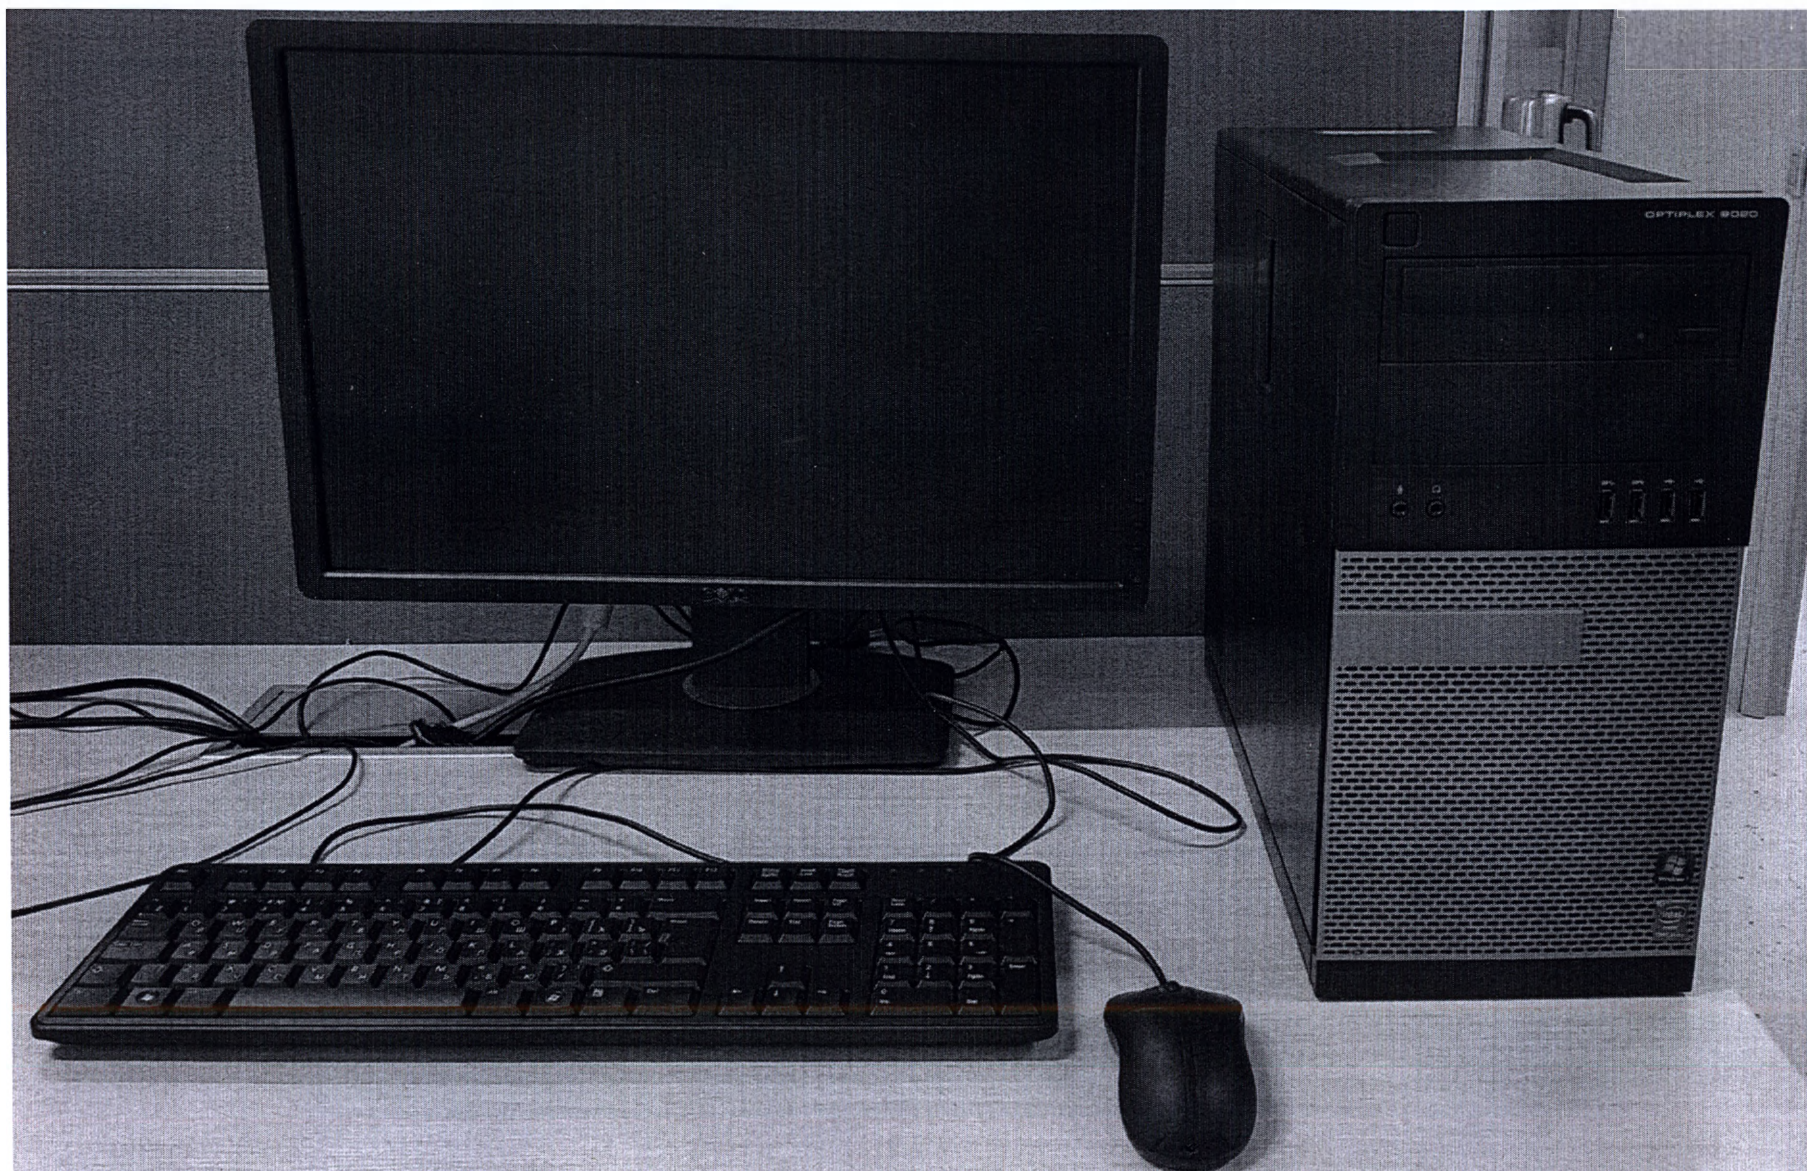


Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога «ДИАРМ-МТ-Плюс», производства АО «МТЛ»,

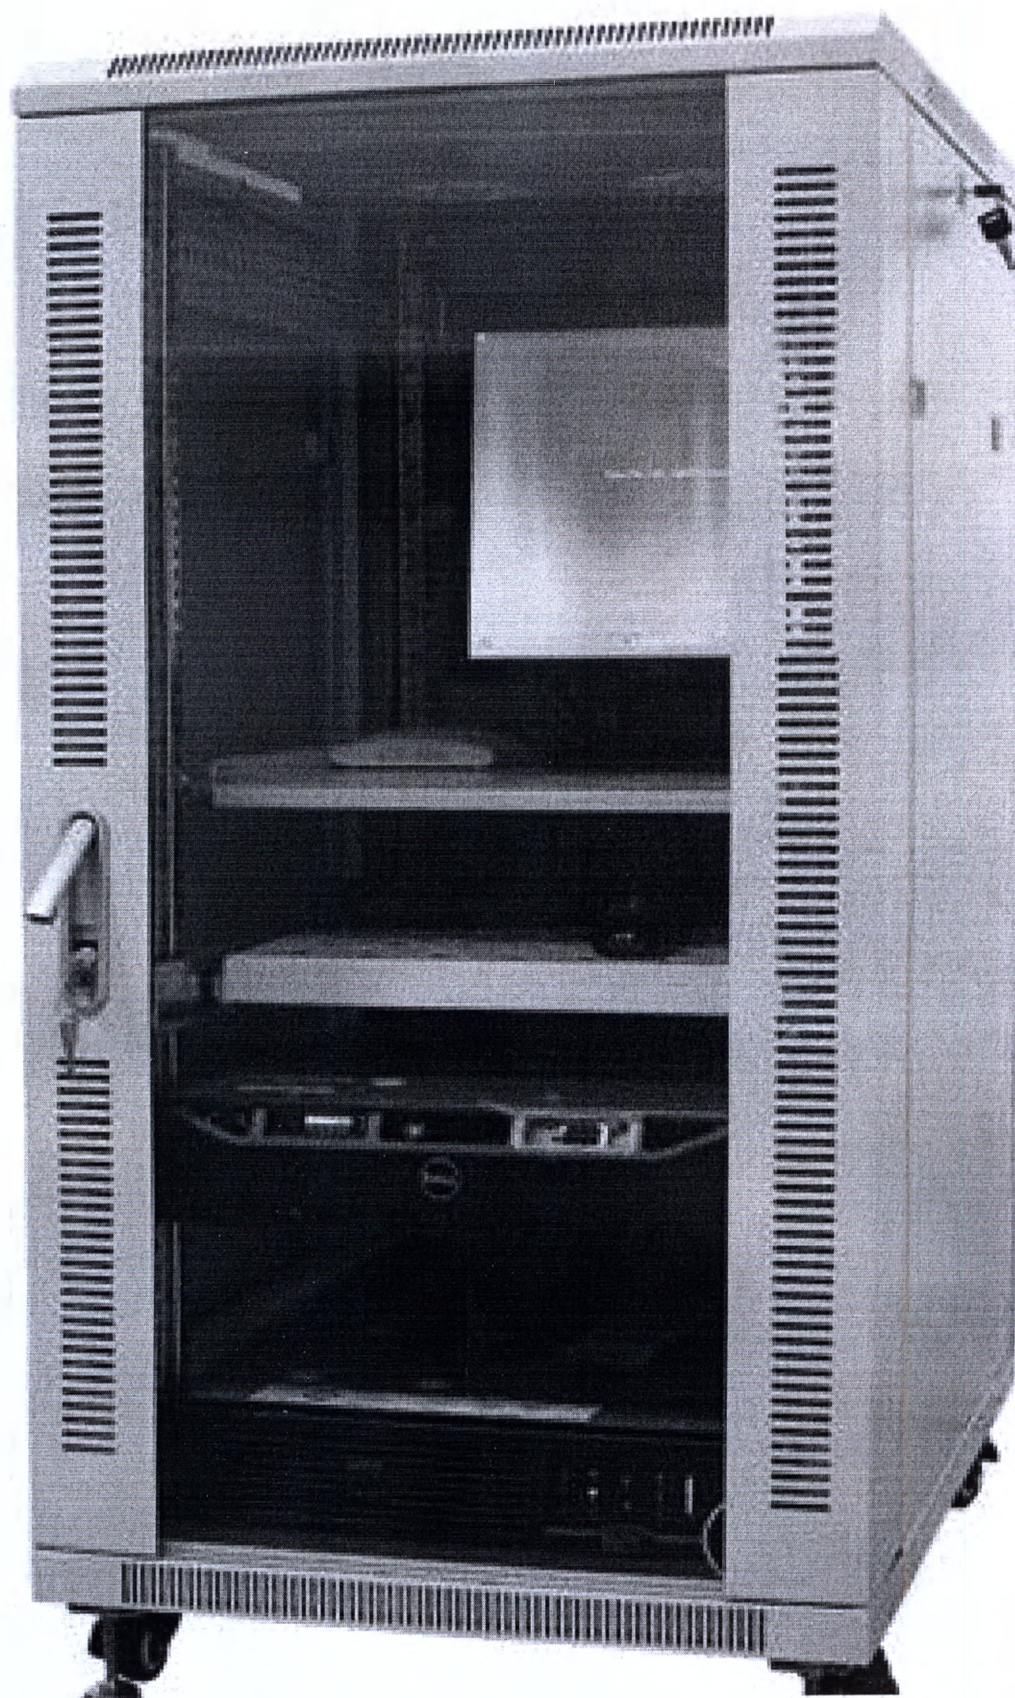


Радиологическая информационная система «ИнтеГРИС-МТ-Плюс»,
производства АО «МТЛ», Россия

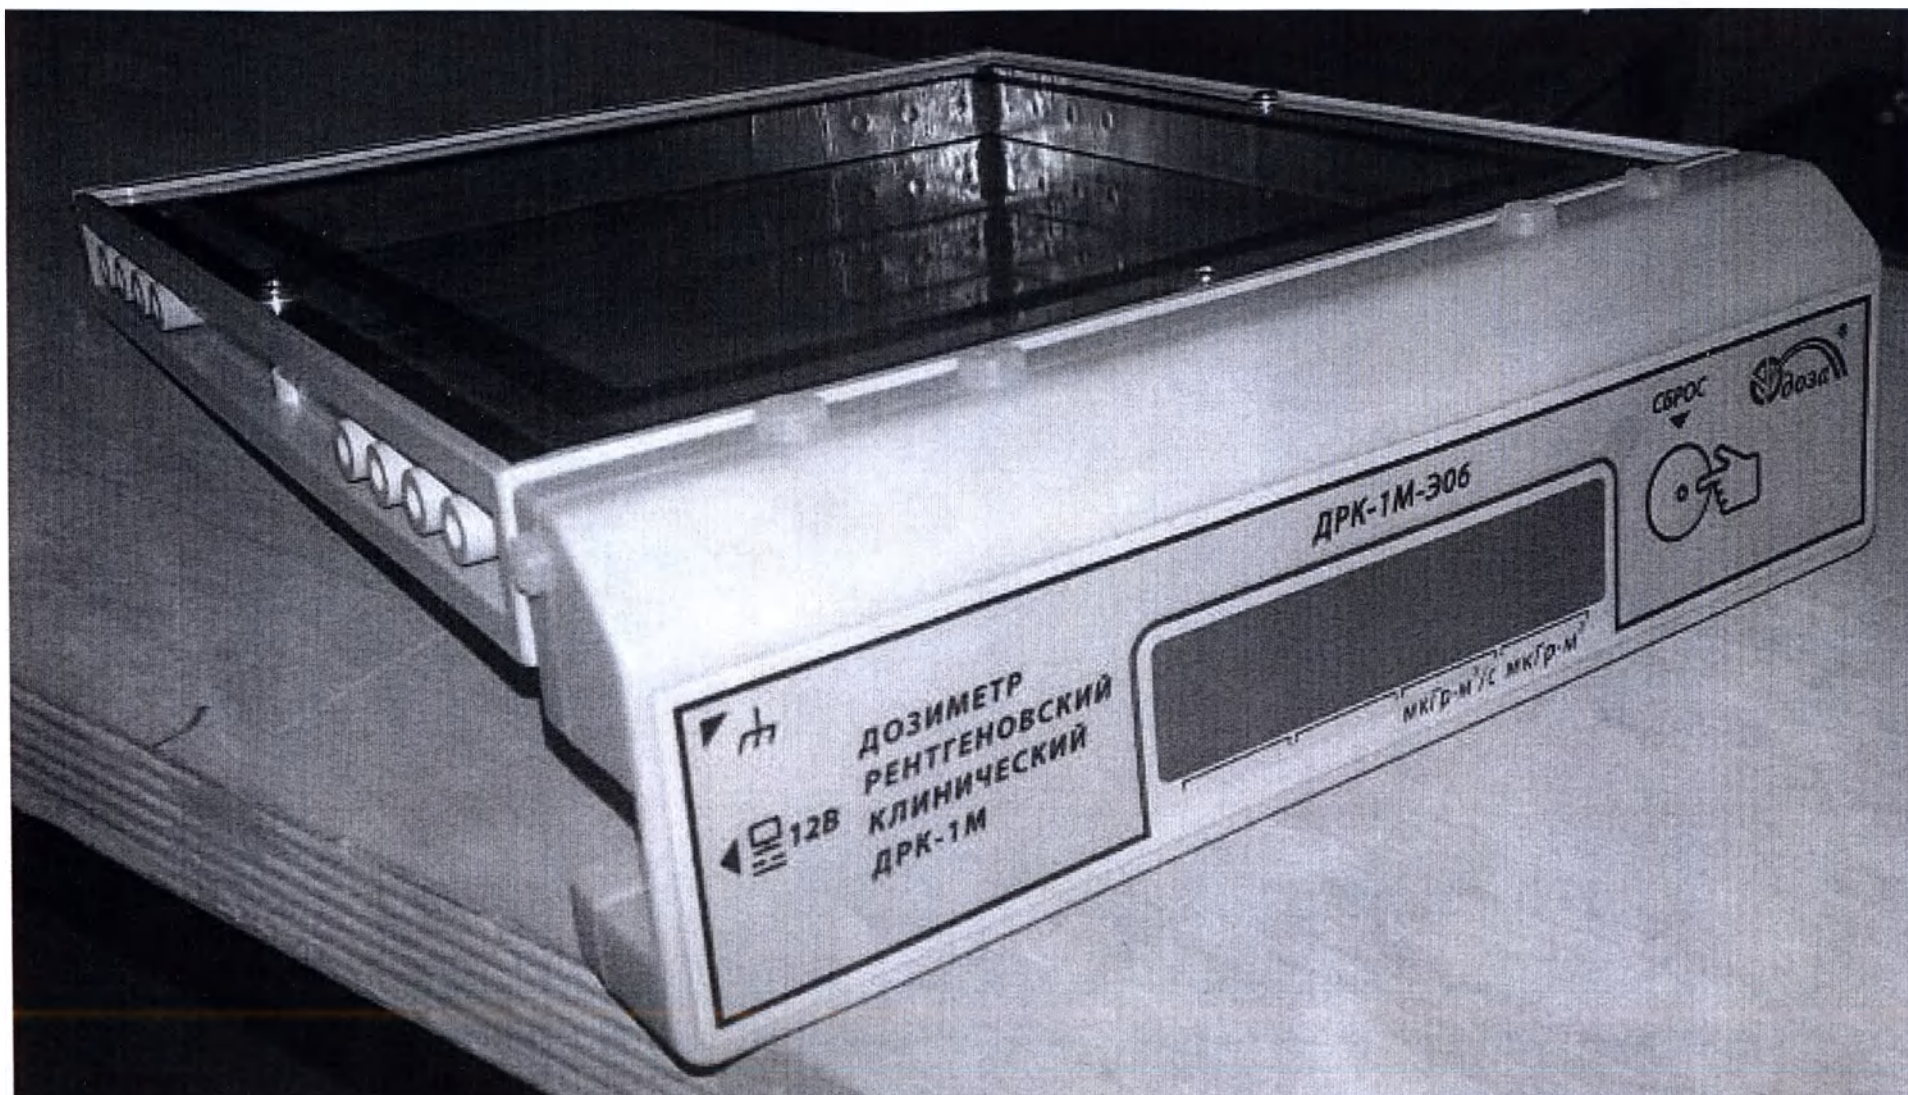

Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М, производства ООО НПП «Доза», Россия

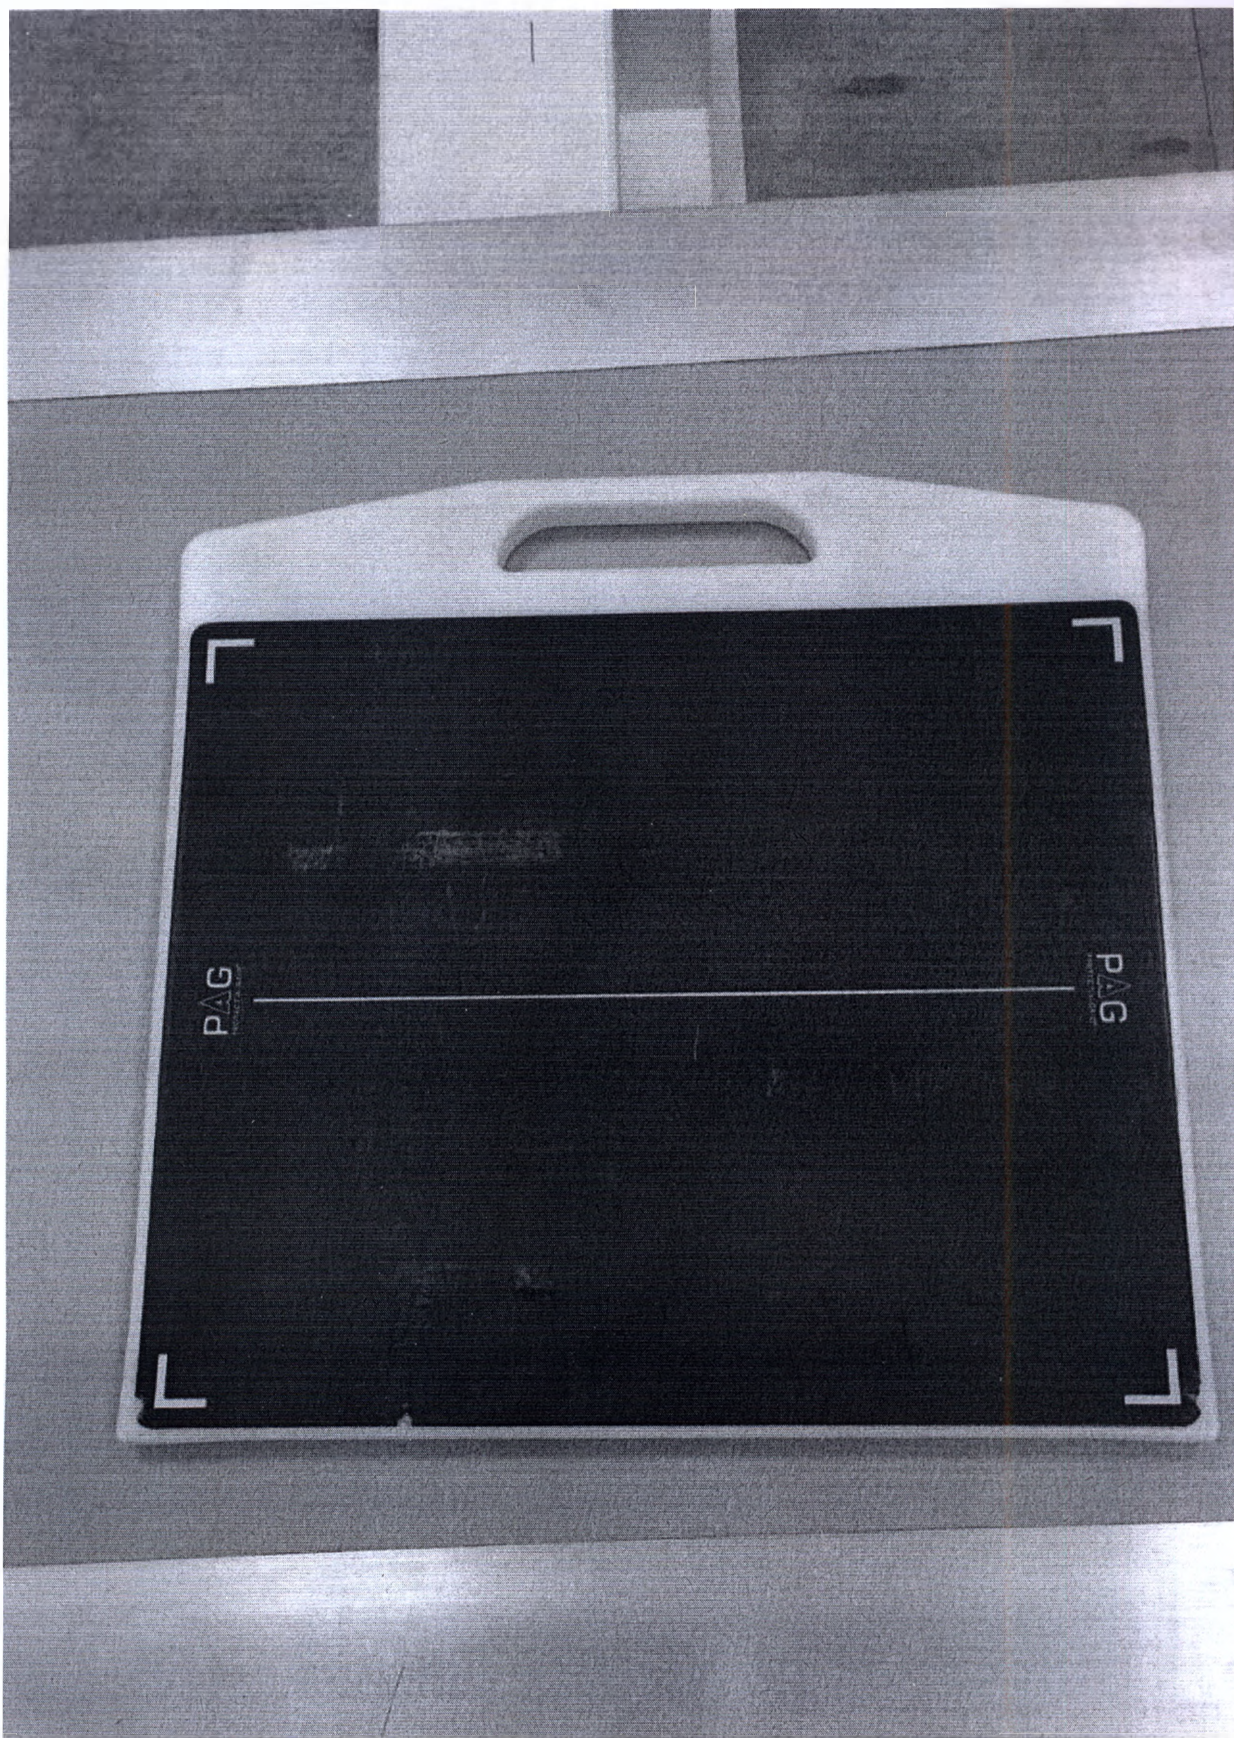

Портативный бокс с растром 23×30 см или 35×43 см,
производства Reina Imaging, США или JPI Healthcare Co., Ltd,
Республика Корея

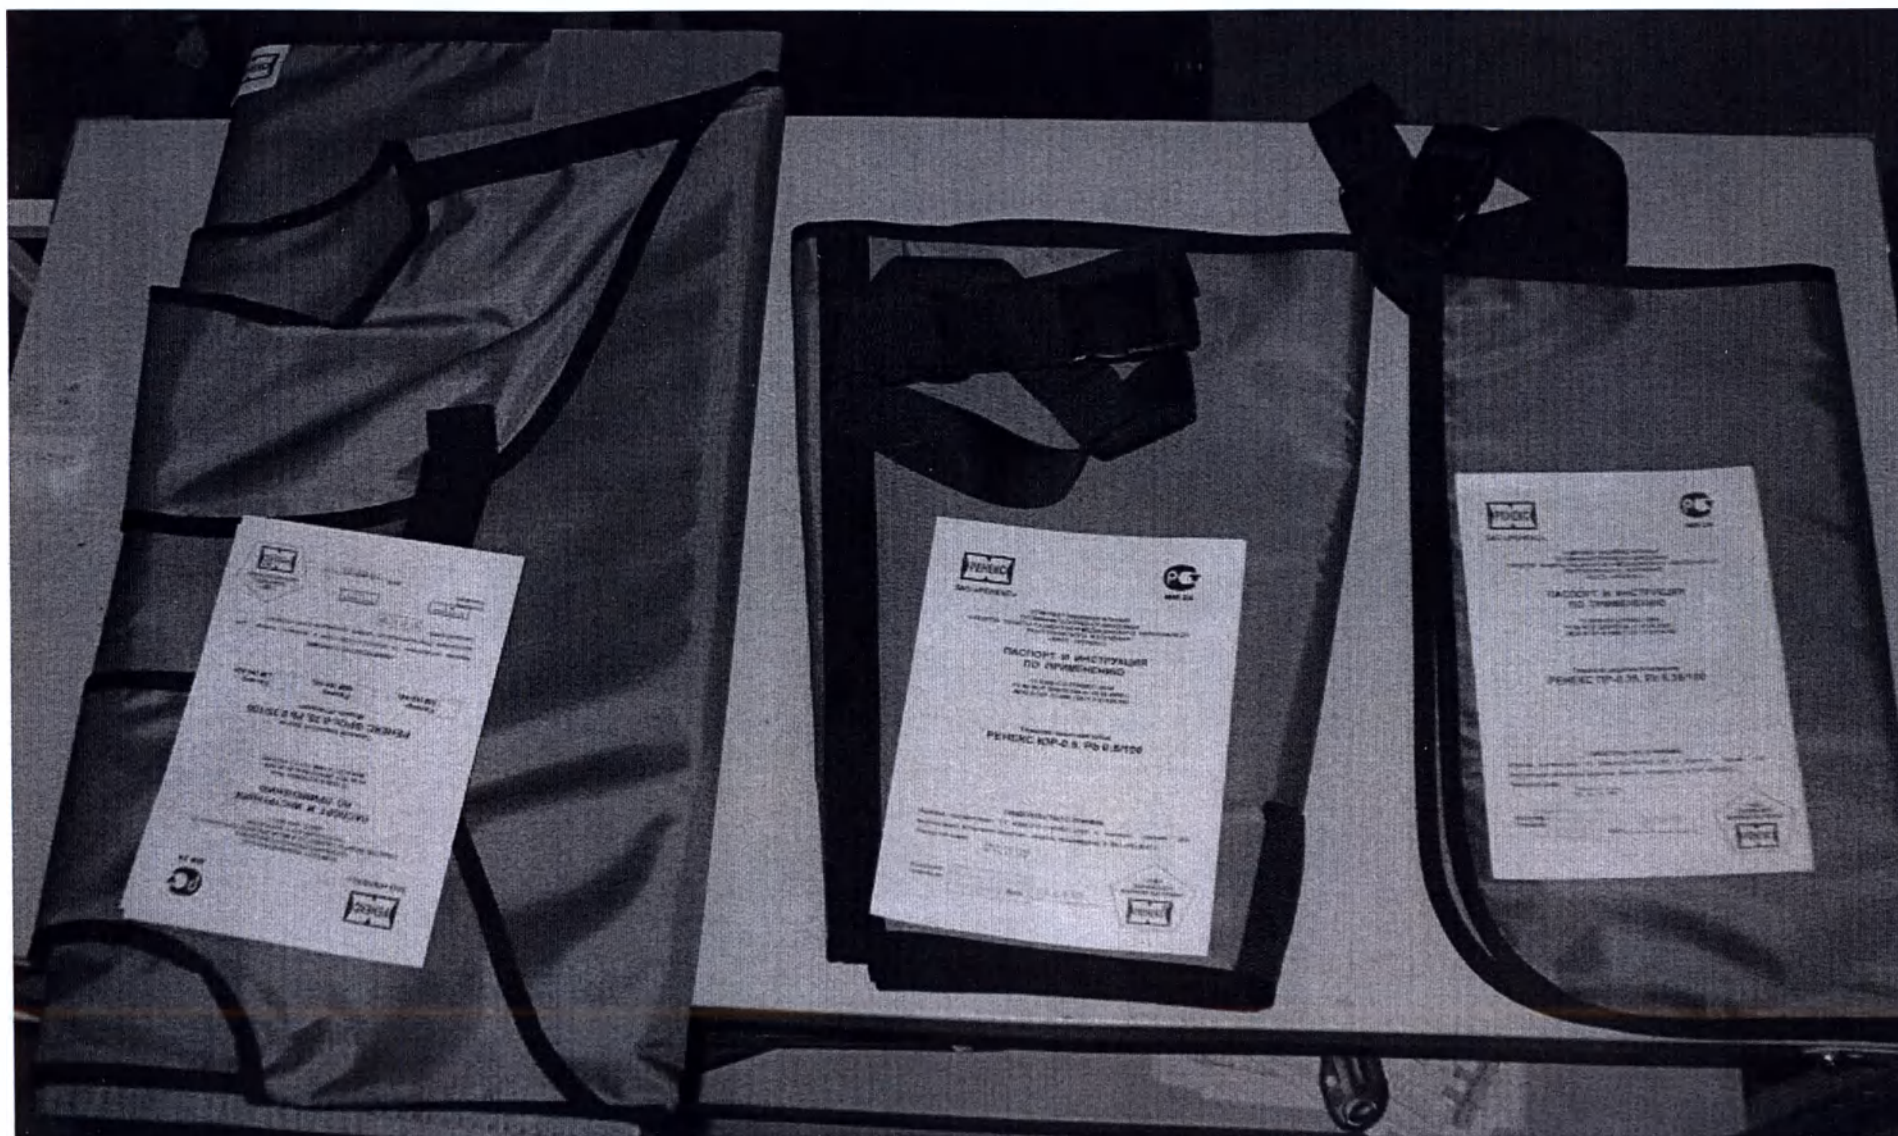

Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС» по ТУ 9398-010-21009821-2004, производства ЗАО «Ренекс», Россия



Комплекты рентгенозащитных средств из материала резиносвинцового для индивидуальной защиты врача, пациента и для использования в микропедиатрии при рентгенодиагностических исследованиях КСИЗ-РС и КСИЗмп-РС по ТУ 9452-001-42879986-2006, производства ООО «МП НПФ «Гаммамед-П», Россия

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 18

(восемнадцати) листах


Генеральный директор
ООО «ВКО Медпром»



Мещеряков О.В.

**Макет маркировки и
упаковки медицинского
изделия Аппарат
рентгенографический
палатный передвижной
разборный портативный
Р-600 «Мобикомпакт»**


ООО
«ВКО Медпром»



**Аппарат рентгенографический палатный
передвижной разборный портативный Р-600
«Мобикомпакт»**


Серийный номер:

Год и месяц упаковывания:

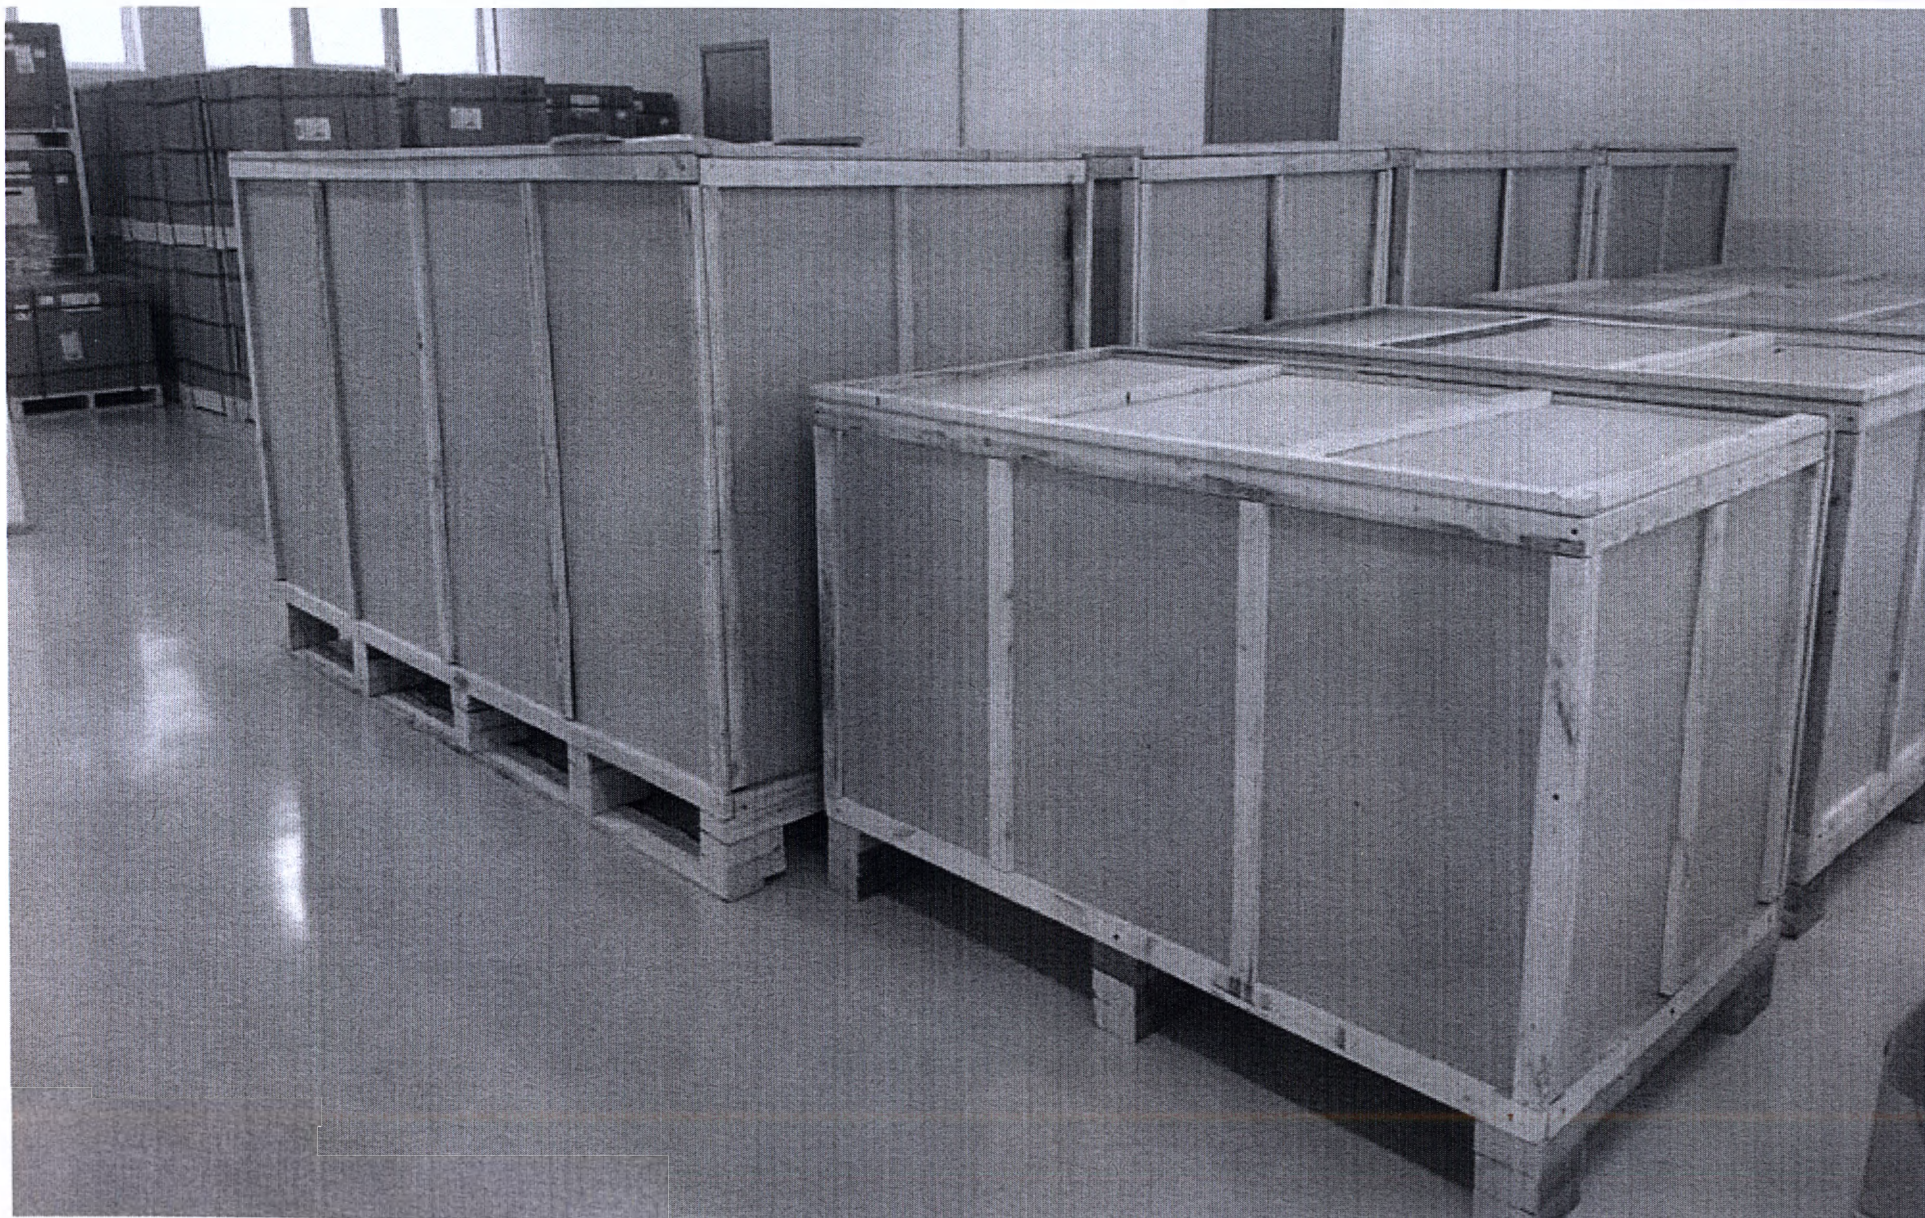

В зависимости от комплектации аппарат может быть упакован от 1 до 2 ящиков. В ящике 2 могут быть расположены устройство печати и другие изделия поставляемые по согласованию с заказчиком. Изделия поставляются в оригинальной упаковке производителей.

Макет маркировки



Аппарат рентгенографический палатный передвижной
разборный портативный Р-600 «Мобикомпакт»

Обозначение

М1-А0000-0Х

Технические условия

ТУ 26.60.11-012-67684634-2021

Рег. удостоверение

ХХХ ХХХХ/ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ

Серийный номер

Р-ХХ-ХХХ

Дата производства

ХХ.ХХХХ

Производитель

ООО «ВКО Медпром»



~ 220/230 В, 50 Гц, 3,5 кВ·А



Х – значения указываются при поставке и после получении Регистрационного удостоверения

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 4

(четыре) листах

Генеральный директор
ООО «ВКО Медпром» *Медпром* Медвяков О.В.

