

«УТВЕРЖДАЮ»

Менеджер по регистрации

ООО «Джонсон & Джонсон»

Р. Финкель


2021 г.



## ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

на медицинское изделие

Устройство для внутрисосудистой тромбэктомии EmboTrap

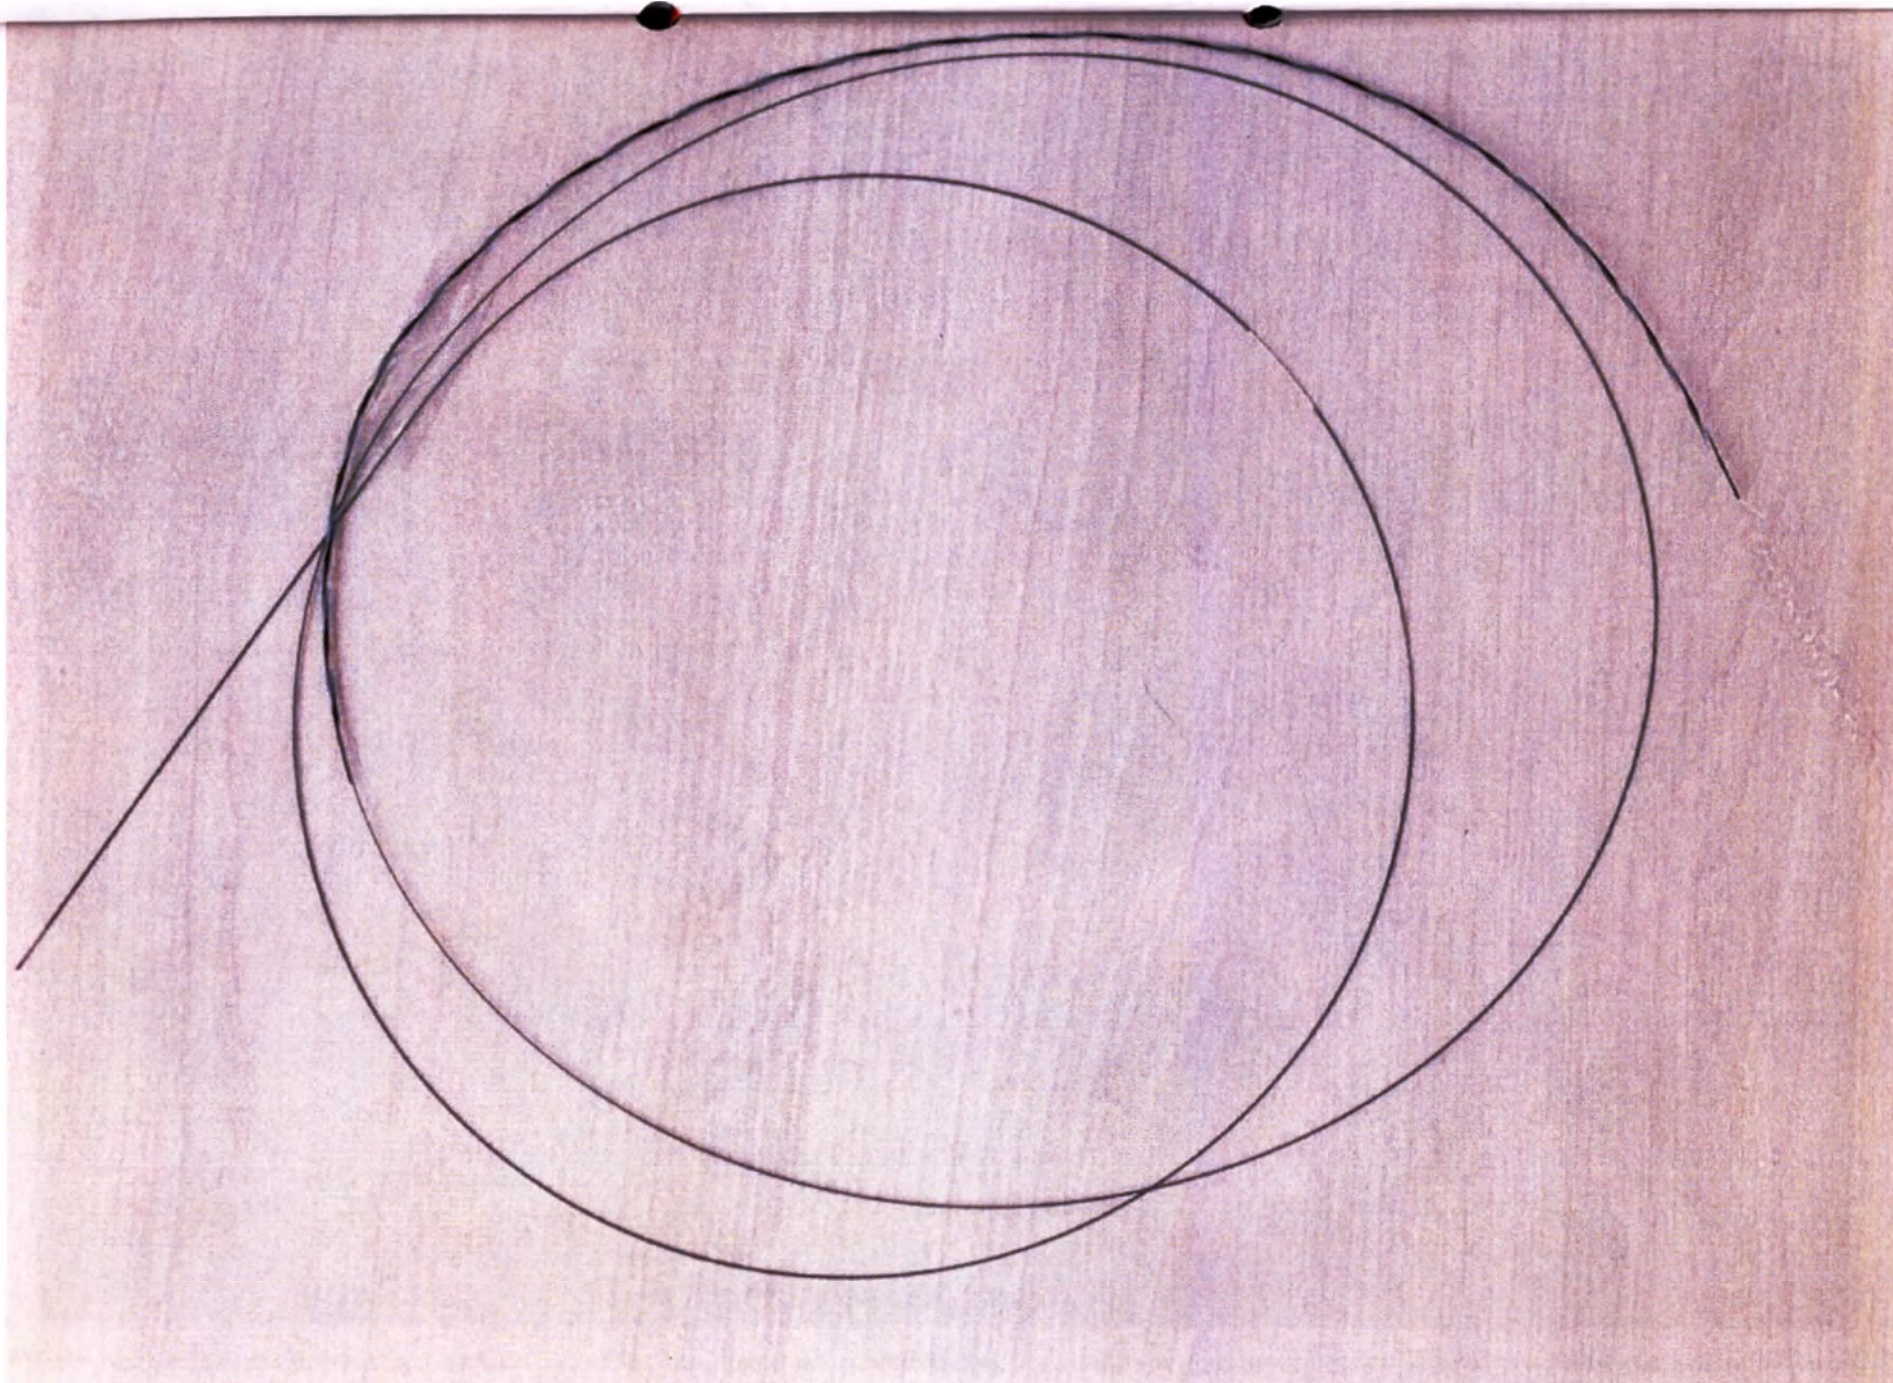


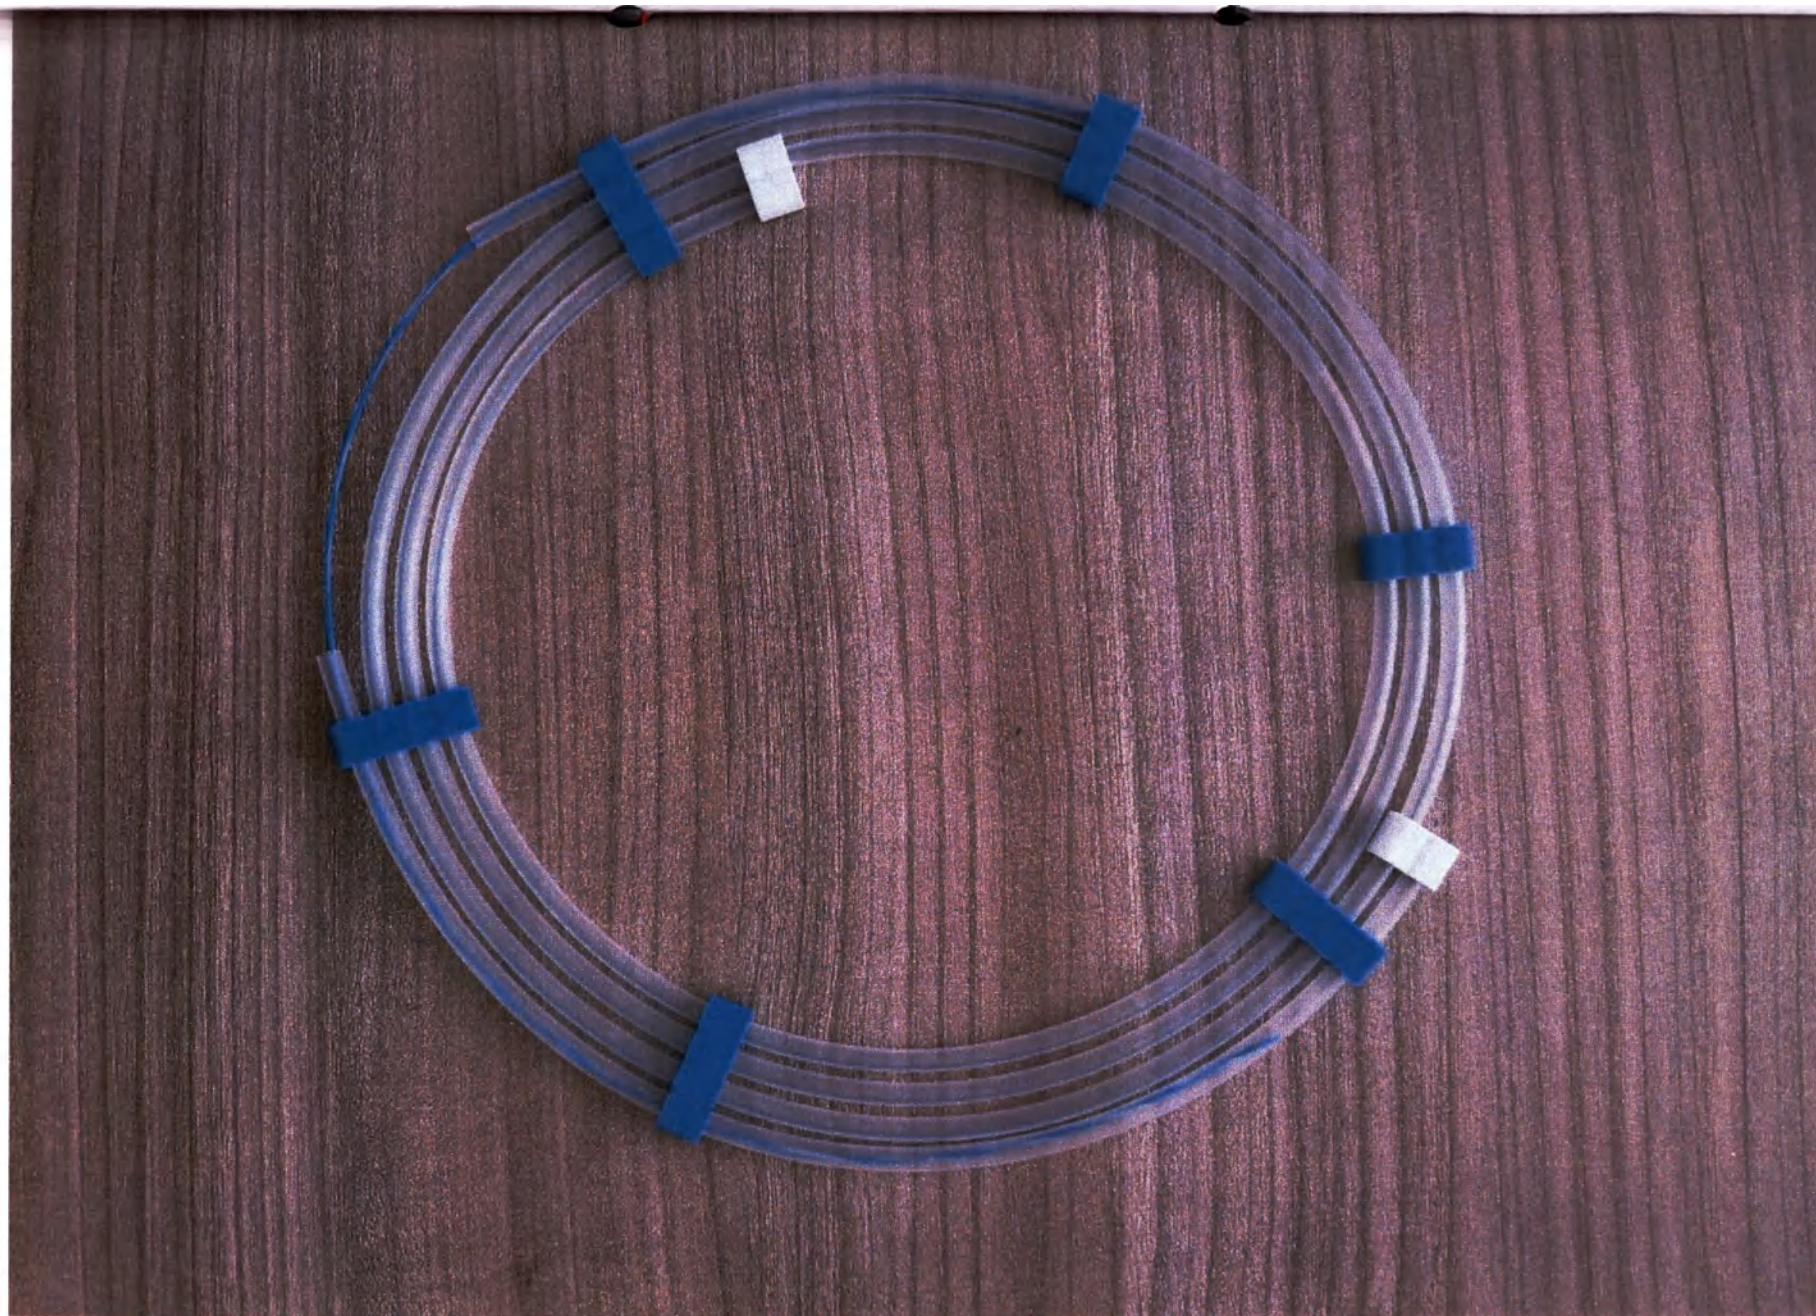



Рис. 2. Общий вид медицинского изделия в кольцеобразной укладке с зажимами. Устройство для внутрисосудистой тромбэктомии EmboTrap II (ЕТ-007-

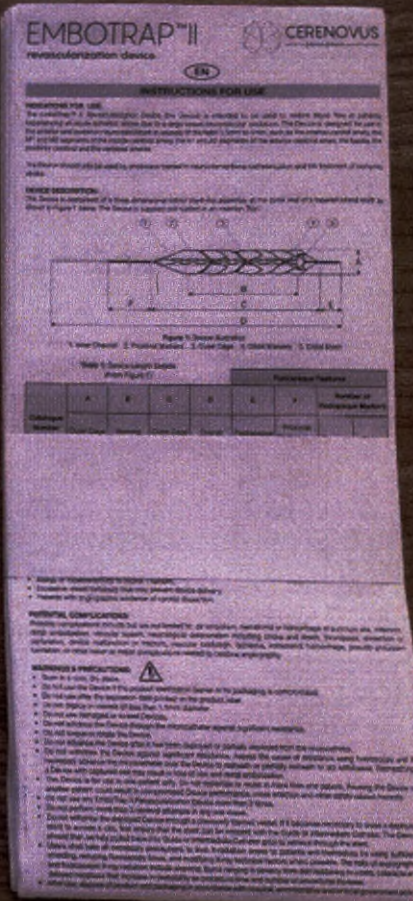

 ООО ЦПМИ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:INFO@CIRMI.RU)  [WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU](http://WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU)

# EMBOTRAP II

revascularization device

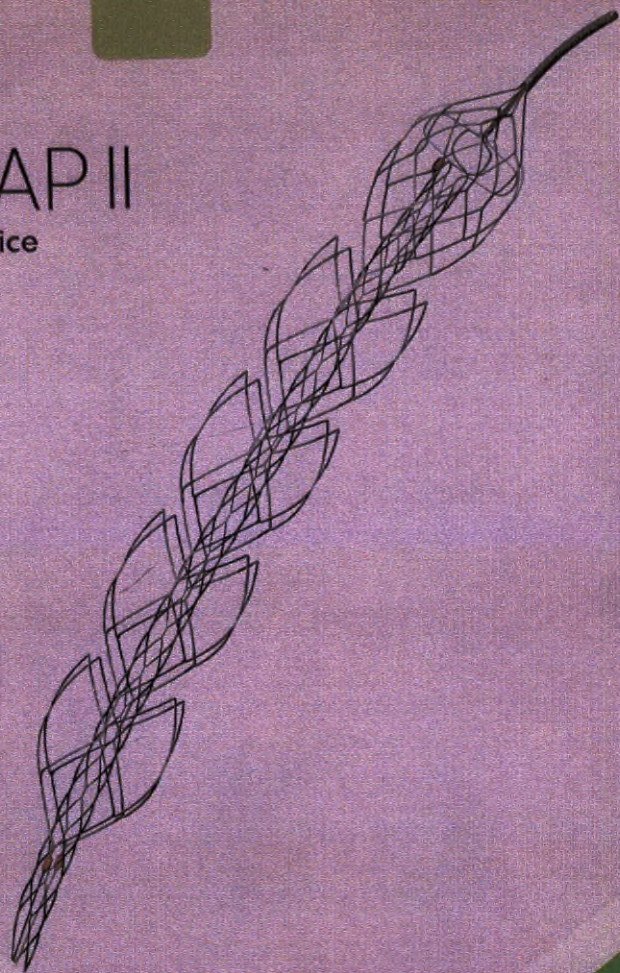

CERENOVUS

MADE IN THE RUSSIAN FEDERATION PART OF COMPANY

рис. 4. Внешний вид потребительской упаковки (картонной коробки). Устройство для внутрисосудистой тромбэктомии EmboTrap II (ET-007-521).

# EMBOTRAP II

revascularization device




## EMBOTRAP™ II



CERENOVUS

Revascularization device  
Dispositif de revascularisation  
Revascularisationsinstrument  
Dispositivo de revascularização  
Dispositivo de revascularización  
Dispositivo de revascularização  
Apparaat voor revascularisatie  
Revasculariseringsinrichting  
Revasculariseringsinrichting  
Revasculariseringsinrichting  
Revascularisationsprístroj  
Dispositiv pentru revascularizare  
Revascularizációs készülék  
Pripomínka za revascularizacijo

Uređaj za revascularizaciju  
Revascularizacijski priređaj  
Revascularizacijske uređaj  
Przyrząd do revascularyzacji  
Revascularizációs készülék  
Uređaj za revascularizaciju  
Revascularizációs készülék  
Zurückzuführen des Gerätes  
cyfrowy za revascularizację  
Revascularizációs készülék  
Revascularizációs készülék

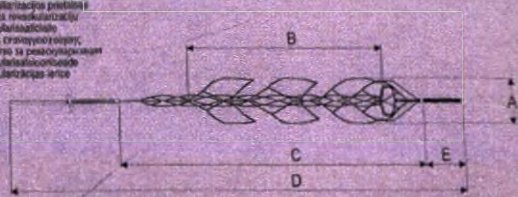

|   |        |
|---|--------|
| A | 5 mm   |
| B | 21 mm  |
| C | 33 mm  |
| D | 194 cm |
| E | 4 mm   |

Minimum Microcatheter ID  
0.021" / 0.53 mm

Contents 1 x

REF ET-007-521

2023-08-20

LOT 20K107AV



CERENOVUS  
EMBOTRAP™ II  
5mm x 21mm



(01) 0 53 92000 08933 4

STERILE EO


REF ET-007-521

2023-08-20

LOT 20K107AV



(17) 230820(10) 20K107AV



CERENOVUS  
EMBOTRAP™ II  
5mm x 21mm



(01) 0 53 92000 08933 4



REF ET-007-521

2023-08-20

LOT 20K107AV



(17) 230820(10) 20K107AV



(01) 0 53 92000 08933 4



(17) 230820(10) 20K107AV

Neuravi LTD, Block 3, Ballybrit Business Park  
Galway, Ireland


Made in Ireland

LBL2294\_B / 0143  
CS103 Rev. 01

Рис. 5. Пример маркировки на потребительской упаковке (картонной коробке). Устройство для внутрисосудистой тромбэктомии EmboTrap II (ET-007-521).



Рис. 6. Пример маркировки на потребительской упаковке (картонной коробке). Устройство для внутрисосудистой тромбэктомии EmboTrap II (ET-007-521).

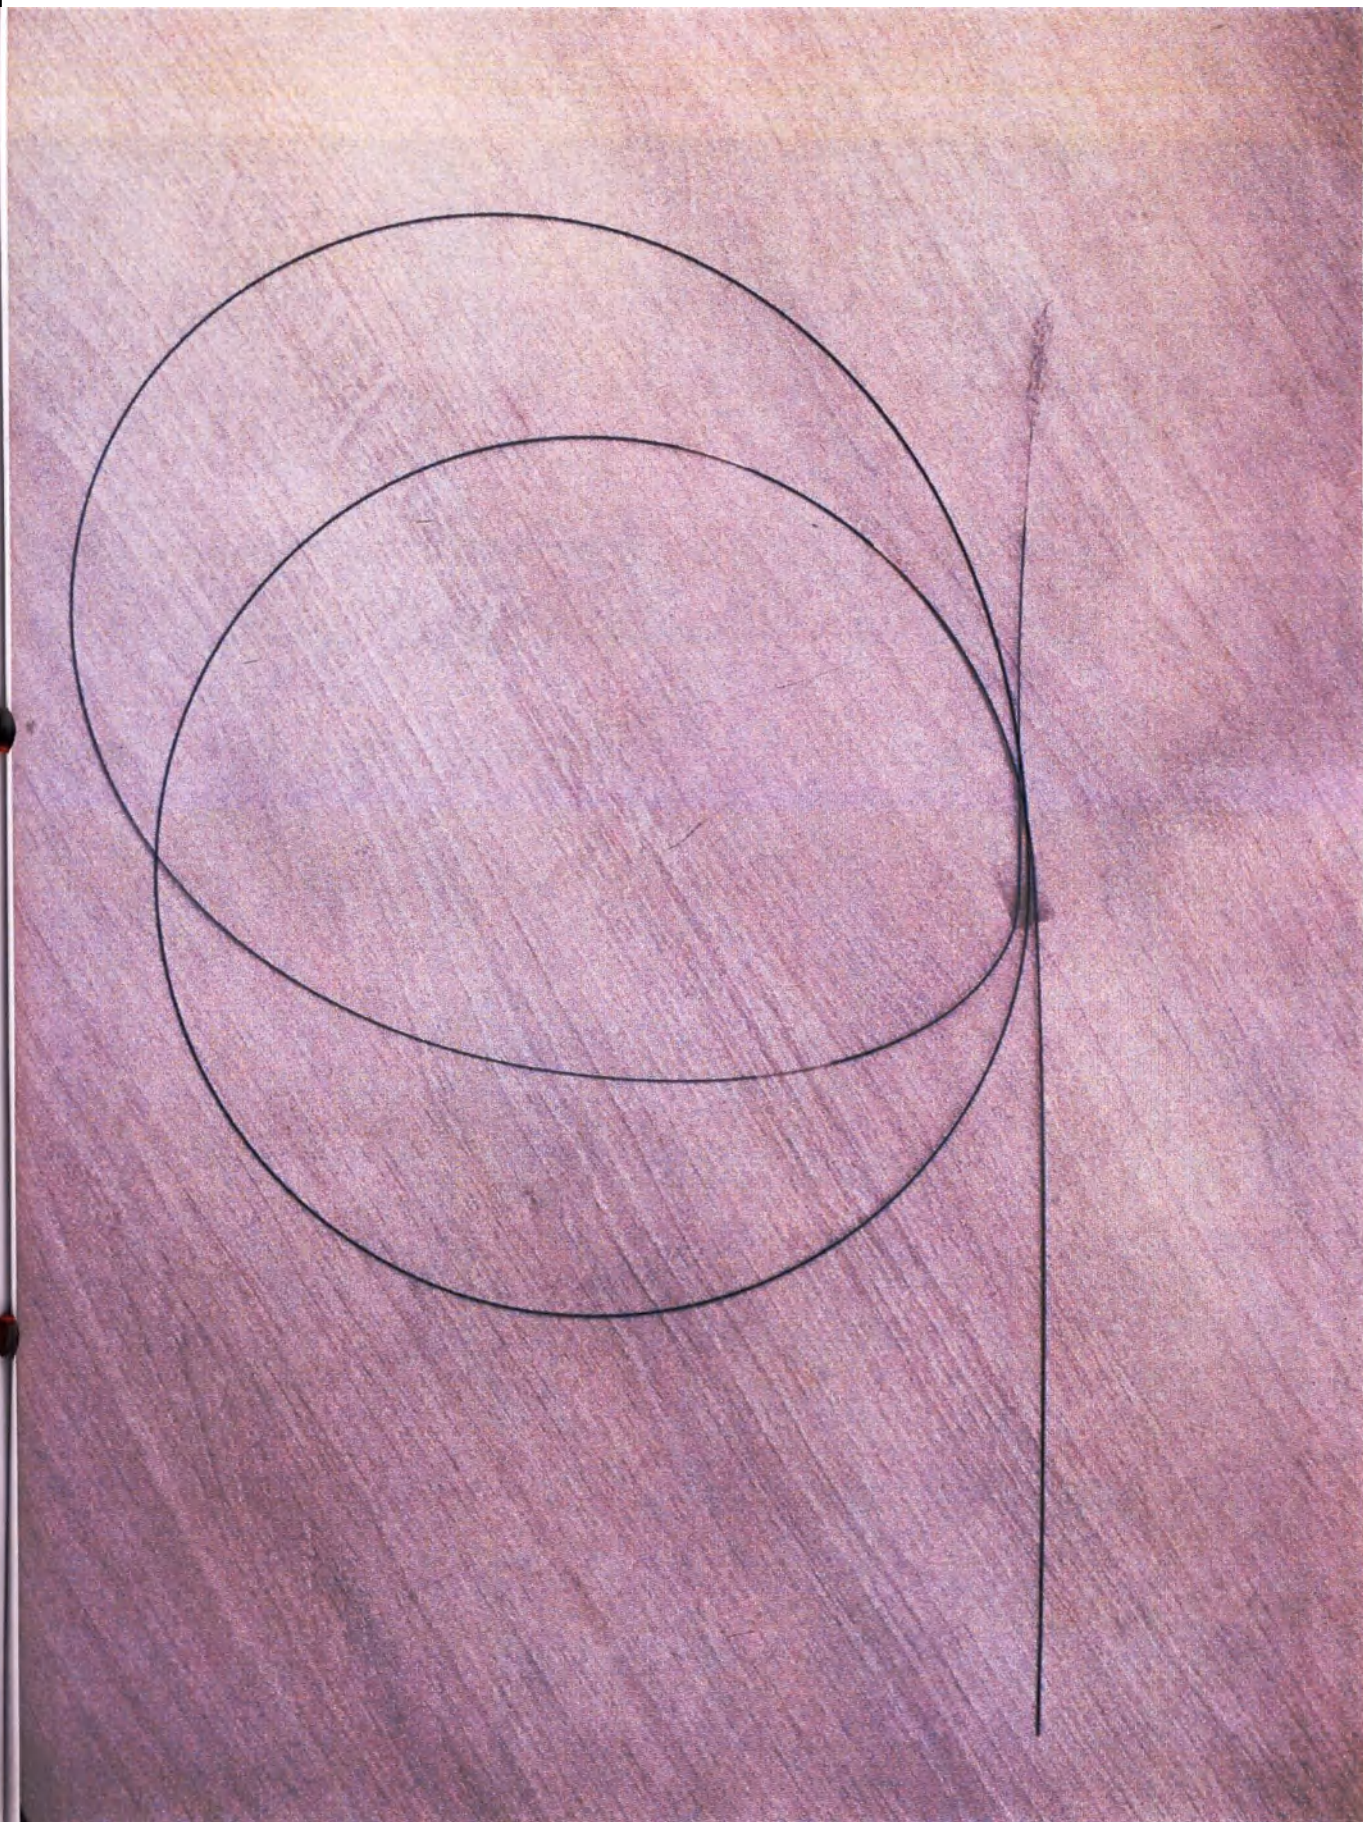

7. Внешний вид медицинского изделия. Устройство для внутрисосудистой тромбэктомии EmboTrap III (ET-307-645)


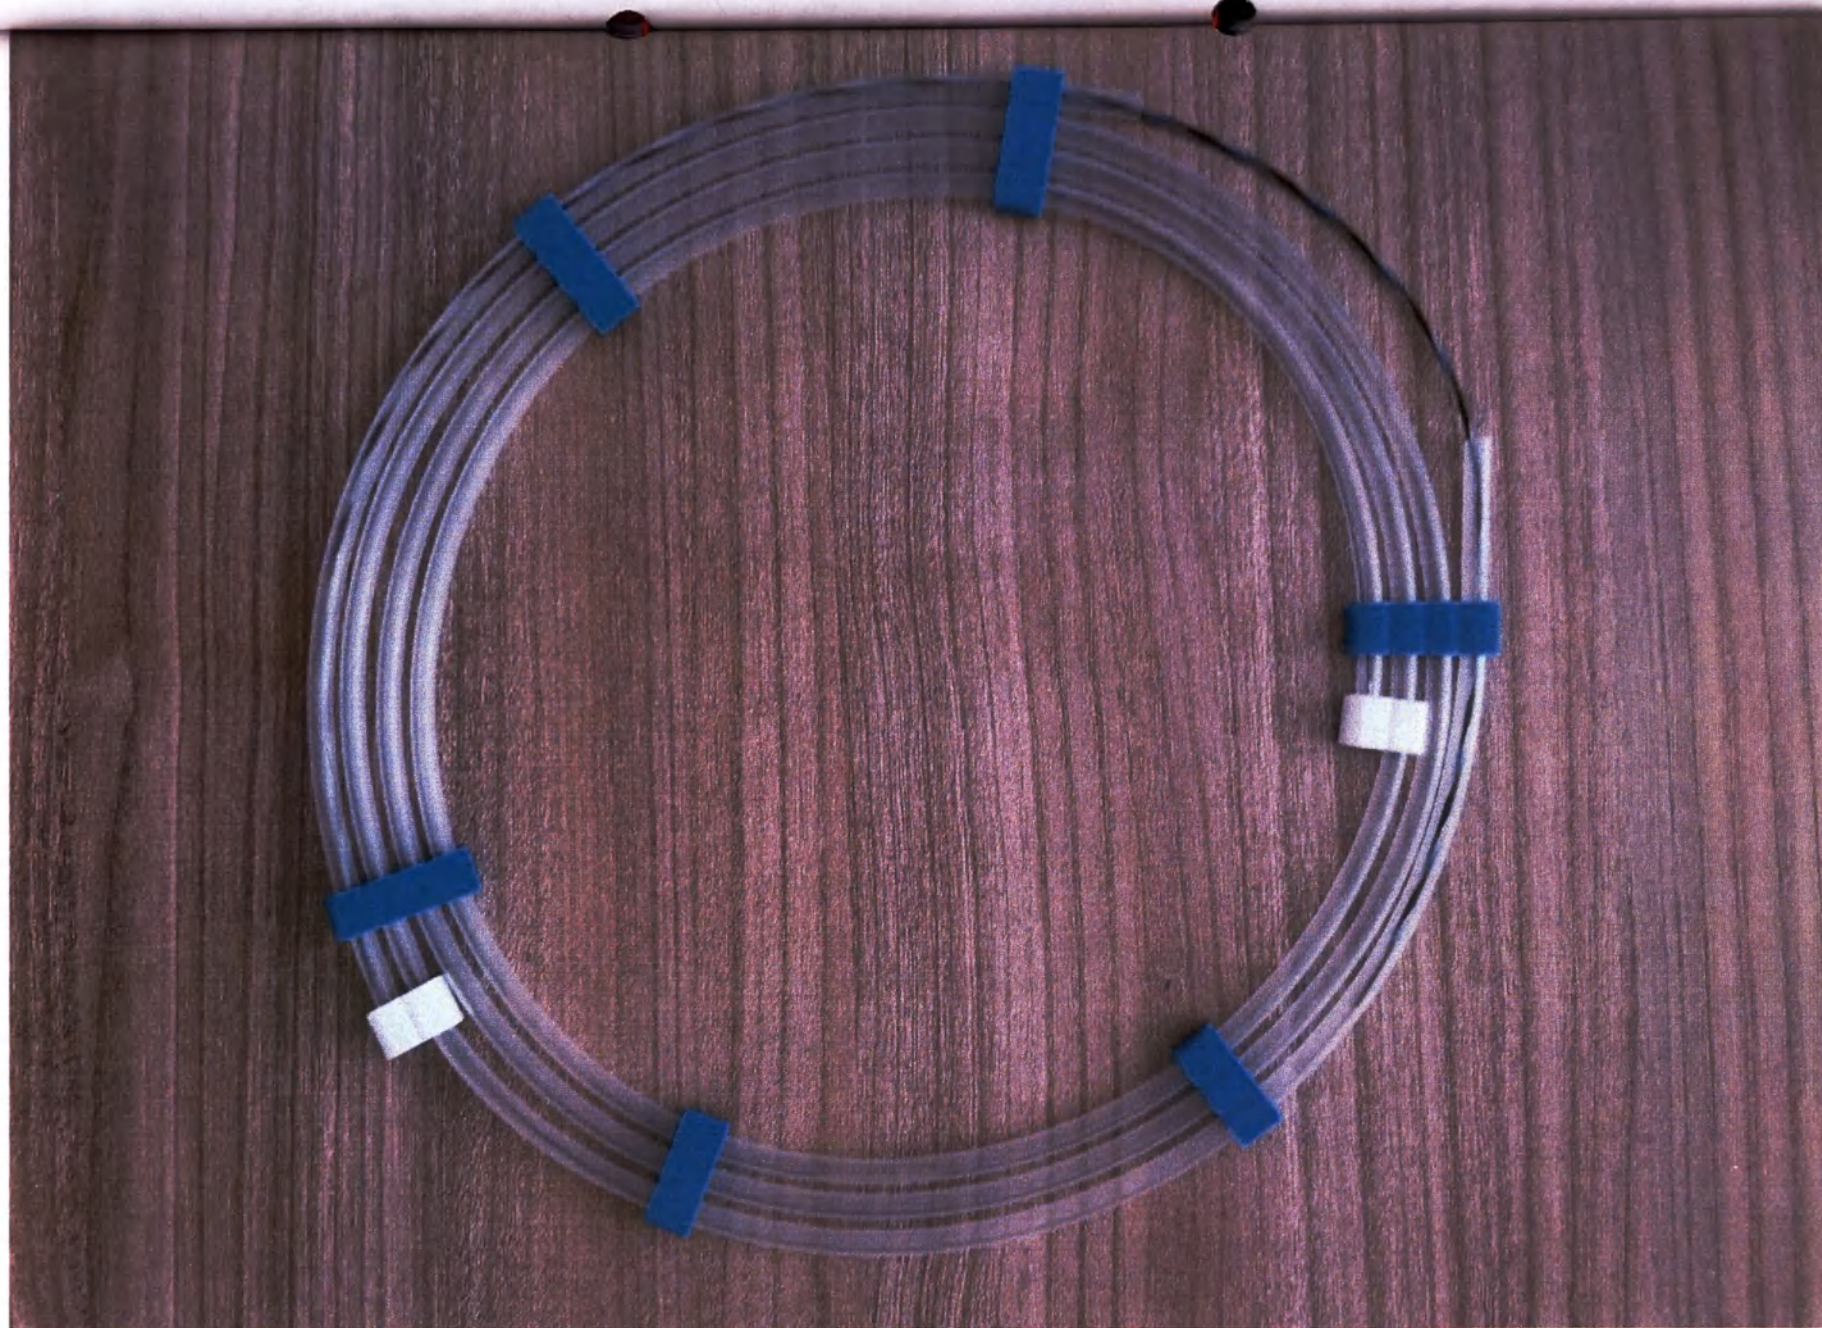



Рис. 8. Общий вид медицинского изделия в кольцеобразной укладке с зажимами. Устройство для внутрисосудистой тромбэктомии EmboTrap III (ET-307-



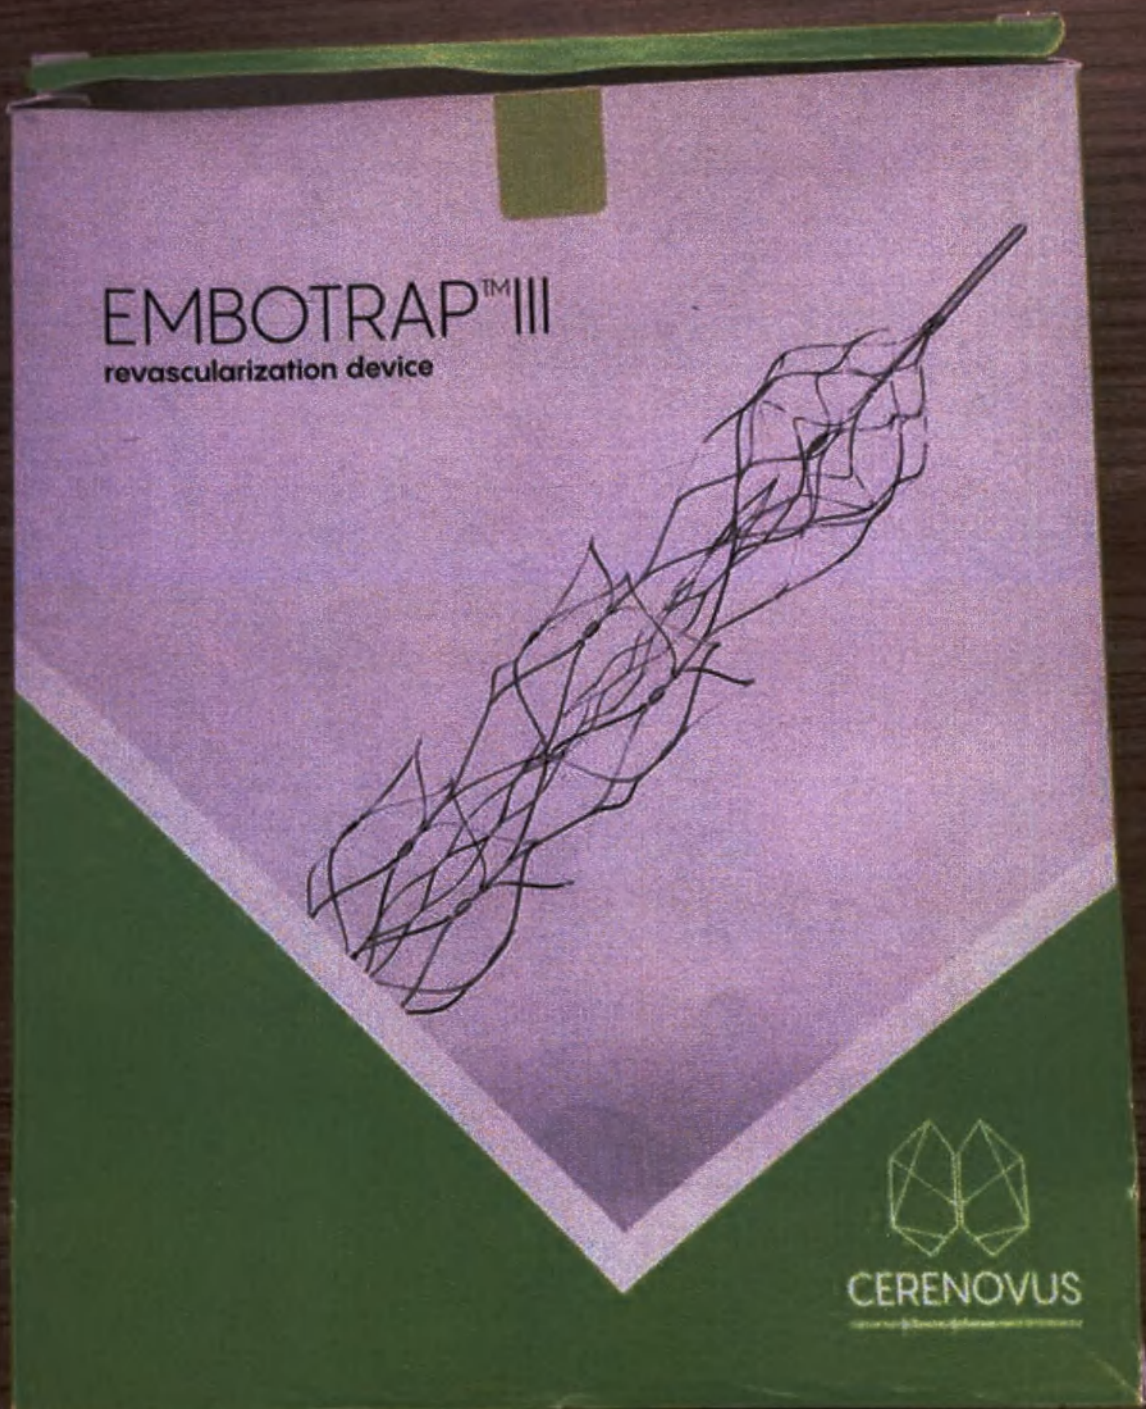

с. 10. Внешний вид потребительской упаковки (картонной коробки). Устройство для внутрисосудистой тромбэктомии EmboTrap III (ET-307-645)

EMBOTRAP™ III  
revascularization device



EMBOTRAP™ III




CERENOVUS

Revascularization device  
Dispositiv de revascularizare  
Revascularisationsapparat  
Dispositif de revascularisation  
Dispositivo de revascularização  
Apparat voor revascularisatie  
Revascularisierungsgerät  
Revascularisierungsapparat  
Revascularization device  
Dispositiv pentru revascularizare  
Revascularisationsapparat  
Revascularisationsapparat

Dispositiv de revascularizare  
Revascularisationsapparat  
Revascularisationsapparat  
Dispositif de revascularisation  
Dispositivo de revascularização  
Apparat voor revascularisatie  
Revascularisierungsgerät  
Revascularisierungsapparat  
Revascularization device  
Dispositiv pentru revascularizare  
Revascularisationsapparat  
Revascularisationsapparat

|   |        |
|---|--------|
| A | 8.5 mm |
| B | 45 mm  |
| C | 87 mm  |
| D | 196 mm |
| E | 4 mm   |


Minimum Sterilizations Dose  
1.0 Gy / 5.18 mm

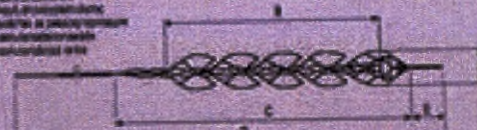

Contents: 1 x  
REF: ET307845 LOT: 20J066AV 2023-09-16



STERILE NO



CERENOVUS  
EMBOTRAP™ III  
8.5 mm x 45 mm

REF: ET307845

LOT: 20J066AV

2023-09-16

CERENOVUS  
EMBOTRAP™ III  
8.5 mm x 45 mm

REF: ET307845

LOT: 20J066AV

2023-09-16



UDI: 1 08 86704 08284 2

Manufactured in: Black & Veatch, Ireland  
2023-09-16



UDI: 1 08 86704 08284 2

(17) 230716(10) 20J066AV



UDI: 1 08 86704 08284 2

(17) 230716(10) 20J066AV



(17) 230716(10) 20J066AV



(17) 230716(10) 20J066AV

UDI: 1 08 86704 08284 2

Manufactured in: Black & Veatch, Ireland  
2023-09-16

UDI: 1 08 86704 08284 2

(17) 230716(10) 20J066AV

UDI: 1 08 86704 08284 2

(17) 230716(10) 20J066AV

UDI: 1 08 86704 08284 2

(17) 230716(10) 20J066AV

UDI: 1 08 86704 08284 2

(17) 230716(10) 20J066AV

UDI: 1 08 86704 08284 2

(17) 230716(10) 20J066AV

UDI: 1 08 86704 08284 2

(17) 230716(10) 20J066AV

UDI: 1 08 86704 08284 2

UDI: 1 08 86704 08284 2

Рис. 11. Пример маркировки на потребительской упаковке (картонной коробке). Устройство для внутрисосудистой тромбэктомии EmboTrap III (ET-307-645)

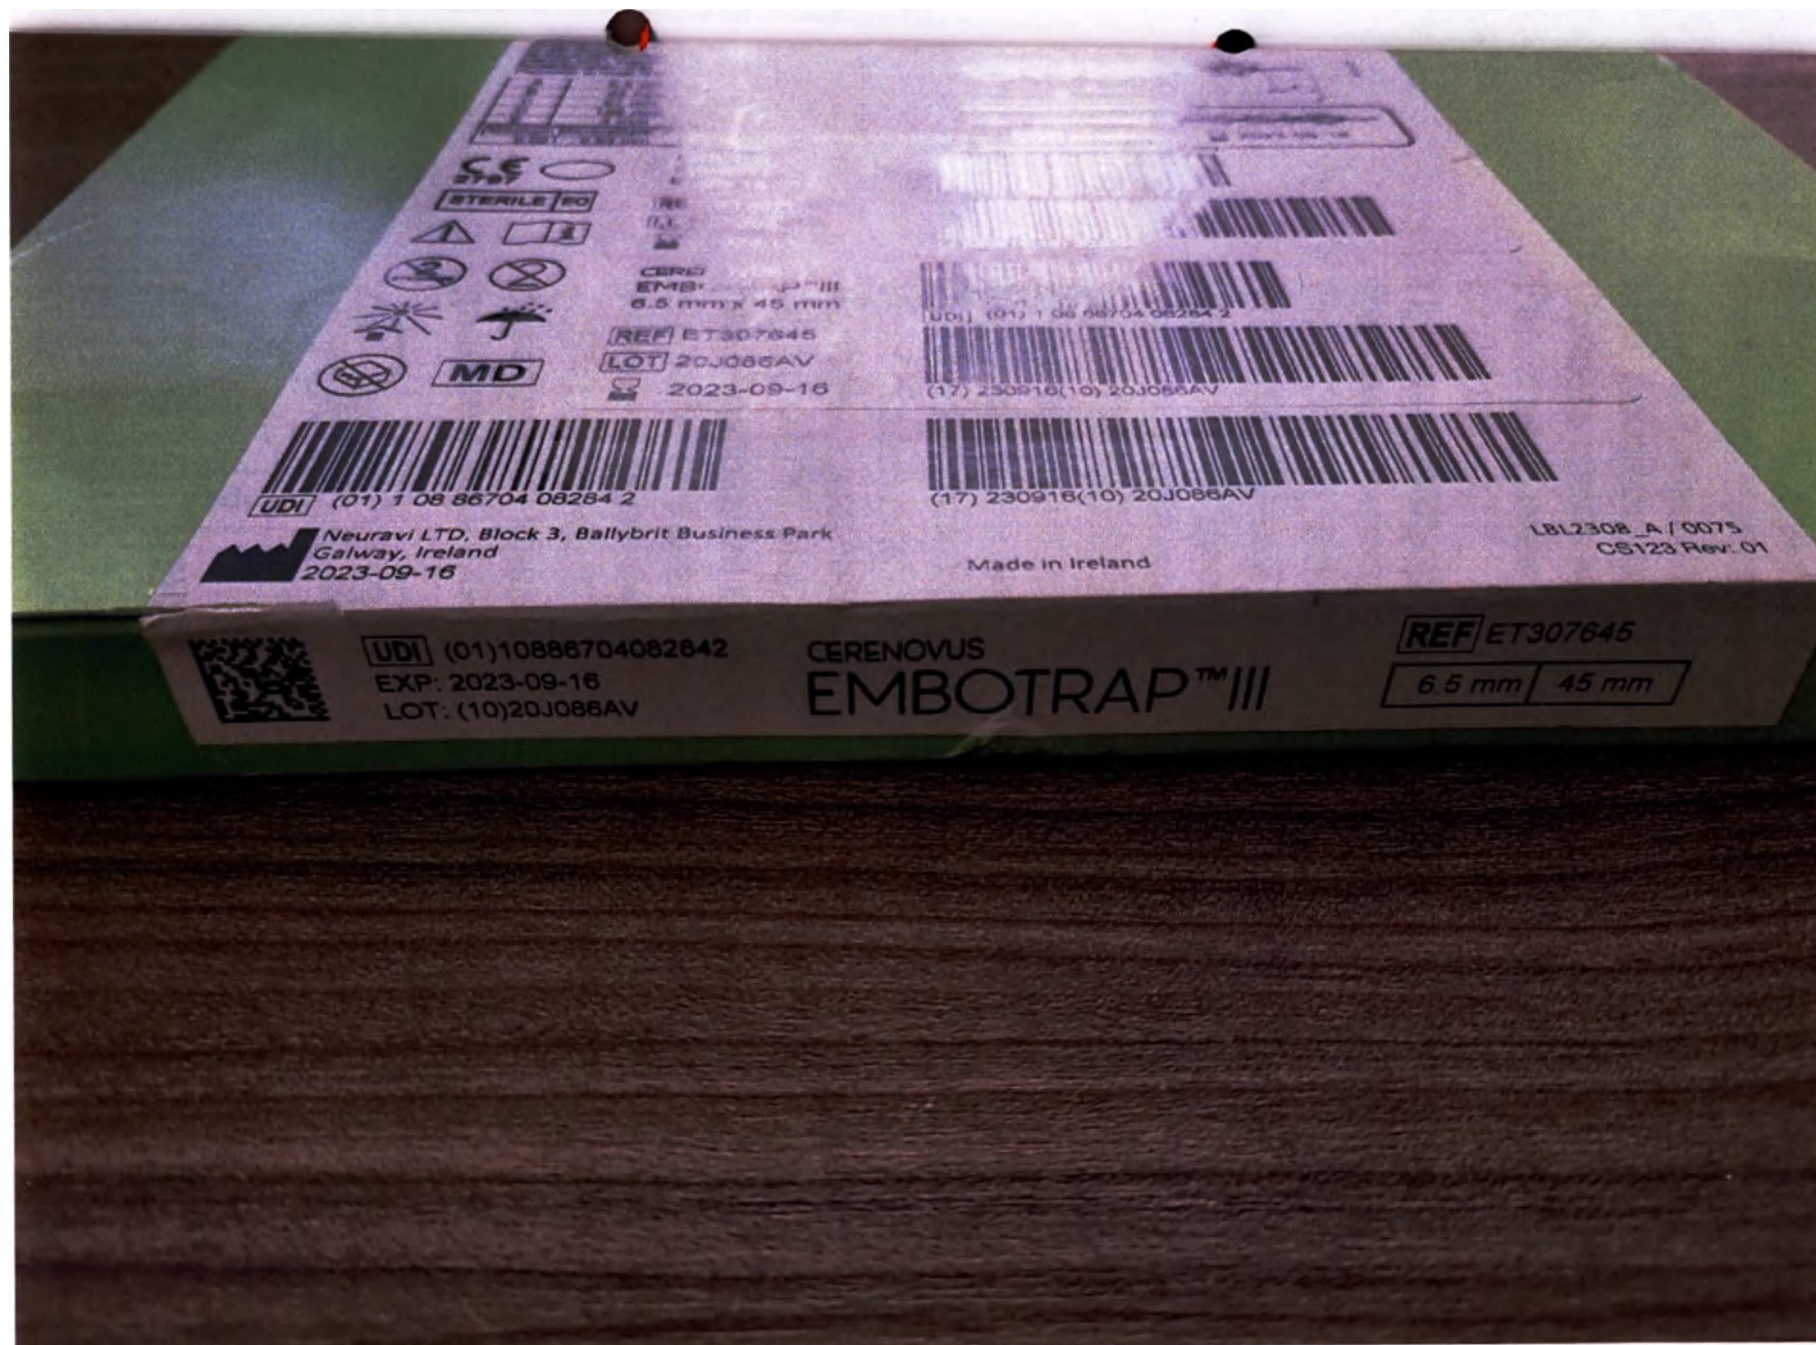


Рис. 12. Пример маркировки на потребительской упаковке (картонной коробке). Устройство для внутрисосудистой тромбэктомии EmboTrap III (ET-307-

**REF** ET-007-533

Устройство для внутрисосудистой тромбэктомии  
EmboTrap: Устройство для внутрисосудистой  
тромбэктомии EmboTrap II (диаметр устройства  
5мм, рабочая длина 33мм)

Область применения: Нейрохирургия

Регистрационное удостоверение: РЗН 2019/8578  
от ДД.ММ.ГГГГ

Производитель (Изготовитель): Neuravi Limited  
(Ньюрави Лимитед), Block 3, Ballybrit Business  
Park, Galway, Ireland, Ирландия

Уполномоченный представитель производителя,  
адрес: ООО "Джонсон & Джонсон", 121614,  
Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2,  
тел: +7(495)5807777

Количество: см. на упаковке

Код партии: см. на упаковке

Дата изготовления: см. на упаковке

Использовать до: см. на упаковке

Условия транспортировки: температура воздуха от  
-35 до +40°C, влажность воздуха (относительная),  
без образования конденсата 30 - 95%,  
атмосферное давление 700-1060 гПа

Условия хранения: температура воздуха от +10 до  
+35°C, влажность воздуха (относительная), без  
образования конденсата <75%, атмосферное  
давление 860-1060 гПа



ET-007-533@002

с. 13. Пример русскоязычной маркировки. Устройство для внутрисосудистой тромбэктомии EmboTrap II  
(ET-007-533)

**REF** ET-307-522

Устройство для внутрисосудистой тромбэктомии  
EmboTrap: Устройство для внутрисосудистой  
тромбэктомии EmboTrap III (диаметр устройства 5  
мм, рабочая длина 22 мм)

Область применения: Нейрохирургия

Регистрационное удостоверение: РЗН 2019/8578  
от ДД.ММ.ГГГГ

Производитель (Изготовитель): Neuravi Limited  
(Ньюрави Лимитед), Block 3, Ballybrit Business  
Park, Galway, Ireland, Ирландия

Уполномоченный представитель производителя,  
адрес: ООО "Джонсон & Джонсон", 121614,  
Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2,  
тел: +7(495)5807777

Количество: см. на упаковке

Код партии: см. на упаковке

Дата изготовления: см. на упаковке

Использовать до: см. на упаковке

Условия транспортировки: температура воздуха от  
-35 до +40°C, влажность воздуха (относительная),  
без образования конденсата 30 - 95%,  
атмосферное давление 700-1060 гПа

Условия хранения: температура воздуха от +10 до  
+35°C, влажность воздуха (относительная), без  
образования конденсата <75%, атмосферное  
давление 860-1060 гПа



ET-307-522@001

ис. 14. Пример русскоязычной маркировки. Устройство для внутрисосудистой тромбэктомии EmboTrap  
III (ET-307-522)

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

15 ( Пятнадцать )

листов

Менеджер по регистрации

Р.Б. Финкель

