Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Юникорнмед"

_____ / Осипов Д.Ю.

М.П.
26.11.2021

Фотографии общего вида на медицинское изделие:

Набор изделий для оториноларингологических осмотров, одноразовый, стерильный, варианты исполнения: набор №1 и набор №2.

Производства компании:
JIANGSU YADA TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD (ЦЗЯНСУ ЯДА ТЕХНОЛОДЖИ ГРУП КО., ЛТД),

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

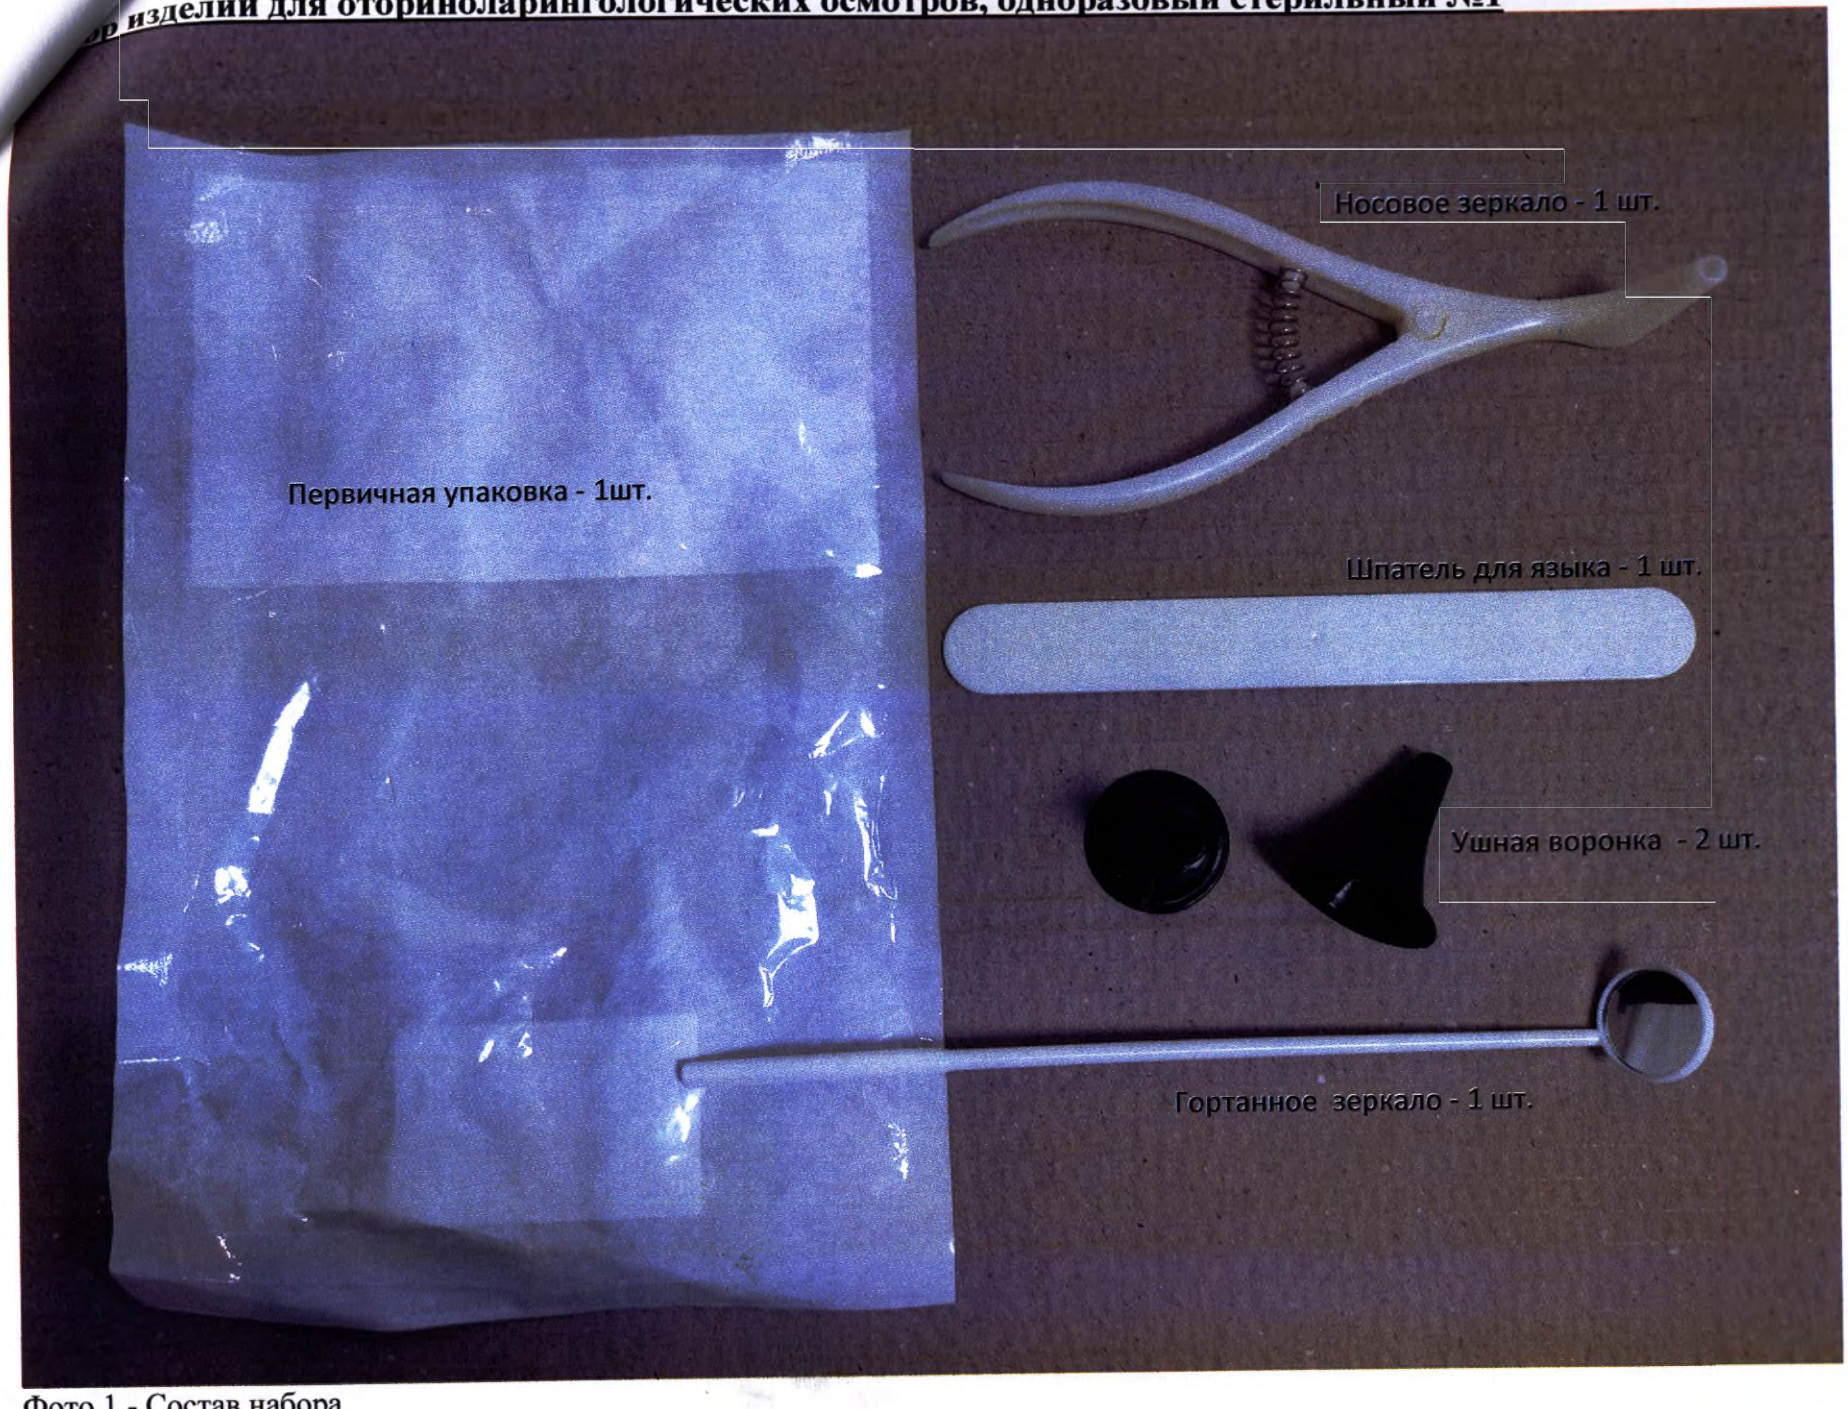

Фото 1 - Состав набора

изделий для оториноларингологических осмотров, одноразовый стерильный №1, в составе (фото 2-6):

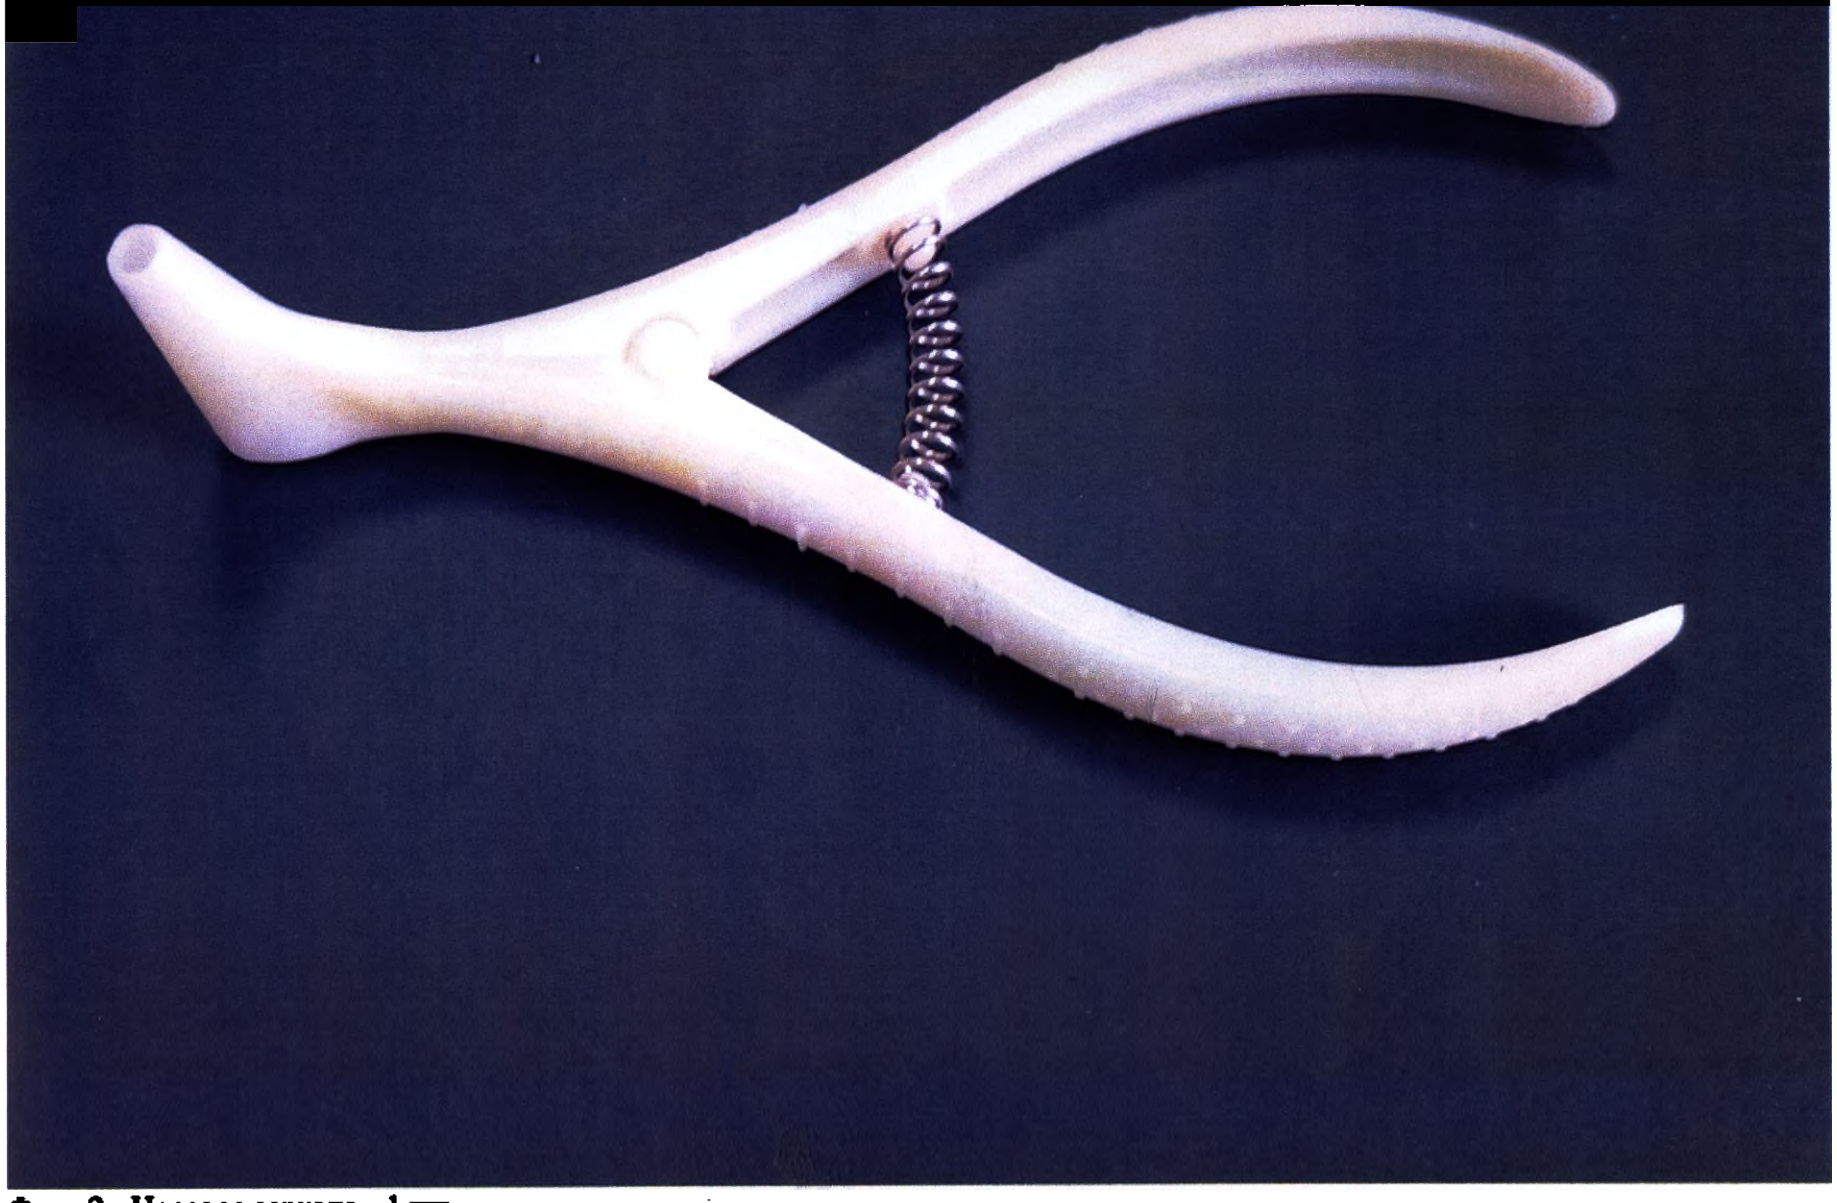

Фото 2 - Носовое зеркало - 1 шт.

Шпатель для языка - 1 шт.

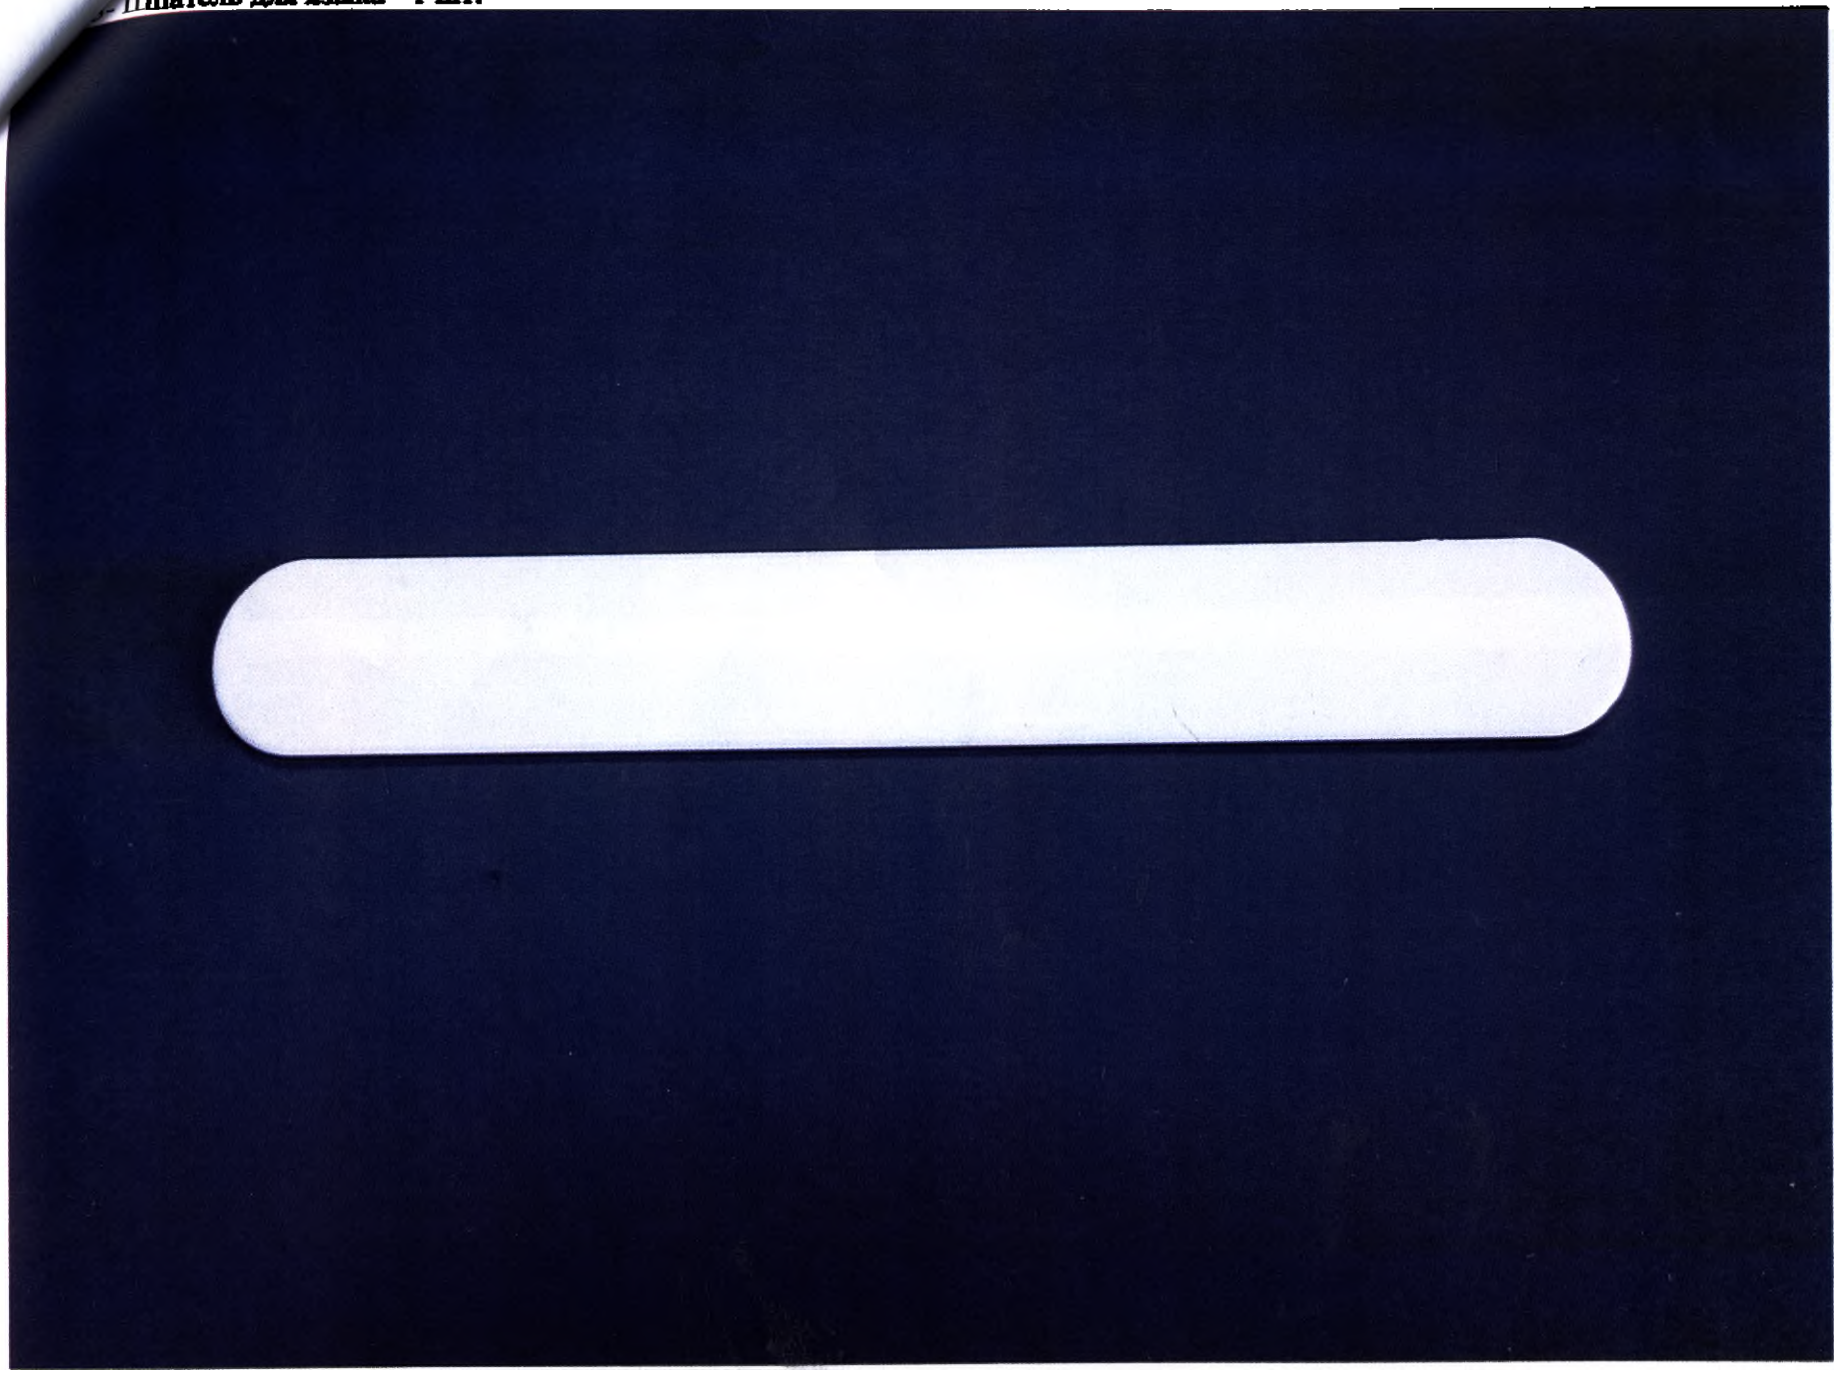

4- Гортанное зеркало - 1 шт.

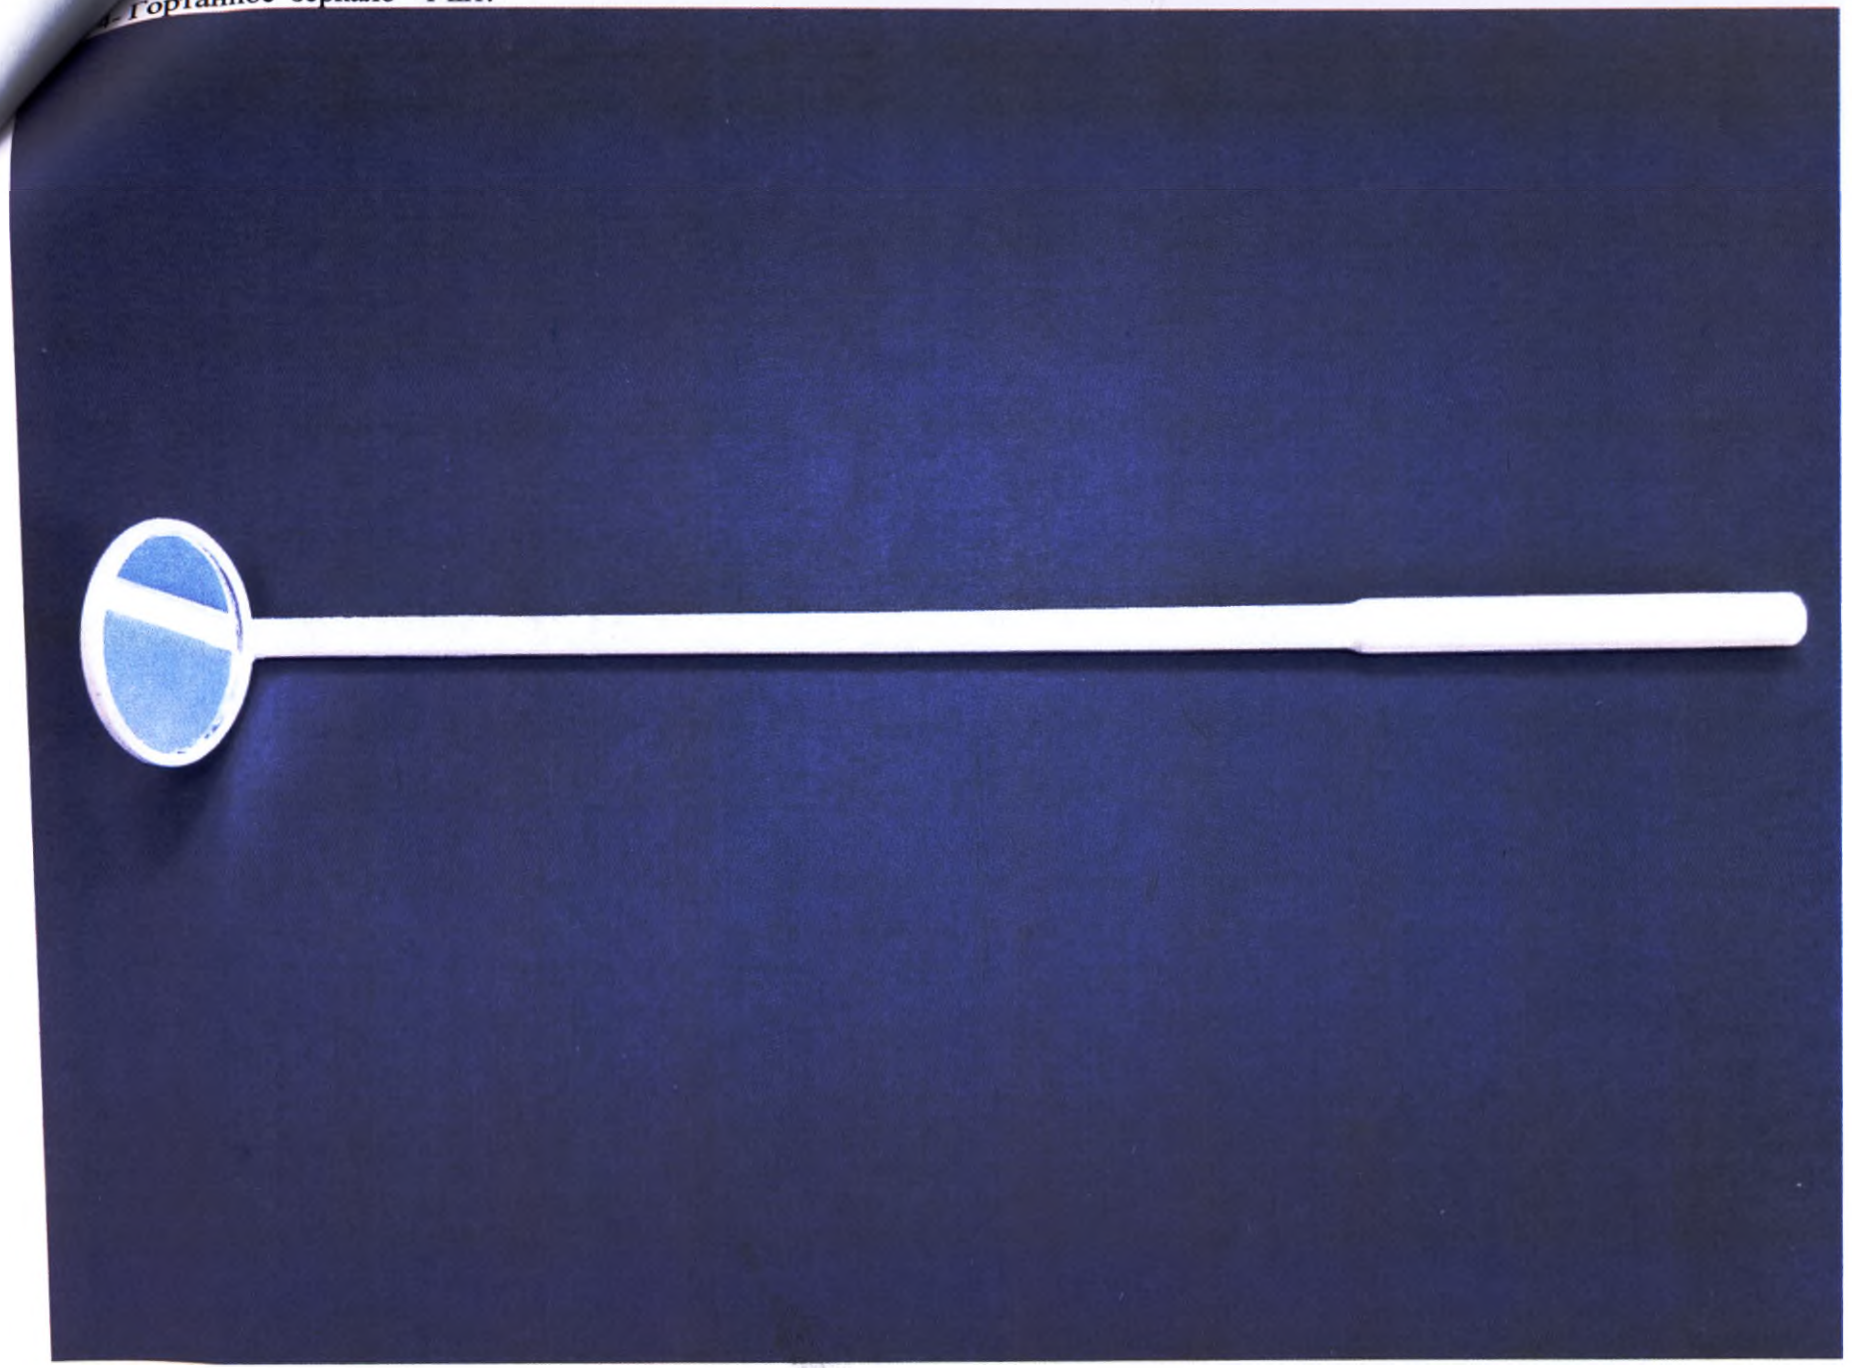

7. Ушная воронка - 2 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Внешний вид первичной упаковки и маркировка

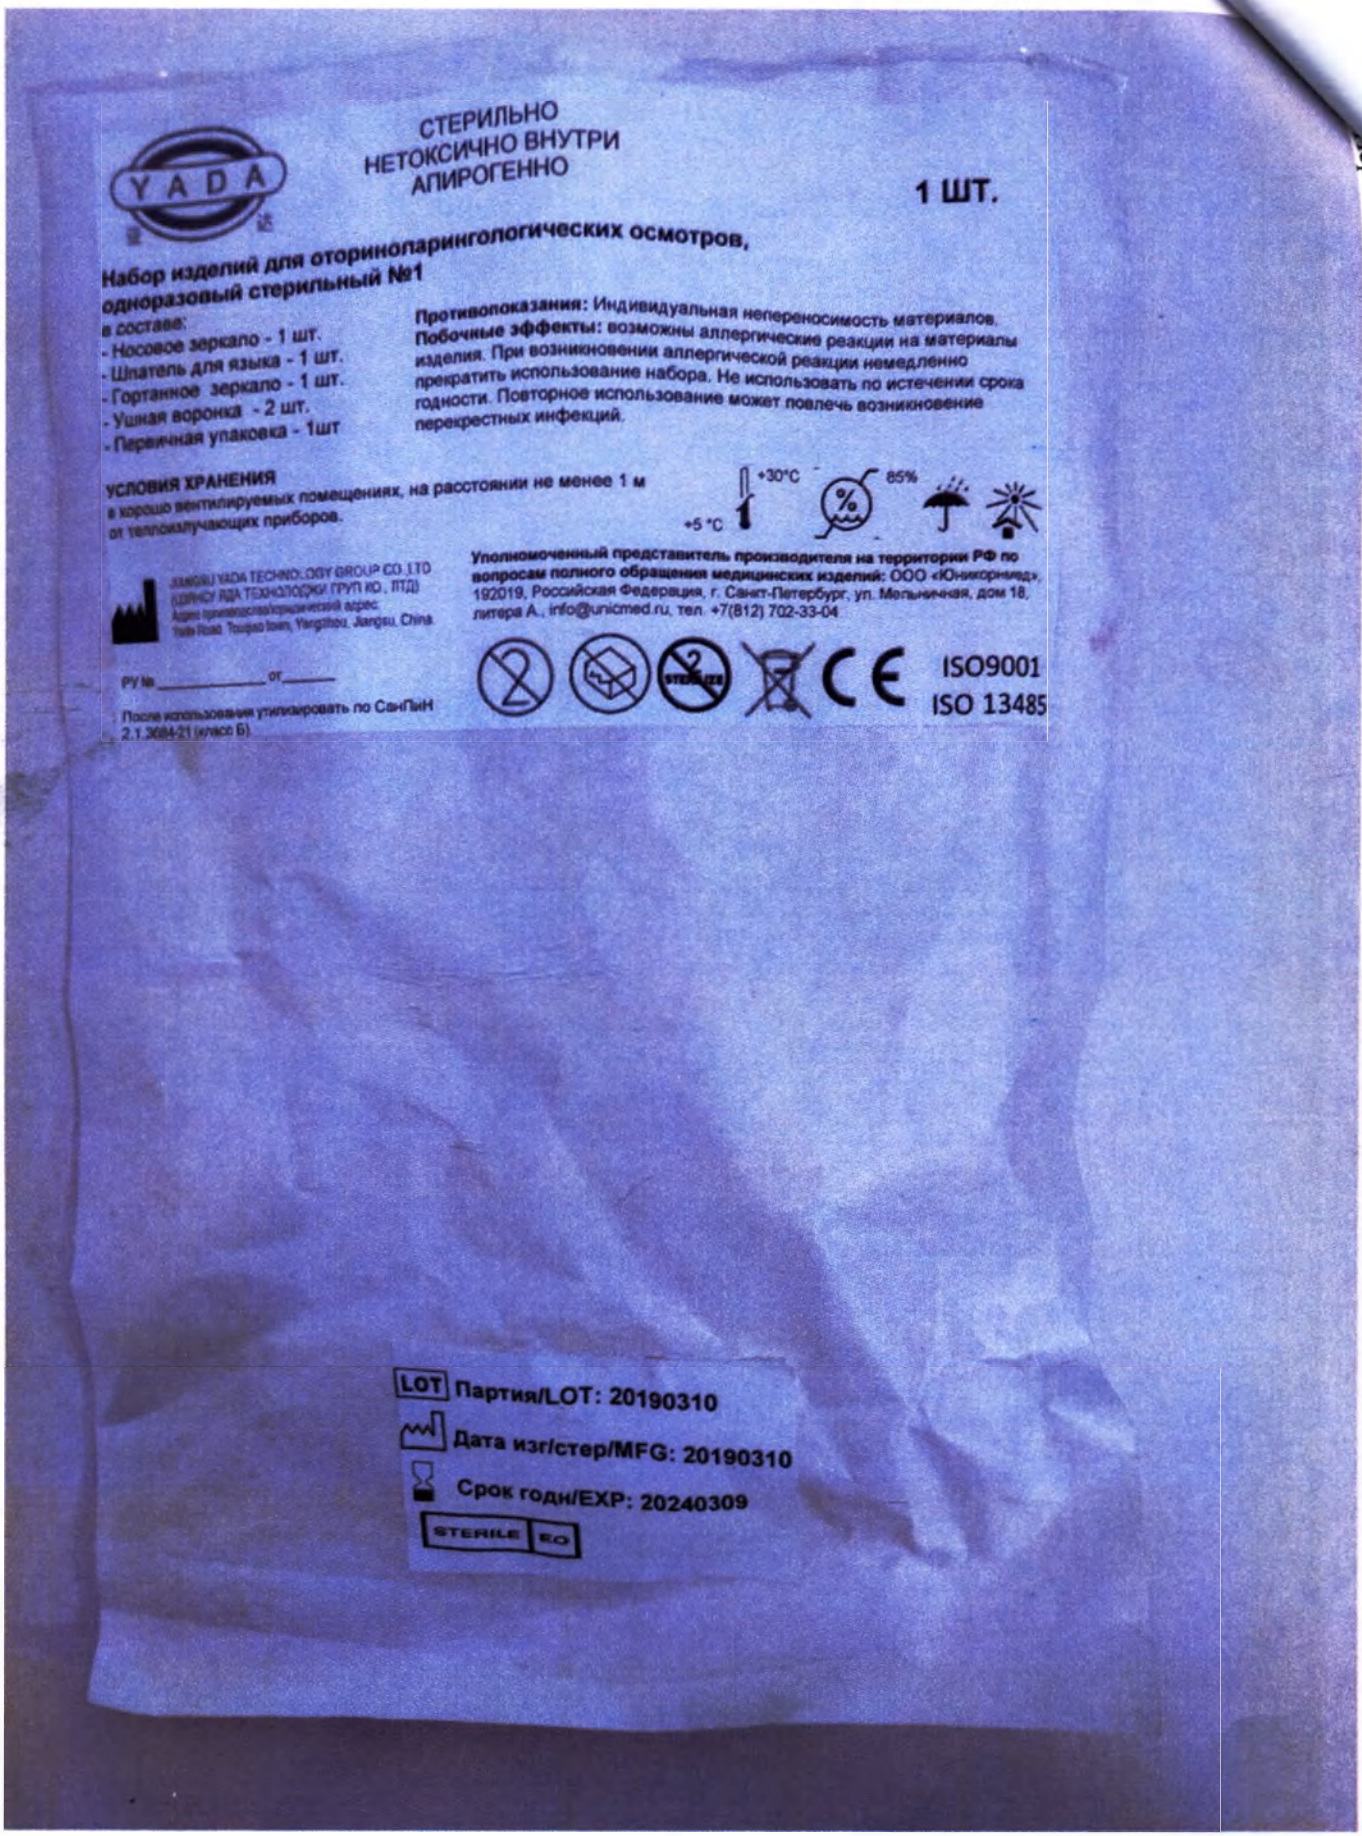

Первичная упаковка- 1 шт.

Внешний вид первичной упаковки Набора изделий для оториноларингологических осмотров, одноразовый стерильный №1
(лицевая сторона)

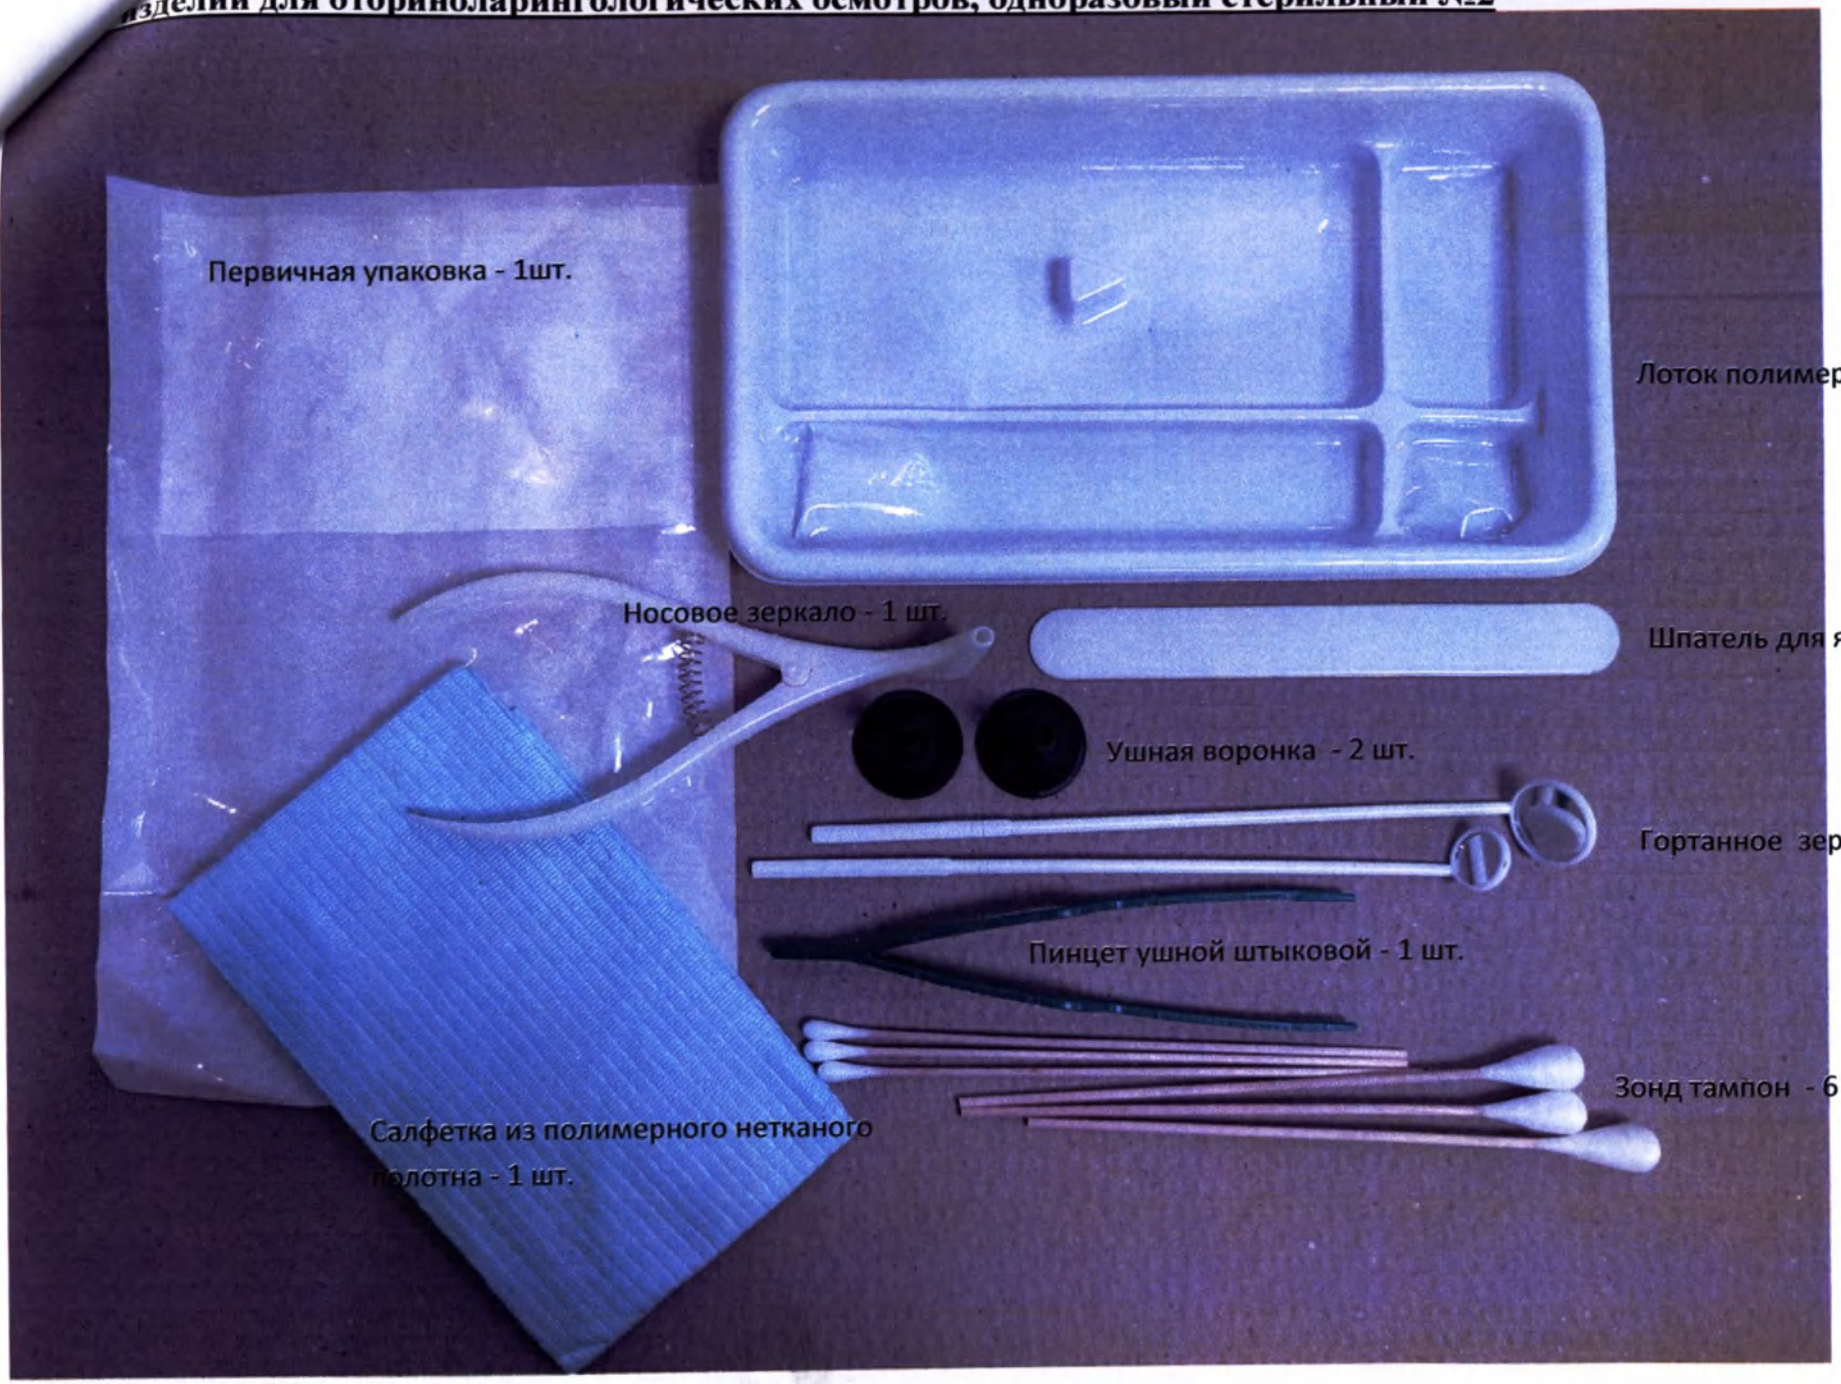

Фото 8- Состав набора

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

...ий для оториноларингологических осмотров, одноразовый стерильный №1, в составе (фото 9-17):

...совое зеркало - 1

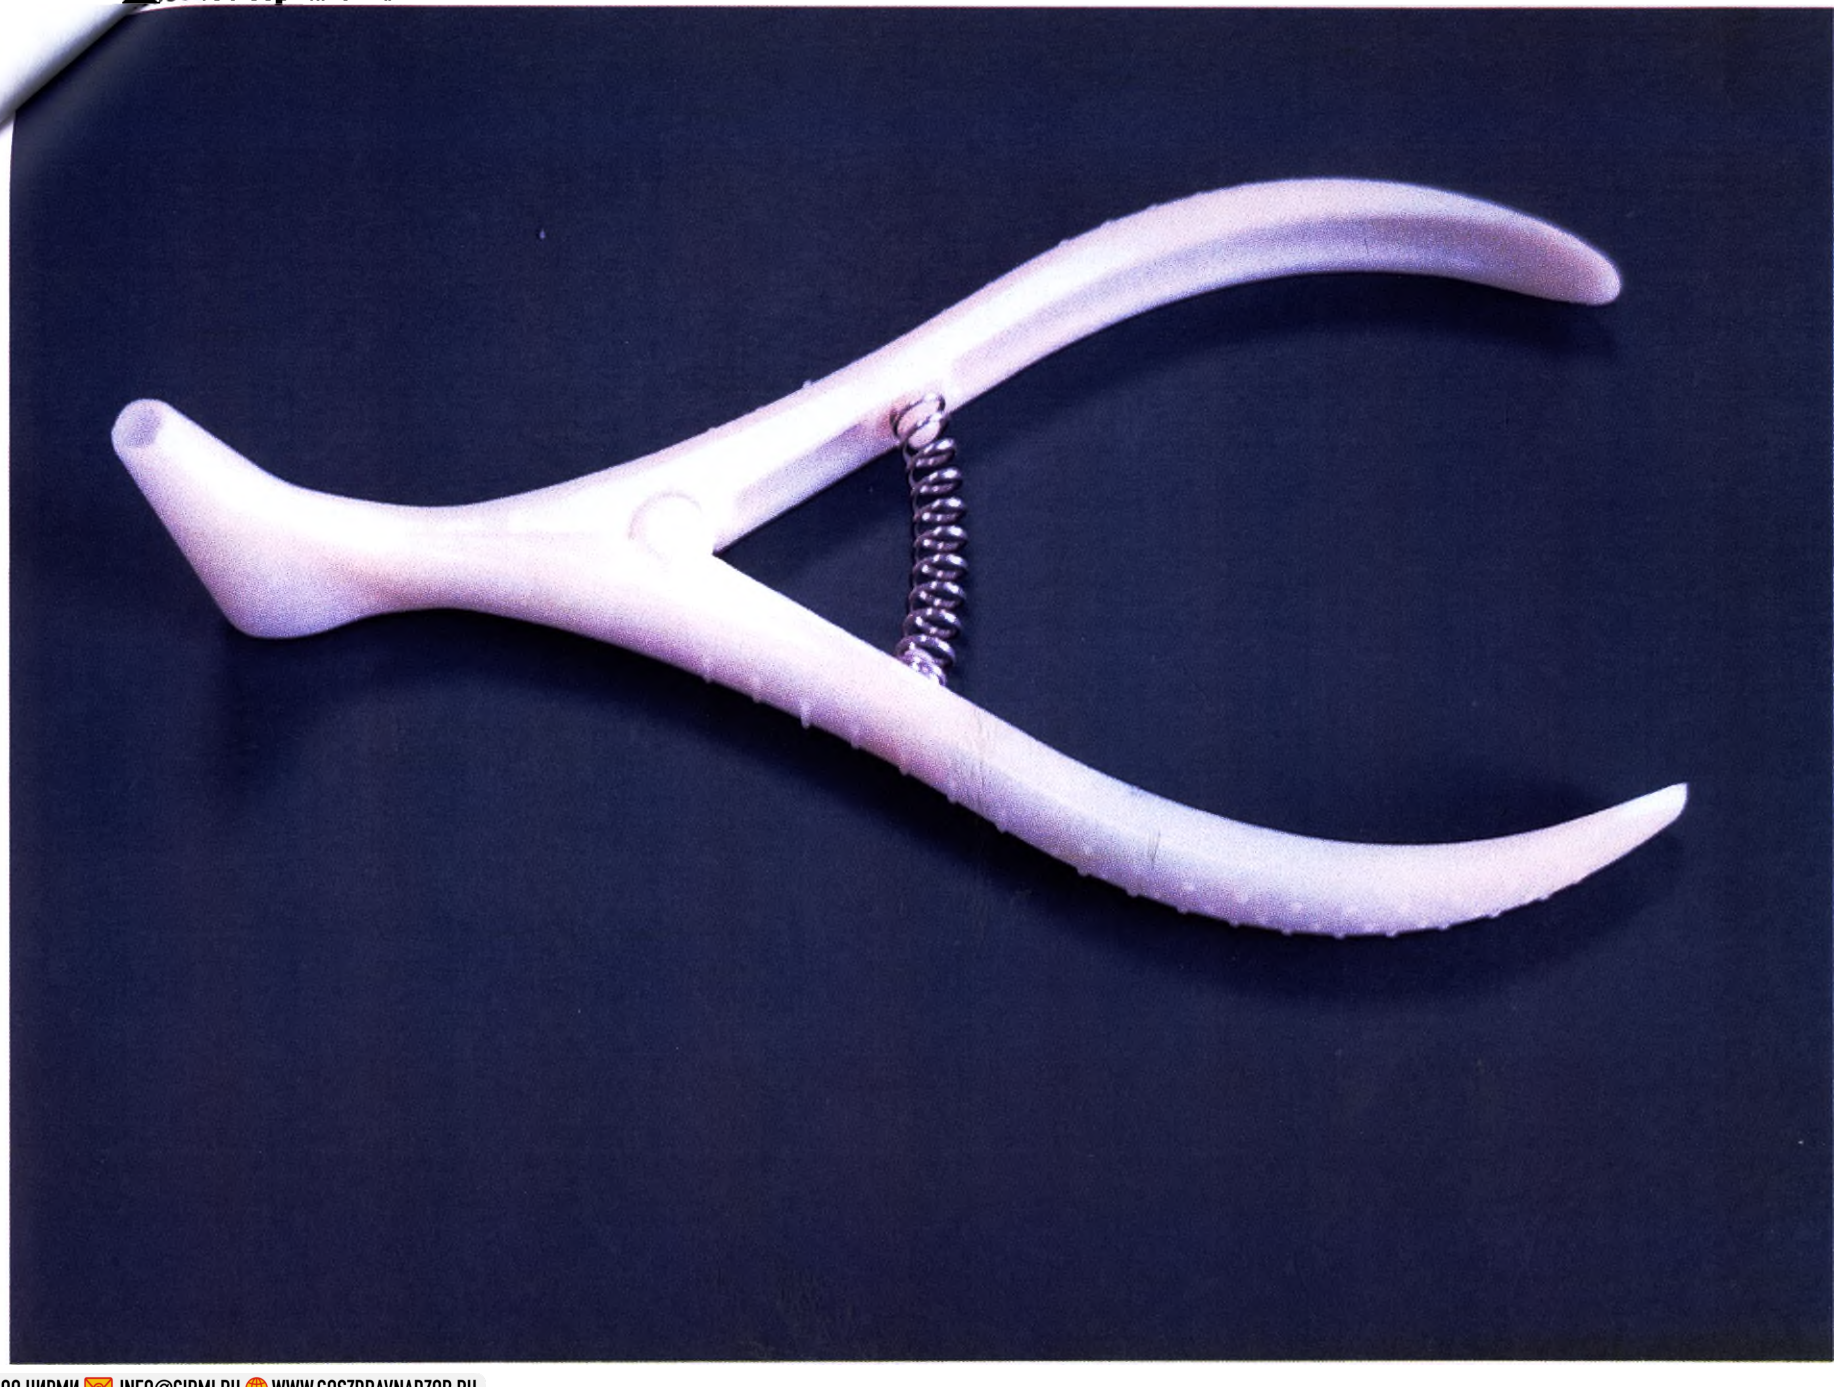

шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ётель для языка - 1 шт.

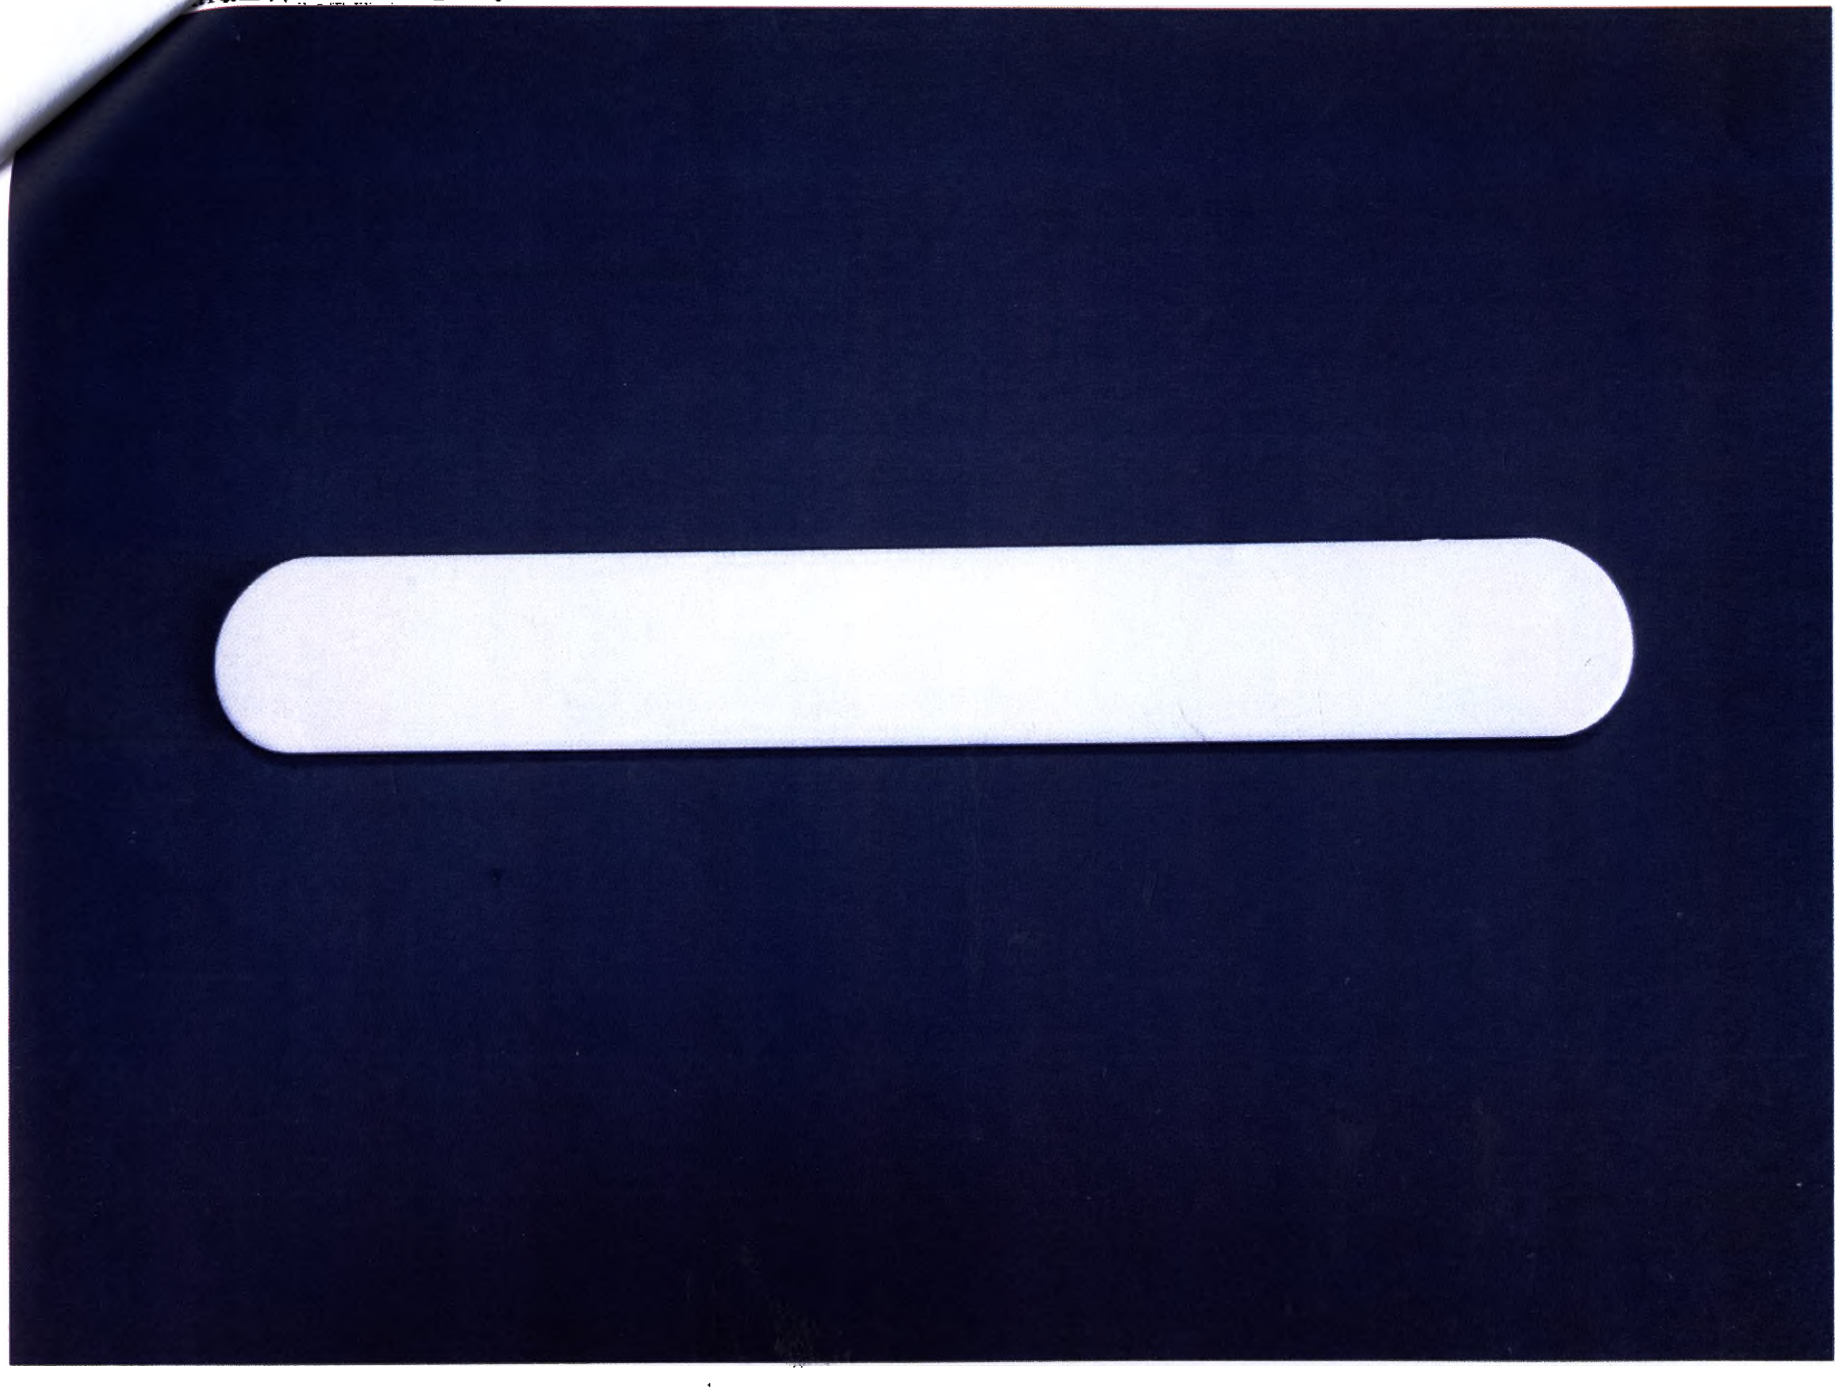

ртанное зеркало - 2 шт.

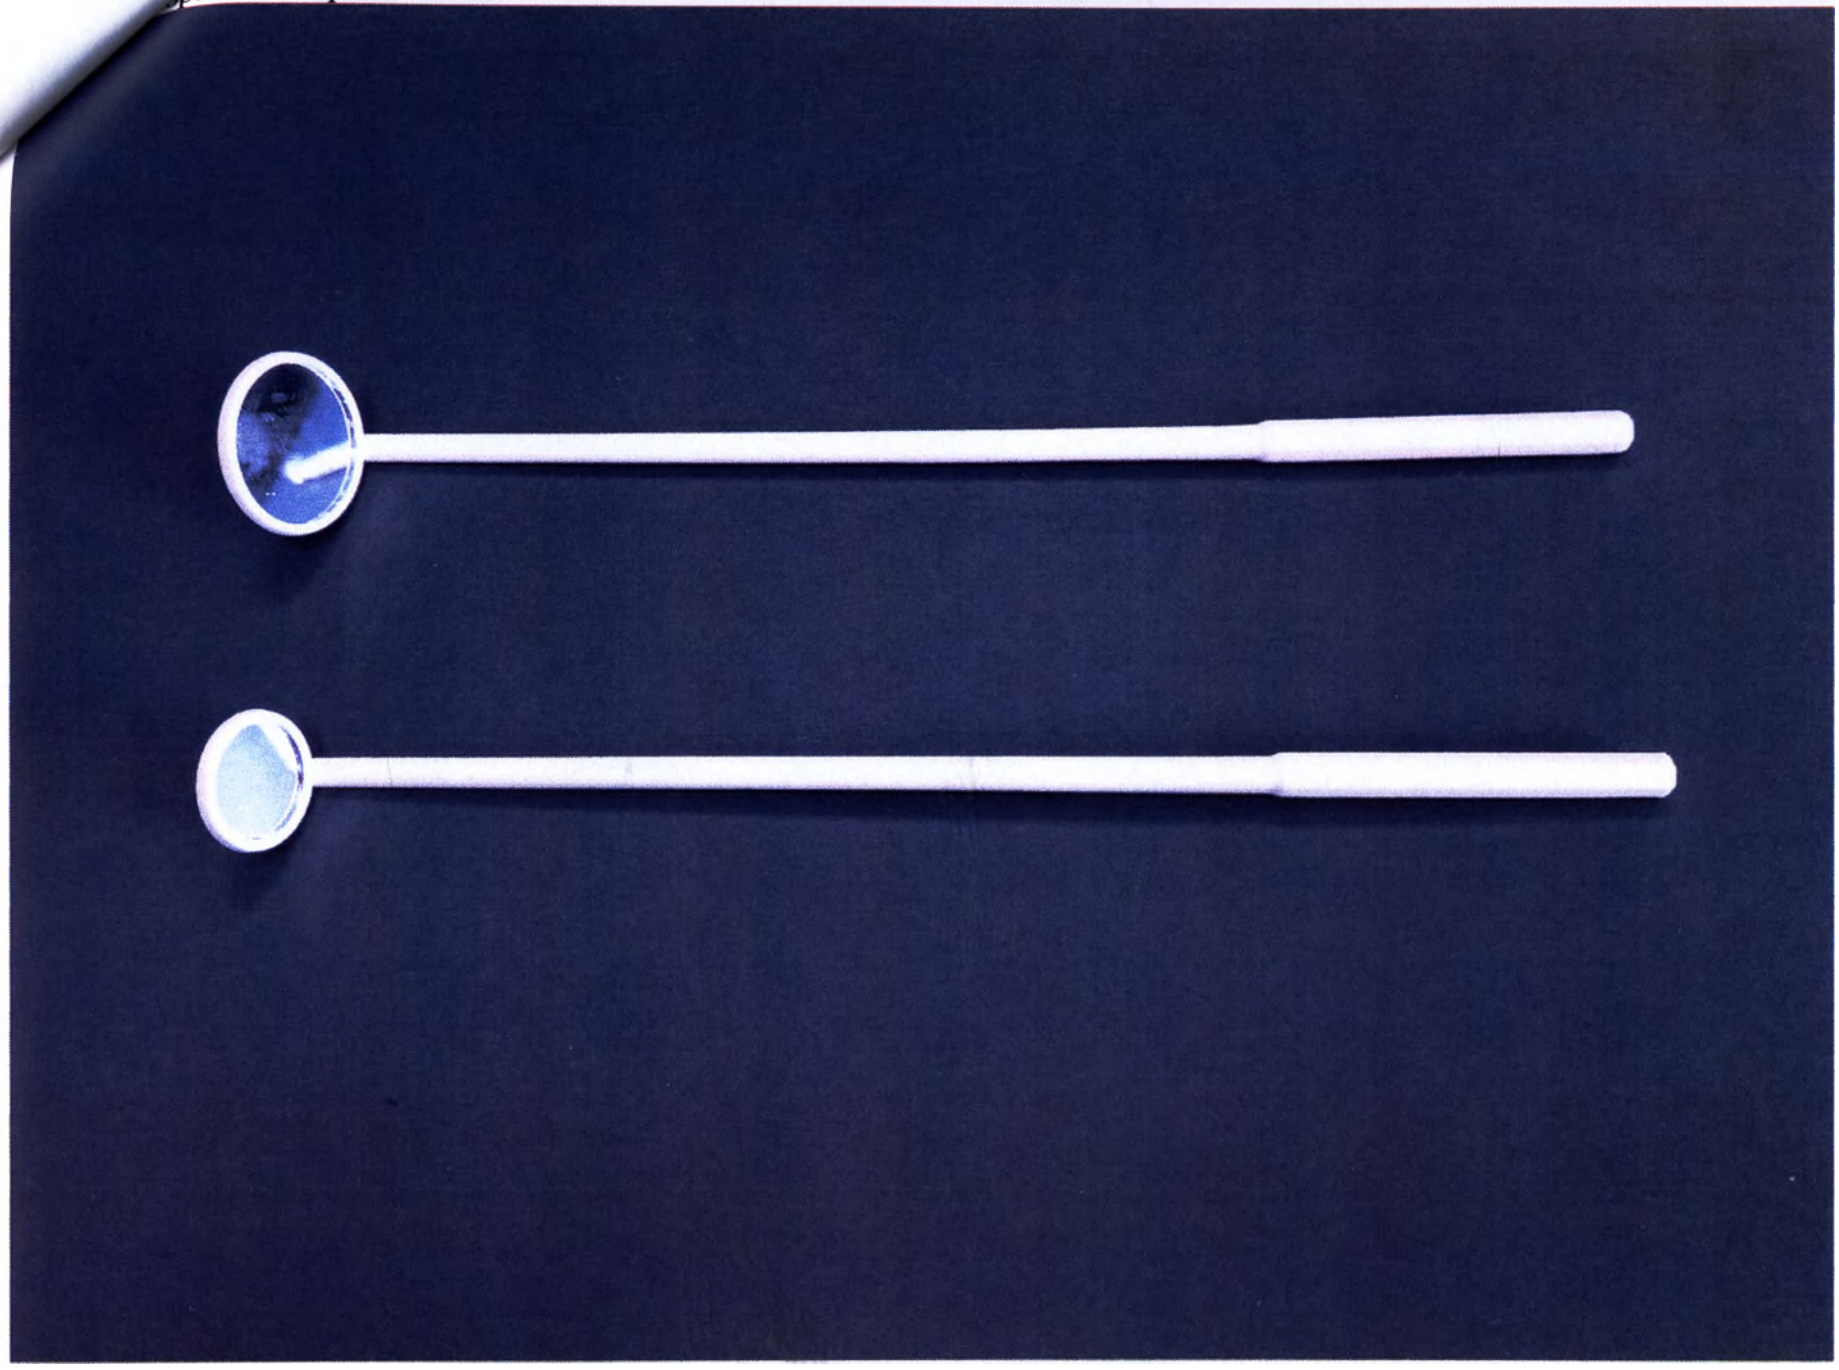

ная воронка - 2 шт.

ет ушной штыковой - 1 шт.

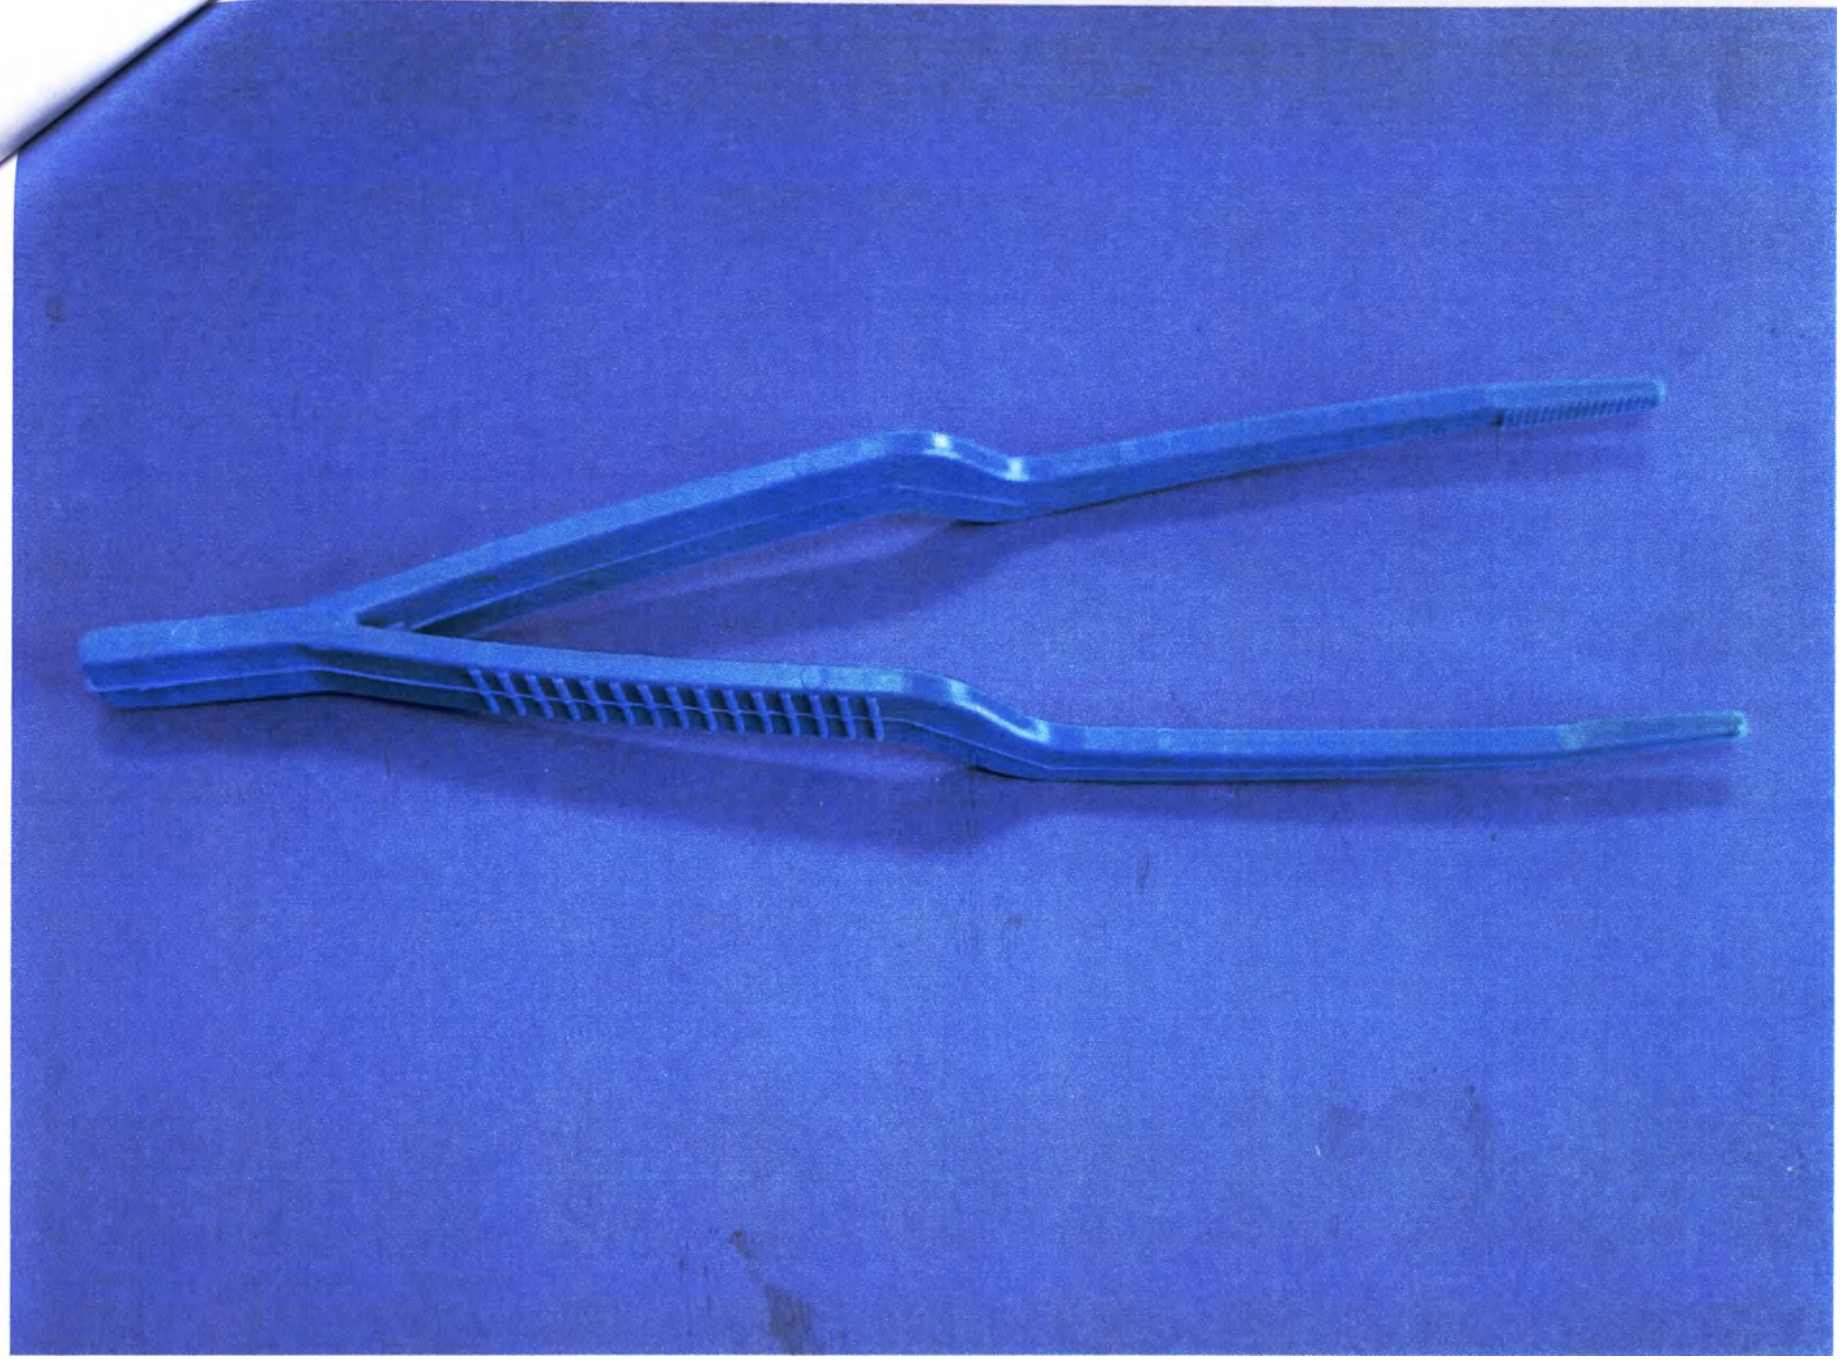

тампон - 6 шт.

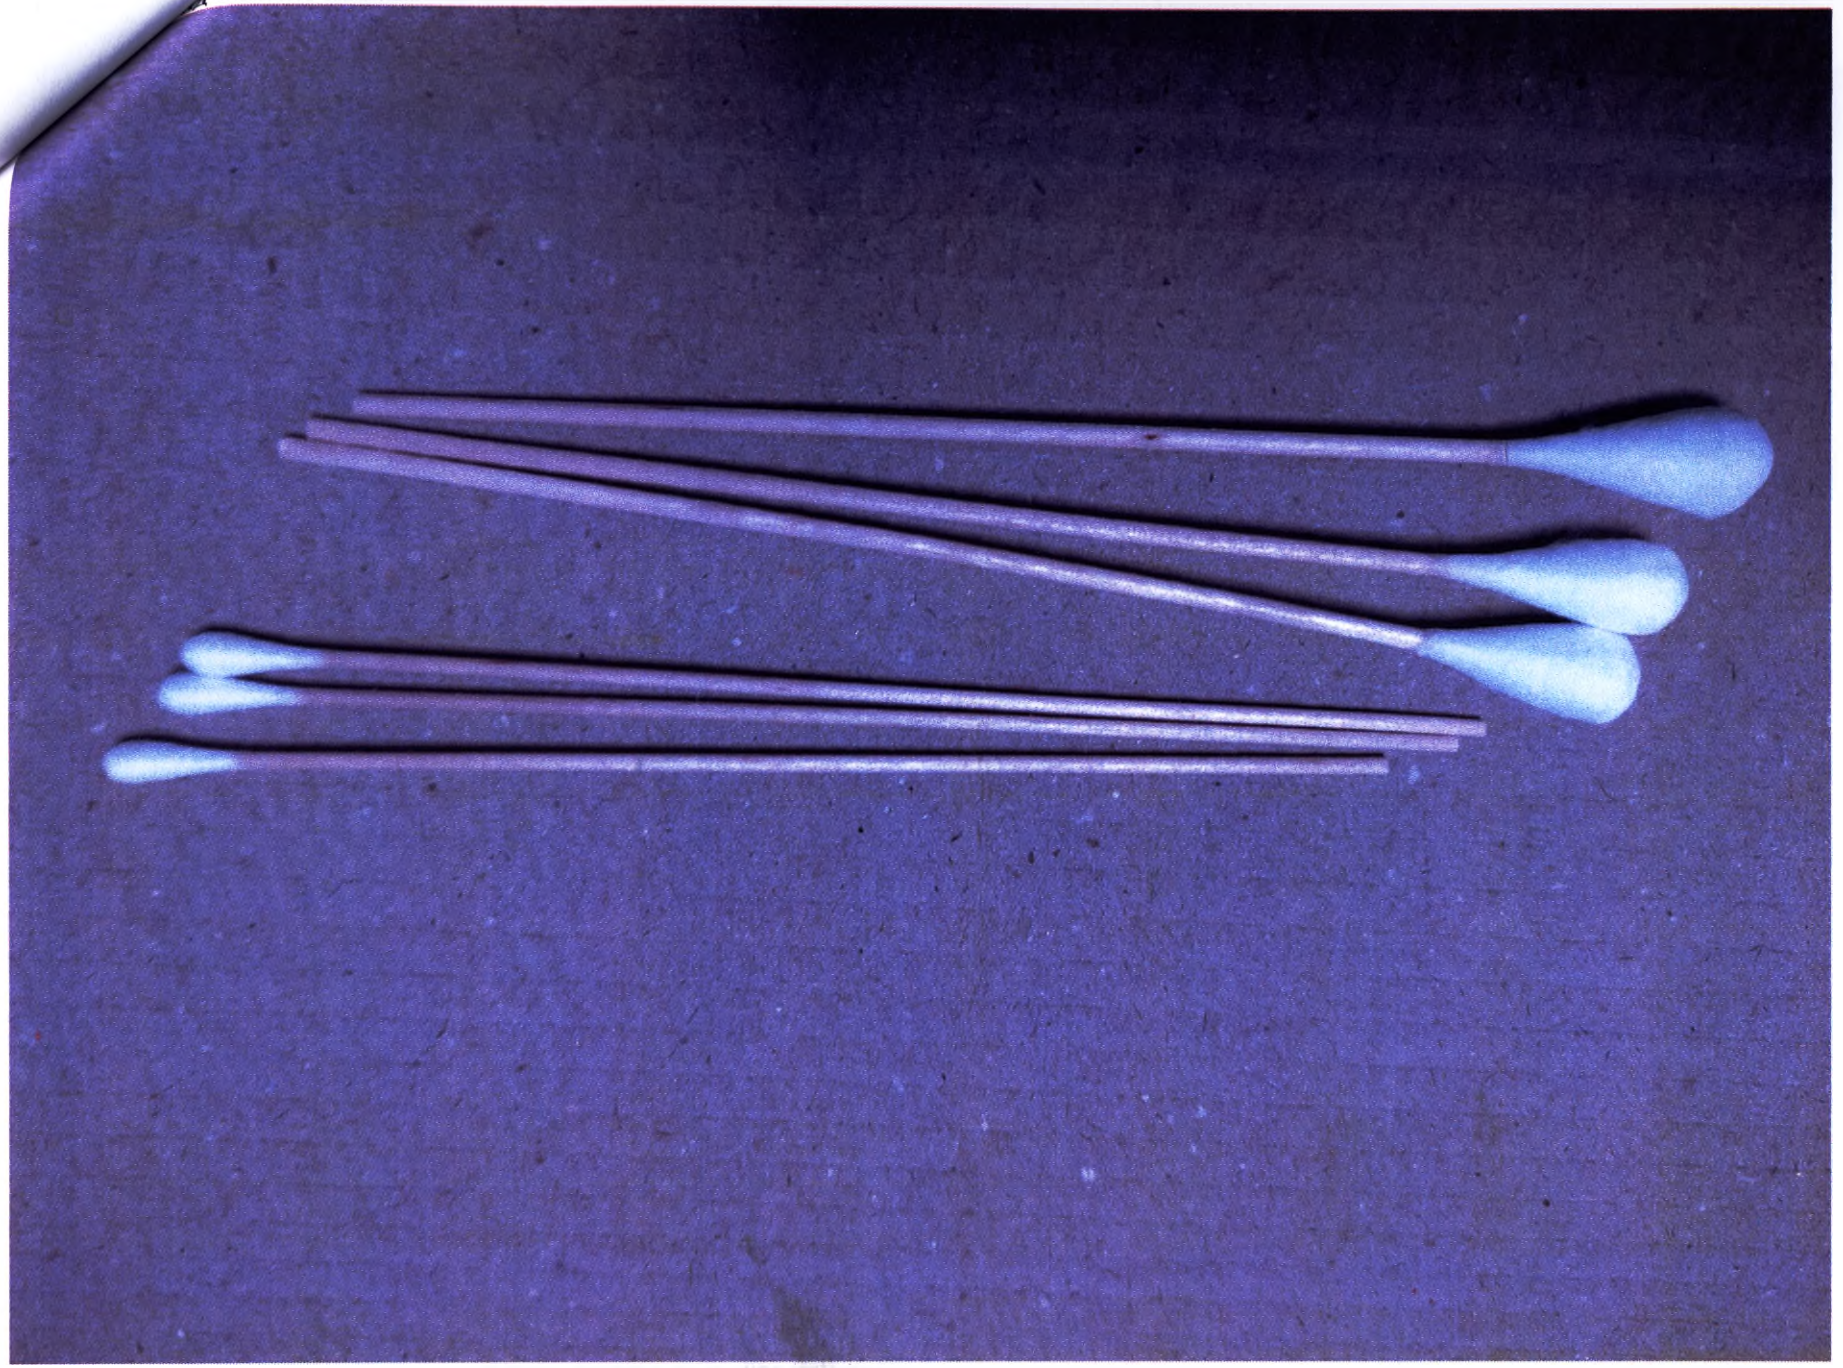

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

алфетка из полимерного нетканого полотна - 1 шт.

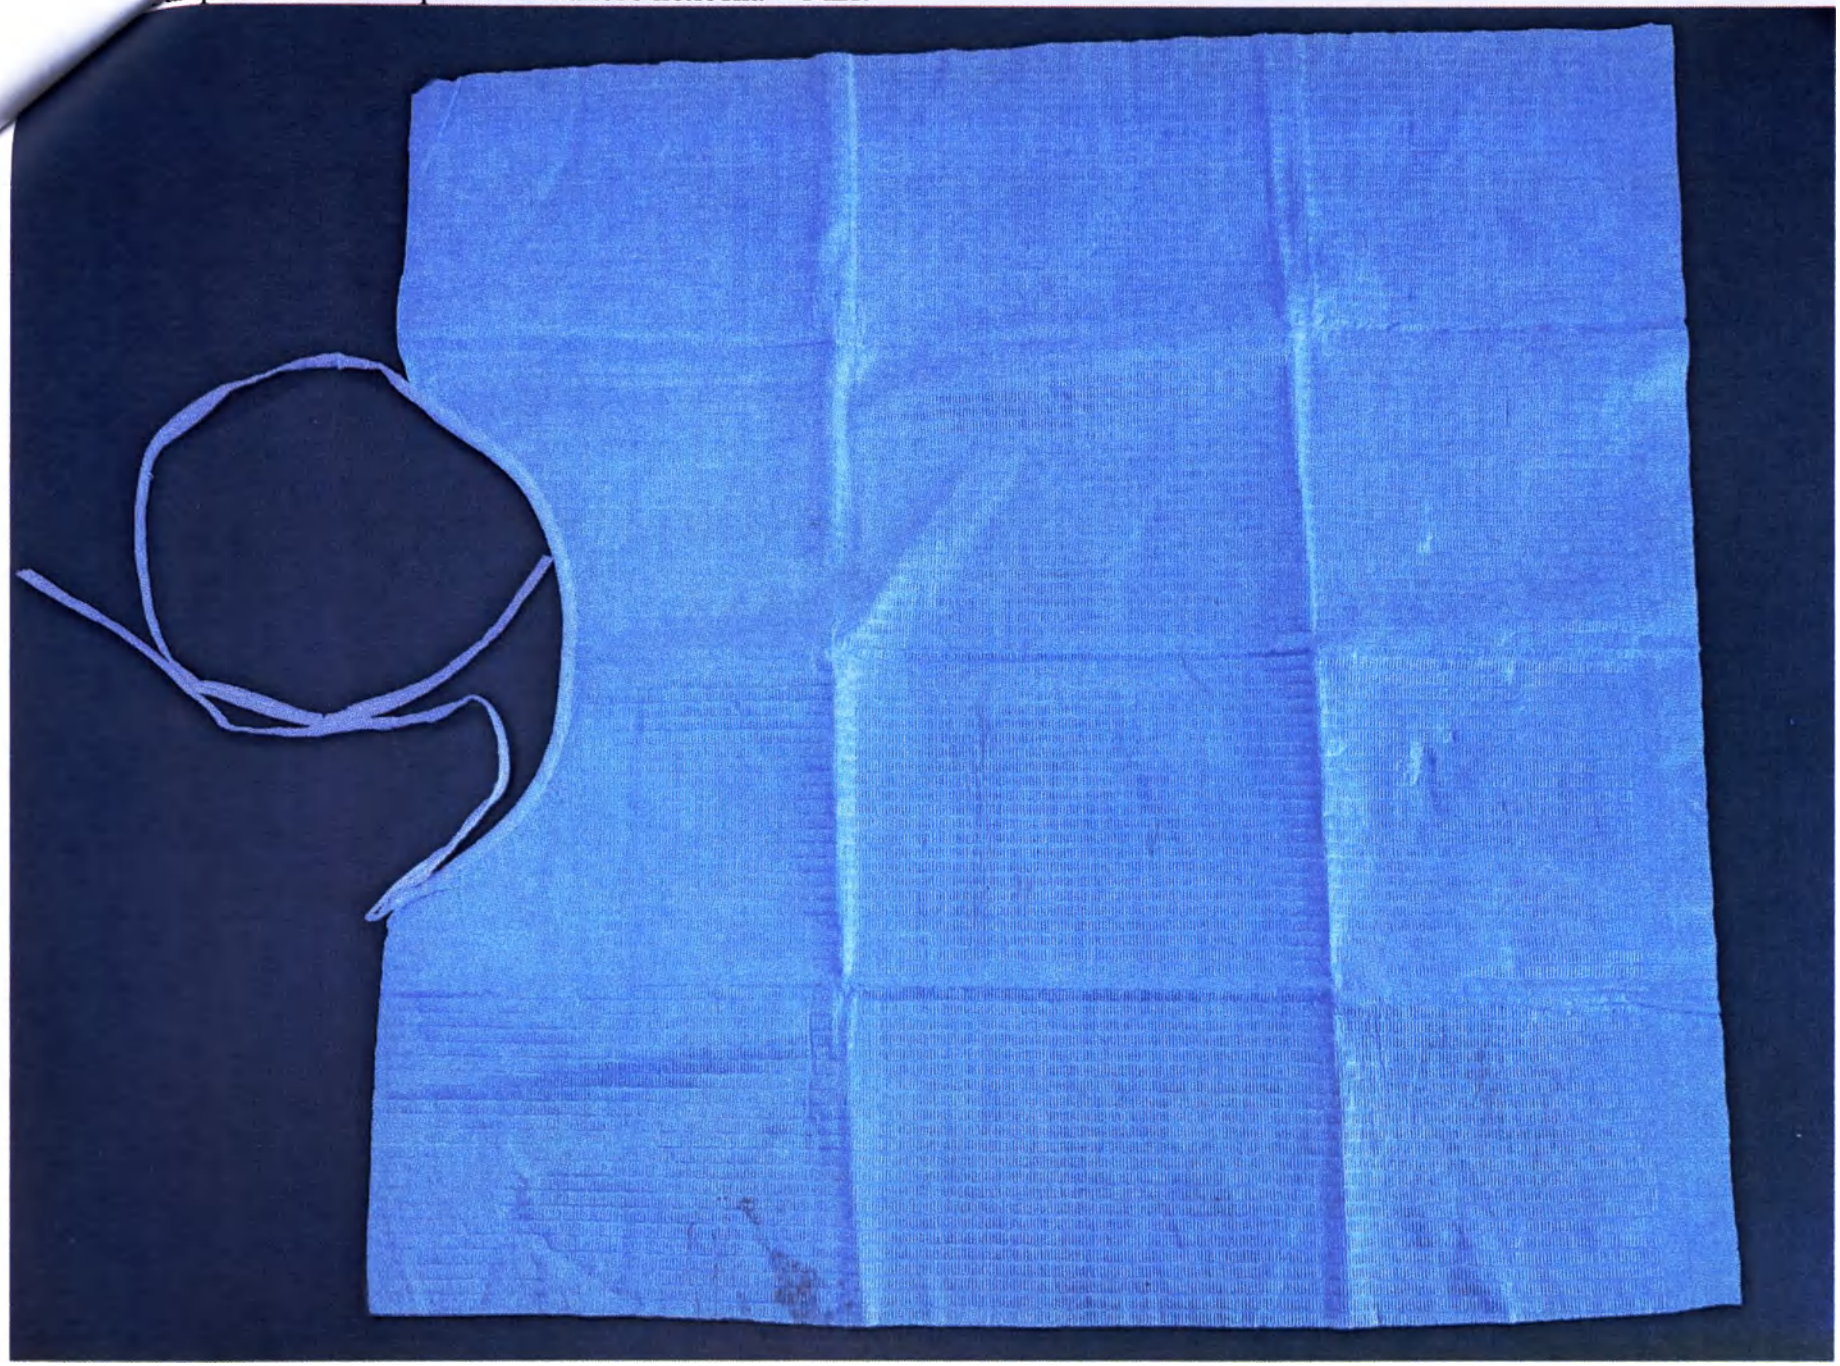

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ок полимерный - 1 шт.

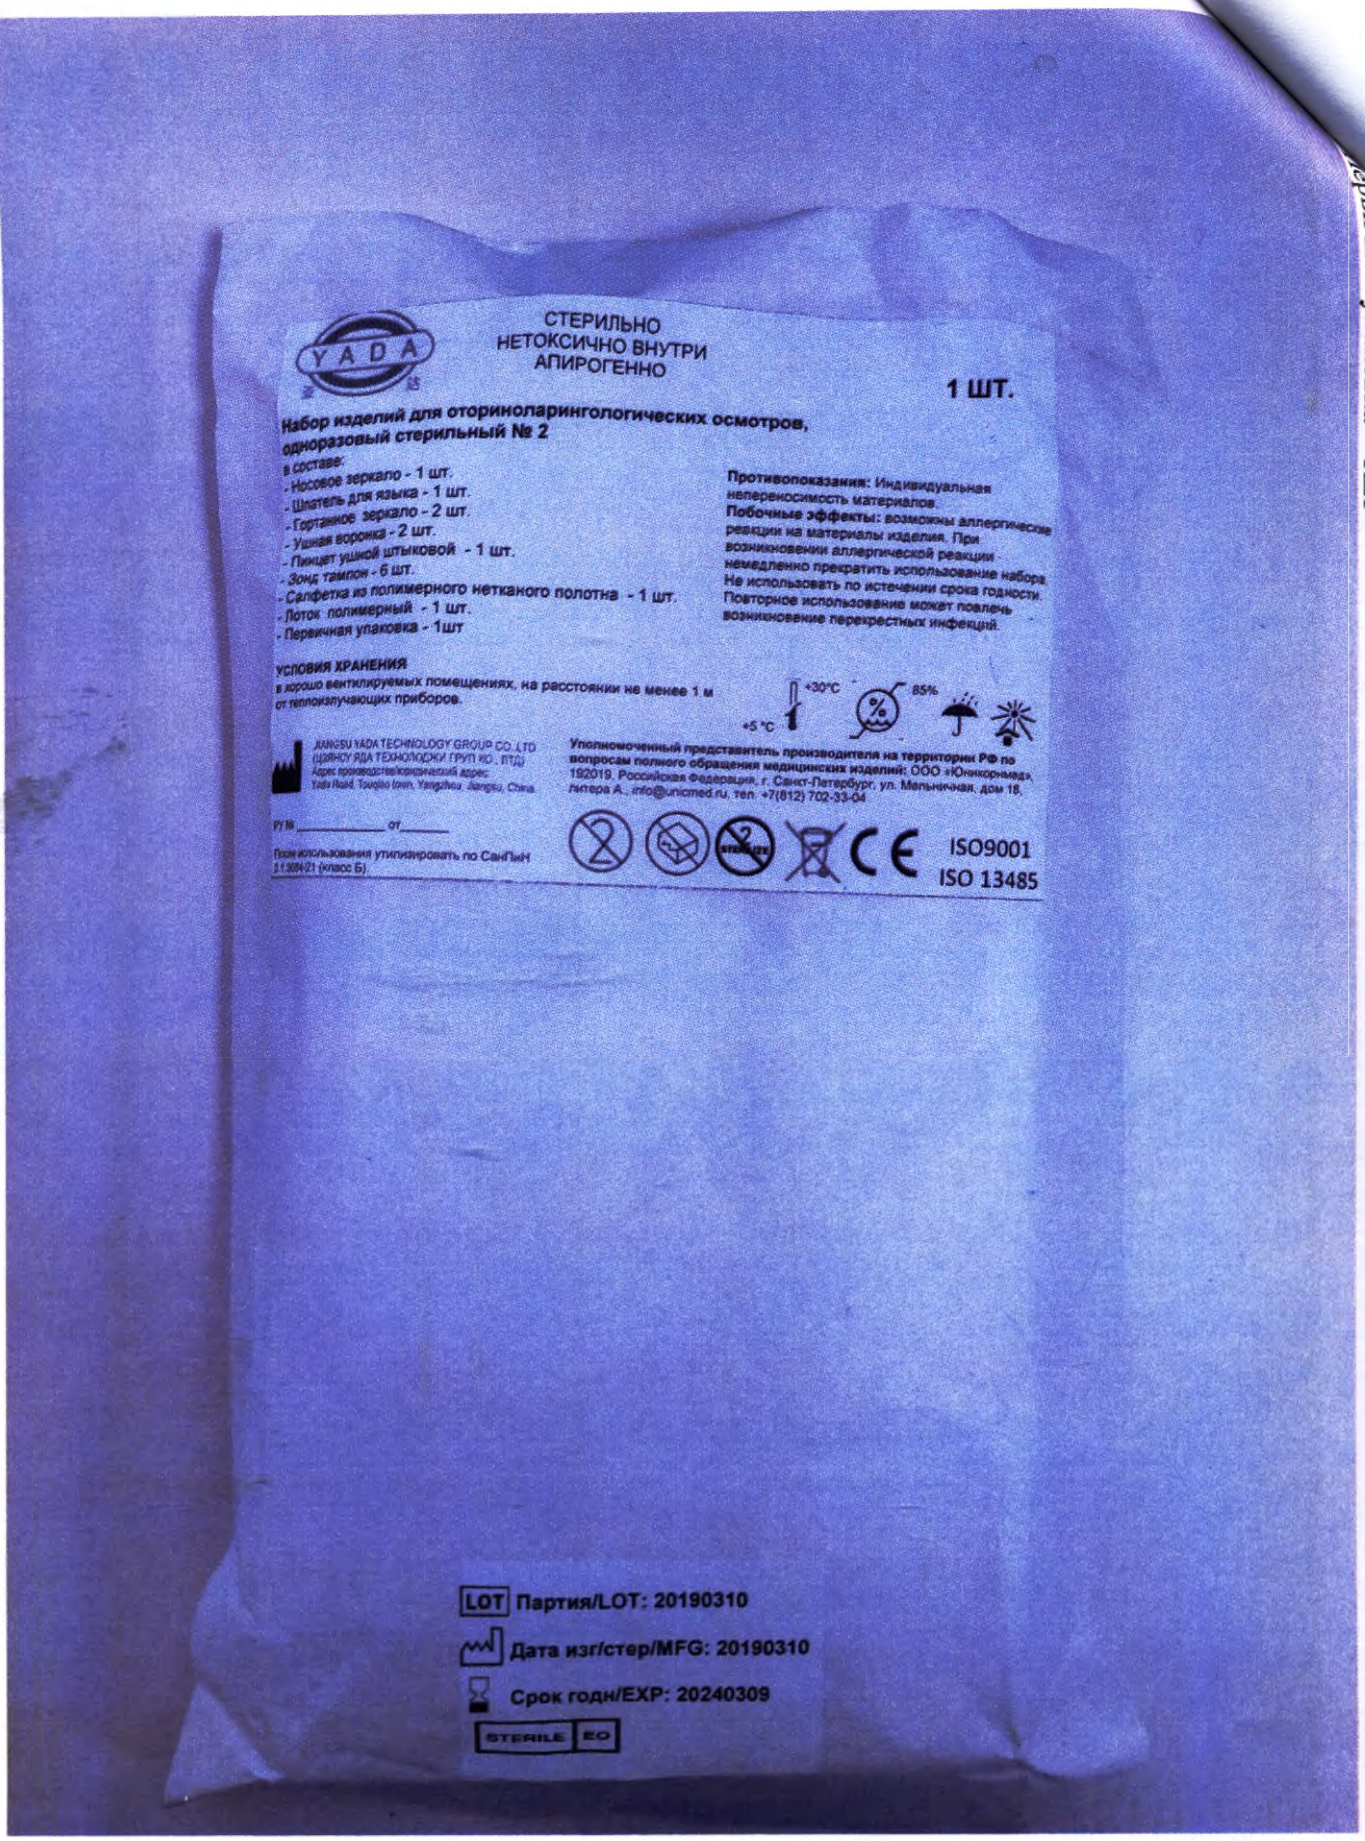
YADA
СТЕРИЛЬНО
НЕТОКСИЧНО ВНУТРИ
АПИРОГЕННО
1 ШТ.
Набор изделий для оториноларингологических осмотров, одноразовый стерильный № 2
в составе:
- Носовое зеркало - 1 шт.
- Шпатель для языка - 1 шт.
- Гортанное зеркало - 2 шт.
- Ушная воронка - 2 шт.
- Пинцет ушной штыковой - 1 шт.
- Зонд тампон - 6 шт.
- Салфетка из полимерного нетканого полотна - 1 шт.
- Лоток полимерный - 1 шт.
- Первичная упаковка - 1шт
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость материалов.
Побочные эффекты: возможны аллергические реакции на материалы изделия. При возникновении аллергической реакции немедленно прекратить использование набора.
Не использовать по истечении срока годности.
Повторное использование может повлечь возникновение перекрестных инфекций.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
в хорошо вентилируемых помещениях, на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.
+5 °C
+30°C
85%
JIANGSU YADA TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD
ЦЗЯНСУ ЯДА ТЕХНОЛОДЖИ ГРУП КО., ЛТД)
Адрес производства/юридический адрес:
Yada Road, Tsuqiao town, Yangzhou, Jiangsu, China
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ по вопросам полного обращения медицинских изделий: ООО «Юникорнмед»,
192019, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, дом 18,
литера А., info@unicmed.ru, тел. +7(812) 702-33-04
РУ № _____ от _____
После использования утилизировать по СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б)
ISO9001
ISO 13485
LOT Партия/LOT: 20190310
Дата изг/стер/MFG: 20190310
Срок годн/EXP: 20240309
STERILE EO

...ний вид первичной упаковки Набора изделий для оториноларингологических осмотров, одноразовый стерильный №2
...сторона)

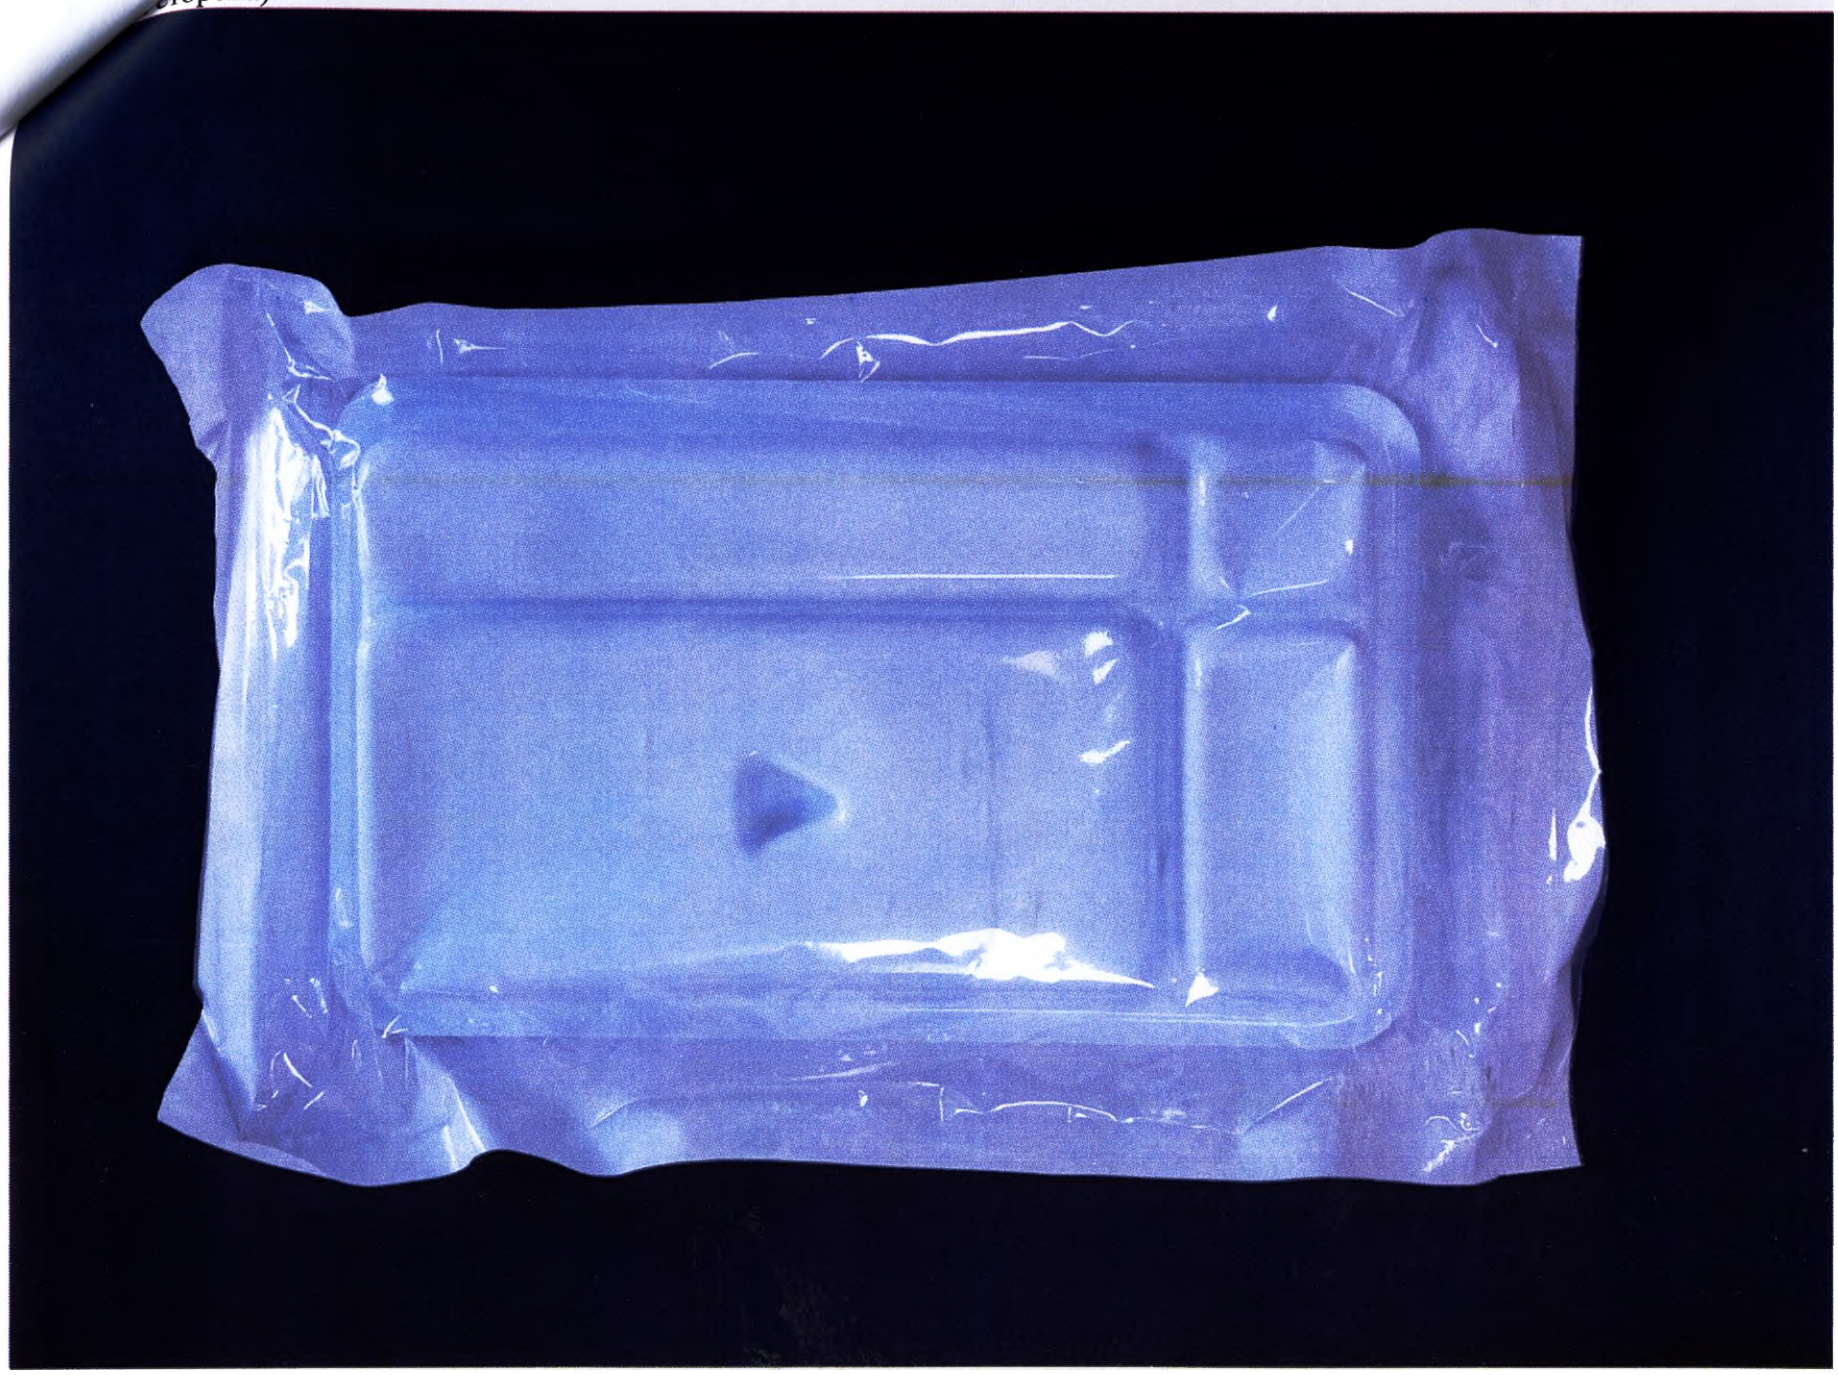

Прошито и пронумеровано

19 (девятнадцать)

Генеральный директор

ООО «Юникорнмед»

Д.Ю. Оси

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU