

Макеты этикеток на медицинское изделие

**Набор реагентов для калибровки «MagnoLIA ЦМВ IgM»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.

Набор реагентов для калибровки «MagnoLIA ЦМВ IgM»

Макет этикеток



Вариант исполнения 1

кат. № 2060101

На коробку

На флаконы:



Набор реагентов для калибровки
«MagnoLIA ЦМВ IgM»

Состав набора:

Калибратор -	1 фл.
Калибратор +	1 фл.

Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.



ТУ 21.20.23-492-98539446-2019
РУ № XXXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

MagnoLIA
ЦМВ
IgM
Калибратор +
объем 1 мл
+25°C
000 «Компания Алкор Био»



MagnoLIA
ЦМВ
IgM
Калибратор -
объем 1 мл
+25°C
000 «Компания Алкор Био»



Набор реагентов для калибровки «MagnoLIA ЦМВ IgM»

Макет этикеток



Вариант исполнения 2

Кат. № 2060105

На коробку:

MagnoLIA ЦМВ IgM

REF 2060105 **LOT** E002

2021-11-19

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6787879, 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

MagnoLIA

Состав набора:

Калибратор -	5 фл.
Калибратор +	5 фл.

ТУ 21.20.23-492-98539446-2019
РУ № XXXXXXXXXXXXXXX

Набор реагентов для калибровки
«MagnoLIA ЦМВ IgM»

LOT E002
REF 2060105
IVD

2020-11-19
2021-11-19
50



Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

На флаконы:

MagnoLIA
ЦМВ
IgM
Калибратор -
объем 1 мл



-5 шт.

MagnoLIA
ЦМВ
IgM
Калибратор +
объем 1 мл



-5 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 3 (ТМ) лист 1

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Д.Г. Полынцев



Фотографии
медицинского изделия для диагностики in vitro

**Набор реагентов для калибровки «MagnaLIA ЦМВ IgM»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Вариант исполнения 1 – стр. 2-4

Вариант исполнения 2 – стр. 5-7

Калибраторы 1, 2 – стр. 8-9

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для калибровки

«MagnoLIA ЦМВ IgM»



MagnoLIA

**Набор реагентов для калибровки
«MagnoLIA ЦМВ IgM»**

Состав набора:

Калибратор -	1 фл.
Калибратор +	1 фл.

Готово к использованию.

Для профессионального применения.

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для калибровки «MagnoLIA ЦМВ IgM»

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002


Набор реагентов для калибровки

«MagnaLIA ЦМВ IgM»

LOT E002



2020-11-19



REF 2060201



2021-11-19



IVD



20



ТУ 21.20.23-493-98539446-2019

РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX



ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru




ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E002

Набор реагентов для калибровки

«MagnaLIA ЦМВ IgM»

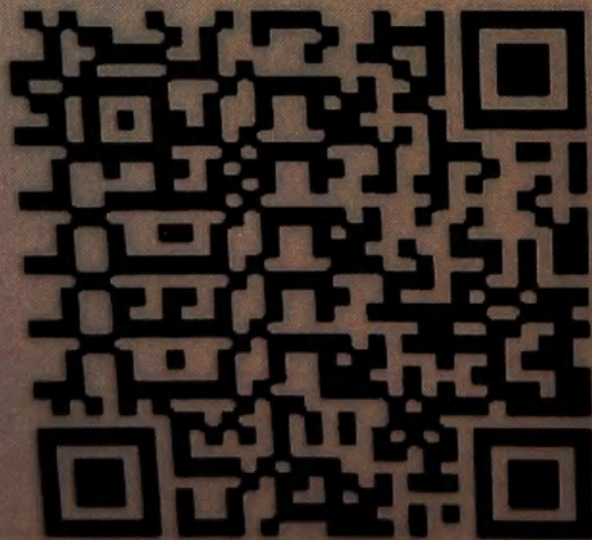

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для калибровки

«MagnoLIA ЦМВ IgM»



Состав набора:

Калибратор -	5 фла.
Калибратор +	5 фла.

ТУ 21.20.25-452-98539446-2019
Р/У № XXXXXXXXXXXXXXXX

Набор реагентов для калибровки
«MagnoLIA ЦМВ IgM»

LOT E002

REF 2060105

IVD

2020-11-19

2021-11-19

Σ₉₀

+2⁺ К_с

i

⚠

⚠

Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для калибровки «MagnoLIA ЦМВ IgM»

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для калибровки

«MagnaLIA ЦМВ IgM»

MagnaLIA ЦМВ IgM

LOT E002 2021-11-19
REF 2060105 +2⁺8⁺°C

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002
Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA ЦМВ IgM»



МагноLIA

ЦМВ

1gM


Калибратор

объем 1 мл

+2  +8
°C



ООО "Компания Алкор Бюро"

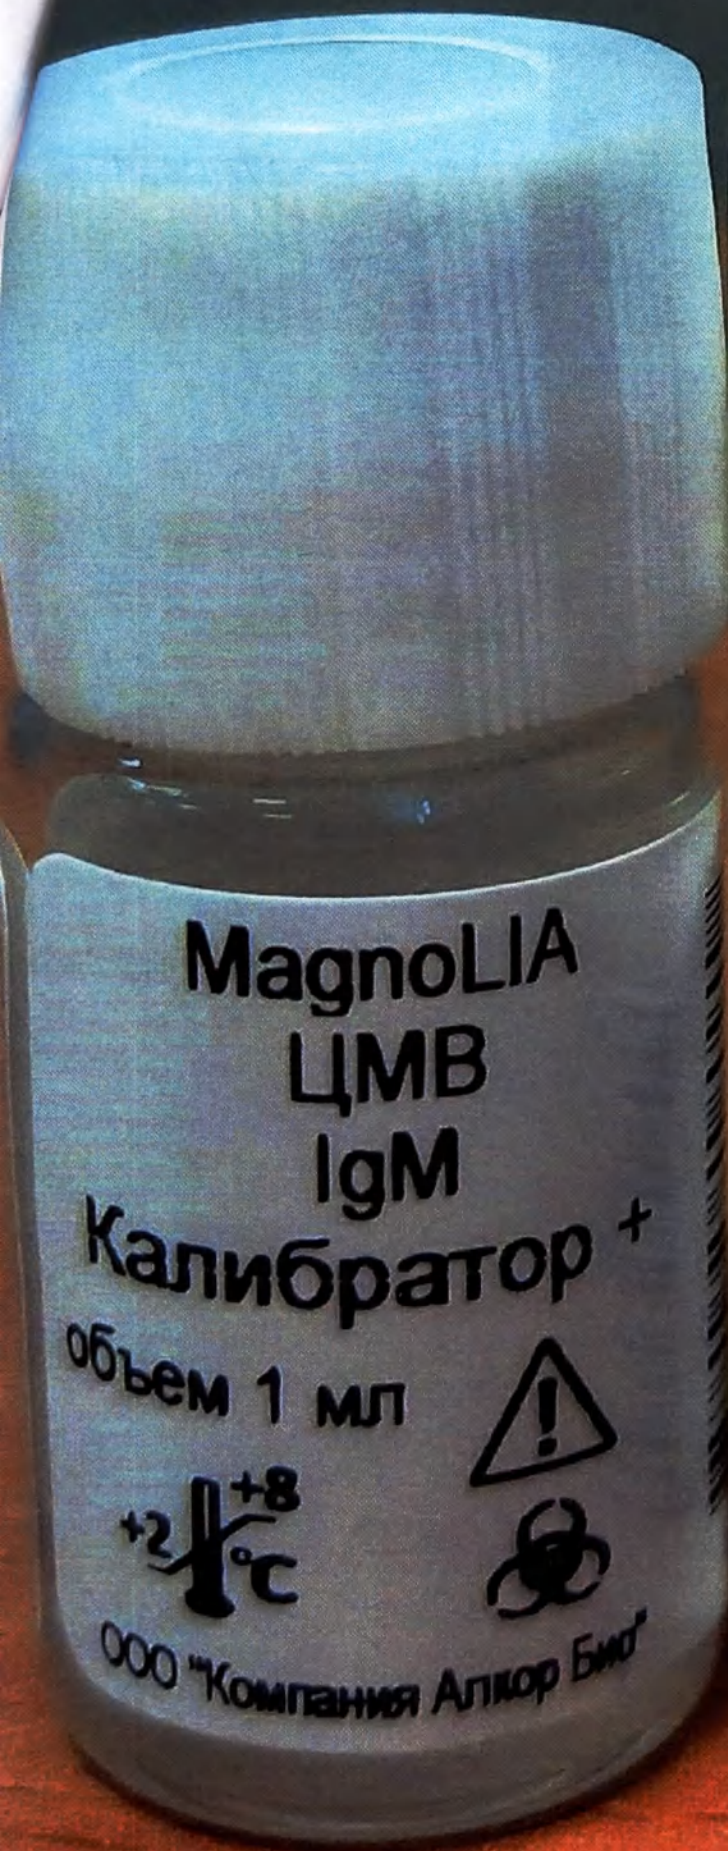

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 2 (2017)
лист 2

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Д.Г. Полинцев

