

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Изделия медицинские кардиохирургические
для диагностики и лечения заболеваний
сердца***

Производства

Biosense Webster, Inc., USA

Байосенс Вебстер Инк., США



Изделие медицинское кардиохирургическое для
диагностики и лечения заболеваний сердца: Проводник.
Область применения: для интервенционной аритмологии

 "Байосенс Вебстер (США), Инк.", 33 Technology
Drive Irvine, California 92618, USA

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя):
ООО "Джонсон & Джонсон", 121614, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2,
тел.: +7 (495) 580 77 77

Номер и дата РУ: РЗН 2015/3497 от 14.08.2017г.

Не использовать после истечения срока годности

Срок годности: 1,8 года

количество штук в упаковке: 1 шт.



STERILE EO



REF 301803P



301803P@001



250 x 250 mm
97.7 x 97.7

Изделие медицинское кардиохирургическое для
диагностики и лечения заболеваний сердца: Кабель.
Область применения: для интервенционной аритмологии

 "Байосенс Вебстер (США), Инк.", 33 Technology
Drive Irvine, California 92618, USA

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя):
ООО "Джонсон & Джонсон", 121614, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2,
тел.: +7 (495) 580 77 77

Номер и дата РУ: РЗН 2015/3497 от 14.08.2017г.

Не использовать после истечения срока годности


количество штук в упаковке: 1 шт.



REF 39E59M



39E59M@001

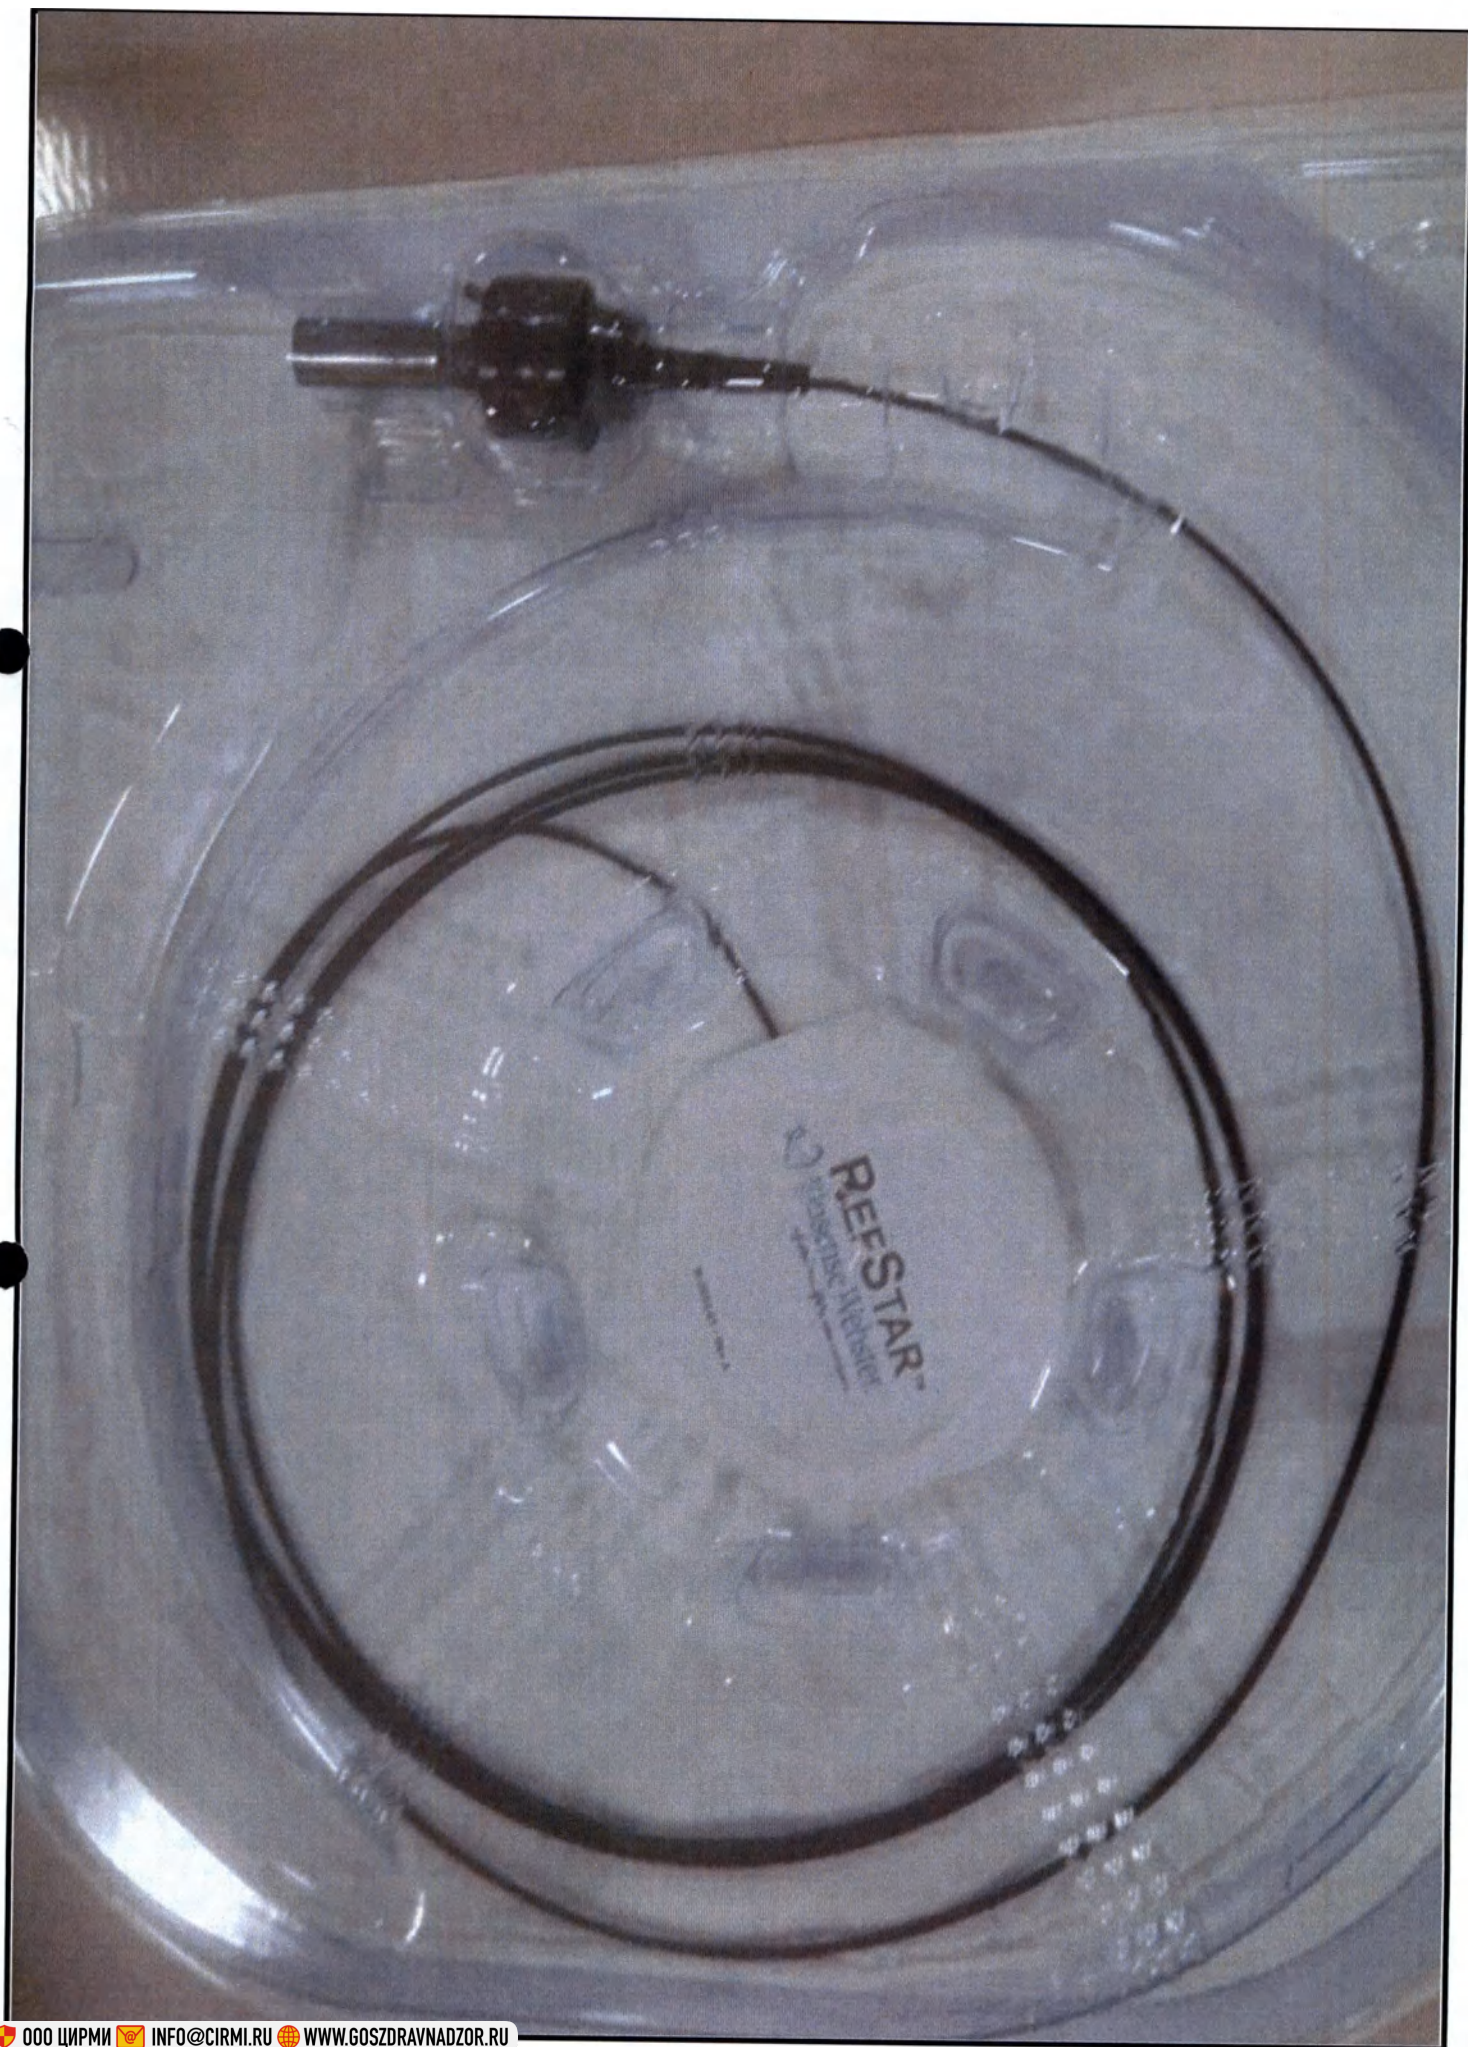

Изделие медицинское кардиохирургическое для
диагностики и лечения заболеваний
сердца: Электрод-накладка.
Область применения: для интервенционной аритмологии

 "Байосенс Вебстер (США), Инк.", 33 Technology
Drive Irvine, California 92618, USA

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя):
ООО "Джонсон & Джонсон", 121614, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2,
тел.: +7 (495) 580 77 77

Номер и дата РУ: РЗН 2015/3497 от 14.08.2017г.

Не использовать после истечения срока годности

Срок годности: 3 года

количество штук в упаковке: 1 шт.



REF 34N01M



34N01M@001



Изделие медицинское кардиохирургическое для
диагностики и лечения заболеваний
сердца: Электрод-накладка.
Область применения: для интервенционной аритмологии

 "Байосенс Вебстер (США), Инк.", 33 Technology
Drive Irvine, California 92618, USA

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя):
ООО "Джонсон & Джонсон", 121614, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2,
тел.: +7 (495) 580 77 77

Номер и дата РУ: РЗН 2015/3497 от 14.08.2017г.

Не использовать после истечения срока годности

Срок годности: 3 года

количество штук в упаковке: 1 шт.



REF XRPP8Y



XRPP8Y@001



Изделие медицинское кардиохирургическое для
диагностики и лечения заболеваний
сердца: Электрод-накладка.
Область применения: для интервенционной аритмологии

 "Байосенс Вебстер (США), Инк.", 33 Technology
Drive Irvine, California 92618, USA

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя):
ООО "Джонсон & Джонсон", 121614, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2,
тел.: +7 (495) 580 77 77

Номер и дата РУ: РЗН 2015/3497 от 14.08.2017г.

Не использовать после истечения срока годности

Срок годности: 3 года


количество штук в упаковке: 1 шт.



REF RR6PNY



RR6PNY@001

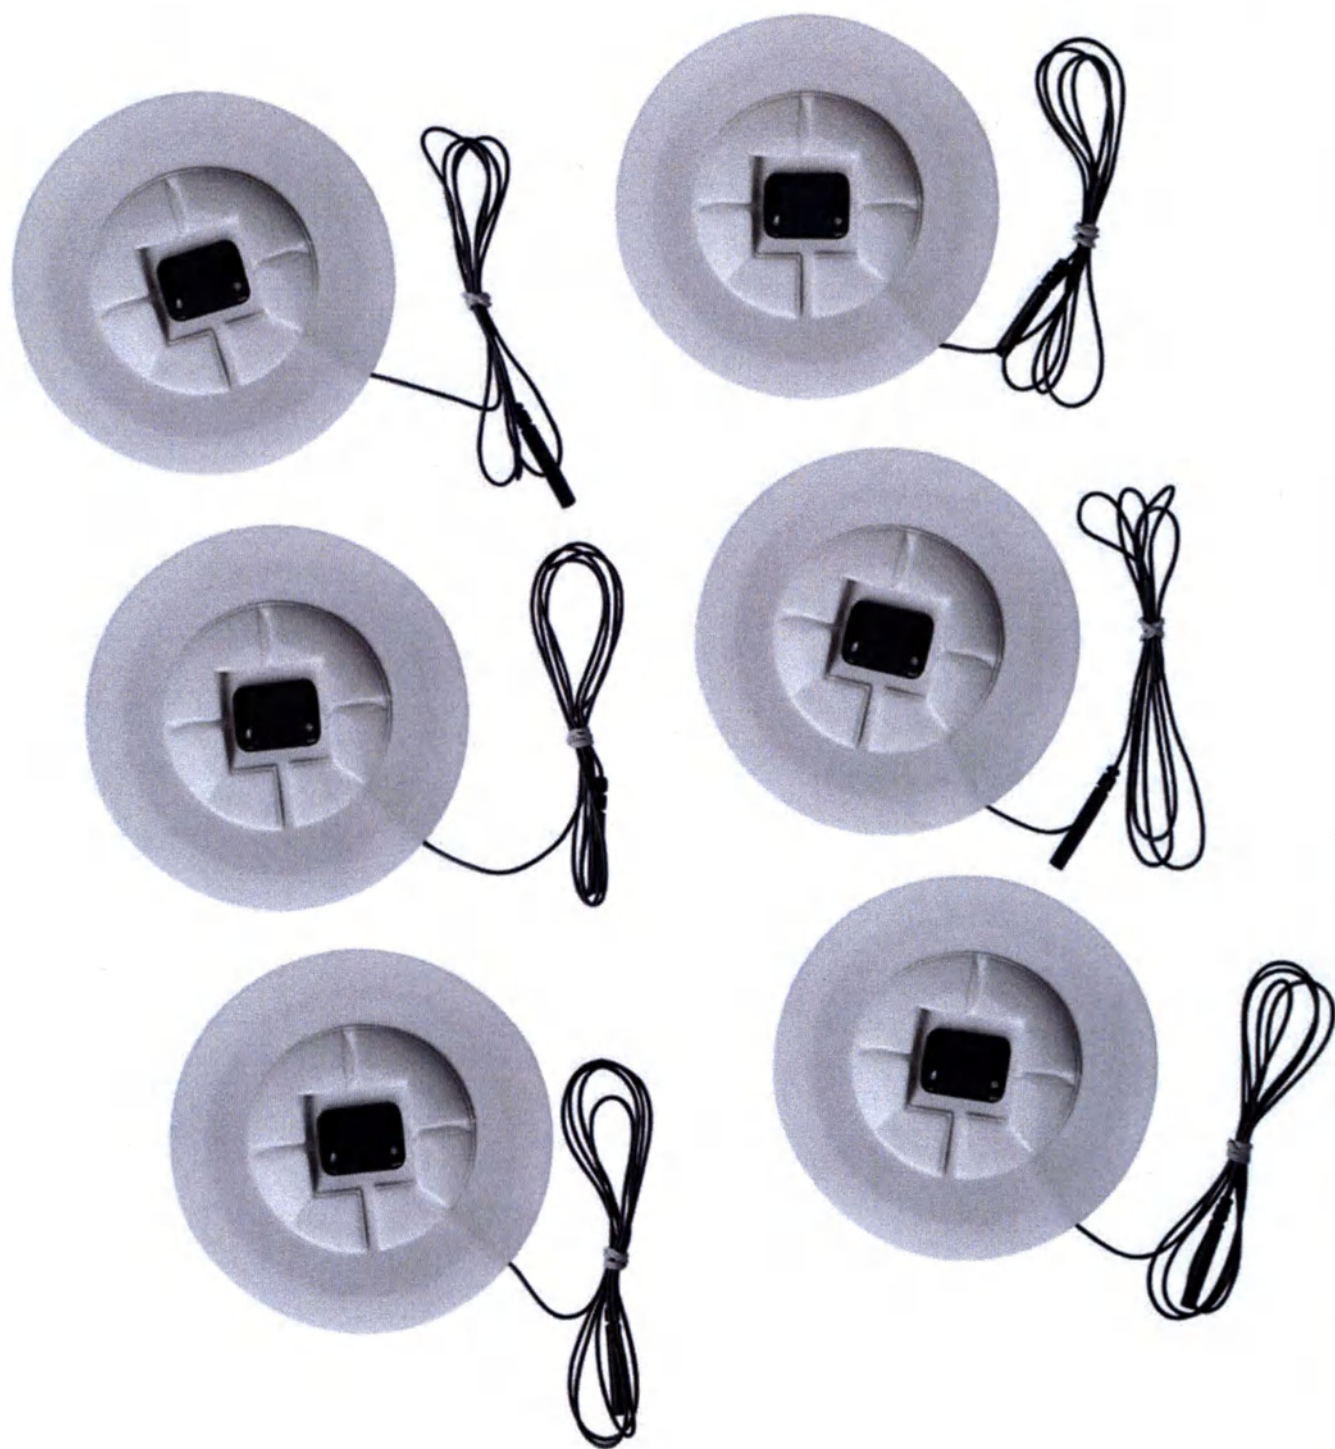

Изделие медицинское кардиохирургическое для
диагностики и лечения заболеваний
сердца: Электрод-накладка.
Область применения: для интервенционной аритмологии

 "Байосенс Вебстер (США), Инк.", 33 Technology
Drive Irvine, California 92618, USA

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя):
ООО "Джонсон & Джонсон", 121614, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2,
тел.: +7 (495) 580 77 77

Номер и дата РУ: РЗН 2015/3497 от 14.08.2017г.

Не использовать после истечения срока годности

Срок годности: 1,5 года

количество штук в упаковке: 1 шт.



REF CREFP6



CREFP6001



Изделие медицинское кардиохирургическое для
диагностики и лечения заболеваний
сердца: Катетер-электрод электрофизиологический.
Область применения: для интервенционной аритмологии

 "Байосенс Вебстер (США), Инк.", 33 Technology
Drive Irvine, California 92618, USA

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя):
ООО "Джонсон & Джонсон", 121614, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2,
тел.: +7 (495) 580 77 77

Номер и дата РУ: РЗН 2015/3497 от 14.08.2017г.

Не использовать после истечения срока годности

количество штук в упаковке: 1 шт.



STERILE | EO



REF D728260RT



D728260RT@001



Изделие медицинское кардиохирургическое для
диагностики и лечения заболеваний
сердца: Катетер-электрод электрофизиологический.
Область применения: для интервенционной аритмологии

 "Байосенс Вебстер (США), Инк.", 33 Technology
Drive Irvine, California 92618, USA

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя):
ООО "Джонсон & Джонсон", 121614, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2,
тел.: +7 (495) 580 77 77

Номер и дата РУ: РЗН 2015/3497 от 14.08.2017г.

Не использовать после истечения срока годности
Внешний диаметр катетера: 5F
эффективная длина катетера: 60 см
Срок годности: 3 года

количество штук в упаковке: 1 шт.



STERILE | EO



REF 37S94R



37S94R@001





Cat No.: BD7TCFJ8L


**NON
NAV**

C3


8mm



[SPACING mm] 1-74 mm




Pin Connector: 10

[illegible]

Cat No.: BD7TCFJ8L

REF: 35U5JR



LOT 17630515M
Batch Code



2017-01-20



2019-12-31



L-1267-04-S REV G

M-5274-207

Изделия медицинские кардиохирургические для
диагностики и лечения заболеваний сердца:
Катетер – электрод электрофизиологический

Область применения: Кардиология

Условия хранения: Хранить в темном сухом месте при
температуре от +5 до +25С.

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: "Байосенс Вебстер, Инк.", США, Biosense
Webster Inc., 3333 Diamond Canyon Road, Diamond Bar,
California, 91765, USA

Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон" 121614, Москва, ул.
Крылатская, д. 17/2, тел. +7(495)5807777
Рег. удост.: РЭН 2015/3497 от 23.01.2017



Артикул 35U5JR 17118

**Sample ONLY.
Not For Resale!**



Изделие медицинское кардиохирургическое для
диагностики и лечения заболеваний сердца:
Катетер – электрод электрофизиологический

Область применения: Кардиология

Условия хранения: Хранить в темном сухом месте при
температуре от +5 до +25С.

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: "Байосенс Вебстер Инк.", США, Biosense
Webster Inc., 3333 Diamond Canyon Road, Diamond Bar,
California, 91765, USA. Собрано в Мексике.

Импортёр: ООО "Джонсон & Джонсон" 121614, Москва, ул.

Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Рег. удост.: РЗН 2015/3497 от 23.01.2017

Артикул 35S37R 17222



Са
No
Беспл
He

4-2000 36V32ACT 17124

3333 Diamond Canyon Road • Diamond Bar, California 91765 USA

C3
XP

REV F



Изделие медицинское кардиохирургическое для
диагностики и лечения заболеваний сердца:
Катетер – электрод электрофизиологический

Область применения: Кардиология

Условия хранения: Хранить в темном сухом месте при
температуре от +5 до +25°C.

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: "Байосенс Вебстер Инк.", США, Biosense
Webster Inc., 3333 Diamond Canyon Road, Diamond Bar,
California, 91765, USA. Собрано в Мексике.



Импортер: ООО "Джонсон & Джонон" 121614, Москва, ул.
Крылатская, д. 17/2, тел. +7(495)5807780

Рег. удост.: РЭН 2015/3497 от 23.01.2017

Артикул 36Y32RCT 17195




Sam
Not
Беспла
Не д

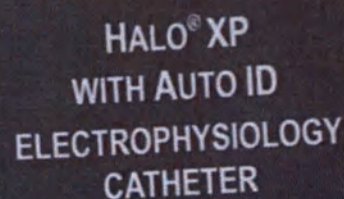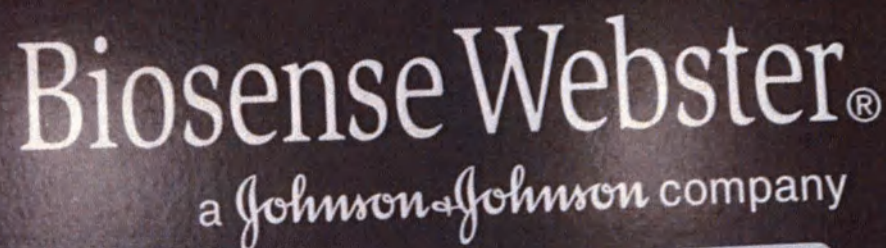

Cat No.: D7T20282CT

ELECTRODES EA 20



Cat No.: D7T20282CT

REF: 36J13RCT

LOT 17638352L

2017-02-02

2020-01-31



Pin Connector : 34

R_x CE **STERILE EO**

Electrophysiology (EKG) is the study of the electrical activity of the heart. It is a non-invasive test that can be used to diagnose a variety of heart conditions. The test is performed by attaching electrodes to the skin on the chest, arms, and legs. The electrodes detect the electrical impulses that travel through the heart muscle, which causes it to contract and pump blood. The resulting electrical activity is recorded on a graph, which is then interpreted by a doctor. EKGs can be used to identify a variety of heart problems, including arrhythmias, heart block, and heart failure. They can also be used to monitor the heart's response to treatment and to assess the risk of future heart problems. EKGs are a common and important tool in the diagnosis and management of heart disease.



07T20282CT



(01)1084683500598



(17)200131(10)176383521

Sample ON
Not For Re
Бесплатный с
Не для пре

1100-43-S REV F

Результаты исследования могут быть использованы в лечебной практике при лечении дерматозов, дерматитов.

Полный текст статьи: <http://www.chem.msu.ru/chem/chem.htm>
 Тел.: (495) 232-3400, 232-3401, 232-3402
 Факс: (495) 232-3403
 E-mail: chem@chem.msu.ru
 Сайт: <http://www.chem.msu.ru/chem/chem.htm>
 Адрес: Москва, МГУ, химический факультет
 119899, Москва, Россия
 Россия 119899, Москва, Россия
 E-mail: chem@chem.msu.ru
 Сайт: <http://www.chem.msu.ru/chem/chem.htm>

Accession 36J13RC



Not For Resale!
Бесплатный образец.
Не для продажи!

Изделие медицинское кардиохирургическое для
диагностики и лечения заболеваний сердца:
Катетер – электрод электрофизиологический

Область применения: Кардиология

Условия хранения: Хранить в темном сухом месте при
температуре от +5 до +25С.

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: "Байосенс Вебстер Инк.", США, Biosense
Webster Inc., 3333 Diamond Canyon Road, Diamond Bar,
California, 91765, USA. Собрано в Мексике.

Импортёр: ООО "Джонсон & Джонсон" 121614, Москва, ул.
Крылатовая, д. 17/2, тел. + 7(495)5807778


Рег. удост.: РЭН 2015/3497 от 23.01.2017




Артикул 36J13RCT 17195



Aprikeyn 37C5CB 1712





Изделие медицинское кардиохирургическое для
диагностики и лечения заболеваний сердца:
Катетер – электрод электрофизиологический

Область применения: Кардиология

Условия хранения: Хранить в темном сухом месте при
температуре от +5 до +25°C.

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: "Байосенс Вебстер Инк.", США, Biosense
Webster Inc., 3333 Diamond Canyon Road, Diamond Bar,
California, 91765, USA. Собрано в Мексике.

Импортёр: ООО "Джонсон & Джонсон" 121614, Москва, ул.

Крылатская, д. 17/2, тел. +7(495)5807777

Рег. удост.: РЗН 2015/3497 от 23.01.2017



Артикул 37C5CR 17195

biosense
webster
company



Изделие медицинское кардиохирургическое для
диагностики и лечения заболеваний сердца:
Катетер – электрод электрофизиологический

Область применения: Кардиология

Условия хранения: Хранить в темном сухом месте при
температуре от +5 до +25С.

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: "Байосенс Вебстер Инк.", США, Biosense
Webster Inc., 3333 Diamond Canyon Road, Diamond Bar,
California, 91765, USA. Собрано в Мексике.

Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон" 121614, Москва, ул.
Крылатская, д. 17/2, тел. +7(495)5807777

Рег. удост.: РЭН 2015/3497 от 23.01.2017

Артикул 36Y39R 17195





Изделие медицинское кардиохирургическое для
диагностики и лечения заболеваний
сердца: Катетер-электрод диагностический.
Область применения: для интервенционной аритмологии

 "Байосенс Вебстер (США), Инк.", 33 Technology
Drive Irvine, California 92618, USA

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя):
ООО "Джонсон & Джонсон", 121614, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2,
тел.: +7 (495) 580 77 77

Номер и дата РУ: РЗН 2015/3497 от 14.08.2017г.

Не использовать после истечения срока годности
Внешний диаметр катетера: 7F
эффективная длина катетера: 115 см
Срок годности: 3 года

количество штук в упаковке: 1 шт.



STERILE EO



REF 36D5JR



36D5JR@001

REL TO OPEN H-5604-16

FILE TO OPEN M-5604-16



Biosense Webster.

TABLE OF THE *Ichneumonidae* FAMILY IN ALABAMA

1233 Diamond Canyon Road • Diamond Bar, California 91766 USA

(800) 838-8500 • (800) 732-9110 • (009) 468-2345 FAX

C3

XP

PARAHISIAN®
ELECTROPHYSIOLOGY
CATHETER

Cat No.: D708RHISRT

ELECTRODES EA 8



SPACING mm 25.10.25.25.25.25.25 mm

D-Type


Cat No.: D708RHISRT

REF: 36L000

LOT 17336956M

2015-10-07

2018-09



 $7F \approx 2.3 \text{ mm}$

Pin Connector : 10



06/09/2014

STERILE EO



L-1097-5S2-S REV J



Изделие медицинское кардиохирургическое для
диагностики и лечения заболеваний
сердца: Катетер-электрод диагностический.
Область применения: для интервенционной аритмологии

 "Байосенс Вебстер (США), Инк.", 33 Technology
Drive Irvine, California 92618, USA

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя):
ООО "Джонсон & Джонсон", 121614, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2,
тел.: +7 (495) 580 77 77

Номер и дата РУ: РЗН 2015/3497 от 14.08.2017г.

Не использовать после истечения срока годности
Внешний диаметр катетера: 7F
эффективная длина катетера: 90 см
Срок годности: 3 года

количество штук в упаковке: 1 шт.



STERILE EO



REF 36L00Q



36L00Q@001



Изделие медицинское кардиохирургическое для
диагностики и лечения заболеваний сердца:
Катетер – электрод диагностический

Область применения: Кардиология

Условия хранения: Хранить в темном сухом месте при
температуре от +5 до +25С.

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: "Байосенс Вебстер Инк.", США, Biosense
Webster Inc., 3333 Diamond Canyon Road, Diamond Bar,
California, 91765, USA. Собрано в Мексике.

Импортёр: ООО "Джонсон & Джонсон" 121614, Москва, ул.
Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Рег. удост.: 2015/3497 от 11.01.2016

Артикул 35016R 17118





Изделие медицинское кардиохирургическое для
диагностики и лечения заболеваний сердца:
Катетер – электрод диагностический

Область применения: Кардиология

Условия хранения: Хранить в темном сухом месте при
температуре от +5 до +25С.

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: "Байосенс Вебстер Инк.", США, Biosense
Webster Inc., 3333 Diamond Canyon Road, Diamond Bar,
California, 91765, USA. Собрано в Мексике.

Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон" 121614, Москва, ул.
Крылатская, д. 17/2, тел. +7(495)5807777

Рег. удост.: 2015/3497 от 11.01.2016



Артикул 36P2515R 17104



Изделие медицинское кардиохирургическое для
диагностики и лечения заболеваний сердца:
Катетер – электрод диагностический

Область применения: Кардиология

Условия хранения: Хранить в темном сухом месте при
температуре от +5 до +25С.

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: "Байосенс Вебстер Инк.", США, Biosense
Webster Inc., 3333 Diamond Canyon Road, Diamond Bar,
California, 91765, USA. Собрано в Мексике.

Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон" 121614, Москва, ул.
Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777


Рег. удост.: РЗН 2015/3497 от 23.01.2017



Артикул CR7TCS4RT 17195



M-5274-64

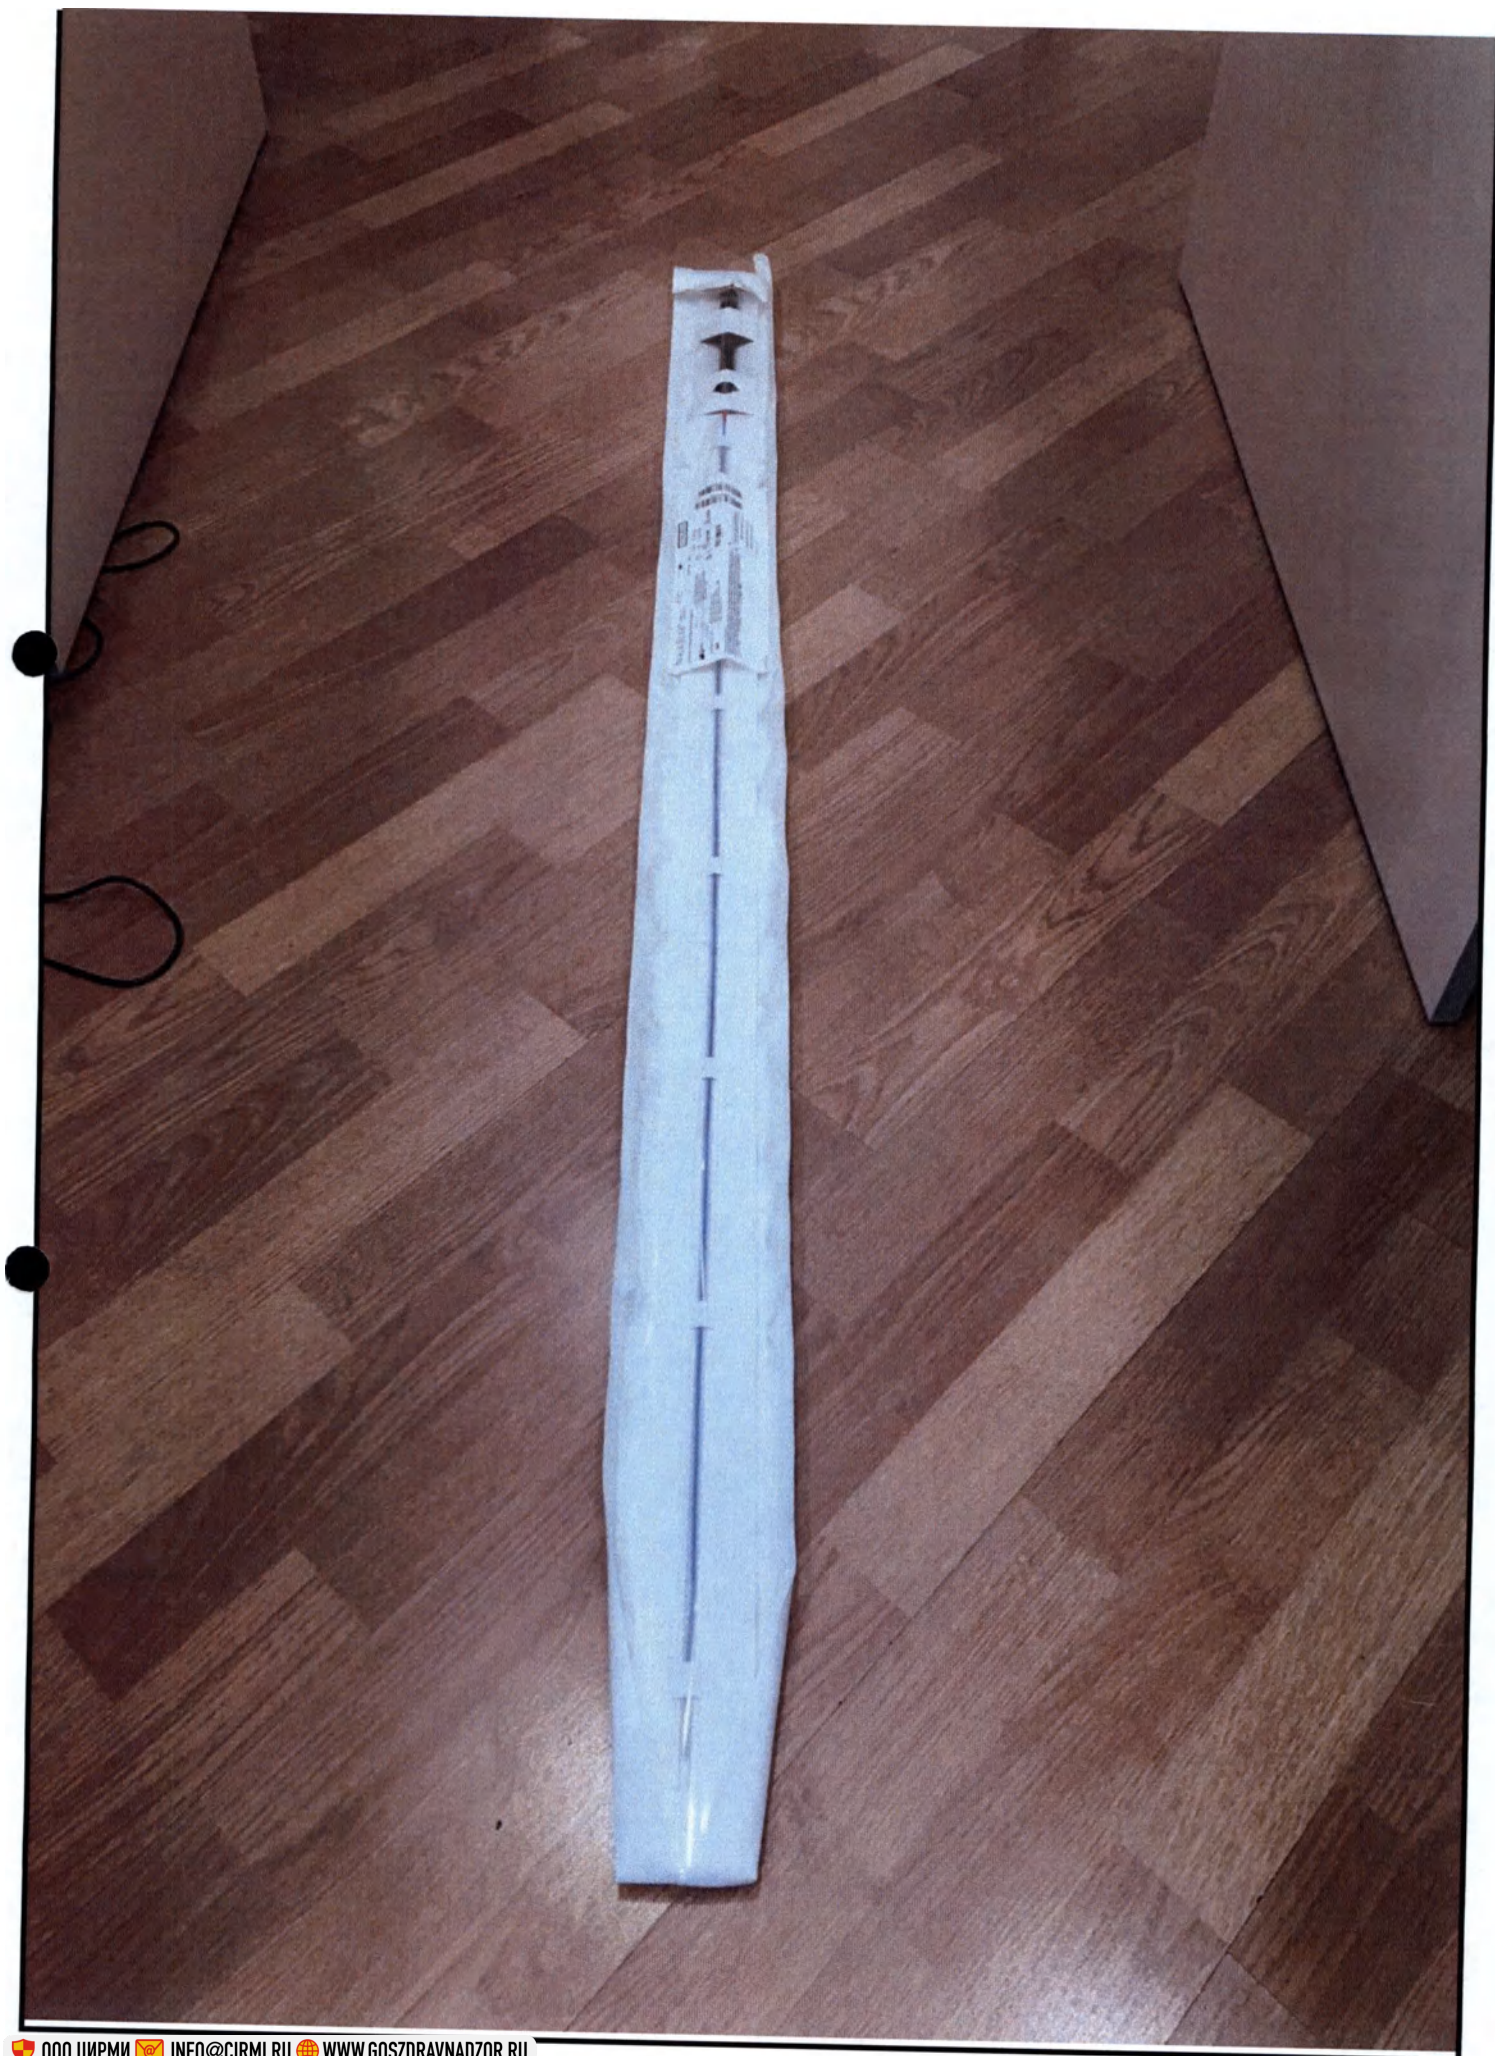

**Sample ONLY.
Not For Resale!**
**Бесплатный образец.
Не для продажи!**

Изделие медицинское кардиохирургическое для
диагностики и лечения заболеваний сердца:
Катетер – электрод диагностический

Область применения: Кардиология

Условия хранения: Хранить в темном сухом месте при
температуре от +5 до +25С.

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: "Байосенс Вебстер Инк.", США, Biosense
Webster Inc., 3333 Diamond Canyon Road, Diamond Bar,
California, 91765, USA. Собрано в Мексике.

Импортёр: ООО "Джонсон & Джонсон" 121614, Москва, ул.

Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Per. удост.: РЭН 2015/3497 от 23.01.2017

Артикул 120705S 17195







NAVISTAR® ELECTROPHYSIOLOGY CATHETER

Cat No.: NS7TCDL174HS

NAV

C3

XP

4mm

D-Type

D

ELECTRODES EA 4

SPACING mm 174 mm

115 cm

7F=2.3 mm

Pin Connector : 25

Rx CE STERILE EO

Специальный катетер-электроды NaviStar®. Электрофизиологический катетер, предназначенный для диагностики и лечения заболеваний сердца. Катетер имеет четыре электрода, расположенных на расстоянии 174 мм друг от друга. Длина катетера составляет 115 см. Диаметр катетера 7F (2.3 мм). Катетер имеет пин-коннектор 25. Катетер стерильный, одноразовый. Катетер имеет маркировку CE, Rx, STERILE, EO. Катетер имеет маркировку L-1183-07-S REV R. Катетер имеет маркировку M-5274-207. Катетер имеет маркировку Sample ONLY. Not For Resale. Бесплатный образец. Не для продажи.

Cat No.: NS7TCDL174HS

REF: 34A35M

LOT 17634717M

2017-01-31

2020-01-31



L-1183-07-S REV R

M-5274-207

Sample ONLY.
Not For Resale!
Бесплатный образец.
Не для продажи!

Катетер предназначен для диагностики и лечения заболеваний сердца. Катетер имеет четыре электрода, расположенных на расстоянии 174 мм друг от друга. Длина катетера составляет 115 см. Диаметр катетера 7F (2.3 мм). Катетер имеет пин-коннектор 25. Катетер стерильный, одноразовый. Катетер имеет маркировку CE, Rx, STERILE, EO. Катетер имеет маркировку L-1183-07-S REV R. Катетер имеет маркировку M-5274-207. Катетер имеет маркировку Sample ONLY. Not For Resale. Бесплатный образец. Не для продажи.

Обратите внимание! Катетер NaviStar® является медицинским изделием. Катетер имеет четыре электрода, расположенных на расстоянии 174 мм друг от друга. Длина катетера составляет 115 см. Диаметр катетера 7F (2.3 мм). Катетер имеет пин-коннектор 25. Катетер стерильный, одноразовый. Катетер имеет маркировку CE, Rx, STERILE, EO. Катетер имеет маркировку L-1183-07-S REV R. Катетер имеет маркировку M-5274-207. Катетер имеет маркировку Sample ONLY. Not For Resale. Бесплатный образец. Не для продажи.

**Изделие медицинское кардиохирургическое для
диагностики и лечения заболеваний сердца:
Катетер – электрод диагностический**

Область применения: Кардиология

Условия хранения: Хранить в темном сухом месте при
температуре от +5 до +25С.

Срок годности: См. на упаковке


Производитель: "Байосено Веботер Инк.", США, Biosense
Webster Inc., 3333 Diamond Canyon Road, Diamond Bar,
California, 91765, USA. Собрано в Мексике.

Импортер: ООО "Джонон & Джонон" 121614, Москва, ул.
Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Рег. удост.: РЭН 2015/3497 от 23.01.2017



Артикул 34A35M 17195

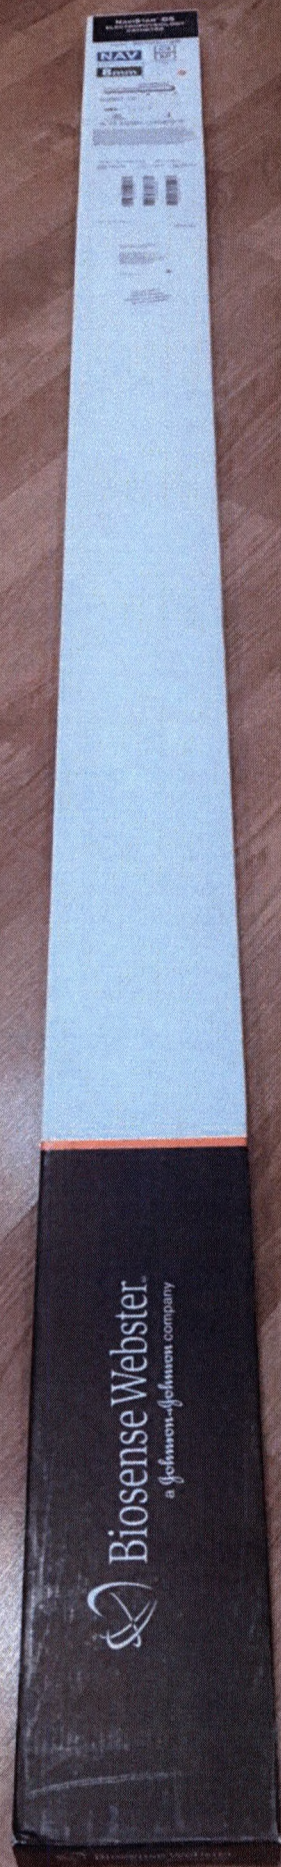





Cat No.: NS7TCF8L174HS

C3
XP


8mm




ELECTRODES EA 4



SPACING mm 1.24 mm



Pin Connector 3 20



Cat No.: NS7TCFBL174HS

REF 3435734

17635113M

2017-02-27

2020-01-31



L-1201-10-S REV K

M-5274-207

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 111–118

Abstract The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week, low-intensity, supervised walking program on the physical and psychological health of sedentary, middle-aged women. The study was a randomized, controlled trial. The intervention group (n = 20) participated in a 12-week walking program, while the control group (n = 20) remained sedentary. The walking program was designed to be low-intensity, with a target heart rate of 110-120 beats per minute. The program was supervised by a certified walking instructor. The study was conducted in a community setting. The primary outcome was the change in physical health, measured by the 6-minute walk test (6MWT) and the 10-minute walk test (10MWT). The secondary outcome was the change in psychological health, measured by the Beck Depression Inventory (BDI) and the State-Trait Anxiety Inventory (STAI). The results showed that the walking program had a significant positive effect on physical health, with the intervention group showing a significant increase in 6MWT and 10MWT scores compared to the control group. There was no significant difference in psychological health between the two groups. The study suggests that a 12-week, low-intensity, supervised walking program can improve physical health in sedentary, middle-aged women.

Accepted 14/07/98 11:00AM

Sample ONLY.
Not For Resale!

Изделие медицинское кардиохирургическое для
диагностики и лечения заболеваний сердца:
Катетер – электрод диагностический

Область применения: Кардиология

Условия хранения: Хранить в темном сухом месте при
температуре от +5 до +25С.

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: "Байосенс Вебстер Инн.", США, Biosense
Webster Inc., 3333 Diamond Canyon Road, Diamond Bar,
California, 91765, USA. Собрано в Мексике.

Импортер: ООО "Джонон & Джонон" 121614, Москва, ул.
Крылатская, д. 17/2, тел. +7(495)5807777

Рег. удост.: РЗН 2015/3497 от 23.01.2017



Артикул 34J57M 17195



Изделие медицинское кардиохирургическое для
диагностики и лечения заболеваний сердца:
Катетер – электрод диагностический

Область применения: Кардиология

Условия хранения. Хранить в темном сухом месте при
температуре от +5 до +25°C.

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: "Байосенс Вебстер Инк.", США, Biosense
Webster Inc., 3333 Diamond Canyon Road, Diamond Bar,
California, 91765, USA. Собрано в Мексике.

Импортер: ООО "Дансон & Дансон" 121614, Москва, ул.
Крылатовая, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Рег. удост.: РЭН 2015/3497 от 23.01.2017



Артикул NR7TCS4Y 17195



Изделие медицинское кардиохирургическое для
диагностики и лечения заболеваний
сердца: Катетер-электрод навигационный.
Область применения: для интервенционной аритмологии

 "Байосенс Вебстер (США), Инк.", 33 Technology
Drive Irvine, California 92618, USA

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя):
ООО "Джонсон & Джонсон", 121614, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2,
тел.: +7 (495) 580 77 77

Номер и дата РУ: РЗН 2015/3497 от 14.08.2017г.

Не использовать после истечения срока годности
Внешний диаметр катетера: 7F
эффективная длина катетера: 115 см
Срок годности: 3 года

количество штук в упаковке: 1 шт.




STERILE EO



REF D128202



D128202@001

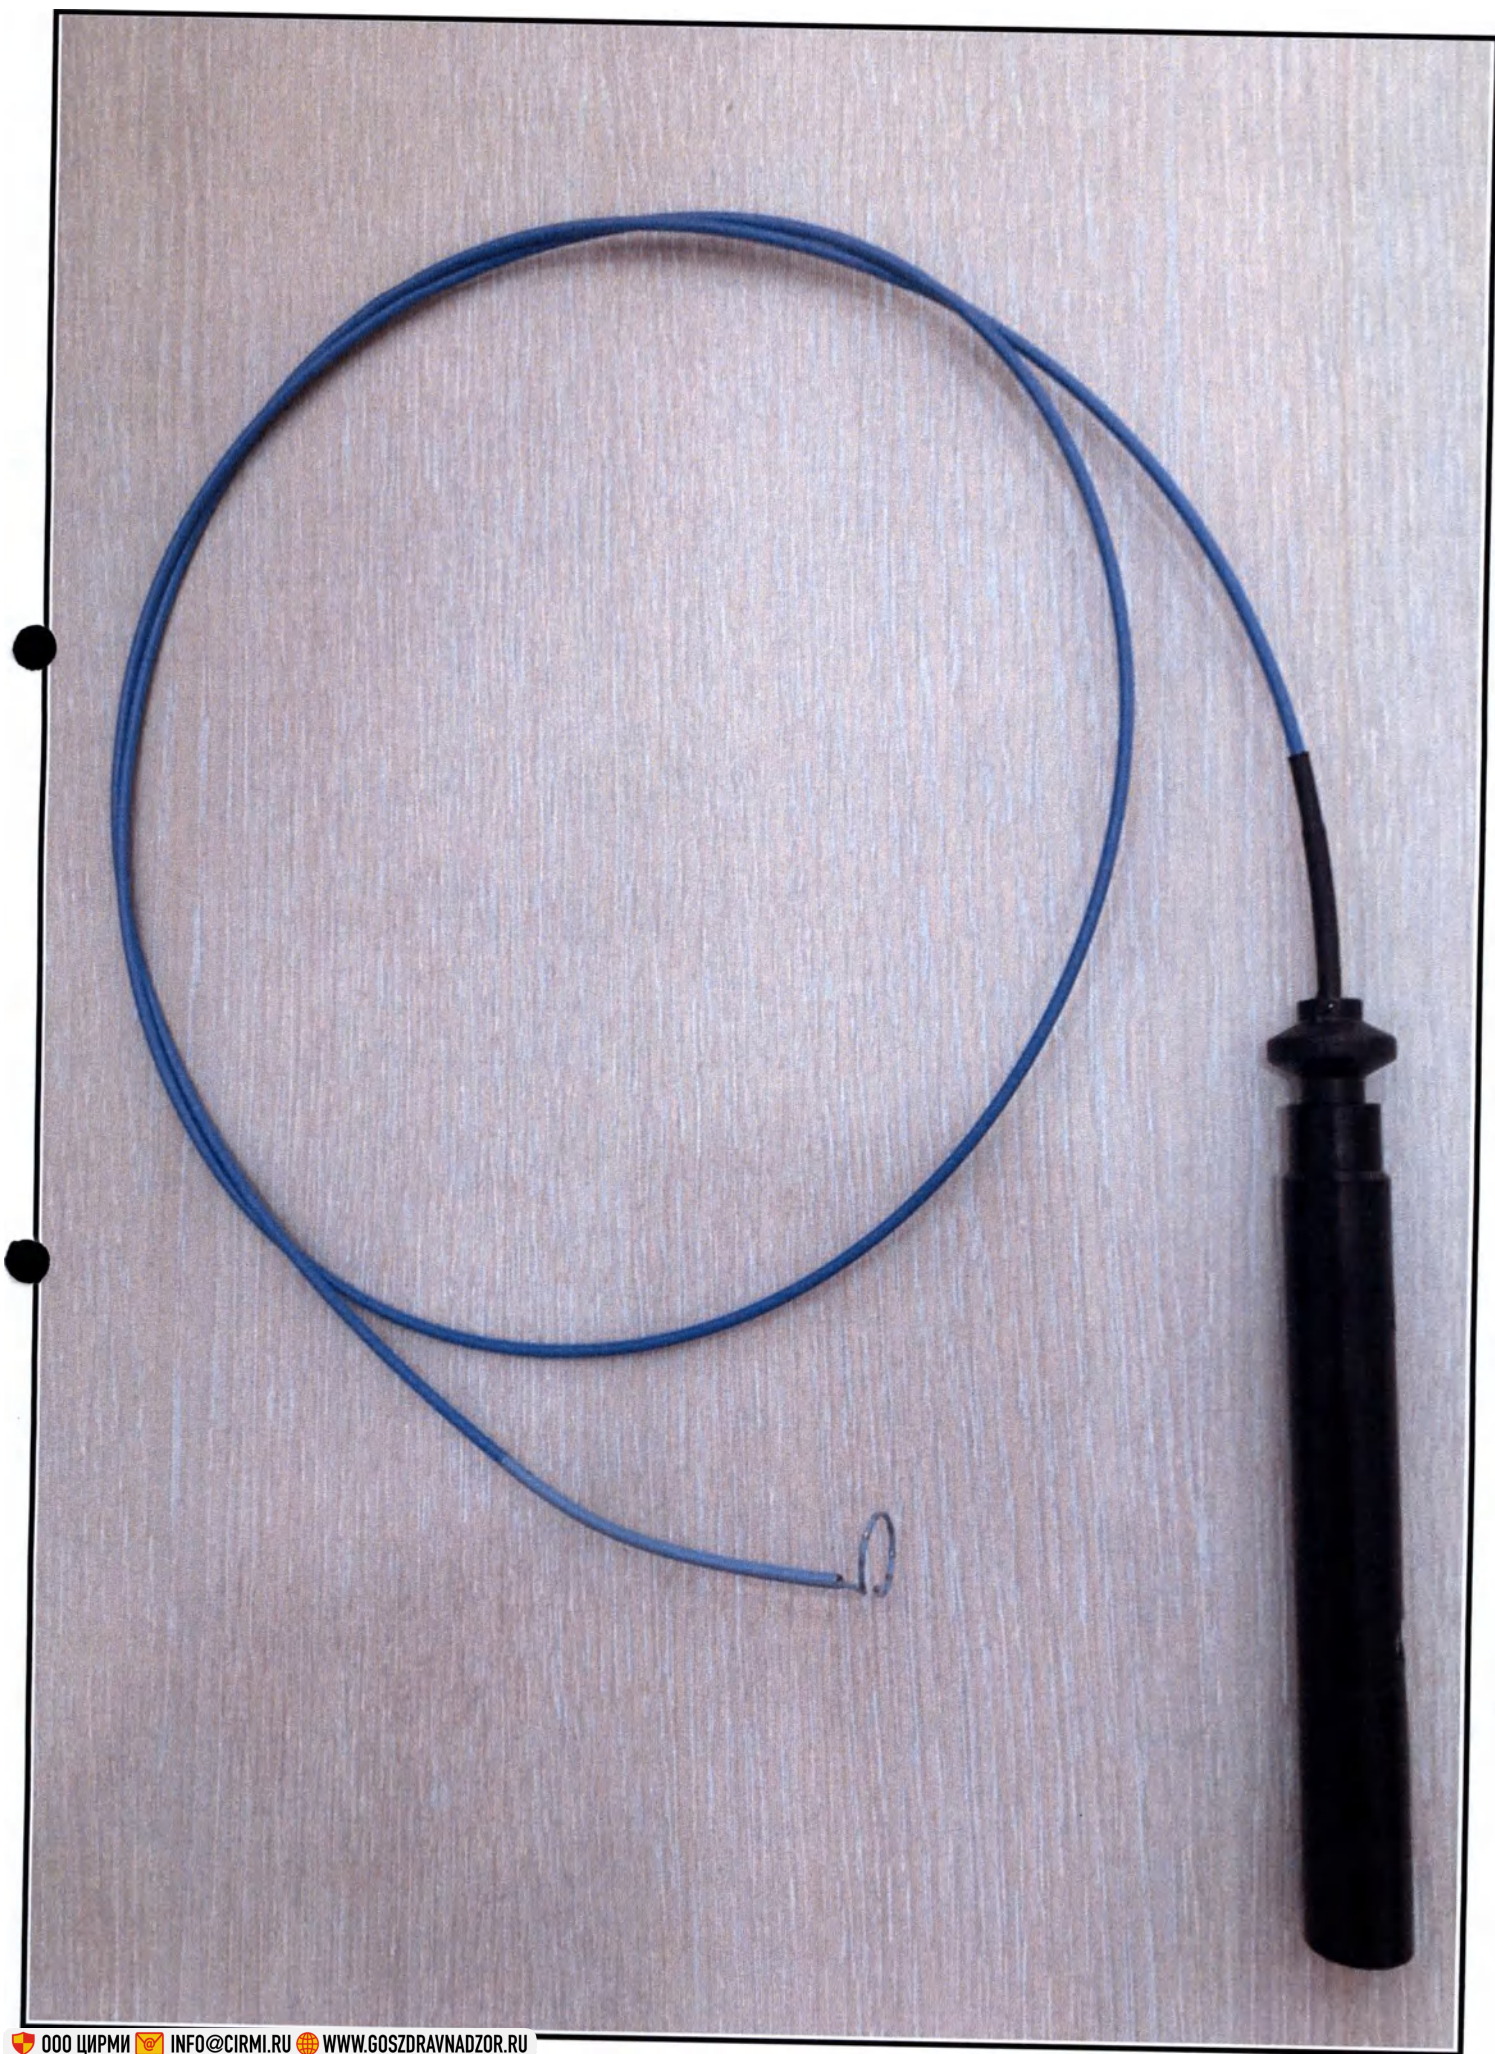

Изделие медицинское кардиохирургическое для
диагностики и лечения заболеваний
сердца: Катетер-электрод навигационный.
Область применения: для интервенционной аритмологии

 "Байосенс Вебстер (США), Инк.", 33 Technology
Drive Irvine, California 92618, USA

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя):
ООО "Джонсон & Джонсон", 121614, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2,
тел.: +7 (495) 580 77 77

Номер и дата РУ: РЗН 2015/3497 от 14.08.2017г.

Не использовать после истечения срока годности
Внешний диаметр катетера: 7F
эффективная длина катетера: 115 см
Срок годности: 1 год


количество штук в упаковке: 1 шт.



STERILE | EO



REF DLN2220CT

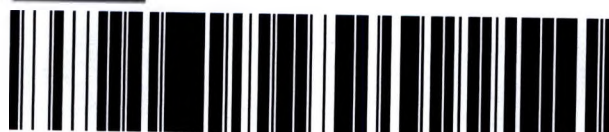

DLN2220CT@001



Изделие медицинское кардиохирургическое для
диагностики и лечения заболеваний
сердца: Катетер-электрод навигационный.
Область применения: для интервенционной аритмологии

 "Байосенс Вебстер (США), Инк.", 33 Technology
Drive Irvine, California 92618, USA

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя):
ООО "Джонсон & Джонсон", 121614, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2,
тел.: +7 (495) 580 77 77

Номер и дата РУ: РЗН 2015/3497 от 14.08.2017г.

Не использовать после истечения срока годности
Внешний диаметр катетера: 7F
эффективная длина катетера: 115 см
Срок годности: 3 года

количество штук в упаковке: 1 шт.




STERILE EO



REF 35U2515R



35U2515R@001

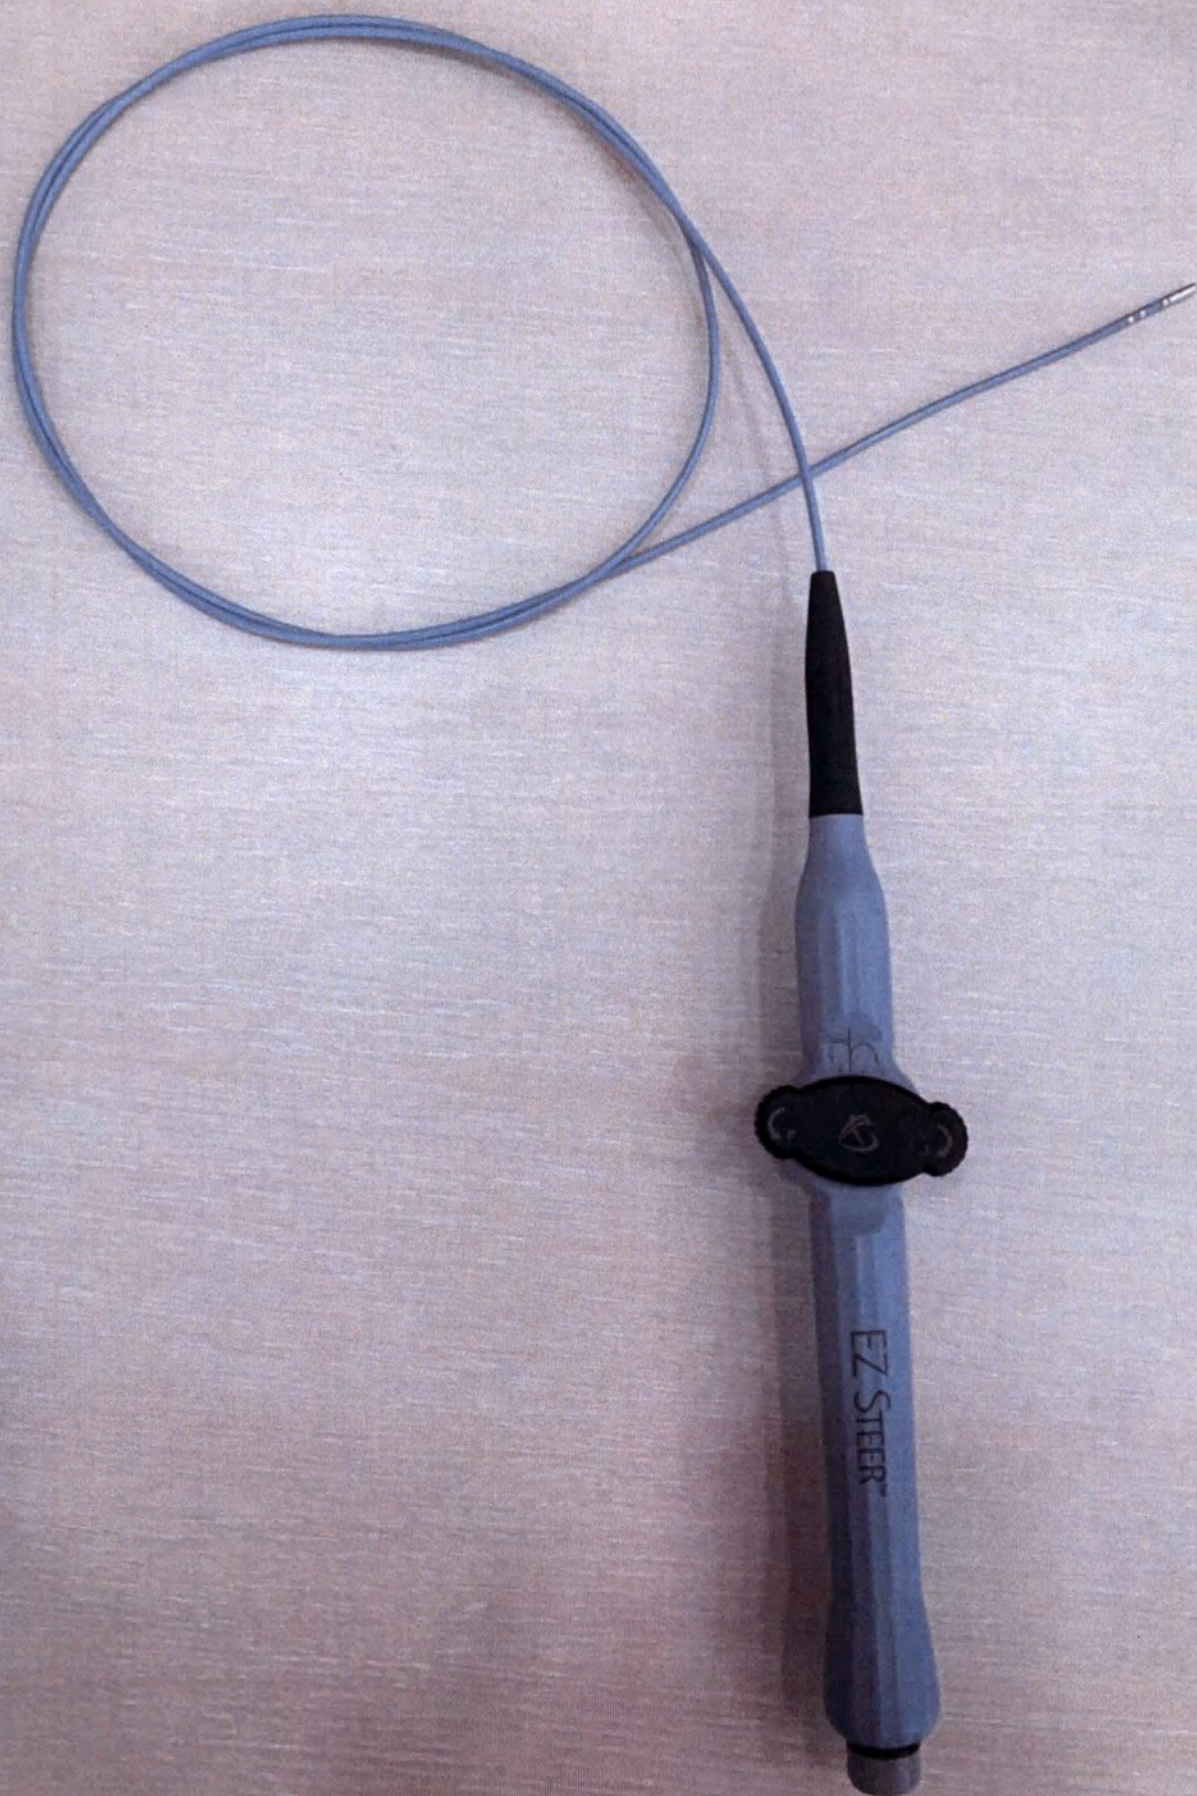

Изделие медицинское кардиохирургическое для
диагностики и лечения заболеваний
сердца: Катетер-электрод лечебный.
Область применения: для интервенционной аритмологии

 "Байосенс Вебстер (США), Инк.", 33 Technology
Drive Irvine, California 92618, USA

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя):
ООО "Джонсон & Джонсон", 121614, ул. Крылатская, д.17, корп.2,
тел.: +7 (495) 580 77 77

Номер и дата РУ: РЗН 2015/3497 от 14.08.2017г.

Не использовать после истечения срока годности
Внешний диаметр катетера: 7F
эффективная длина катетера: 115 см
Срок годности: 3 года

количество штук в упаковке: 1 шт.



STERILE EO



REF 3515JR



3515JR@001



Изд. мед. кардиохир. для диаг. и леч. заб. сердца:
Катетер – электрод лечебный.

Область применения: Кардиология

Условия хранения: Хранить в темном сухом месте при
температуре от +5 до +25С.

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Biosense Webster, Inc., Biosense Webster (Israel)
Ltd., США, Нидерланды, Израиль, Мексика.


Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон" 121614, Москва, ул.
Крылатская, д. 17/2, тел. +7(495)5807777

Рег. удост.: 2015/3497 от 11.01.2016



Артикул 36N07R 17118

ster®

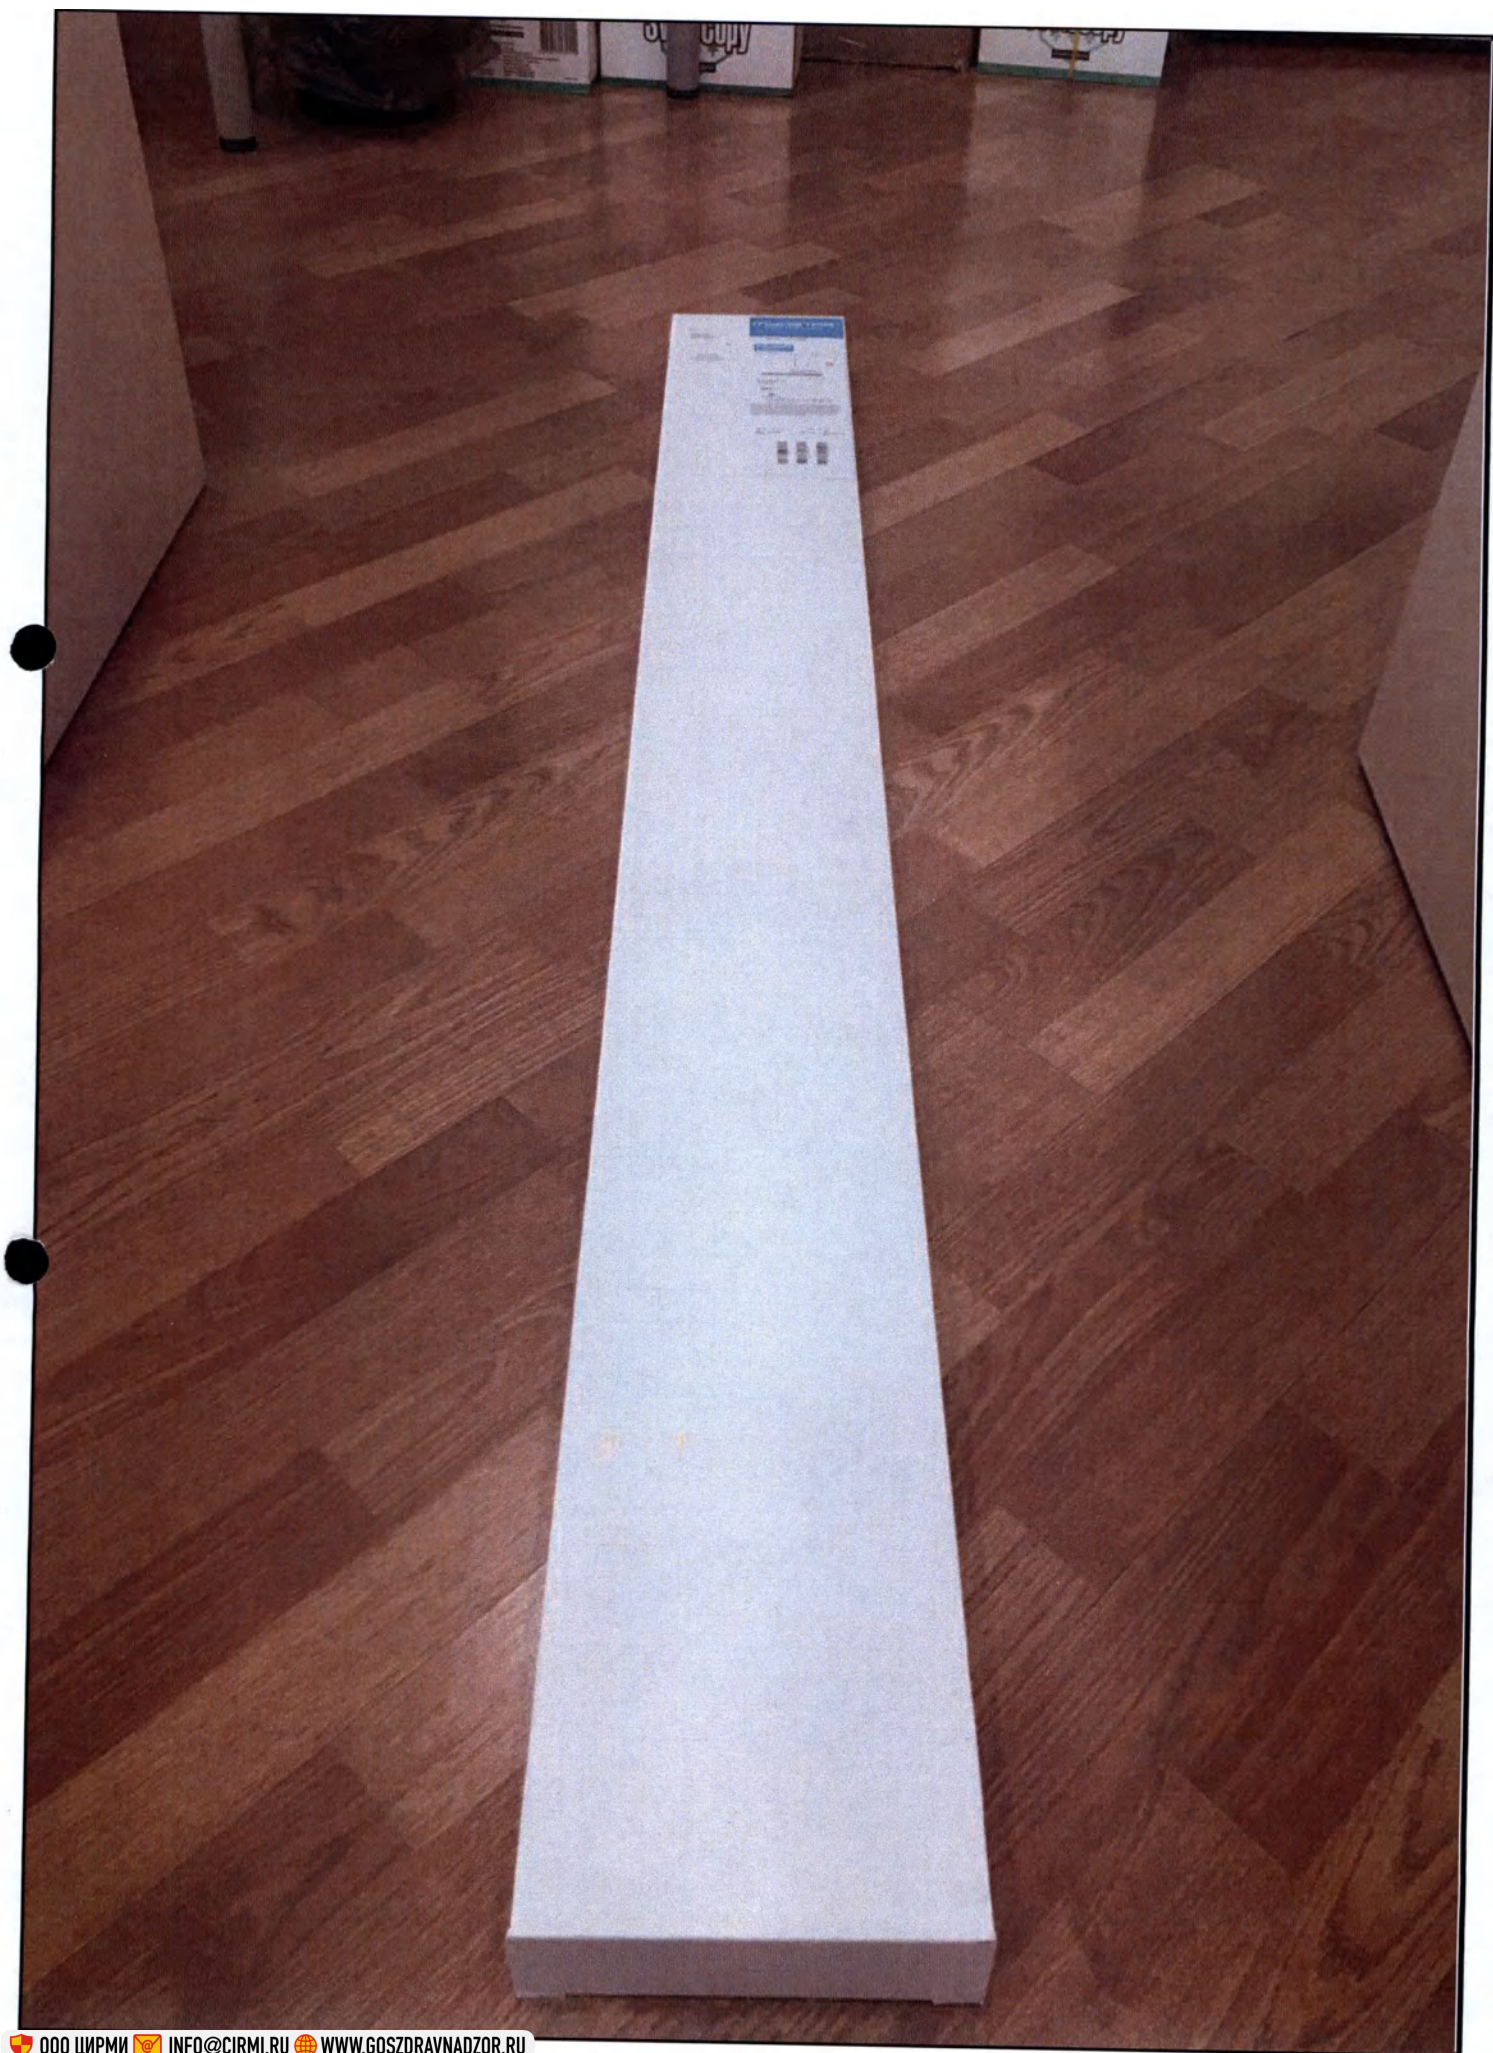





Изд. мед. кардиохир. для диаг. и леч. заб. сердца:
Катетер – электрод инъекционн.

Область применения: Кардиология

Условия хранения: Хранить в темном сухом месте при
температуре от +5 до +25С.

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Biosense Webster, Inc., Biosense Webster (Israel)
Ltd., США, Нидерланды, Израиль, Мексика.

Импортёр: ООО "Джонсон & Джонсон" 121614, Москва, ул.

Крылатская, д. 17/2, тел. +7(495)5807777

Рег. удост.: 2015/3497 от 11.01.2016



Артикул 121120S 17118

