

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Оксигенатор мембранный САРЮХФ
с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром**



Рис. 1 - Оксигенатор мембранный CAPiox® NX19 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром Вид спереди.



Рис. 2 - Оксигенатор мембранный CARIOX® NX19 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром Вид сзади.

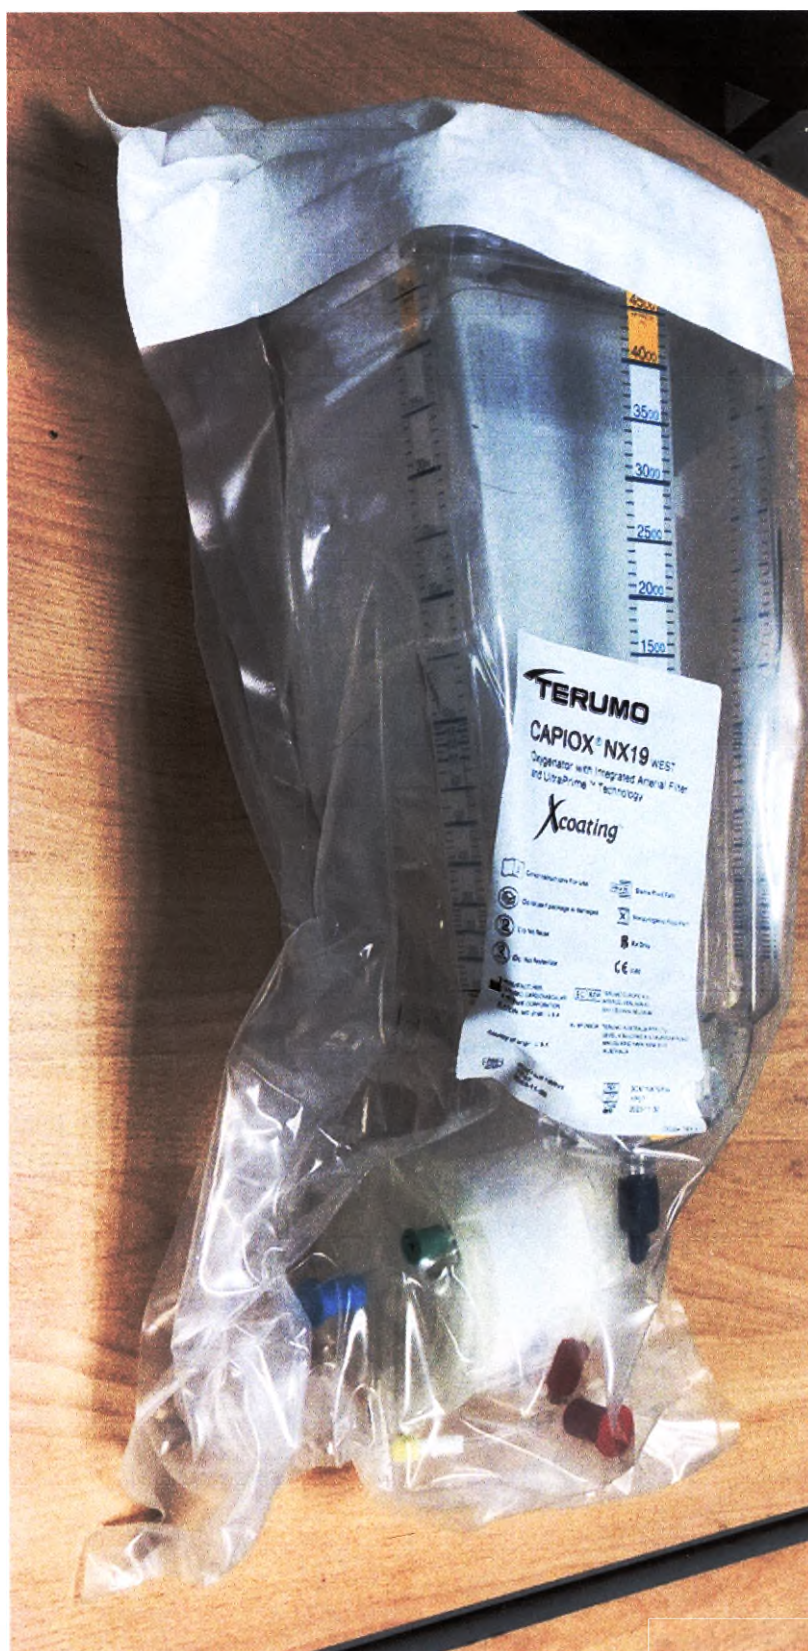


Рис. 3 - Оксигенатор мембранный CAPIOX® NX19 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром в стерильной упаковке

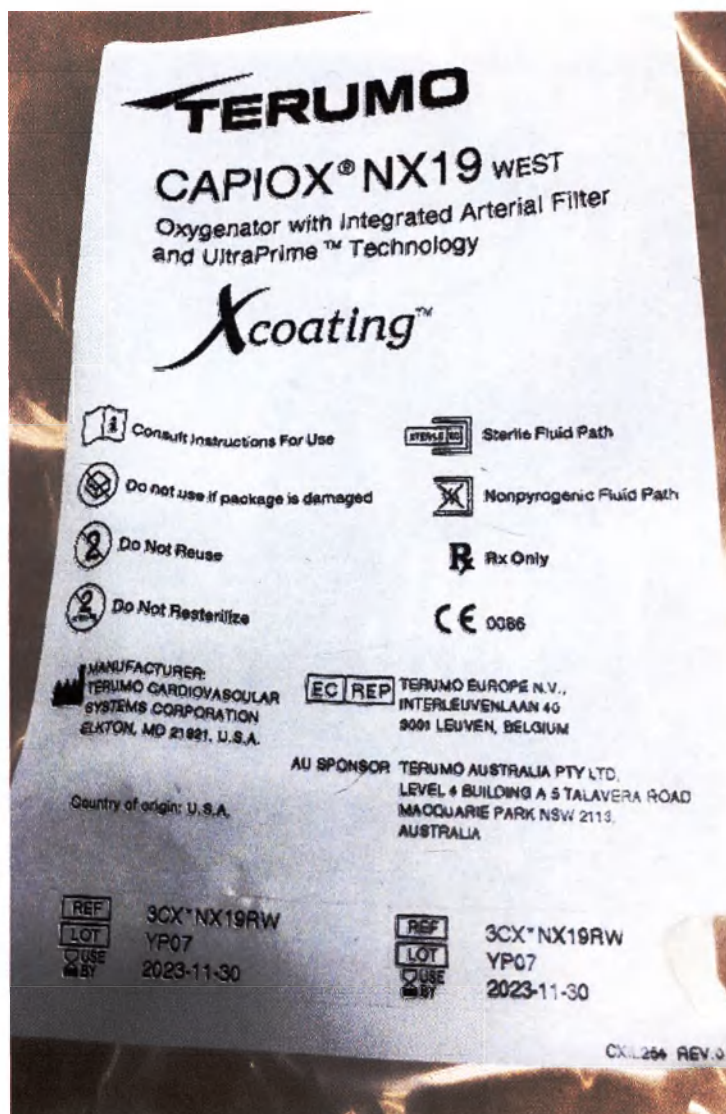


Рис. 4 – маркировка на стерильной упаковке оксигенатора мембранного CAPIOX® NX19 с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром



Рис. 5 - Оксигенатор мембранный CAPIOX® FX15 Advance с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром 3000 мл. Вид спереди.



Рис. 6 - Оксигенатор мембранный CARIOX® FX15 Advance с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром 3000мл. Вид сзади.

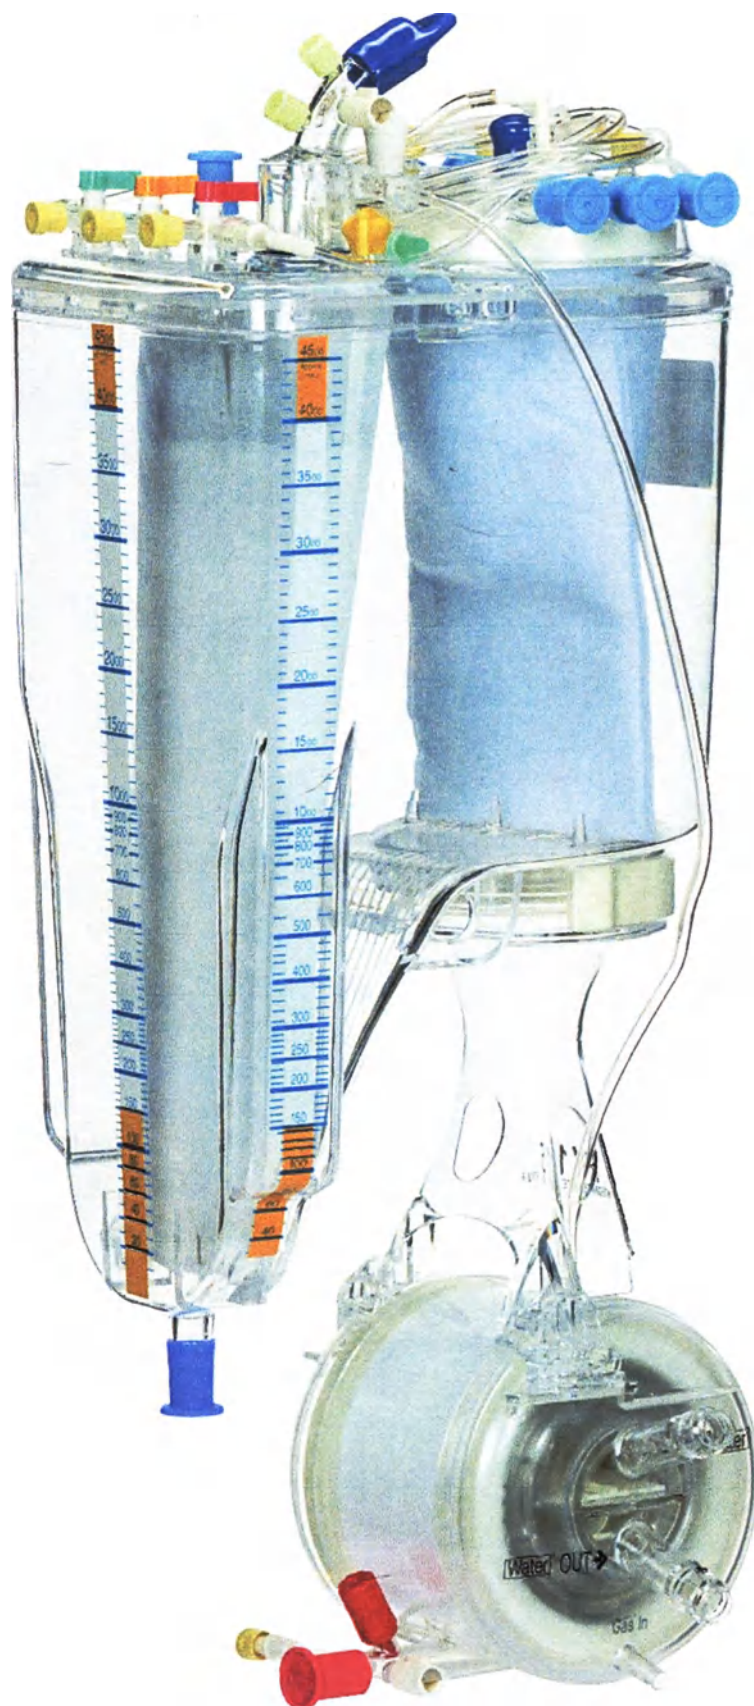


Рис. 7 - Оксигенатор мембранный CAPIOX® FX15 Advance с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром 4000мл.



Рис. 8 - Оксигенатор мембранный CAPIOX® FX15 Advance с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром в стерильной упаковке



Рис. 9 – маркировка на оксигенаторе мембранном CAPIOX® FX15 Advance с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром

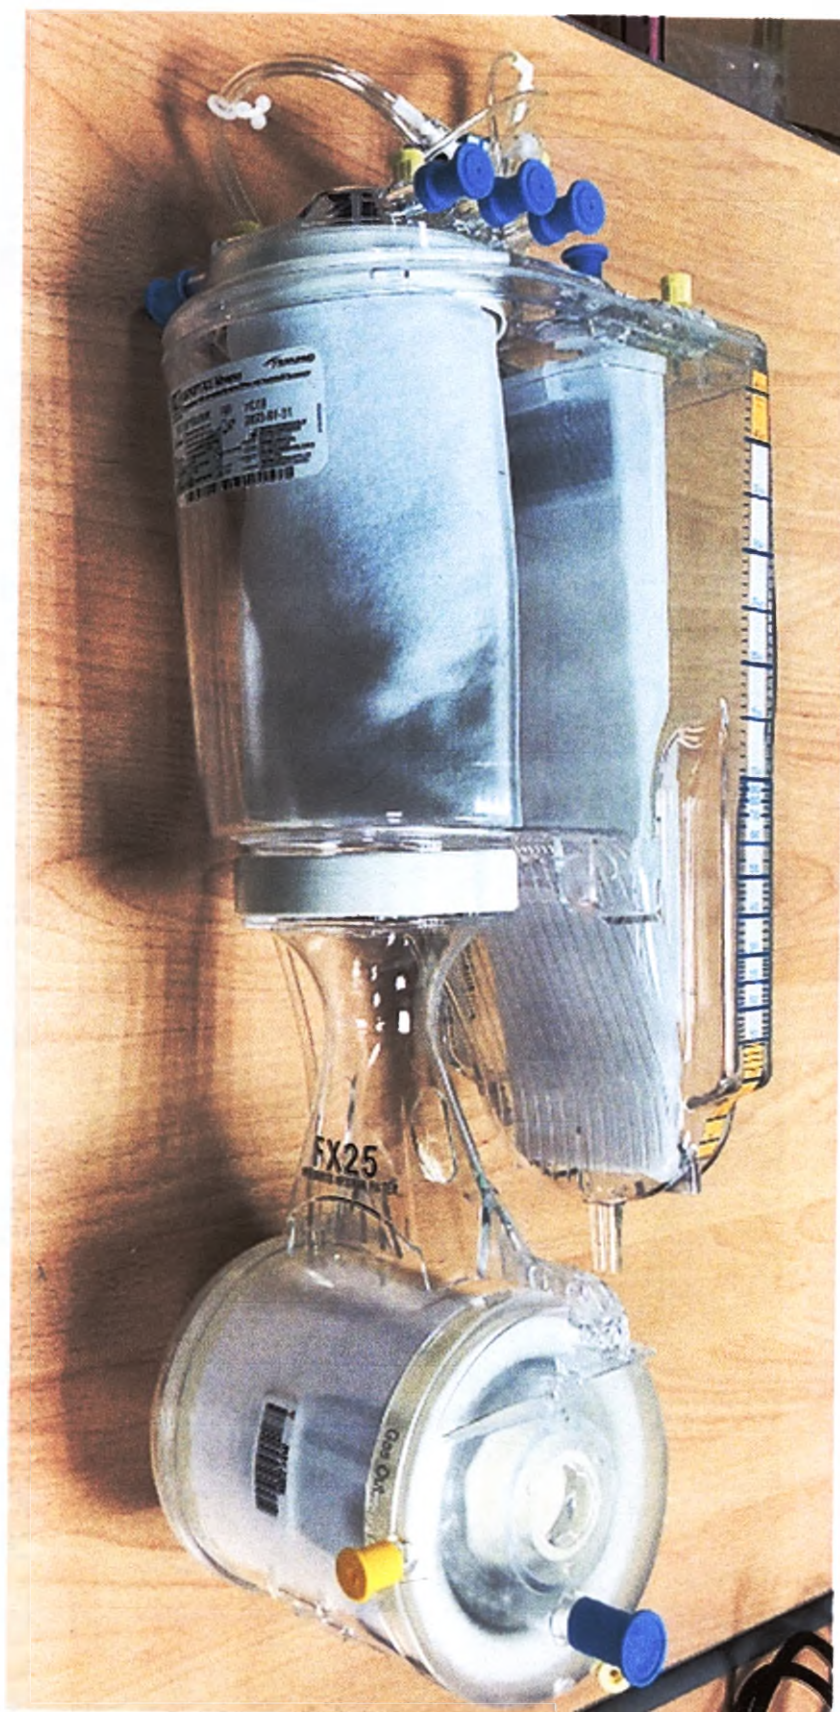


Рис. 10 - Оксигенатор мембранный CAPIOX® FX25 Advantex с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром. Вид спереди.

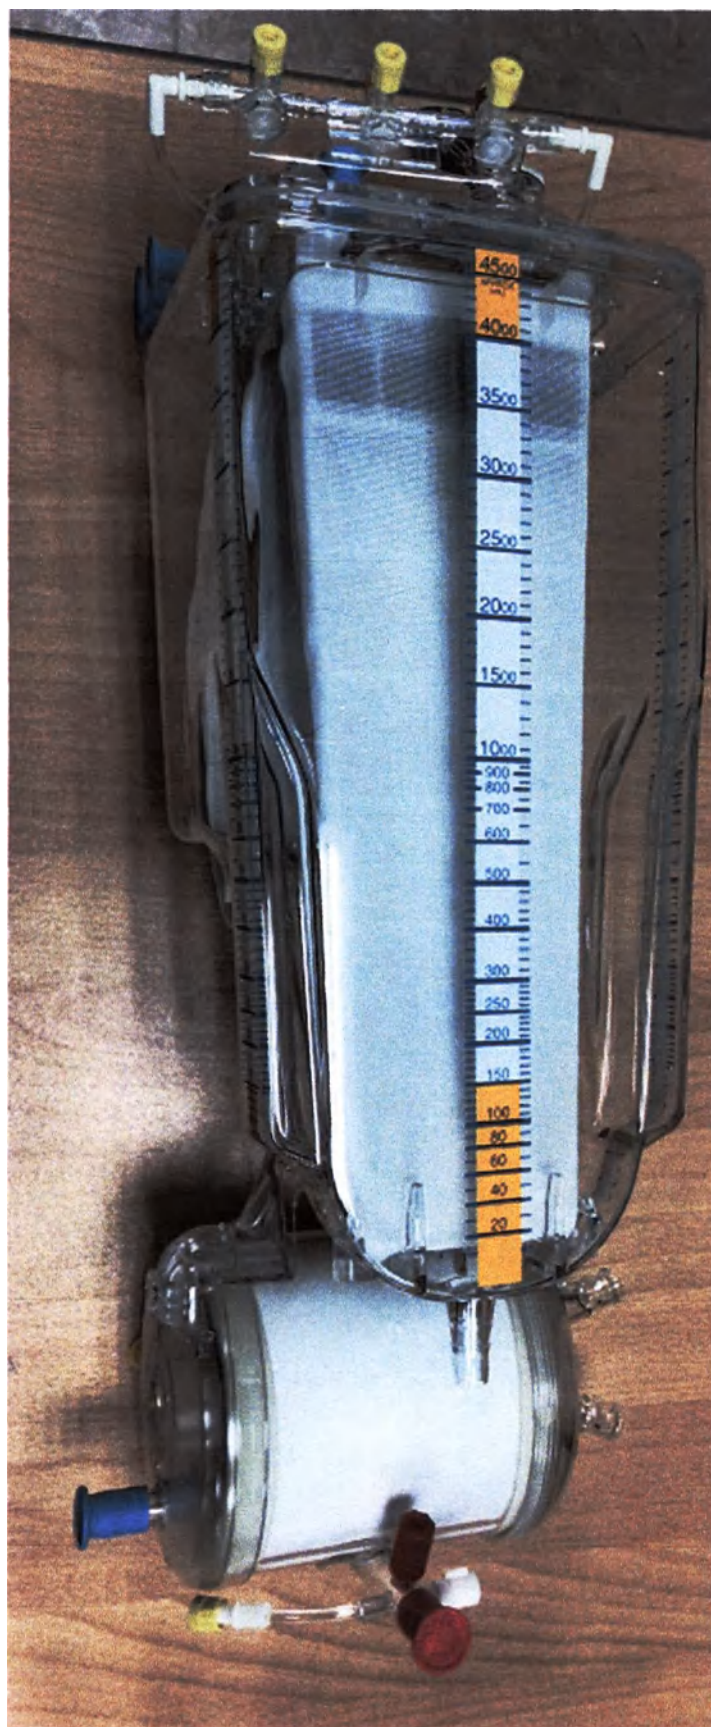


Рис. 11 - Оксигенатор мембранный CAPIOX® FX25 Advance с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром. Вид сзади.



Рис. 12 - Оксигенатор мембранный CARIOX® FX25 Advance с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром в стерильной упаковке

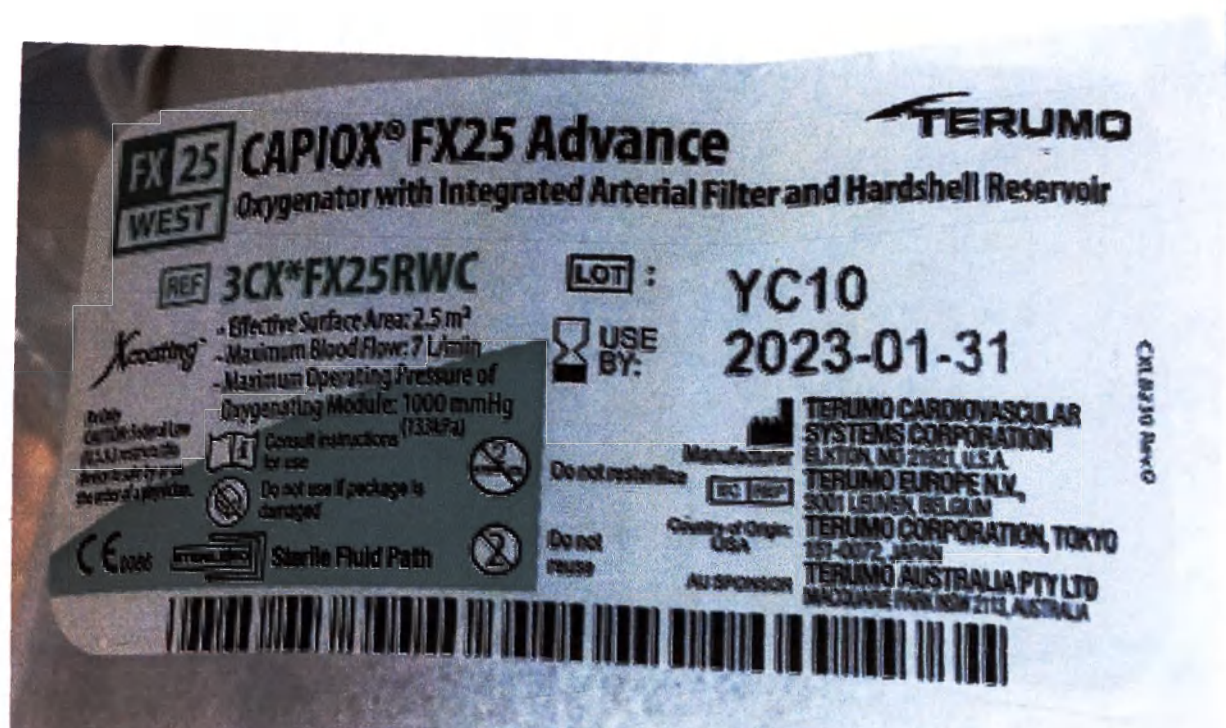


Рис. 13 – маркировка на стерильной упаковке оксигенатора мембранного CAPIOX® FX25 Advance с встроенным артериальным фильтром и жестким резервуаром.

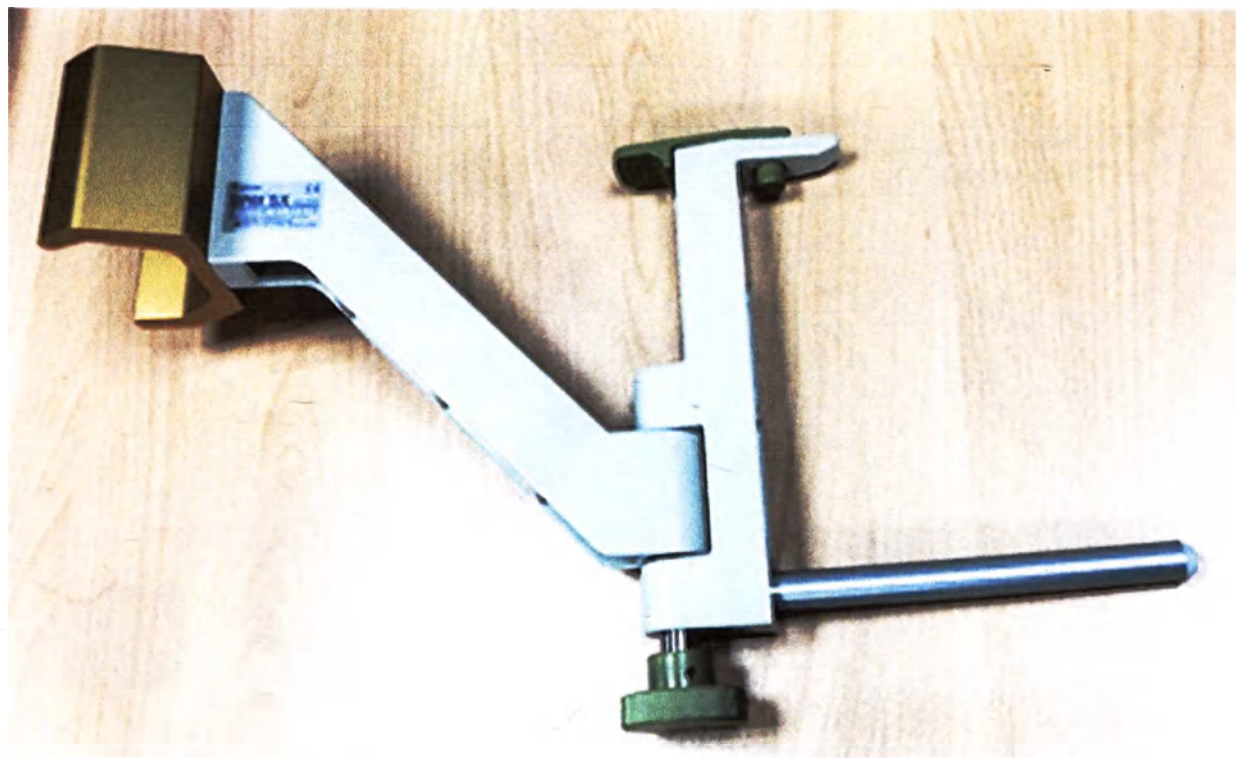


Рис. 14 – Держатель для оксигенатора XX*CXH18R вид спереди



Рис. 15 – Держатель для оксигенатора XX*CXH18R вид в упаковке

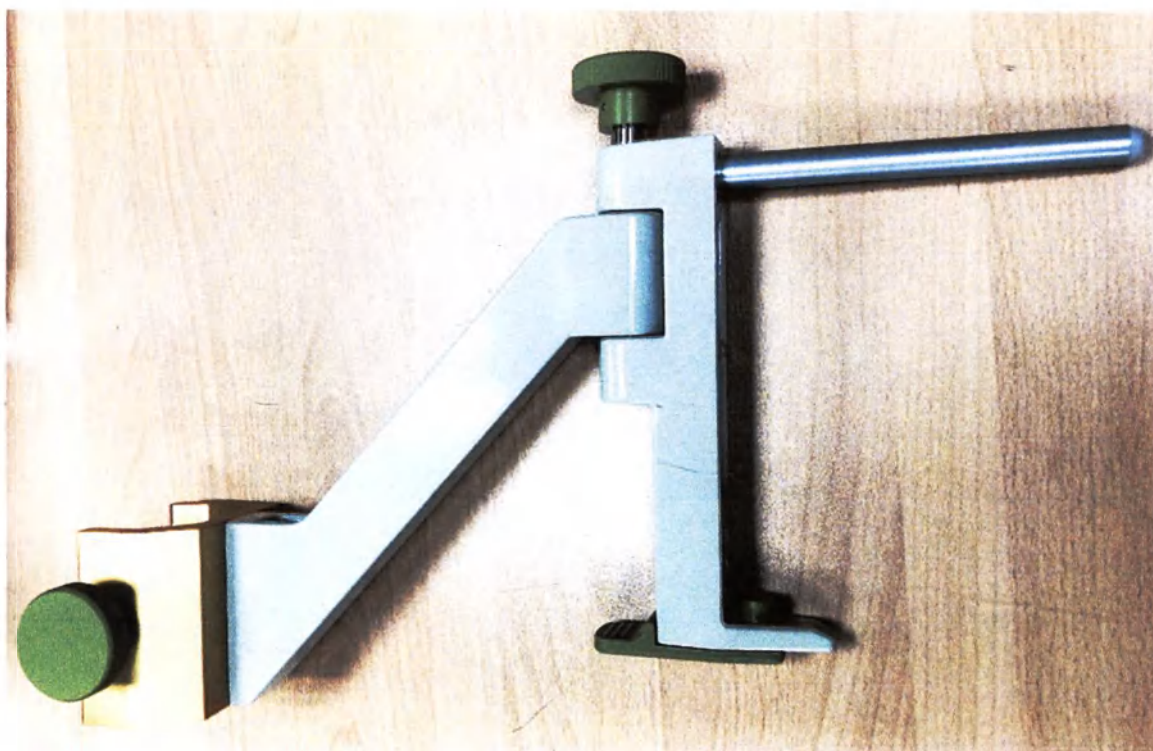


Рис. 16 – Держатель для оксигенатора XX*CXH18R вид сзади



Рис. 17 – Маркировка держателя для оксигенатора XX*CXH18R



Рис. 18 – Держатель для оксигенатора XX* CXH15 вид спереди



Рис. 19 – Держатель для оксигенатора XX* CXH15 в упаковке

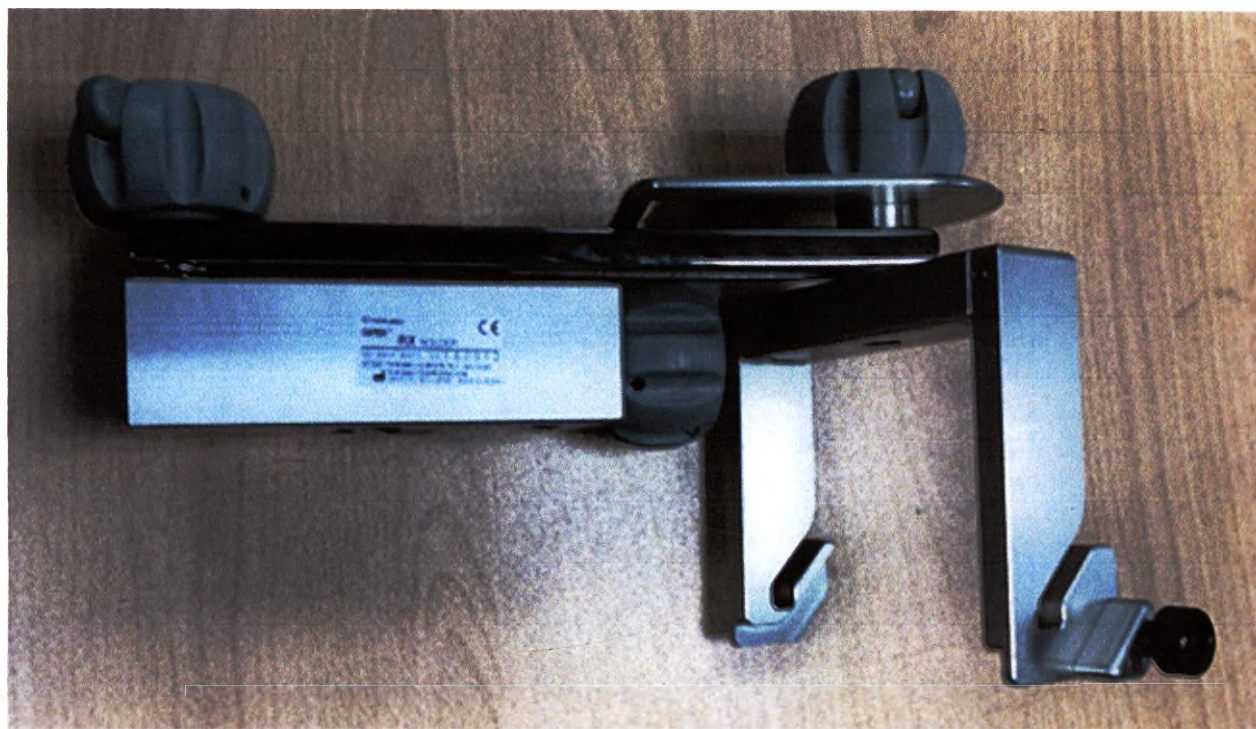


Рис. 20 – Держатель для оксигенатора XX* CXH15 вид сзади



Рис. 21 – Маркировка держателя для оксигенатора XX* CXH15

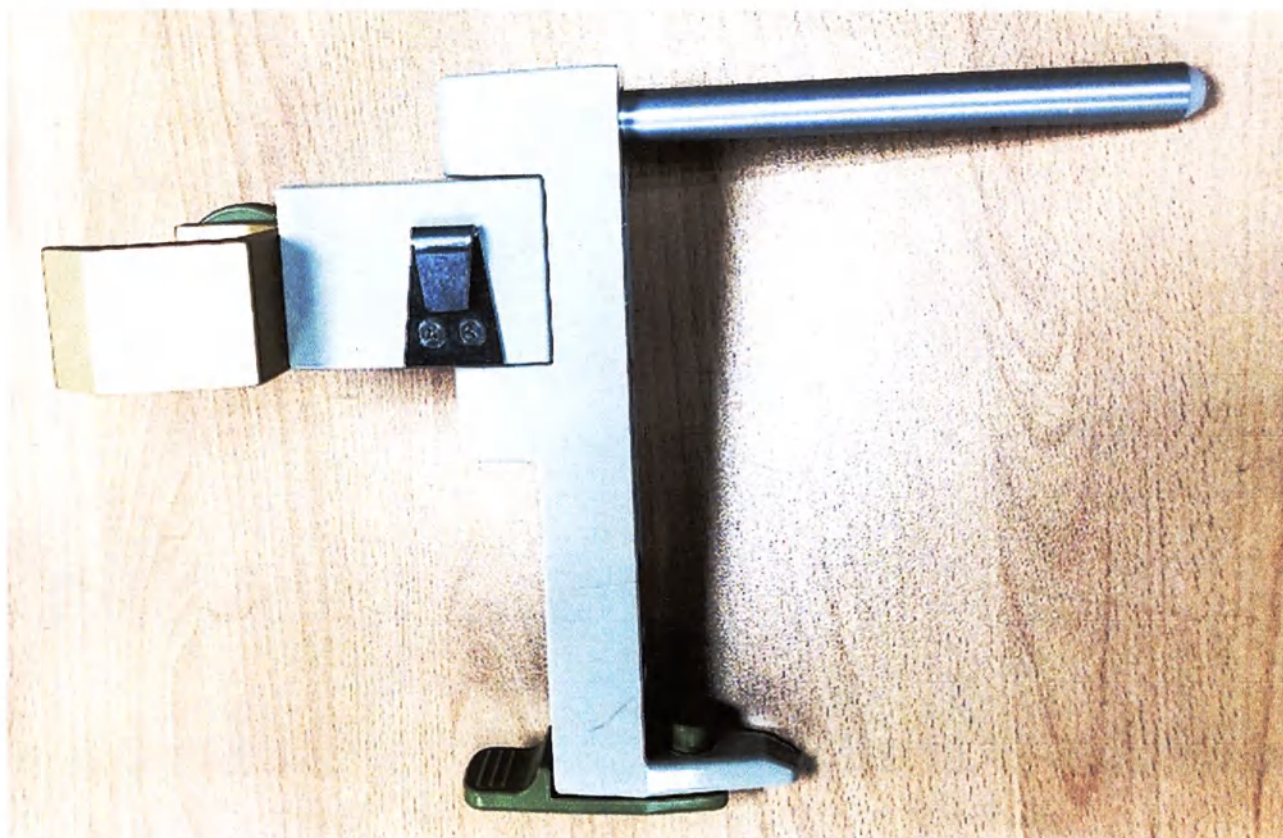


Рис. 22 – Держатель для оксигенатора XX*ХН032, вид спереди



Рис. 23 – Держатель для оксигенатора XX*ХН032, вид в упаковке

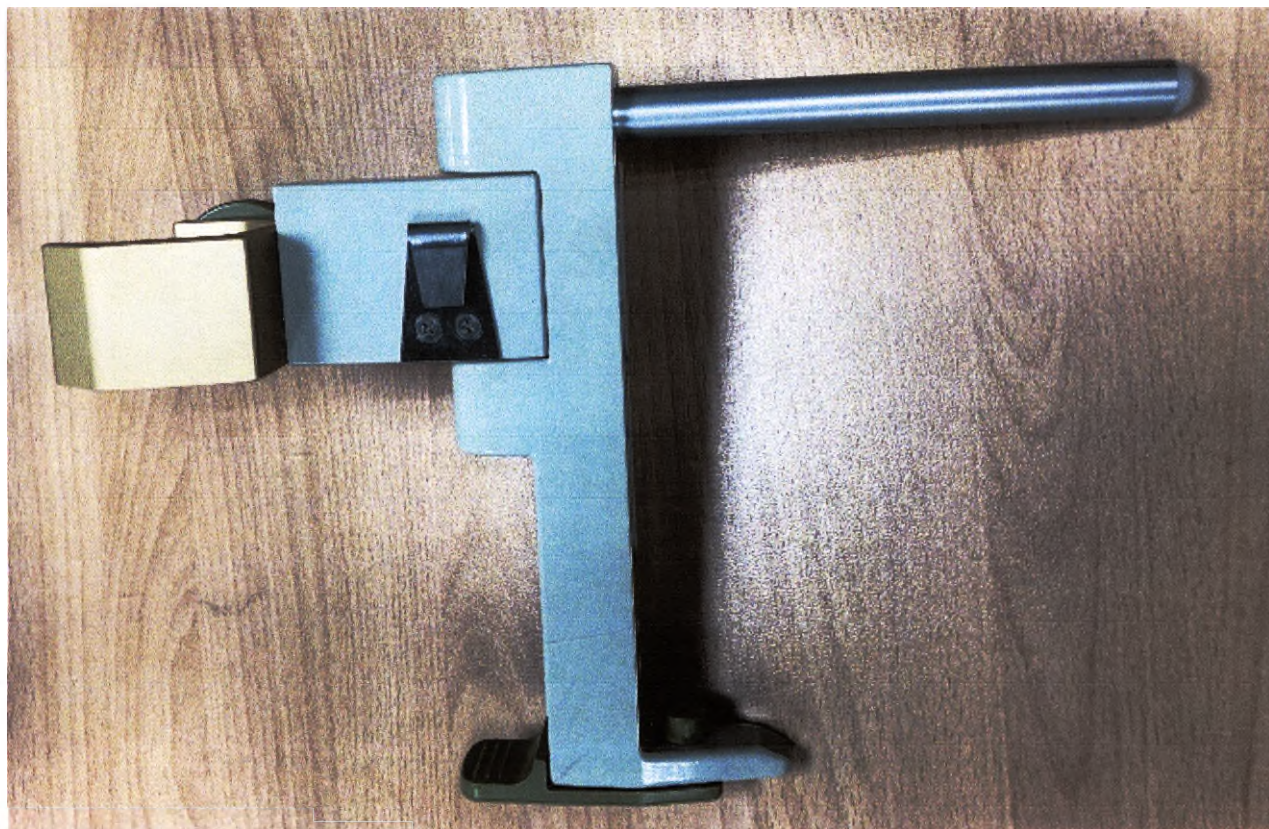


Рис. 24 – Держатель для оксигенатора XX*XH032, вид сзади



Рис. 25 – Маркировка держателя для оксигенатора XX*XH032



Рис. 26 – Держатель для оксигенатора XX*CXH25F, вид спереди



Рис. 27 – Держатель для оксигенатора XX*CXH25F в упаковке

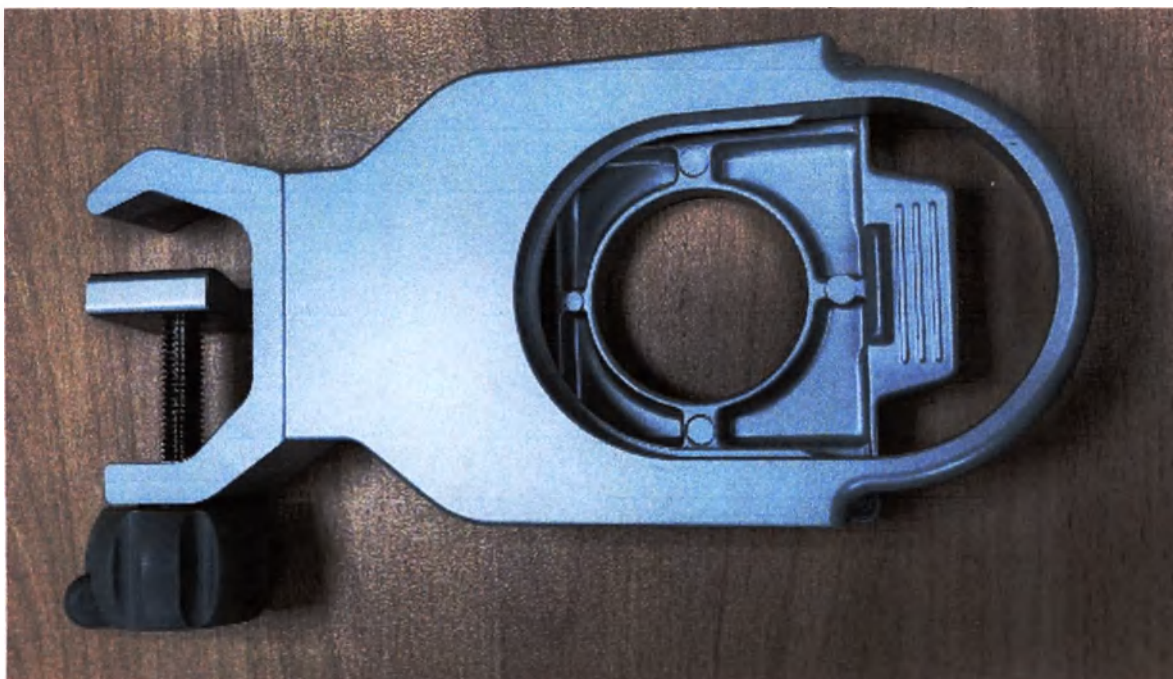


Рис. 28 – Держатель для оксигенатора XX*CXH25F, вид сзади



Рис. 29 – Маркировка держателя для оксигенатора XX*CXH25F

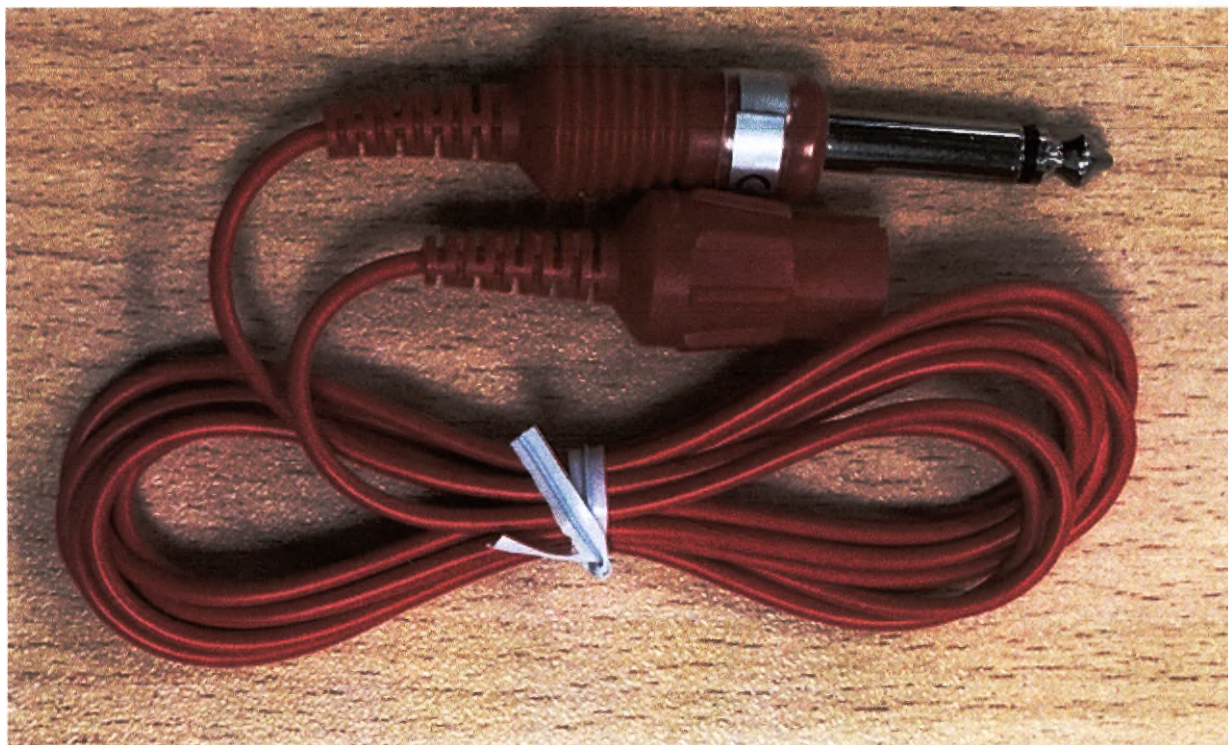


Рис. 32 – Красный кабель термисторного датчика CX*BP022



Рис. 33 – Красный кабель термисторного датчика CX*BP022 в упаковке

Прошито, пронумеровано,

24

листов

скреплено печатью ООО «Терумо Рус»

Генеральный директор

Уэно Минору

