

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Мединтех»



Кутихина Я.А.

2021 г.

АППАРАТ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЦВЕТОТЕРАПИИ NL II
по ТУ 26.60.13-003-29548090-2021

Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия

РАЗРАБОТАНО

Директор

ООО «НВ»



Скибинская Е.Е.

2021 г.

г. Краснодар

2021

1. Маска офтальмологическая





2. Пульт управления



Аппарат офтальмологический для цветотерапии NL II



ООО «Мединтех»
141983, Россия, Московская обл., г. Дубна,
ул. Программистов, д. 4, стр. 4, офис 225



01.2021 г.



4607121040001



IP 30





Мощность, потребляемая аппаратом от сети
переменного тока (220 В, 50 Гц), не более 20 ВА.


Макс. рабочий цикл: 30 мин – работа, 10 мин – пауза.


ТУ 26.60.13-003-29548090-2021

Разъемы на пульте управления

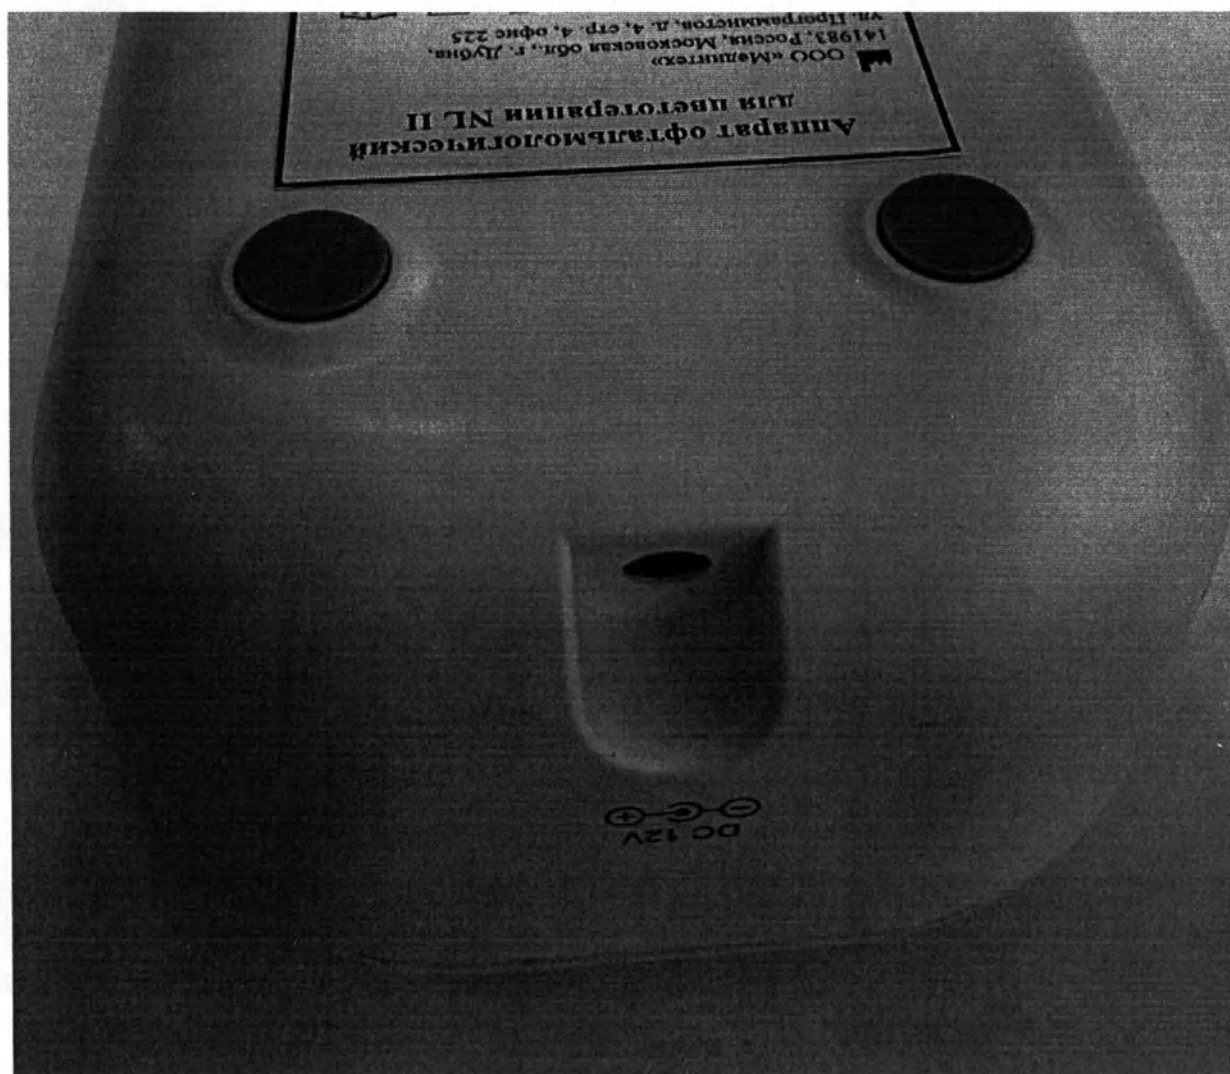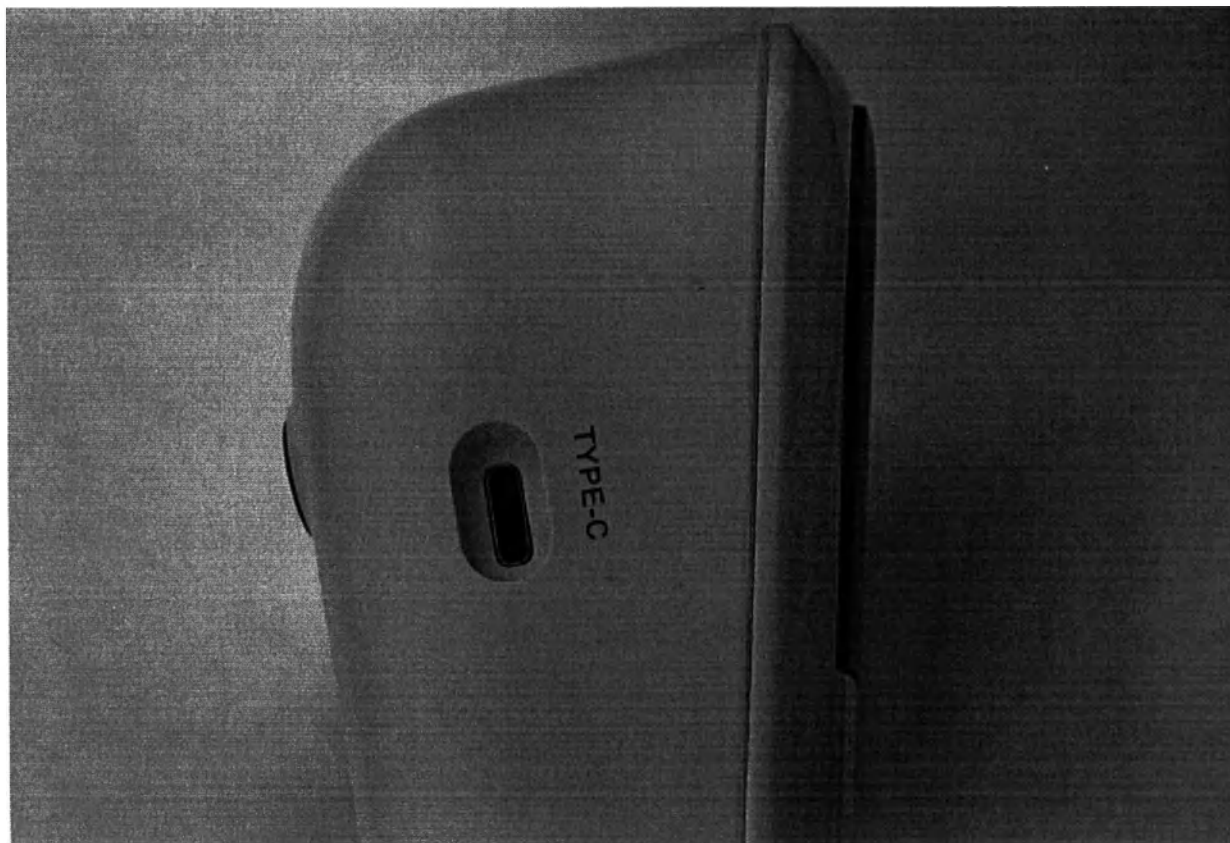

3. Сетевой блок питания

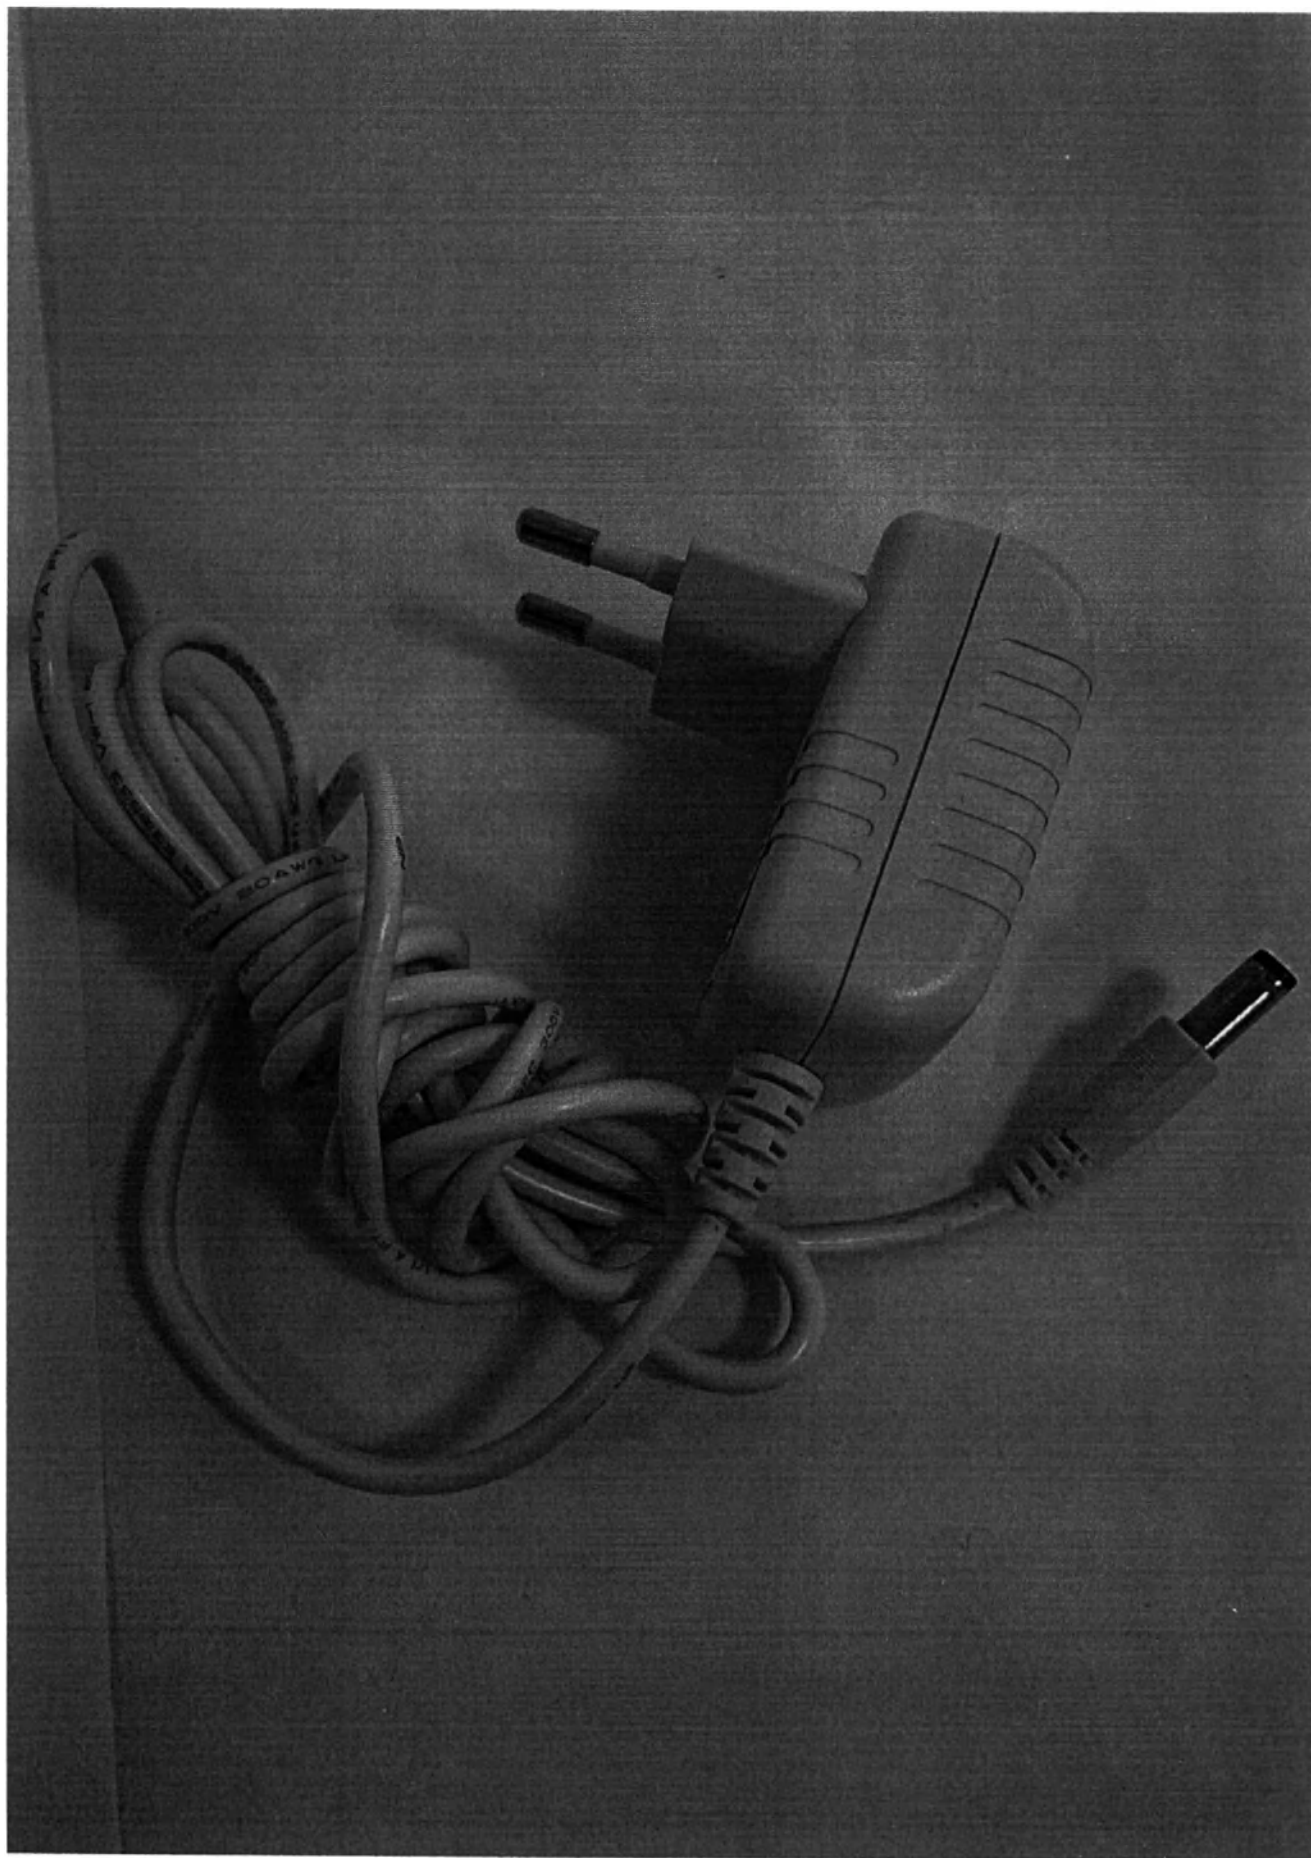

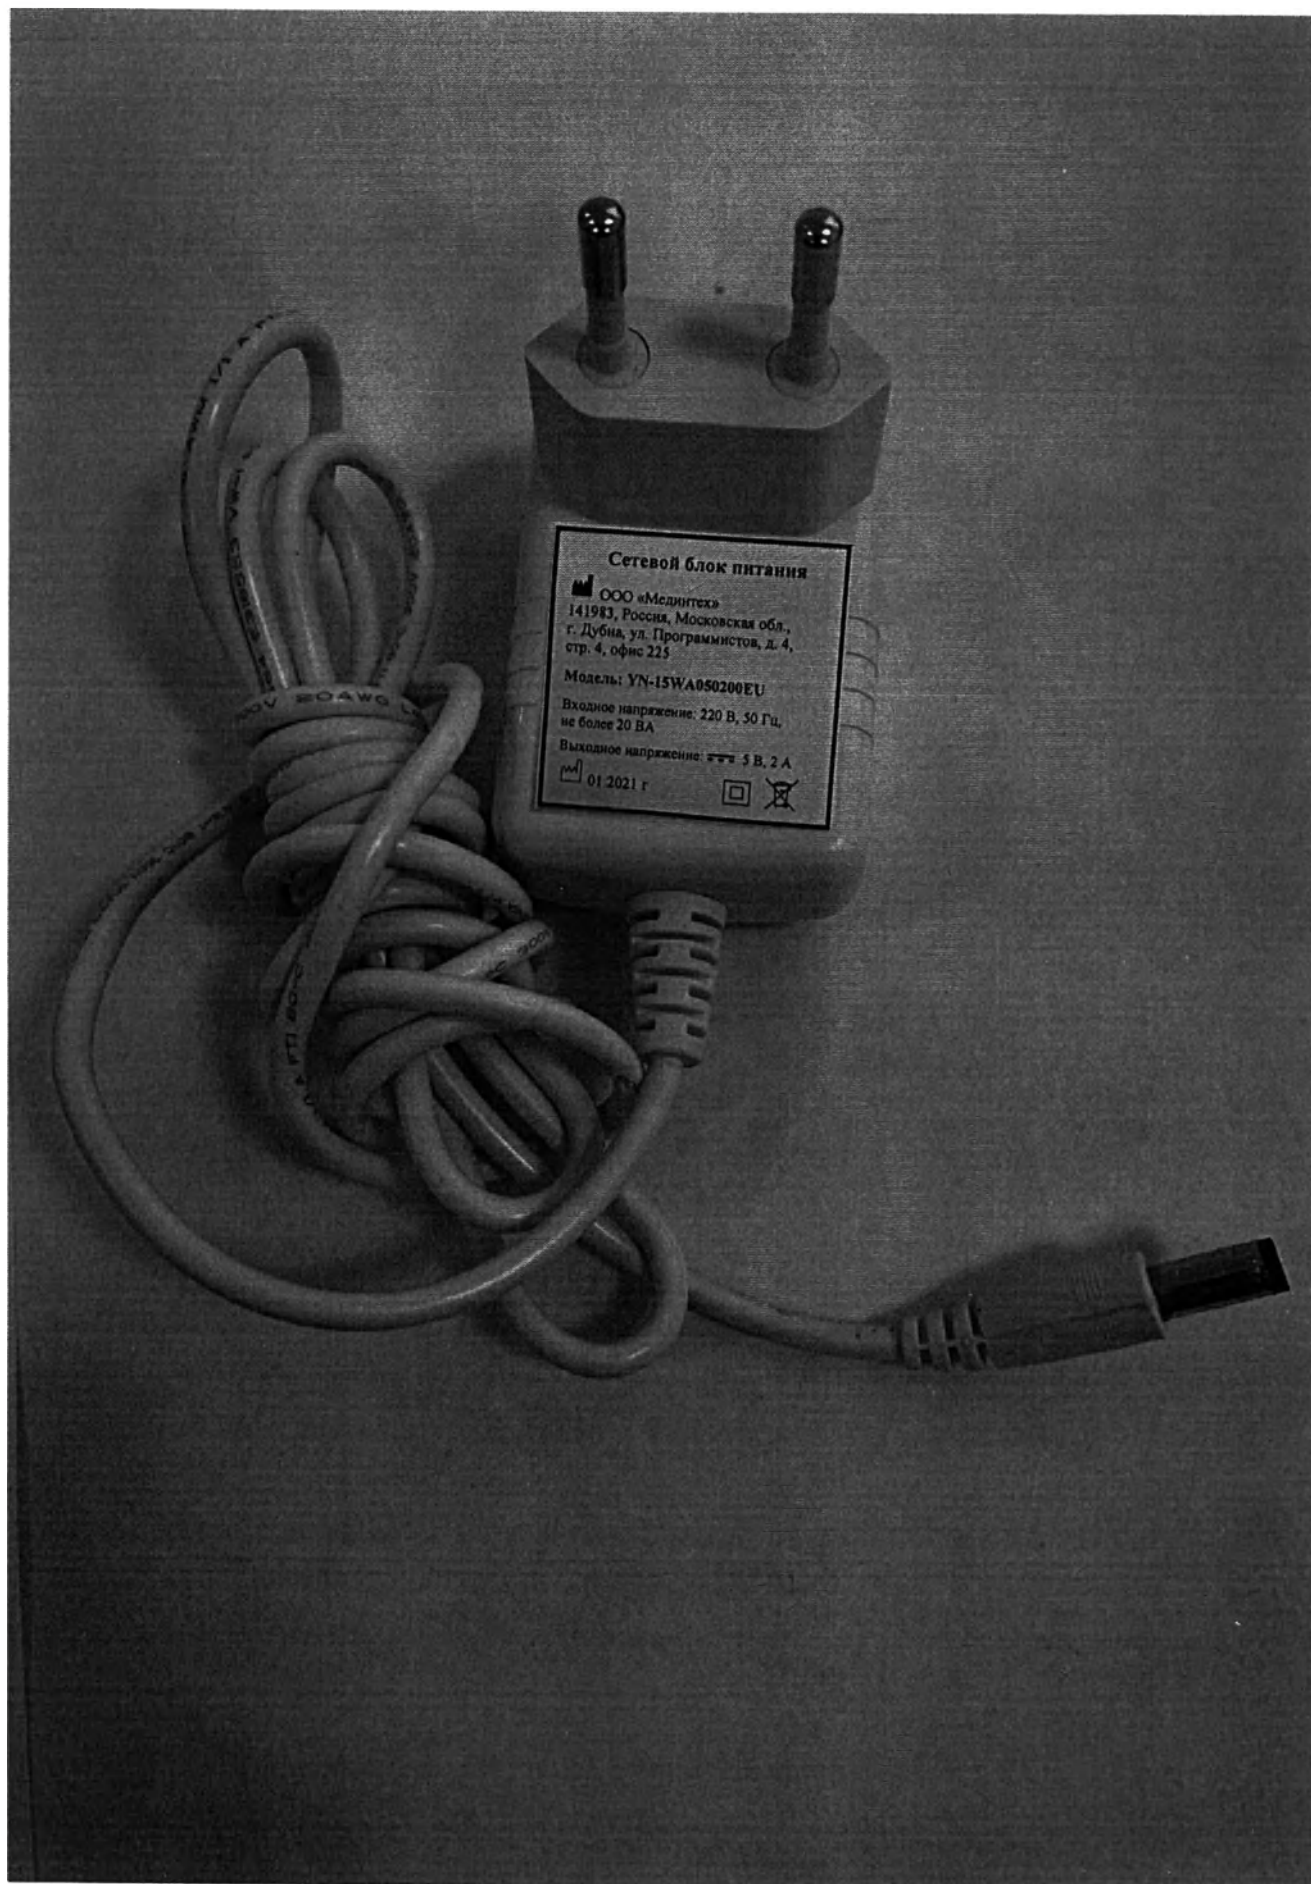

Сетевой блок питания

ООО «Медитех»
141983, Россия, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Программистов, д. 4,
стр. 4, офис 225

Модель: YN-15WA050200EU

Входное напряжение: 220 В, 50 Гц,
не более 20 ВА

Выходное напряжение: $\pm$ 5 В, 2 А

01.2021 г



Маркировка. Аппарат офтальмологический для цветотерапии NL II
по ТУ 26.60.13-003-29548090-2021

Маркировка. Пульт управления

Аппарат офтальмологический для цветотерапии NL II



ООО «Мединтех»
141983, Россия, Московская обл., г. Дубна,
ул. Программистов, д. 4, стр. 4, офис 225



01.2021 г.



4607121040001



IP 30



Мощность, потребляемая аппаратом от сети
переменного тока (220 В, 50 Гц), не более 20 ВА.

Макс. рабочий цикл: 30 мин – работа, 10 мин – пауза.

ТУ 26.60.13-003-29548090-2021

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 1
(ПО ГОСТ ИЕС 60825-1-2013)

Длина волны: 650 нм

Сетевой блок питания



ООО «Мединтех»
141983, Россия, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Программистов, д. 4,
стр. 4, офис 225

Модель: YN-15WA050200EU

Входное напряжение: 220 В, 50 Гц,
не более 20 ВА

Выходное напряжение:  5 В, 2 А



01.2021 г



прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 11 (одиннадцать) лист(ов)

Генеральный директор
ООО «МЕДИТЕХ»

Кутикова Я.А.

« 14 » 12 2021 г.

