



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «ОЭЗ «ВладМиВа»
В.П.Чуев
« 14 » 10 2022 г.

Фотографические изображения
общего вида медицинского изделия

**Материал универсальный стоматологический наногибридный реставрационный
«ДентЛайт-нано»
по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021
(Приложение)**

Материал универсальный стоматологический
наногибридный реставрационный «ДентЛайт-нано»

по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

WV
ВЛАДИВА

ДентЛайт-нано

Шприц с пастой (4 г) A2, A3, A3.5, OA2	4 шт
Флакон-капельница с адгезивом (6 г)	1 шт
Шприц с гелем для травления (3 мл)	1 шт
Апликаторы	25 шт
Иглы (канюли)	25 шт
Пластина с лунками	1 шт
Инструкция по применению	1 шт



Производитель:
АО «ВладМиВа»
308023, Россия,
г. Балашиха,
ул. Студенческая, 19
+7 495 200 5555
www.vladmiva.ru

Хранить в сухом, защищенном от света месте
при t от +2°C до +25°C
Срок годности 3 года
ТУ 32.50.50-142-45814830-2021
РУ №



Риск/Угроза
LDT
75 05 2021 01
EXP. 2024 01



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала универсального стоматологического
наногибридного реставрационного
«ДентЛайт-нано»
по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

Стоматологический наногибридный реставрационный материал «ДентЛайт-нано» (далее по тексту - материал) входит в состав стоматологических материалов и комплектуются в виде набора.

Материал предназначен для реставрации и пломбирования фронтальных и боковых зубов, а также для реставрации твердых тканей зубов, восстановления крылышки зуба, замены коронок, временных и постоянных несъемных протезов, а также для реставрации фронтальных и боковых зубов во всех слоях.

Материал «ДентЛайт-нано» предназначен для профессионального использования стоматологами.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Материал «ДентЛайт-нано», шприц с пастой (4 г) - 4 шт. (A2, A3, A3.5, OA2)

Материал универсальный стоматологический
наногибридный реставрационный «ДентЛайт-нано»

по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

ВЛАДМИВА

ДентЛайт-нано

Шприц с пастой (4 г) A2, A3, A3.5, 0A2	4 шт
Флакон-капельница с адгезивом (6 г)	1 шт
Шприц с гелем для травления (3 мл)	1 шт
Аппликаторы	25 шт
Иглы (канюли)	25 шт
Пластина с лунками	1 шт
Инструкция по применению	1 шт



Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия,
г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Хранить в сухом, защищенном от света месте
при t от +2°C до +25°C

Срок годности 3 года
ТУ 32.50.50-142-45814830-2021
РУ №



Packer/
Упаковщик



75 05 2021 01
2024 01

Коробка (увеличено) материала «ДентЛайт-нано», шприц с пастой (4 г) - 4 шт. (A2, A3, A3.5, 0A2)

Материал универсальный стоматологический
наногибридный реставрационный «ДентЛайт-нано»

по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

ВВ
ВЛАДМИВА

ДентЛайт-нано

Шприц с пастой (4 г) A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, OA2	8 шт
Флакон-капельница с адгезивом (6 г)	1 шт
Шприц с гелем для травления (3 мл)	1 шт
Апликаторы	25 шт
Иглы (канюли)	25 шт
Пластина с лунками	1 шт
Инструкция по применению	1 шт



Производитель:
АО «ОЗ» «Знахарин»
304023, Россия
г. Белгород
ул. Стромынский, 19
+7 4722 204-535

www.vladmiva.ru

Хранить в сухом, защищенном от света месте
при +5°C до +25°C

Срок годности 3 года
ТУ 32.50.50-142-45814830-2021
РУ №



Решет / Упаковка

LOT W

75 03 2021 01
EXP 2024 01



Материал «ДентЛайт-нано», шприц с пастой (4 г) - 8 шт. (A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, OA2)

Материал универсальный стоматологический
наногибридный реставрационный «ДентЛайт-нано»

по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

ВЛАДМИВА

ДентЛайт-нано

Шприц с пастой (4,5 г) A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, C3, OA2	8 шт
Флакон-капельница с адгезивом (6 г)	1 шт
Шприц с гелем для травления (3 мл)	1 шт
Аппликаторы	25 шт
Иглы (канюли)	25 шт
Пластина с лунками	1 шт
Инструкция по применению	1 шт



Применитель:
АО «ВЗЛ» «ВладМива»
300003, Россия,
г. Белгород
ул. Студенческая, 16
+7 4722 200-555

Хранить в сухом, защищенном от света месте
при t от +2°C до +25°C
Срок годности 3 года
ТУ 32.50.50-142-45814830-2021
РФ №



Регистр
Удостоверение
LOT
75 02 2021 01
EXP. 2024 01



Материал «ДентЛайт-нано», шприц с пастой (4,5 г) - 8 шт. (A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, C3, OA2)

Материал универсальный стоматологический
наногибридный реставрационный «ДентЛайт-нано»

по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

ВЛАДМИВА

ДентЛайт-нано

Шприц с пастой (4 г) A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, C3, OA2, D2, D3, E1, E2	12 шт
Флакон-капельница с адгезивом (6 г)	1 шт
Шприц с гелем для травления (3 мл)	1 шт
Аппликаторы	25 шт
Иглы (канюли)	25 шт
Пластина с лунками	1 шт
Инструкция по применению	1 шт




Производитель:
АО «СЗТ «ВладМива»
308023, Россия
г. Белгород
ул. Студенческая, 79
т: 4722 200 555
www.vladmiva.ru

Хранить в сухом, защищенном от света месте
при t от -2°C до +25°C
Срок годности 3 года
ТУ 32.50.50-142-45814830-2021
РФ №



Рестав.
Упаковка
LOT
75 06 2021 01
EXP 2024 01



Материал «ДентЛайт-нано», шприц с пастой (4 г) - 12 шт. (A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, C3, OA2, D2, D3, E1, E2)

Материал универсальный стоматологический
наногибридный реставрационный «ДентЛайт-нано»
по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

ВЛАДМИВА

ДентЛайт-нано

Шприц с пастой (4,5 г) A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, C3, OA2, D2, D3, E1, E2	12 шт
Флакон-капельница с адгезивом (6 г)	1 шт
Шприц с гелем для травления (3 мл)	1 шт
Апликаторы	25 шт
Иглы (канюли)	25 шт
Пластина с лунками	1 шт
Инструкция по применению	1 шт



Производитель:
АО «ЦРМИ» «Владмива»
309023, Россия,
г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200 535
www.vladmiva.ru

Хранить в сухом, защищенном от света месте
при $+2^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$
Срок годности 3 года
ТУ 32.50.50-142-45814830-2021
РУ №



Риски/
Упак.
75 07 2021 01
EXP 2024 01

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала универсального стоматологического
наногибридного реставрационного
«ДентЛайт-нано»
по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021
Универсальный реставрационный материал «ДентЛайт-нано» (далее по
тексту - материал) предназначен для восстановления утраченных тканей
зубов, а также для реставрации и пломбирования эстетичных и функциональных
зубов. Материал применяется для реставрации передних и задних зубов, а также
для реставрации коронок, мостов, протезов, а также для реставрации
зубов, имеющих дефекты окклюзии и формы зубов на всех этапах
реставрации. Материал «ДентЛайт-нано» не требует дополнительной
полировки.



Материал «ДентЛайт-нано», шприц с пастой (4,5 г) - 12 шт. (A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, C3, OA2, D2, D3, E1, E2)

Материал универсальный стоматологический
наногибридный реставрационный «ДентЛайт-нано»
по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

ВЛАДМИВА

ДентЛайт-нано

Шприц с пастой (4,5 г) A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, C3, D2, D3, OА2, E1, E2, OВ2, TE, TA, T	16 шт
Флакон-капельница с адгезивом (6 г)	1 шт
Шприц с гелем для травления (3 мл)	1 шт
Аппликаторы	25 шт
Игла (картридж)	25 шт
Пластина с лунками	1 шт
Инструкция по применению	1 шт




Полное наименование:
АО «ЦИРМИ»
240001, Рязань,
г. Беляевка
ул. Трудовой славы 19
т/ф 4722 059-500

Хранить в герметичной упаковке до срока годности
при t от +5°C до +25°C
Срок годности 2 года
ТУ 32.50.50-142-45814830-2021
Р/М




Рестав.
Владмива
75 09 2021 01
EXP 2024 01



Инструкция по применению
наногибридного реставрационного материала «ДентЛайт-нано»
по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

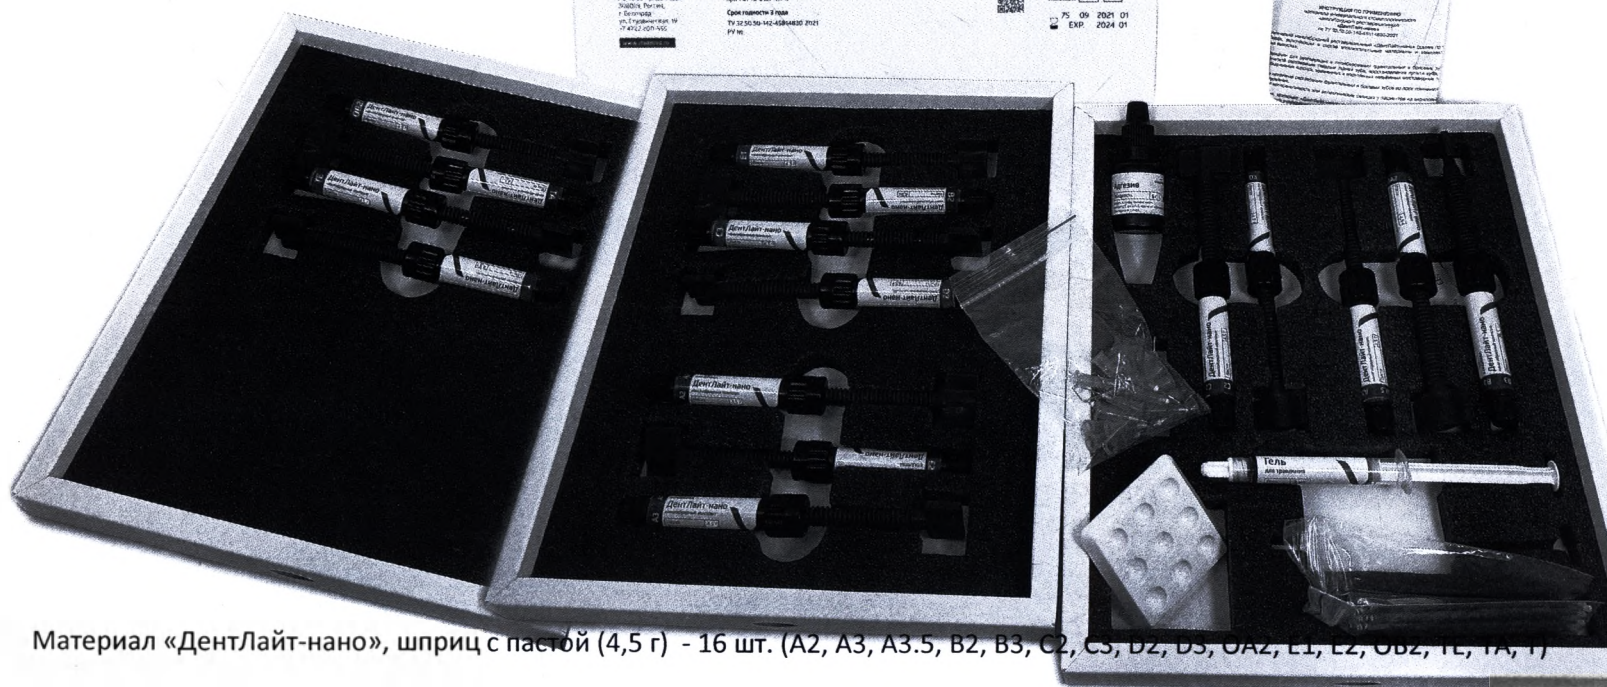



Материал «ДентЛайт-нано», шприц с пастой (4,5 г) - 16 шт. (A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, C3, D2, D3, OА2, E1, E2, OВ2, TE, TA, T)

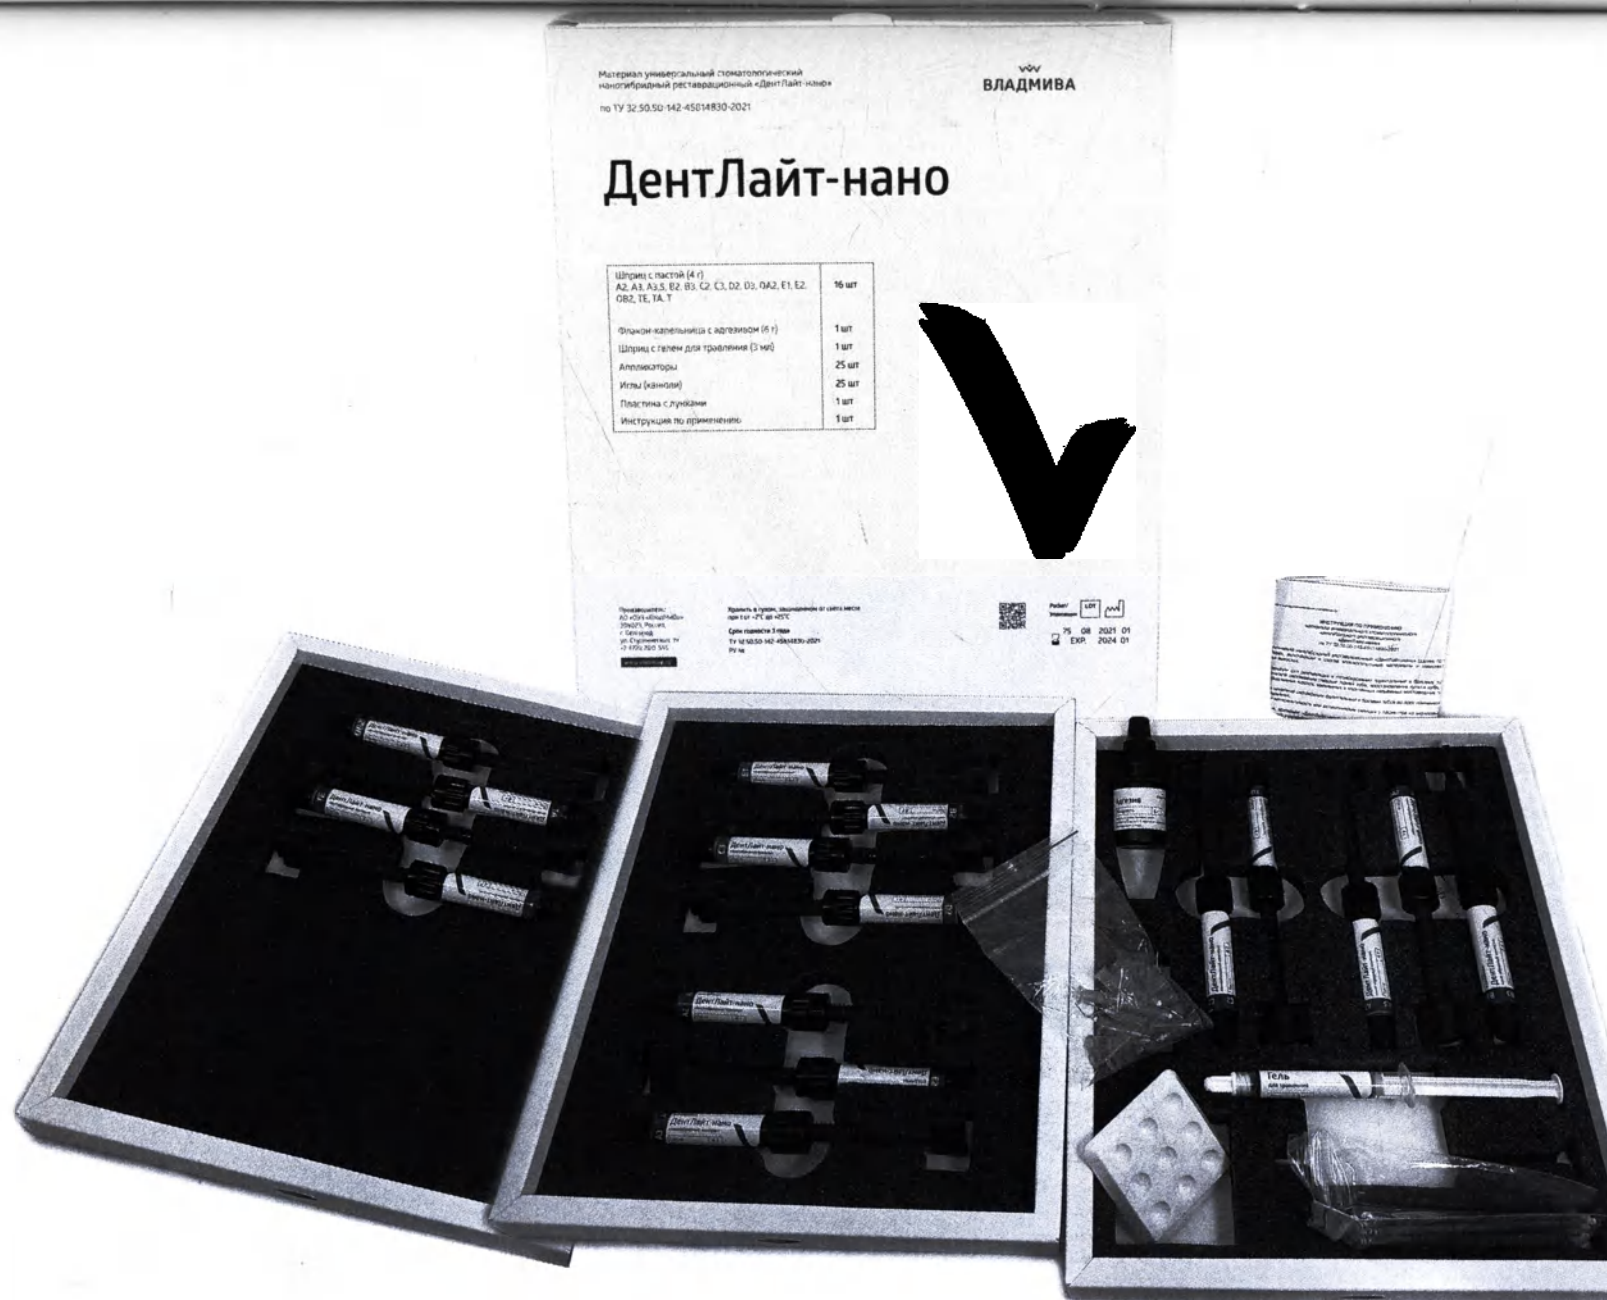

Материал «ДентЛайт-нано», шприц с пастой (4 г) - 16 шт. (A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, C3, D2, D3, OA2, E1, E2, OB2, TE, TA, T)

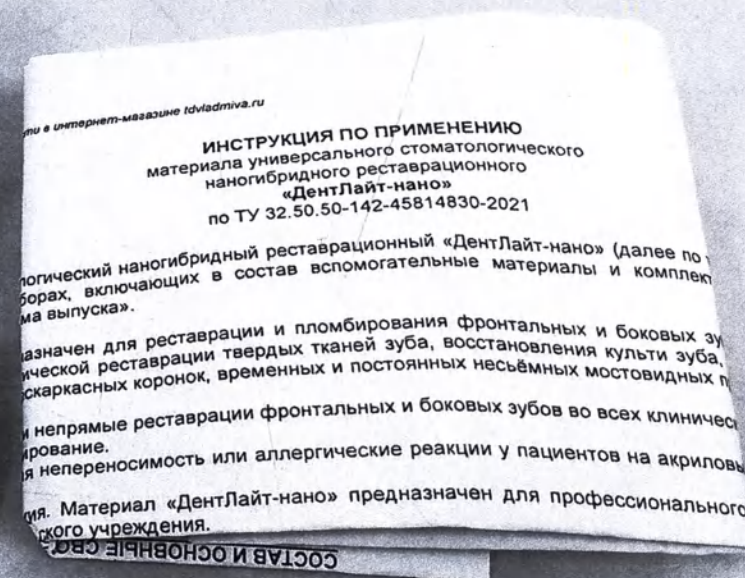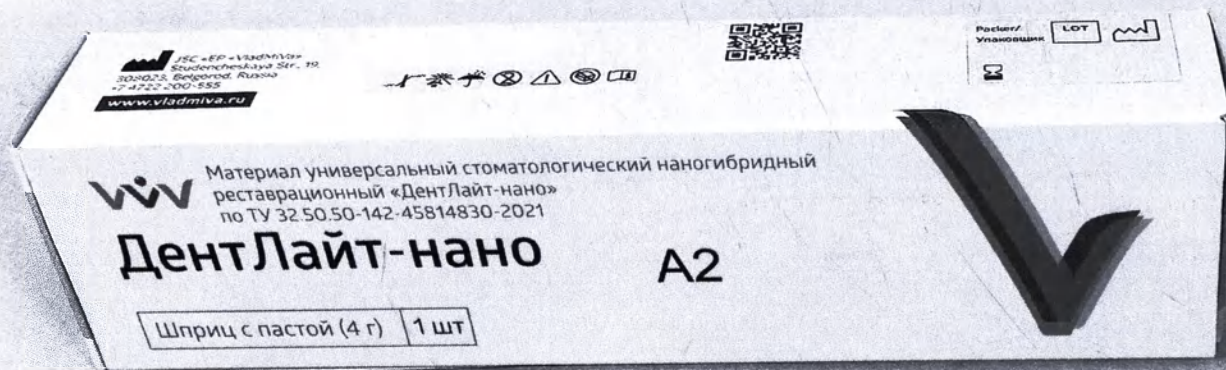

Материал «ДентЛайт-нано», шприц с пастой (4 г) - 1 шт. (A2)

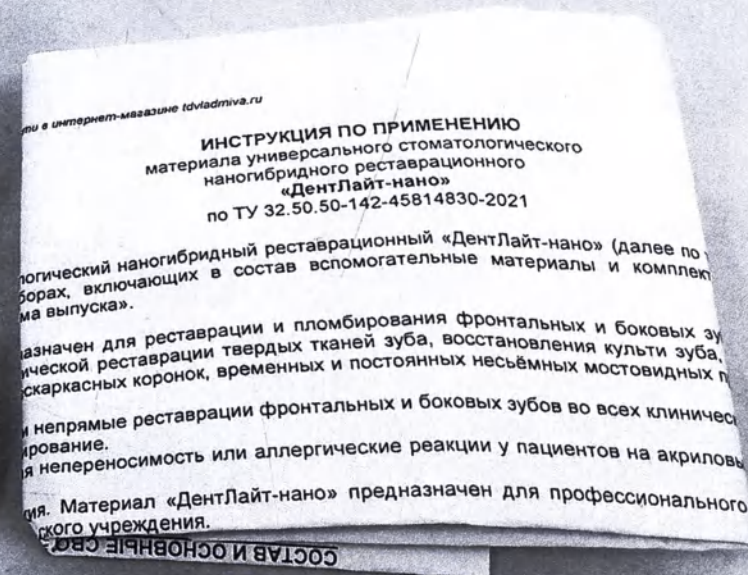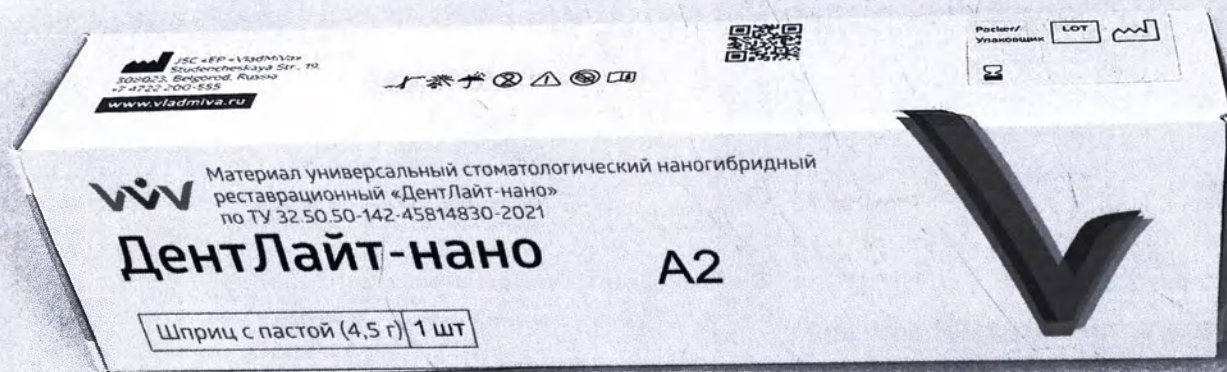

Материал «ДентЛайт-нано», шприц с пастой (4,5 г) - 1 шт. (A2)

асти в интернет-магазине fdvlab.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ материала универсального стоматологического наногибридного реставрационного «ДентЛайт-нано» по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

огический наногибридный реставрационный «ДентЛайт-нано» (далее р
вборах, включающих в состав вспомогательные материалы и комп
рма выпуска».

ачен для реставрации и пломбирования фронтальных и боковых зубов
реставрации твердых тканей зуба, восстановления культи зуба, изгото
сных коронок, временных и постоянных несъемных мостовидных пр


непрямые реставрации фронтальных и боковых зубов во всех клинич
нирование.

непереносимость или аллергические реакции у пациентов на акрило

я. Материал «ДентЛайт-нано» предназначен для профессионально
ического учреждения.

рентгеноконтрастным полимерным композитом светового отверждения
тс отдельным изделием и в наборах, включающих в состав вспомога
гель для травления, аппликаторы, иглы, пластина с лунками.

одится в виде рентгеноконтрастной композитной пасты светового от
(BIS-GMA, UDMA, PGDMA, BIS-EMA, TEGMA, TMPTA), а также р
, 0,2-3 мкм), наноразмерные поверхностно-модифицированные част
наполнитель (0,1-10 мкм), фотоинициаторы, стабилизаторы, крас
мас.% (или 62-68 объем.%). Материал «ДентЛайт-нано» выпускается
3; UD; эмали - E0, E1; E2; E3; E4; опаловых - OA2; OA3, OA3,5; OB
синий), TG (серый), TA (янтарный), отбеленных: W; OW; WD, (X)WB, (X
и 400-500 нм. Материал легко моделируется, не липнет к инструменту
иала «ДентЛайт-нано»: обладает рентгеноконтрастностью; чувствитель

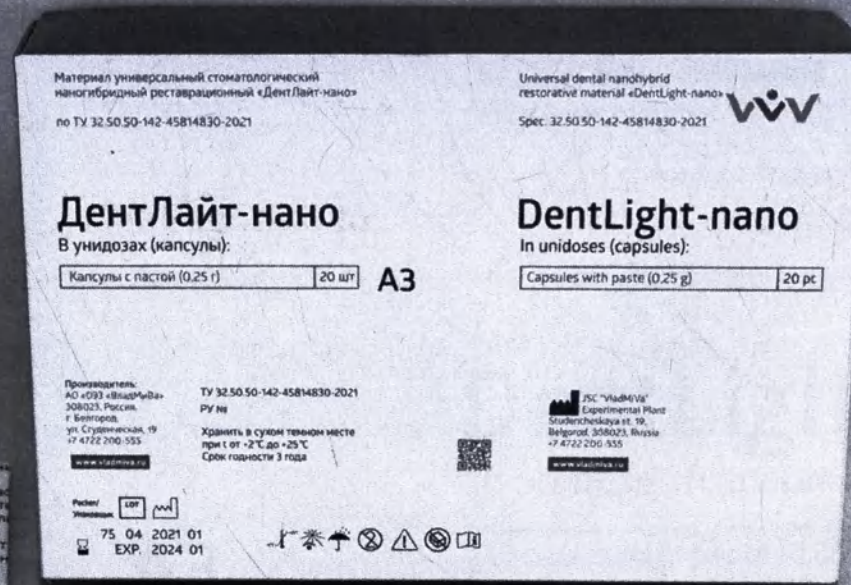

Материал «ДентЛайт-нано», в унидозах (капсулы), 0,25 г - 20 шт. (A3)

Материал универсальный стоматологический
наногибридный реставрационный «ДентЛайт-нано»

по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

Universal dental nanohybrid
restorative material «DentLight-nano»



Spec. 32.50.50-142-45814830-2021

ДентЛайт-нано

В унидозах (капсулы):

Капсулы с пастой (0,25 г)

20 шт

A3

DentLight-nano

In unidoses (capsules):

Capsules with paste (0,25 g)

20 pc

Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия,
г. Белгород,
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

ТУ 32.50.50-142-45814830-2021
ПУ №

Хранить в сухом темном месте
при t от +2°C до +25°C
Срок годности 3 года



JSC "VladMiVa"
Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Пакет/
Упаковка



75 04 2021 01



EXP. 2024 01



Коробка (увеличено) материала «ДентЛайт-нано», в унидозах (капсулы), 0,25 г - 20 шт. (A3)

Коробка (увеличено) материала «ДентЛайт-нано», в унидозах (капсулы), 0,25 г - 20 шт. (A3)

Материал универсальный
стоматологический наногибридный
реставрационный «ДентЛайт-нано»
по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

Universal dental nanohybrid
restorative material «DentLight-nano»
Spec 32.50.50-142-45814830-2021



ДентЛайт-нано

DentLight-nano

В унидозах (капсулы):

Капсулы с пастой (0,25 г) 0A3.5, A2, A3, B2, B3, C2, C3, D2, D3, E1, E2, OB2	80 шт
Флакон-капельница с адгезивом (5 мл)	1 шт
Шприц с гелем для травления (3 мл)	1 шт
Аппликаторы	25 шт
Иглы (канюли)	25 шт
Пластина с лунками	1 шт
Диспенсер для нанесения материала	1 шт
Инструкция по применению	1 шт

In unidoses (capsules):

Capsules with paste (0.25 g) 0A3.5, A2, A3, B2, B3, C2, C3, D2, D3, E1, E2, OB2	80 pc
Flask-dropper with adhesive (5 ml)	1 pc
Syringe with etching gel (3 ml)	1 pc
Applicators	25 pc
Needles (cannulas)	25 pc
Plate with holes	1 pc
Dispenser for material application	1 pc
Instruction for use	1 pc

Производитель:
АО «ЦДЗ «Биофарма»
390017, Россия,
г. Белгород,
ул. Студенческая, 19
т: 4732-200-853

Хранить в сухом темном месте
при t от +2°C до +25°C
Срок годности 3 года

ТУ 32.50.50-142-45814830-2021
РТУ

АО «ЦДЗ «Биофарма»
Белгородский ОУ, г. Белгород,
ул. Студенческая, 19
т: 4732-200-853

Store in a dry and dark place
at t of +2°C to +25°C
3 years shelf life

Риски/Угрозы: 75 05 2021 01
EKF 2024 01

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


Материал «ДентЛайт-нано» (далее - материал) предназначен для реставрации фронтальных и боковых зубов, а также для восстановления культи зубов, изготовления временных и постоянных несъемных протезов, реставрации фронтальных и боковых зубов во всех клинических случаях, требующих или не требующих реакции на этикетирование.

Материал «ДентЛайт-нано» предназначен для профессионального использования.

Материал «ДентЛайт-нано» представляет собой светово отверждаемый наногибридный материал, состоящий из смеси наночастиц, микрозаполнителей, адгезивов, инициаторов, пигментов, пластификаторов, а также других компонентов, обеспечивающих оптимальные свойства материала.

Материал «ДентЛайт-нано» имеет следующие характеристики:

- Формы выпуска: 0A3.5, A2, A3, B2, B3, C2, C3, D2, D3, E1, E2, OB2.
- Материал «ДентЛайт-нано» имеет следующие характеристики:
- Материал «ДентЛайт-нано» имеет следующие характеристики:

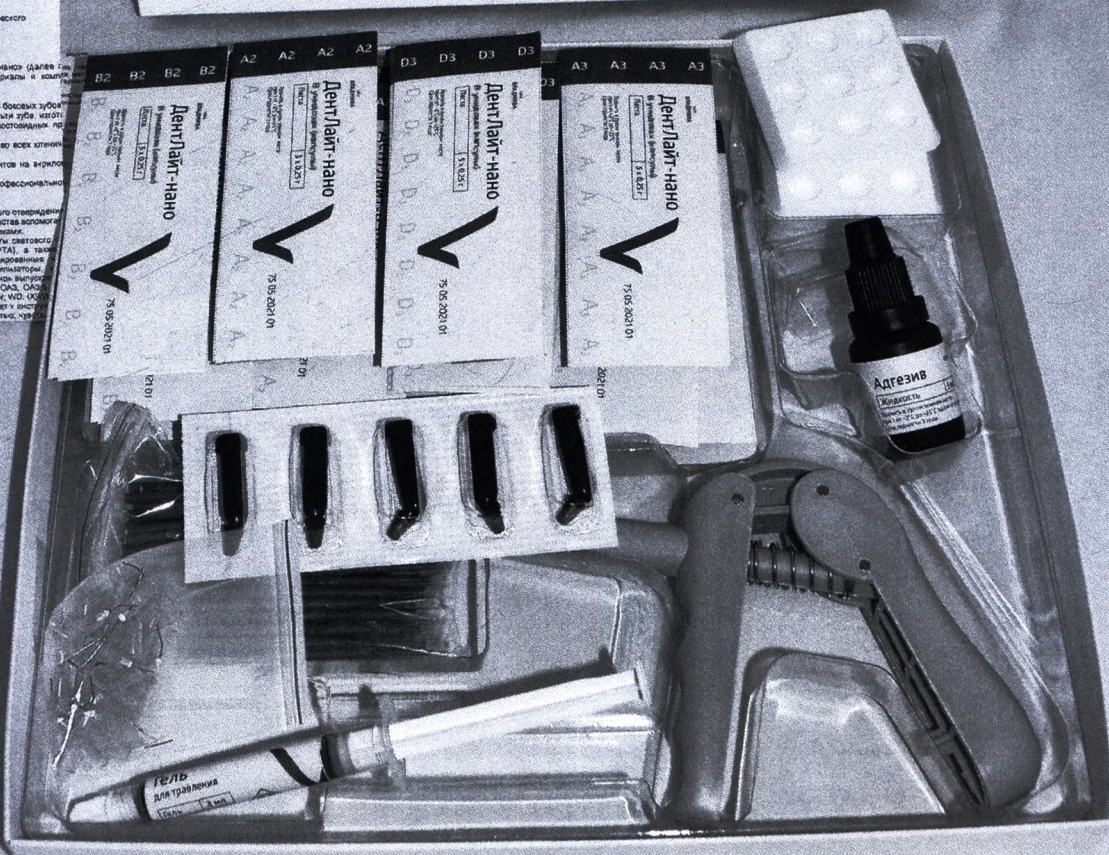

Материал универсальный
стоматологический наногибридный
реставрационный «ДентЛайт-нано»
по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

ДентЛайт-нано



Universal dental nanohybrid
restorative material «DentLight-nano»
Spec. 32.50.50-142-45814830-2021

DentLight-nano

В унисдозах (капсулы):

Капсулы с пастой (0,25 г) 0A3.5, D3, A2, A3, B2, B3, C2	80 шт
Палочка-капсулятор с аппликатором (5 мл)	1 шт
Шпатель, 1 шт для трафаретной (3 мл)	1 шт
Аппликатор	25 шт
Палочка-капсулятор (3 мл)	25 шт
Палочка-капсулятор (1 мл)	1 шт
Диспенсер для пасты на трафарет	1 шт
Инструкция по применению	1 шт


Организация:
ООО «Цирми»
Адрес: 105080, г. Москва, Россия,
ул. Мухоморова, д. 10
Т: 4752 205155
E: info@cirmi.ru
ТУ 32.50.50-142-45814830-2021
Р. 1



В унидозах (капсулы):

Капсулы с пастой (0,25 г) 0A3.5, D3, A2, A3, B2, B3, C2	80 шт
Палочка-капсулятор с аппликатором (5 мл)	1 шт
Шпатель, 1 шт для трафаретной (3 мл)	1 шт
Аппликатор	25 шт
Палочка-капсулятор (3 мл)	25 шт
Палочка-капсулятор (1 мл)	1 шт
Диспенсер для пасты на трафарет	1 шт
Инструкция по применению	1 шт

Организация:
ООО «Цирми»
Адрес: 105080, г. Москва, Россия,
ул. Мухоморова, д. 10
Т: 4752 205155
E: info@cirmi.ru
ТУ 32.50.50-142-45814830-2021
Р. 1

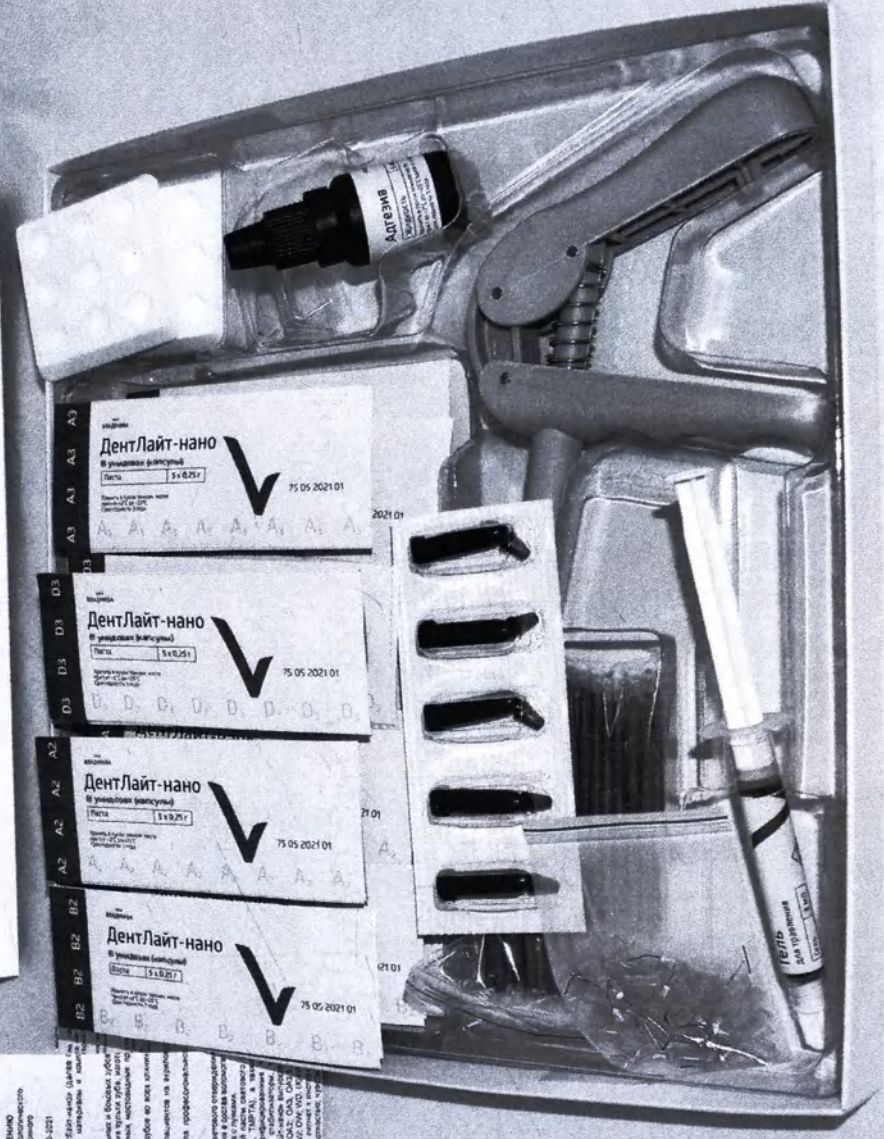

Материал «ДентЛайт-нано», в унидозах (капсулы), 0,25 г - 80 шт. (0A3.5, D3, A2, A3, B2, B3, C2)

Материал универсальный
стоматологический наногибридный
реставрационный «ДентЛайт-нано»
по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

Universal dental nanohybrid
restorative material «DentLight-nano»
Spec. 32.50.50-142-45814830-2021



ДентЛайт-нано

DentLight-nano

В унидозах (капсулы):

Капсулы с пастой (0,25 г) OA3.5, A2, A3, B2, D3	80 шт
Флакон-капельница с адгезивом (5 мл)	1 шт
Шприц с гелем для травления (3 мл)	1 шт
Аппликаторы	25 шт
Иглы (канюли)	25 шт
Пластина с лунками	1 шт
Диспенсер для нанесения материала	1 шт
Инструкция по применению	1 шт

In unidoses (capsules):

Capsules with paste (0.25 g) OA3.5, A2, A3, B2, D3	80 pc
Flask-dropper with adhesive (5 ml)	1 pc
Syringe with etching gel (3 ml)	1 pc
Applicators	25 pc
Needles (cannulae)	25 pc
Plate with holes	1 pc
Dispenser for material application	1 pc
Instruction for use	1 pc

Применяется
АО «ОЗ» «Одент»
300023, Россия,
г. Белгород,
ул. Стрелецкая, 79
Т: 4722 200 345

Хранить в сухом темном месте
при +5...+25 °С.
Срок годности 3 года

«ОЗ» «ОД» «ОДЕНТ»
Odontobond Ltd., St.
Petersburg, Russia
+7 812 200 345

Store in a dry and dark place
at +5...+25 °C.
3 years shelf life



75 05 2021 D1
EXP 2024 D1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ материала универсального стоматологического наногибридного реставрационного «ДентЛайт-нано» по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

Наногибридный реставрационный материал «ДентЛайт-нано» (далее по тексту – материал) – это стоматологический материал, состоящий из композитных смол, наполненных наночастицами, и фотоинициатора. Материал предназначен для реставрации передних и боковых зубов, а также для восстановления культи зуба, изогнутой коронки, временных и постоянных несъемных мостовидных протезов.

Материал «ДентЛайт-нано» применяется для реставрации передних и боковых зубов во всех клинических случаях, когда требуется восстановление эстетики и функциональности зуба. Материал «ДентЛайт-нано» предназначен для профессионального использования.

Материал «ДентЛайт-нано» состоит из композитных смол, наполненных наночастицами, и фотоинициатора. Материал «ДентЛайт-нано» применяется для реставрации передних и боковых зубов, а также для восстановления культи зуба, изогнутой коронки, временных и постоянных несъемных мостовидных протезов.

Материал «ДентЛайт-нано» применяется для реставрации передних и боковых зубов во всех клинических случаях, когда требуется восстановление эстетики и функциональности зуба. Материал «ДентЛайт-нано» предназначен для профессионального использования.

Материал «ДентЛайт-нано» применяется для реставрации передних и боковых зубов во всех клинических случаях, когда требуется восстановление эстетики и функциональности зуба. Материал «ДентЛайт-нано» предназначен для профессионального использования.


Материал «ДентЛайт-нано» применяется для реставрации передних и боковых зубов во всех клинических случаях, когда требуется восстановление эстетики и функциональности зуба. Материал «ДентЛайт-нано» предназначен для профессионального использования.

Материал «ДентЛайт-нано» применяется для реставрации передних и боковых зубов во всех клинических случаях, когда требуется восстановление эстетики и функциональности зуба. Материал «ДентЛайт-нано» предназначен для профессионального использования.


Материал «ДентЛайт-нано» применяется для реставрации передних и боковых зубов во всех клинических случаях, когда требуется восстановление эстетики и функциональности зуба. Материал «ДентЛайт-нано» предназначен для профессионального использования.

Материал «ДентЛайт-нано» применяется для реставрации передних и боковых зубов во всех клинических случаях, когда требуется восстановление эстетики и функциональности зуба. Материал «ДентЛайт-нано» предназначен для профессионального использования.

Материал «ДентЛайт-нано», в унидозах (капсулы), 0,25 г - 80 шт. (OA3.5, A2, A3, B2, D3)

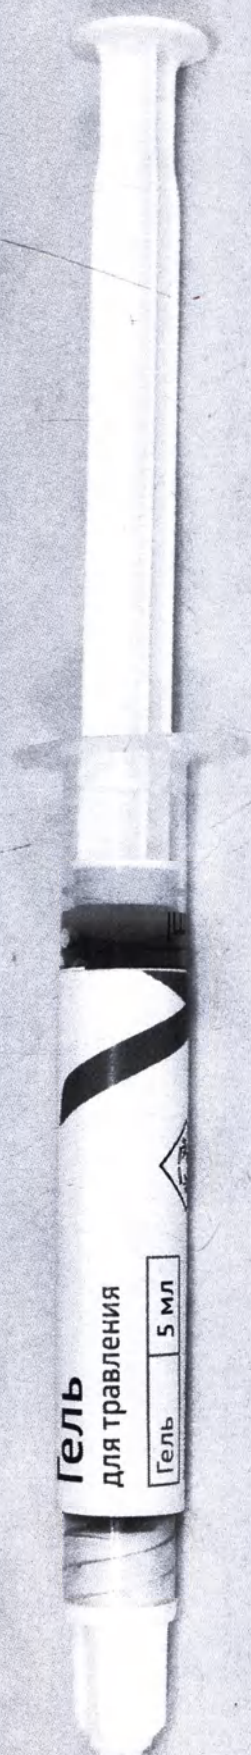

Шприц с гелем для травления (5 мл)

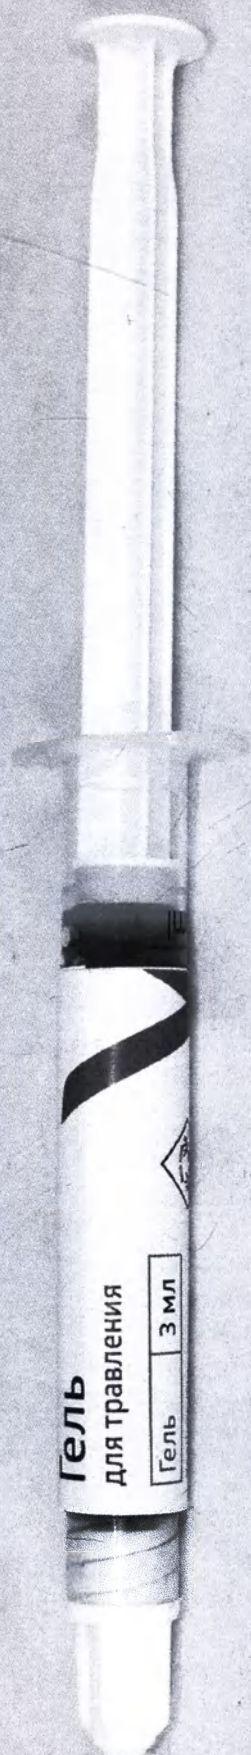

Шприц с гелем для травления (3 мл)



«ДентЛайт-нано»

ВЛАДИМИР

Адгезив

Жидкость

6 г

Хранить в сухом темном месте
при t от +2°C до +25°C вдали от источников
Срок годности 3 года


Флакон-капельница с адгезивом (6 г)



Флакон-капельница с адгезивом (5 мл)




Пластина с лунками

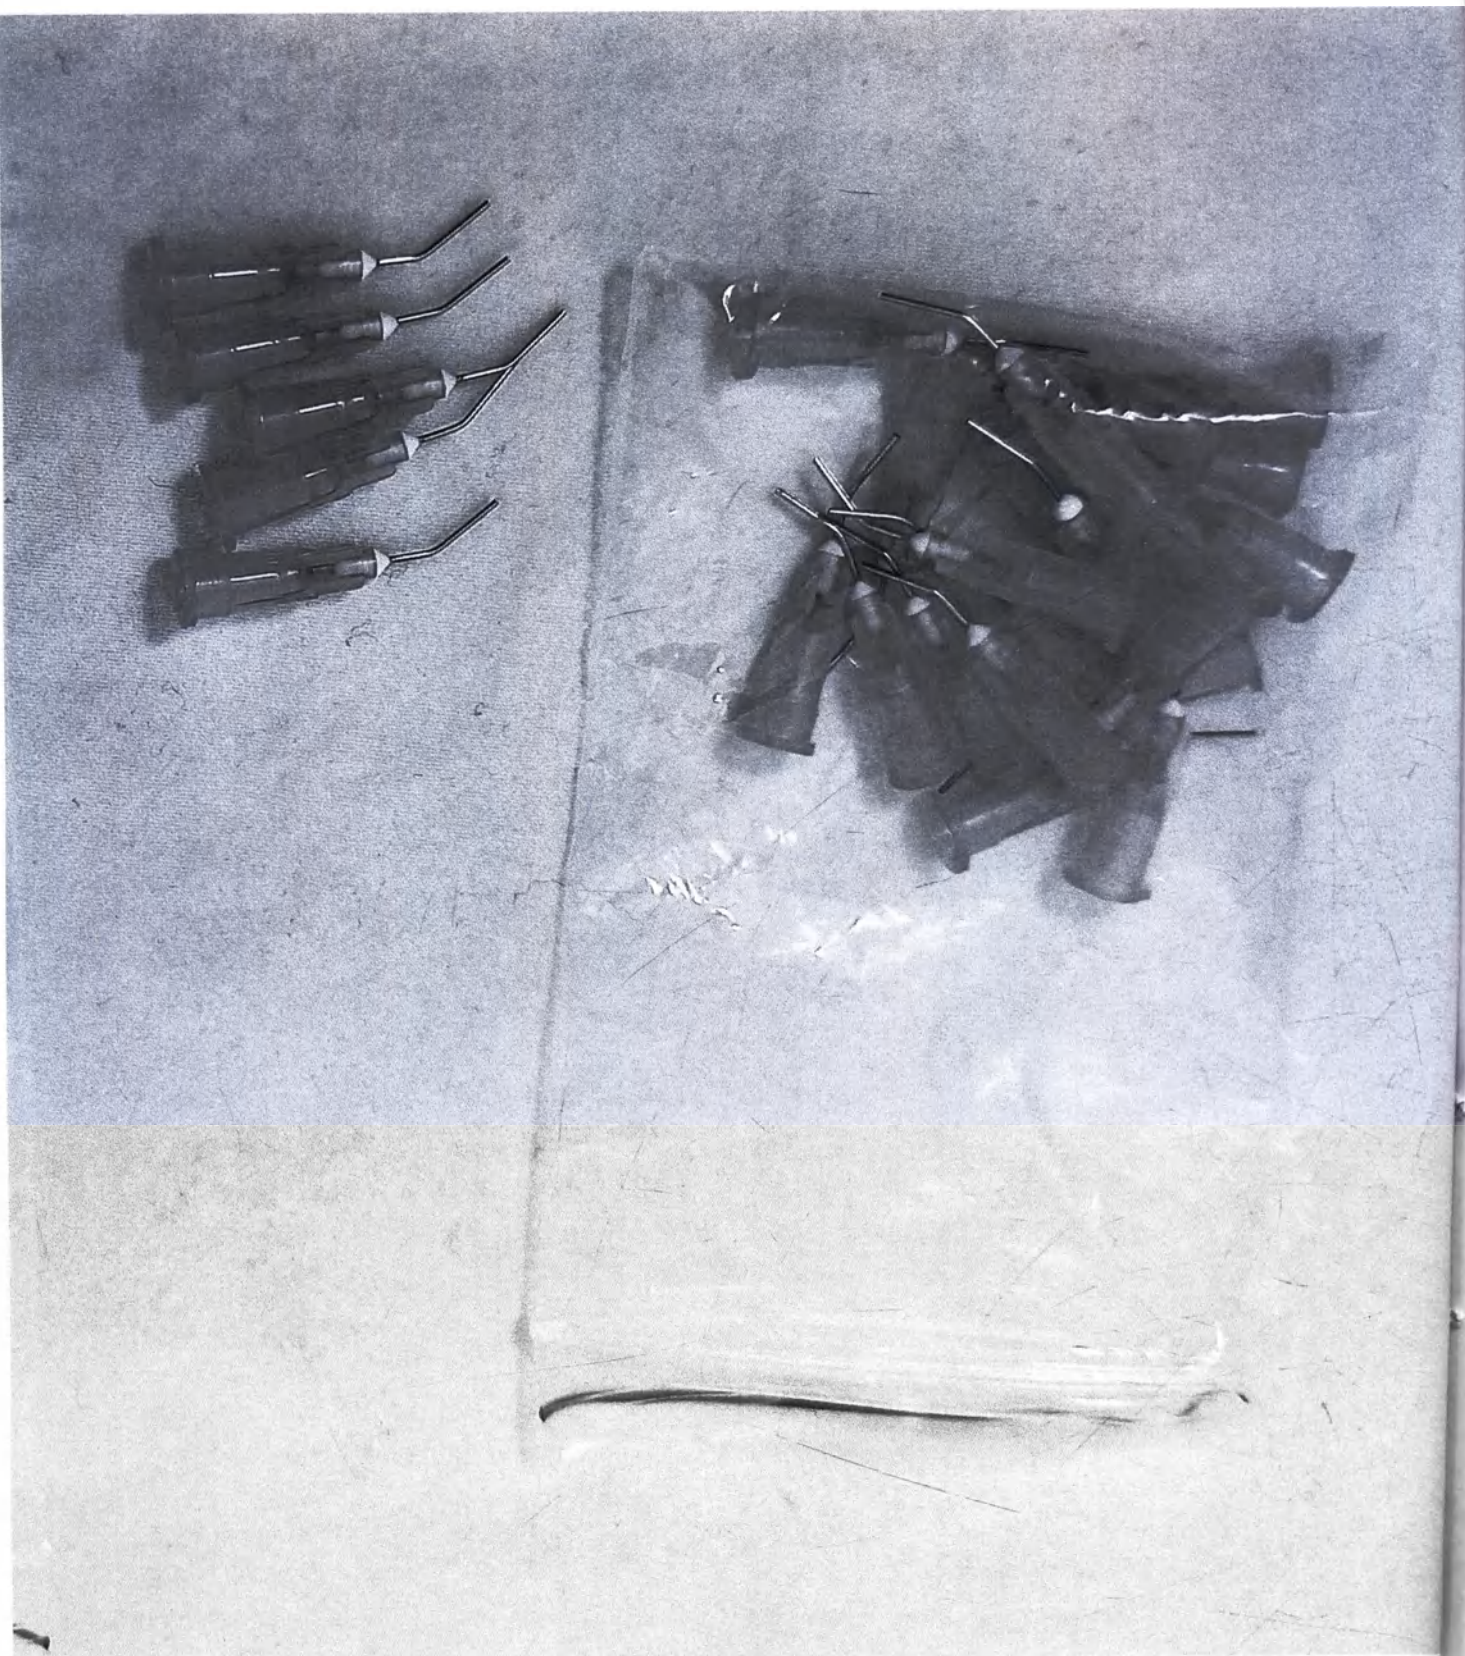



Аппликаторы

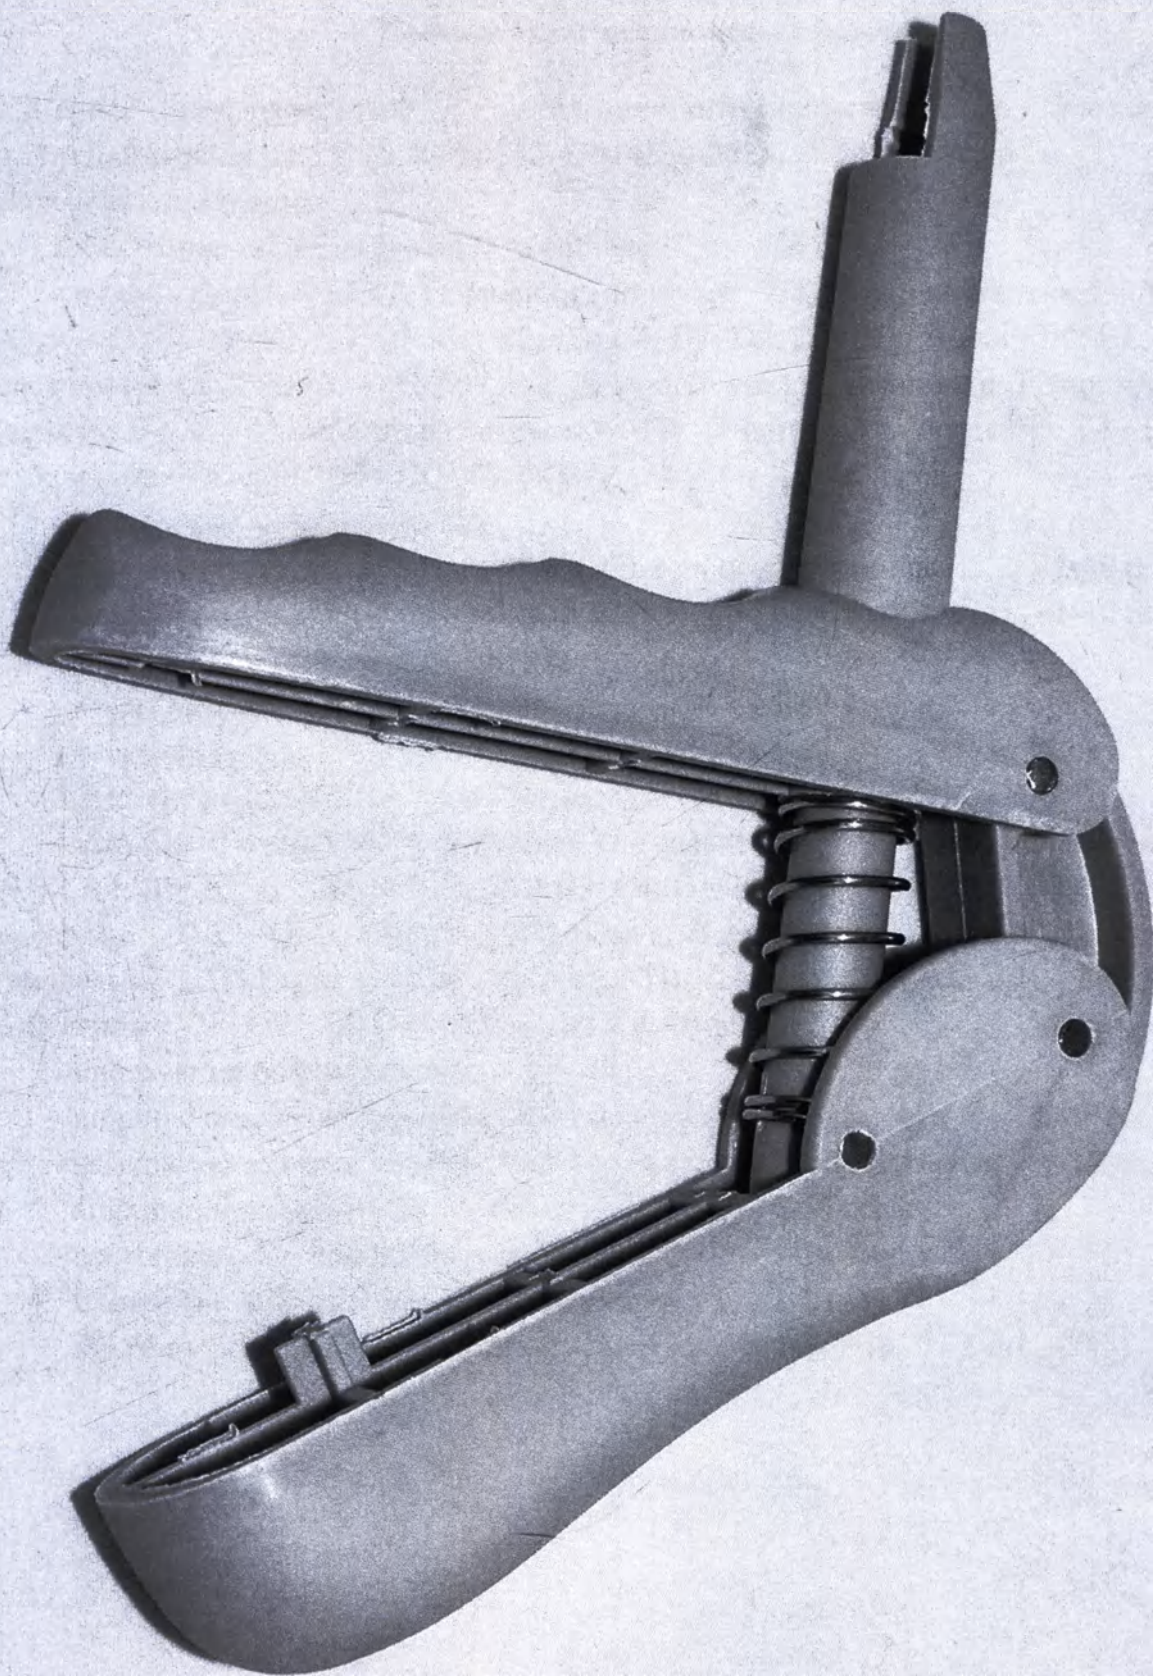

Диспенсер для внесения материала

Наименование медицинского изделия

Материал универсальный стоматологический наногибридный реставрационный «ДентЛайт-нано» по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021,

варианты исполнения:

1. Материал «ДентЛайт-нано», в составе:

- шприц с пастой (4/4,5 г) оттенки (по шкале VITA): универсальные - A1; A2; A3; A3,5; A4; B1; B2; B3; B4; B5; C1; C2; C3; C4; D1; D2; D3; UD; эмали - E0; E1; E2; E3; E4; опакующие - OA2; OA3, OA3,5; OB2; режущий край (translucent): Т (прозрачный), ТЕ (эмалевый), СТ (пришеечная область), ТВ (синий), TG (серый), ТА (янтарный), отбеленные - W; OW; WD, (X)WB, (X)WE - 1 – 16 шт.

- инструкция по применению - 1 шт.

- шприц с гелем для травления (3/5 мл), при необходимости - 1-10 шт.

- флакон-капельница с адгезивом (5 мл/6 г), при необходимости - 1-10 шт.

- аппликаторы, при необходимости - 5-50 шт.

- иглы (канюли), при необходимости - 5-50 шт.

- пластина с лунками, при необходимости - 1-10 шт.

2. Материал «ДентЛайт-нано» в унидозах (капсулы), в составе:

- капсулы с пастой (0,25 г) оттенки (по шкале VITA): универсальные - A1; A2; A3; A3,5; A4; B1; B2; B3; B4; B5; C1; C2; C3; C4; D1; D2; D3; UD; эмали - E0; E1; E2; E3; E4; опакующие - OA2; OA3, OA3,5; OB2; режущий край (translucent): Т (прозрачный), ТЕ (эмалевый), СТ (пришеечная область), ТВ (синий), TG (серый), ТА (янтарный), отбеленные - W; OW; WD, (X)WB, (X)WE – 20-80 шт.

- инструкция по применению - 1 шт.

- шприц с гелем для травления (3/5 мл), при необходимости - 1-10 шт.

- флакон-капельница с адгезивом (5 мл/6 г), при необходимости - 1-10 шт.

- аппликаторы, при необходимости - 5-50 шт.

- иглы (канюли), при необходимости - 5-50 шт.

- пластина с лунками, при необходимости - 1-10 шт.

- диспенсер для внесения материала, при необходимости - 1 шт.

В данном документе
пронумеровано, прошито
и скреплено печатью
25 листа(ов)
зам.нач.ТО Курсенко З.В.





«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «ОЗ «ВладМиВа»
В.П.Чуев
« 10 » 2022 г.

Маркировка
потребительской упаковки

**Материал универсальный стоматологический наногибридный реставрационный
«ДентЛайт-нано»
по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021
(Приложение)**

Universal dental nanohybrid
restorative material «DentLight-nano»
according to Spec. 32.50.50-142-45814830-2021

VLADMIVA

DentLight-nano

Syringe with paste (4 g) A2, A3, A3.5, OA2	4 pc
Flask-dropper with adhesive (6 g)	1 pc
Syringe with etching gel (3 ml)	1 pc
Applicators	25 pc
Needles (cannulas)	25 pc
Plate with holes	1 pc
Instruction for use	1 pc



РРС ИП ВЛАДИВА
г. Минск, ул. Сурганова, 19
110023, Республика Беларусь
+375 22 277 555
www.vladmiva.ru

RC №
Spec. 32.50.50-142-45814830-2021

Материал универсальный стоматологический
наногибридный реставрационный «ДентЛайт-нано»
по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

ВЛАДМИВА

ДентЛайт-нано

Шприц с пастой (4 г) A2, A3, A3.5, OA2	4 шт
Флакон-капельница с адгезивом (6 г)	1 шт
Шприц с гелем для травления (3 мл)	1 шт
Апликаторы	25 шт
Иглы (канюли)	25 шт
Пластина с пунками	1 шт
Инструкция по применению	1 шт



Практически
60-100% белизация
30-20% блеск
г. Беларусь
ул. Сурганова, 19
+375 22 277 555
www.vladmiva.ru

Хранить в сухом, защищенном от света месте
при t от -2°C до +25°C
Срок годности 3 года
ТУ 32.50.50-142-45814830-2021
РУ №



Ракет/ Упакет
LOT
Время/Time

Версия/Version, № 1 от 11.2022



Universal dental nanohybrid
restorative material «DentLight-nano»
according to Spec. 32.50.50-142-45814830-2021

VLADMIVA

DentLight-nano

Syringe with paste (4 g)	8 pc
A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, OA2	
Flask-dropper with adhesive (6 g)	1 pc
Syringe with etching gel (3 ml)	1 pc
Applicators	25 pc
Needles (cannulas)	25 pc
Plate with holes	1 pc
Instruction for use	1 pc



АО «ВЛДМИВА»
Инновационная стоматология
303023, Россия, г. Белгород
ул. Сурбенинская, 19
т: 47322-200-555
www.vladmiva.ru

RC No
Spec. 32.50.50-142-45814830-2021



Материал универсальный стоматологический
наногибридный реставрационный «ДентЛайт-нано»
по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

ВЛАДМИВА

ДентЛайт-нано

Шприц с пастой (4 г)	8 шт
A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, OA2	
Флакон-капельница с адгезивом (6 г)	1 шт
Шприц с гелем для травления (3 мл)	1 шт
Аппликаторы	25 шт
Иглы (канюли)	25 шт
Пластина с лунками	1 шт
Инструкция по применению	1 шт



Производитель:
АО «ВЛДМИВА»
303023, Россия,
г. Белгород
ул. Сурбенинская, 19
т: 47322-200-555
www.vladmiva.ru

Хранить в сухом, защищенном от света месте
при t от -2°C до +25°C
Срок годности 3 года
ТУ 32.50.50-142-45814830-2021
РУ №



Риски/
Упаковка

Всего/Всего: № 1 от 11222

Universal dental nanohybrid
restorative material «DentLight-nano»
according to Spec. 32.50.50-142-45814830-2021

VLADMIVA

DentLight-nano

Syringe with paste (4.5 g)	8 pc
A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, OA2	1 pc
Flask-dropper with adhesive (6 g)	1 pc
Syringe with etching gel (3 ml)	25 pc
Applicators	25 pc
Needles (cannulas)	25 pc
Plate with holes	1 pc
Instruction for use	1 pc



ГОС ЦИРМИ
Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
г. Минск, ул. Сургановская, 19
т. +375 29 200 153

RC №
Spec. 32.50.50-142-45814830-2021



Материал универсальный стоматологический
наногибридный реставрационный «ДентЛайт-нано»
по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

VLADMIVA

ДентЛайт-нано

Шприц с пастой (4.5 г)	8 шт
A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, OA2	1 шт
Флакон-капельница с адгезивом (6 г)	1 шт
Шприц с гелем для травления (3 мл)	25 шт
Аппликаторы	25 шт
Иглы (канюли)	25 шт
Пластина с лунками	1 шт
Инструкция по применению	1 шт



Производитель:
АО «ВЛДМ» «Владмива»
108023, Минск,
г. Беларусь,
ул. Сургановская, 19
т. +375 29 200 153
www.vladmiva.ru

Хранить в сухом, защищенном от света месте
при t от -2°C до +25°C.
Срок годности 3 года
ТУ 32.50.50-142-45814830-2021
РУ №



Риски/Упаковка



Версия/Revision: № 1, от 11.2023

Universal dental nanohybrid
restorative material «DentLight-nano»
according to Spec. 32.50.50-142-45814830-2021

VLADMIVA

DentLight-nano

Syringe with paste (4 g)	12 pc
A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, C3, OA2, D2, D3, E1, E2	
Flask-dropper with adhesive (6 g)	1 pc
Syringe with etching gel (3 ml)	1 pc
Applicators	25 pc
Needles (cannulas)	25 pc
Plate with holes	1 pc
Instruction for use	1 pc



РФ НРП-0204-19
РФ НРП-0204-19
РФ НРП-0204-19
РФ НРП-0204-19
www.vladmiva.ru

RC №
Spec. 32.50.50-142-45814830-2021



Материал универсальный стоматологический
наногибридный реставрационный «ДентЛайт-нано»
по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

ВЛАДМИВА

ДентЛайт-нано

Шприц с пастой (4 г)	12 шт
A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, C3, OA2, D2, D3, E1, E2	
Флакон-капельница с адгезивом (6 г)	1 шт
Шприц с гелем для травления (3 мл)	1 шт
Аппликаторы	25 шт
Иглы (канюли)	25 шт
Пластина с пунками	1 шт
Инструкция по применению	1 шт



Производитель:
АО «ОЗБ-Белстат» (Бел)
308033, Россия
г. Белгород
ул. Студенческая, 19
т: 4722 200 555
www.vladmiva.ru

Хранить в сухом, защищенном от света месте
при t от -2°C до +25°C
Срок годности 3 года
ТУ 32.50.50-142-45814830-2021
РФ №



Рестав.
Упаковка
LOT
www.vladmiva.ru

Рестав./Упаковка, № 1, от 11.2.22

Universal dental nanohybrid
restorative material «DentLight-nano»
according to Spec. 32.50.50-142-45814830-2021

VLADMIVA

DentLight-nano

Syringe with paste (4.5 g)	12 pc
A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, C3, OA2, D2, D3, E1, E2	1 pc
Flask-dropper with adhesive (6 g)	1 pc
Syringe with etching gel (3 ml)	1 pc
Applicators	25 pc
Needles (cannulas)	25 pc
Plate with holes	1 pc
Instruction for use	1 pc



OSC-IPR, Vladmiva
Belarusian Republic, Minsk
375023, Belarus
+7 4022 200 555
www.vladmiva.ru

RC №
Spec. 32.50.50-142-45814830-2021



Материал универсальный стоматологический
наногибридный реставрационный «ДентЛайт-нано»
по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

ВЛАДМИВА


ДентЛайт-нано

Шприц с пастой (4.5 г)	12 шт
A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, C3, OA2, D2, D3, E1, E2	1 шт
Флакон-капельница с адгезивом (6 г)	1 шт
Шприц с гелем для травления (3 мл)	1 шт
Апликаторы	25 шт
Иглы (канюли)	25 шт
Пластина с лунками	1 шт
Инструкция по применению	1 шт



Производитель:
АО «ОЗБ-Беларусь»
303023, Россия,
г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4022 200 555
www.vladmiva.ru

Хранить в сухом, защищенном от света месте
при t от -2°C до +25°C
Срок годности 3 года
ТУ 32.50.50-142-45814830-2021
РУ №




Всп-м/Version № 1 от 11.02.22

VLADMIVA

DentLight-nano

Syringe with paste (4 g)	16 pc
A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, C3, D2, D3, OA2, E1, E2, OB2, TE, TA, T	
Flask-dropper with adhesive (6 g)	1 pc
Syringe with etching gel (3 ml)	1 pc
Applicators	25 pc
Needles (cannulas)	25 pc
Plate with holes	1 pc
Instruction for use	1 pc



RC No
Spec. 32.50.50-142-45814830-2021



ВЛАДМИВА

ДентЛайт-нано

Шприц с пастой (4 г)	16 шт
A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, C3, D2, D3, OA2, E1, E2, OB2, TE, T	
Флакон-капельница с адгезивом (6 г)	1 шт
Шприц с гелем для травления (3 мл)	1 шт
Аппликаторы	25 шт
Иглы (канюли)	25 шт
Пластина с лунками	1 шт
Инструкция по применению	1 шт



Производитель:
АО «ОЗБ»-Владимир
360023, Россия,
г. Белгород
ул. Студенческая, 19
т. 4722 200 555

Хранить в сухом, защищенном от света месте
при t от -2°C до -25°C

Срок годности 3 года

ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

PV №



Packet/ LOT

Buyer: www.fishbase.org; Reg. 1, 07/11/2007

Universal dental nanohybrid
restorative material «DentLight-nano»
according to Spec. 32.50.50-142-45814830-2021

VLADMIVA

DentLight-nano

Syringe with paste (4.5 g) A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, C3, D2, D3, OA2, E1, E2, OB2, TE, TA, T	16 pc
Flask-dropper with adhesive (6 g)	1 pc
Syringe with etching gel (3 ml)	1 pc
Applicators	25 pc
Needles (cannulas)	25 pc
Plate with holes	1 pc
Instruction for use	1 pc



ИЗГОТОВИТЕЛ
ООО «Владива»
309023, Владимирская обл.
г. Владимир, ул. Студенческая, 99
7 4722 200-555
www.vladmiva.ru

RC №
Spec. 32.50.50-142-45814830-2021



Материал универсальный стоматологический
наногибридный реставрационный «ДентЛайт-нано»
по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

VLADMIVA

ДентЛайт-нано

Шприц с пастой (4.5 г) A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, C3, D2, D3, OA2, E1, E2, OB2, TE, TA, T	16 шт
Флакон-капельница с адгезивом (6 г)	1 шт
Шприц с гелем для травления (3 мл)	1 шт
Аппликаторы	25 шт
Иглы (канюли)	25 шт
Пластина с лунками	1 шт
Инструкция по применению	1 шт



Производитель:
АО «ОЗ» «Владива»
309023, Россия,
г. Владимир
ул. Студенческая, 99
+7 4722 200-555
www.vladmiva.ru

Хранить в сухом, защищенном от света месте
при t от +2°C до +25°C
Срок годности 3 года
ТУ 32.50.50-142-45814830-2021
РУ №



Рейтинг
Удовлетворенности
LOT
Всего отзывов: № 1 от 11.2022

Материал универсальный стоматологический
наногибридный реставрационный «ДентЛайт-нано»
по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

ДентЛайт-нано

В унисдозах (капсулы):

Капсулы с пастой (0,25 г)

20 шт

A3

Universal dental nanohybrid
restorative material «DentLight-nano»
according to
Spec. 32.50.50-142-45814830-2021



DentLight-nano

In unidoses (capsules):

Capsules with paste (0.25 g)

20 pc

Производитель:
АО «ОЗС «ВладМиВа»
305023, Россия,
г. Белгород,
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

ТУ 32.50.50-142-45814830-2021
РУ №

Хранить в сухом темном месте
при t от +2°C до +25°C
Срок годности 3 года



JSC «VladMiVa»
Experimental Plant
Studenetskaya str. 19,
Belgorod, 305023, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Packer/
Упаковка



Вопрос/Verdict: № 1 от 11.2022

Материал универсальный
стоматологический наногибридный
реставрационный «ДентЛайт-нано»
по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

Universal dental nanohybrid
restorative material «DentLight-nano»
according to
Spec. 32.50.50-142-45814830-2021



ДентЛайт-нано

DentLight-nano

В унидозах (капсулы):

Капсулы с пастой (0,25 г) 0A3.5, A2, A3, B2, D3	80 шт
Флакон-капельница с адгезивом (5 мл)	1 шт
Шприц с гелем для травления (3 мл)	1 шт
Аппликаторы	25 шт
Иглы (канюли)	25 шт
Пластина с лунками	1 шт
Диспенсер для внесения материала	1 шт
Инструкция по применению	1 шт

In unidoses (capsules):


Capsules with paste (0,25 g) 0A3.5, A2, A3, B2, D3	80 pc
Flask-dropper with adhesive (5 ml)	1 pc
Syringe with etching gel (3 ml)	1 pc
Applicators	25 pc
Needles (cannulas)	25 pc
Plate with holes	1 pc
Dispenser for material application	1 pc
Instruction for use	1 pc

Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия,
г Белгород,
ул Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

ТУ 32.50.50-142-45814830-2021
РУ №

Хранить в сухом темном месте
при t от +2°C до +25°C
Срок годности 3 года




JSC «EP «VladMiVa»
Студенческая Стр., 19,
308023, Belgorod, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Store in a dry and dark place
at t of +2°C to +25°C
3 years shelf-life

Packer/
Упаковщик



Материал универсальный
стоматологический наногибридный
реставрационный «ДентЛайт-нано»
по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

Universal dental nanohybrid
restorative material «DentLight-nano»
according to
Spec. 32.50.50-142-45814830-2021



ДентЛайт-нано

DentLight-nano

В унидозах (капсулы):

Капсулы с пастой (0,25 г) 0A3.5, D3, A2, A3, B2, B3, C2	80 шт
Флакон-капельница с адгезивом (5 мл)	1 шт
Шприц с гелем для травления (3 мл)	1 шт
Аппликаторы	25 шт
Иглы (канюли)	25 шт
Пластина с лунками	1 шт
Диспенсер для внесения материала	1 шт
Инструкция по применению	1 шт

In unidoses (capsules):

Capsules with paste (0.25 g) 0A3.5, D3, A2, A3, B2, B3, C2	80 pc
Flask-dropper with adhesive (5 ml)	1 pc
Syringe with etching gel (3 ml)	1 pc
Applicators	25 pc
Needles (cannulas)	25 pc
Plate with holes	1 pc
Dispenser for material application	1 pc
Instruction for use	1 pc


Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия,
г. Белгород,
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

Р/№

Хранить в сухом темном месте
при t от +2°C до +25°C
Срок годности 3 года




ЗАО «ОЗЗ «ВладМиВа»
Студенческая Стр., 19,
308023, Белгород, Russia
+7 4722 200 555

www.vladmiva.ru

Store in a dry and dark place
at t of +2°C to +25°C
3 years shelf-life

Packer/
Упаковщик



Материал универсальный
стоматологический наногибридный
реставрационный «ДентЛайт-нано»
по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

Universal dental nanohybrid
restorative material «DentLight-nano»
according to
Spec. 32.50.50-142-45814830-2021



ДентЛайт-нано

DentLight-nano

В унидозах (капсулы):

Капсулы с пастой (0,25 г)	80 шт
OA3.5, A2, A3, B2, B3, C2, C3, D2, D3, E1, E2, OB2	
Флакон-капельница с адгезивом (5 мл)	1 шт
Шприц с гелем для травления (3 мл)	1 шт
Аппликаторы	25 шт
Иглы (канюли)	25 шт
Пластина с лунками	1 шт
Диспенсер для внесения материала	1 шт
Инструкция по применению	1 шт

In unidoses (capsules):

Capsules with paste (0.25 g)	80 pc
OA3.5, A2, A3, B2, B3, C2, C3, D2, D3, E1, E2, OB2	
Flask-dropper with adhesive (5 ml)	1 pc
Syringe with etching gel (3 ml)	1 pc
Applicators	25 pc
Needles (cannulas)	25 pc
Plate with holes	1 pc
Dispenser for material application	1 pc
Instruction for use	1 pc


Производитель:
АО «ВладМиВа»
308023, Россия,
г. Белгород,
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200 555

www.vladmiva.ru

ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

Р/М

Хранить в сухом темном месте
при t от +2°C до +25°C
Срок годности 3 года



JSC «EP «VladMiVa»
Студенческая Стр., 19,
308023, Belgorod, Russia
+7 4722 200 555

www.vladmiva.ru

Store in a dry and dark place
at t of +2°C to +25°C
3 years shelf-life

Packer/

Упаковщик



Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия,
г. Белгород,
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

ТУ 32.50.50-142-45814830-2021
ПУ №

Хранить в сухом темном месте
при t от +2°C до +25°C
Срок годности 3 года



Universal dental nanohybrid restorative material «DentLight-nano»
according to Spec. 32.50.50-142-45814830-2021

DentLight-nano

A2

Syringe with paste (4,5 g) 1 pc

JSC «EP «VladMiVa»
Studenetskaya Str., 19,
308023, Belgorod, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru



Packer/
Упаковщик

LOT



Материал универсальный стоматологический наногибридный
реставрационный «ДентЛайт-нано» по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

ДентЛайт-нано

A2

Шприц с пастой (4,5 г) 1 шт

ДентЛайт-нано

ВЛАДМИВА

ВЛАДМИВА

DentLight-nano

Версия/Version: № 1, от 11.2022

Производитель:
АО «ОЗЭ «ВладМиВа»
308023, Россия,
г. Белгород,
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

ТУ 32.50.50-142-45814830-2021
Р/У №

Хранить в сухом темном месте
при t от +2°C до +25°C
Срок годности 3 года



Universal dental nanohybrid restorative material «DentLight-nano»
according to Spec. 32.50.50-142-45814830-2021


DentLight-nano

A2

Syringe with paste (4 g) 1 pc

JSC «EP «VladMiVa»
Studenetskaya Str., 19,
308023, Belgorod, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru



Packer/
Упаковщик

LOT



Материал универсальный стоматологический наногибридный
реставрационный «ДентЛайт-нано» по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021

ДентЛайт-нано

A2

Шприц с пастой (4 г) 1 шт

ДентЛайт-нано

VIV
ВЛАДМИВА

VIV
ВЛАДМИВА

DentLight-nano

Версия/Version: № 1 от 11.2022

A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2

ВЛАДИВА

ДентЛайт-нано

В унидозах (капсулы)

Капсула с пастой (0,25 г) 5 шт

Хранить в сухом темном месте при t от +2°C до +25°C
Срок годности 3 года

A₂ A₂ A₂ A₂ A₂ A₂ A₂ A₂



A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3

ВЛАДИВА

ДентЛайт-нано

В унидозах (капсулы)

Капсула с пастой (0,25 г) 5 шт

Хранить в сухом темном месте при t от +2°C до +25°C
Срок годности 3 года

A₃ A₃ A₃ A₃ A₃ A₃ A₃ A₃



B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2

ВЛАДИВА

ДентЛайт-нано

В унидозах (капсулы)

Капсула с пастой (0,25 г) 5 шт

Хранить в сухом темном месте при t от +2°C до +25°C
Срок годности 3 года

B₂ B₂ B₂ B₂ B₂ B₂ B₂ B₂



D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3

ВЛАДИВА

ДентЛайт-нано

В унидозах (капсулы)

Капсула с пастой (0,25 г) 5 шт

Хранить в сухом темном месте при t от +2°C до +25°C
Срок годности 3 года

D₃ D₃ D₃ D₃ D₃ D₃ D₃ D₃



OA3.5 OA3.5 OA3.5 OA3.5 OA3.5 OA3.5

ВЛАДИВА

ДентЛайт-нано

В унидозах (капсулы)

Капсула с пастой (0,25 г) 5 шт

Хранить в сухом темном месте при t от +2°C до +25°C
Срок годности 3 года

OA_{3.5} OA_{3.5} OA_{3.5} OA_{3.5} OA_{3.5} OA_{3.5}



OA2 OA2 OA2 OA2 OA2 OA2

ВЛАДИВА

ДентЛайт-нано

В унидозах (капсулы)

Капсула с пастой (0,25 г) 5 шт

Хранить в сухом темном месте при t от +2°C до +25°C
Срок годности 3 года

OA₂ OA₂ OA₂ OA₂ OA₂ OA₂



ВЛАДИВА

ДентЛайт-нано

В унидозах (капсулы)

Капсула с пастой (0,25 г) 5 шт

Хранить в сухом темном месте при t от +2°C до +25°C
Срок годности 3 года

C₂ C₂ C₂ C₂ C₂ C₂ C₂ C₂

ВЛАДИВА

ДентЛайт-нано

В унидозах (капсулы)

Капсула с пастой (0,25 г) 5 шт

Хранить в сухом темном месте при t от +2°C до +25°C
Срок годности 3 года

C₃ C₃ C₃ C₃ C₃ C₃ C₃ C₃

ВЛАДИВА

ДентЛайт-нано

В унидозах (капсулы)

Капсула с пастой (0,25 г) 5 шт

Хранить в сухом темном месте при t от +2°C до +25°C
Срок годности 3 года

A_{3.5} A_{3.5} A_{3.5} A_{3.5} A_{3.5} A_{3.5} A_{3.5} A_{3.5}

ВЛАДИВА

ДентЛайт-нано

В унидозах (капсулы)

Капсула с пастой (0,25 г) 5 шт

Хранить в сухом темном месте при t от +2°C до +25°C
Срок годности 3 года

D₂ D₂ D₂ D₂ D₂ D₂ D₂ D₂

ВЛАДИВА

ДентЛайт-нано

В унидозах (капсулы)

Капсула с пастой (0,25 г) 5 шт

Хранить в сухом темном месте при t от +2°C до +25°C
Срок годности 3 года

E₁ E₁ E₁ E₁ E₁ E₁ E₁ E₁

ВЛАДИВА

ДентЛайт-нано

В унидозах (капсулы)

Капсула с пастой (0,25 г) 5 шт

Хранить в сухом темном месте при t от +2°C до +25°C
Срок годности 3 года

E₂ E₂ E₂ E₂ E₂ E₂ E₂ E₂

«ДентЛайт-нано» ^{www} ВЛАДМИВА

Адгезив

Жидкость	6 г
----------	-----



Хранить в сухом темном месте
при t от +2°C до +25°C вдали от источников огня.
Срок годности 3 года

«ДентЛайт-нано» ^{www} ВЛАДМИВА


Адгезив

Жидкость	5 мл
----------	------




Хранить в сухом темном месте
при t от +2°C до +25°C вдали от источников огня.
Срок годности 3 года

Этикетки на флакон-капельницу с адгезивом (5 мл или 6 г)

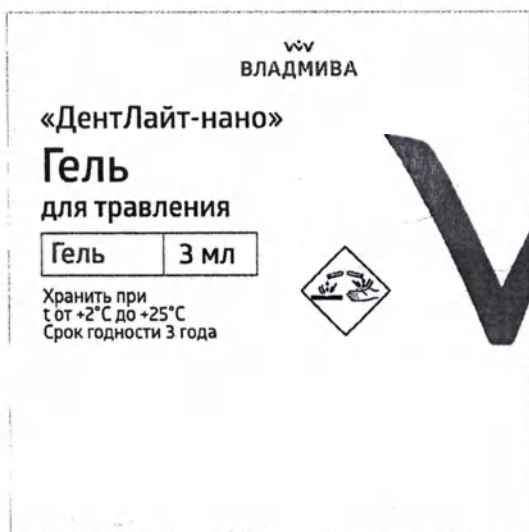

Этикетки на шприц с гелем для травления (3 мл или 5 мл)

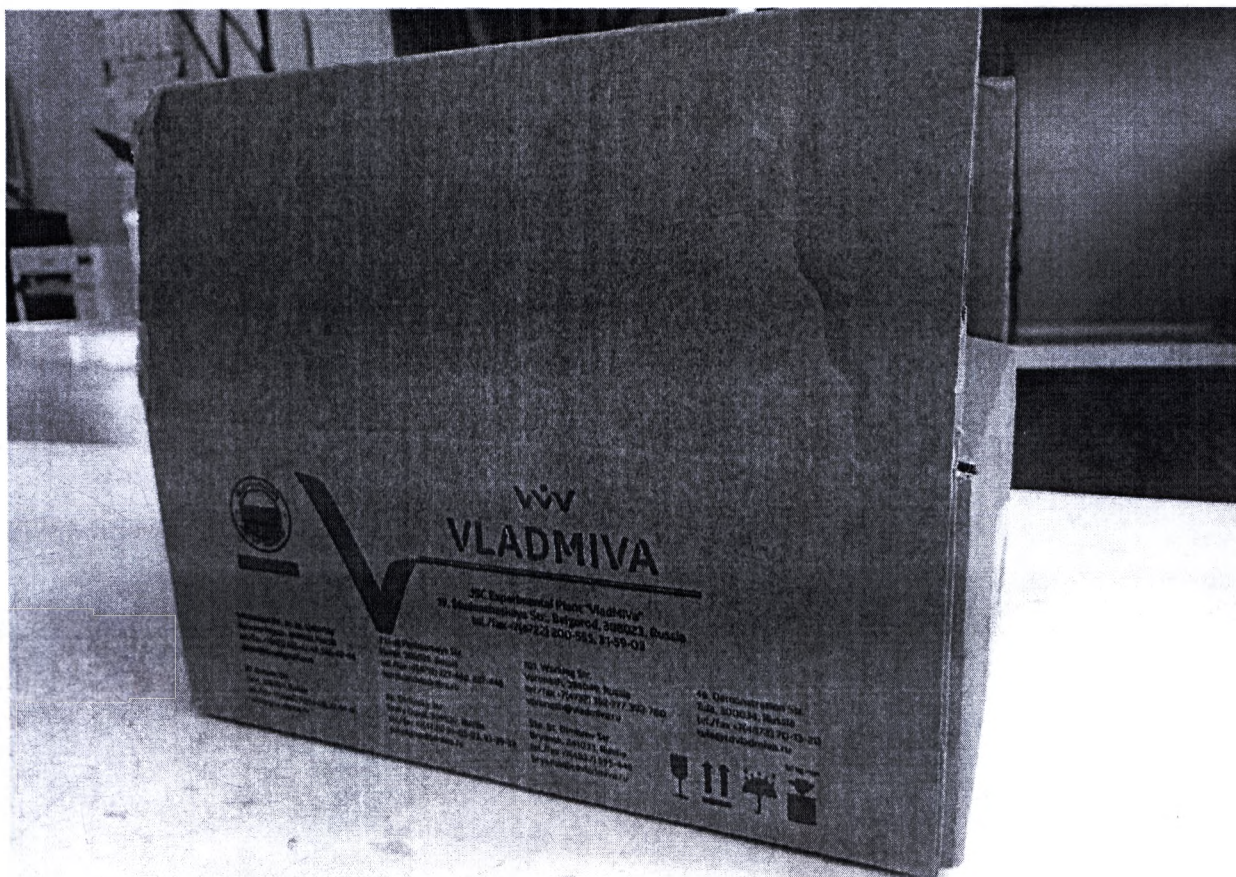

Транспортная упаковка – гофрокороб

Образец упаковочного листа на транспортную упаковку

 VLADMIVA ВЛАДМИВА www.vladmiva.ru		УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ / PACKING LIST	
		Дата упаковывания/Date of packing	Артикул/Art.
Наименование Name			
Кол-во (шт.) Quantity (pc.)			
Партия LOT	Годен до Exp.	Упаковщик (контролер) Packer (controller)	
Manufacturer: JSC «EP «VladMiVa» Studencheskaya st. 19, Belgorod, 308023, Russia, tel. +7 (4722) 200-555		Производитель: АО «ОЭЗ «ВладМиВа» 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 19, тел. (4722) 200-555	

Образец упаковочного листа на транспортную упаковку

 VLADMIVA ВЛАДМИВА www.vladmiva.ru		УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ / PACKING LIST	
		Дата упаковывания/Date of packing	Артикул/Art.
Наименование Name			
Кол-во (шт.) Quantity (pc.)			
Партия LOT	Годен до Exp.	Упаковщик (контролер) Packer (controller)	
Manufacturer: JSC «EP «VladMiVa» Studencheskaya st. 19, Belgorod, 308023, Russia, tel. +7 (4722) 200-555		Производитель: АО «ОЭЗ «ВладМиВа» 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 19, тел. (4722) 200-555	

Наименование медицинского изделия

Материал универсальный стоматологический наногибридный реставрационный «ДентЛайт-нано» по ТУ 32.50.50-142-45814830-2021,

варианты исполнения:

1. Материал «ДентЛайт-нано», в составе:

- шприц с пастой (4/4,5 г) оттенки (по шкале VITA): универсальные - A1; A2; A3; A3,5; A4; B1; B2; B3; B4; B5; C1; C2; C3; C4; D1; D2; D3; UD; эмали - E0; E1; E2; E3; E4; опакующие - OA2; OA3, OA3,5; OB2; режущий край (translucent): Т (прозрачный), ТЕ (эмалевый), СТ (пришеечная область), ТВ (синий), TG (серый), ТА (янтарный), отбеленные - W; OW; WD, (X)WB, (X)WE - 1 – 16 шт.

- инструкция по применению - 1 шт.

- шприц с гелем для травления (3/5 мл), при необходимости - 1-10 шт.

- флакон-капельница с адгезивом (5 мл/6 г), при необходимости - 1-10 шт.

- аппликаторы, при необходимости - 5-50 шт.

- иглы (канюли), при необходимости - 5-50 шт.

- пластина с лунками, при необходимости - 1-10 шт.

2. Материал «ДентЛайт-нано» в унидозах (капсулы), в составе:

- капсулы с пастой (0,25 г) оттенки (по шкале VITA): универсальные - A1; A2; A3; A3,5; A4; B1; B2; B3; B4; B5; C1; C2; C3; C4; D1; D2; D3; UD; эмали - E0; E1; E2; E3; E4; опакующие - OA2; OA3, OA3,5; OB2; режущий край (translucent): Т (прозрачный), ТЕ (эмалевый), СТ (пришеечная область), ТВ (синий), TG (серый), ТА (янтарный), отбеленные - W; OW; WD, (X)WB, (X)WE – 20-80 шт.

- инструкция по применению - 1 шт.

- шприц с гелем для травления (3/5 мл), при необходимости - 1-10 шт.

- флакон-капельница с адгезивом (5 мл/6 г), при необходимости - 1-10 шт.

- аппликаторы, при необходимости - 5-50 шт.

- иглы (канюли), при необходимости - 5-50 шт.

- пластина с лунками, при необходимости - 1-10 шт.

- диспенсер для внесения материала, при необходимости - 1 шт.



В данном документе
пронумеровано, прошито
и скреплено печатью
25 листа(ов)
зам.нач. ТО Курсенко З.В.