



Фотографии
медицинского изделия для диагностики in vitro

**Набор реагентов для калибровки «MagnoLIA Краснуха IgG»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Вариант исполнения 1 – стр. 2-4

Вариант исполнения 2 – стр. 5-7

Калибраторы 1, 2, 3, 4 – стр. 8-11

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E002

Набор реагентов для калибровки

«MagnaLIA Краснуха IgG»



MagnaLIA

Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA Краснуха IgG»

Состав набора:

Калибратор 1	1 фл.
Калибратор 2	1 фл.
Калибратор 3	1 фл.
Калибратор 4	1 фл.

Готово к использованию.

Для профессионального применения.

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для калибровки «MagnaLIA Краснуха IgG»

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E002

Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA Краснуха IgG»

LOT

E002



2020-12-15



REF

2010101



2021-12-15



IVD



10



ТУ 21.20.23-476-98539446-2019
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX



ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E002

Набор реагентов для калибровки

«MagnoLIA Краснуха IgG»

Флаконы 3 мл 125



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA Краснуха IgG»



Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA Краснуха IgG»

Состав набора:

Калибратор 1	5 фл.
Калибратор 2	5 фл.
Калибратор 3	5 фл.
Калибратор 4	5 фл.

LOT E002

2020-12-15

+2⁺8



REF 2010105

2021-12-15



IVD



ТУ 21.20.23-476-98539446-2019
РУ № XXXXXXXXXXXXX

Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HbAg отсутствуют.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для калибровки «MagnaLIA Краснуха IgG»

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для калибровки

«MagnaLIA Краснуха IgG»

MagnaLIA Краснуха IgG

LOT E002

2021-12-15

REF 2010105

+2⁺8
°C

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
тел./факс: +7(812)6778779, 6772182
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

ООО «Компания Алюр Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для калибровки

«MagnoLIA Краснуха IgG»





ООО "Компания Алкор Био"



+2
+8



объем 1,0 мл

Калибратор 1

Magnolia
Краснуха 100



ООО "Компания Алкор Био"




+2
+8



объем 0,5 мл

Калибратор 2

Магнолия
Красная IgG

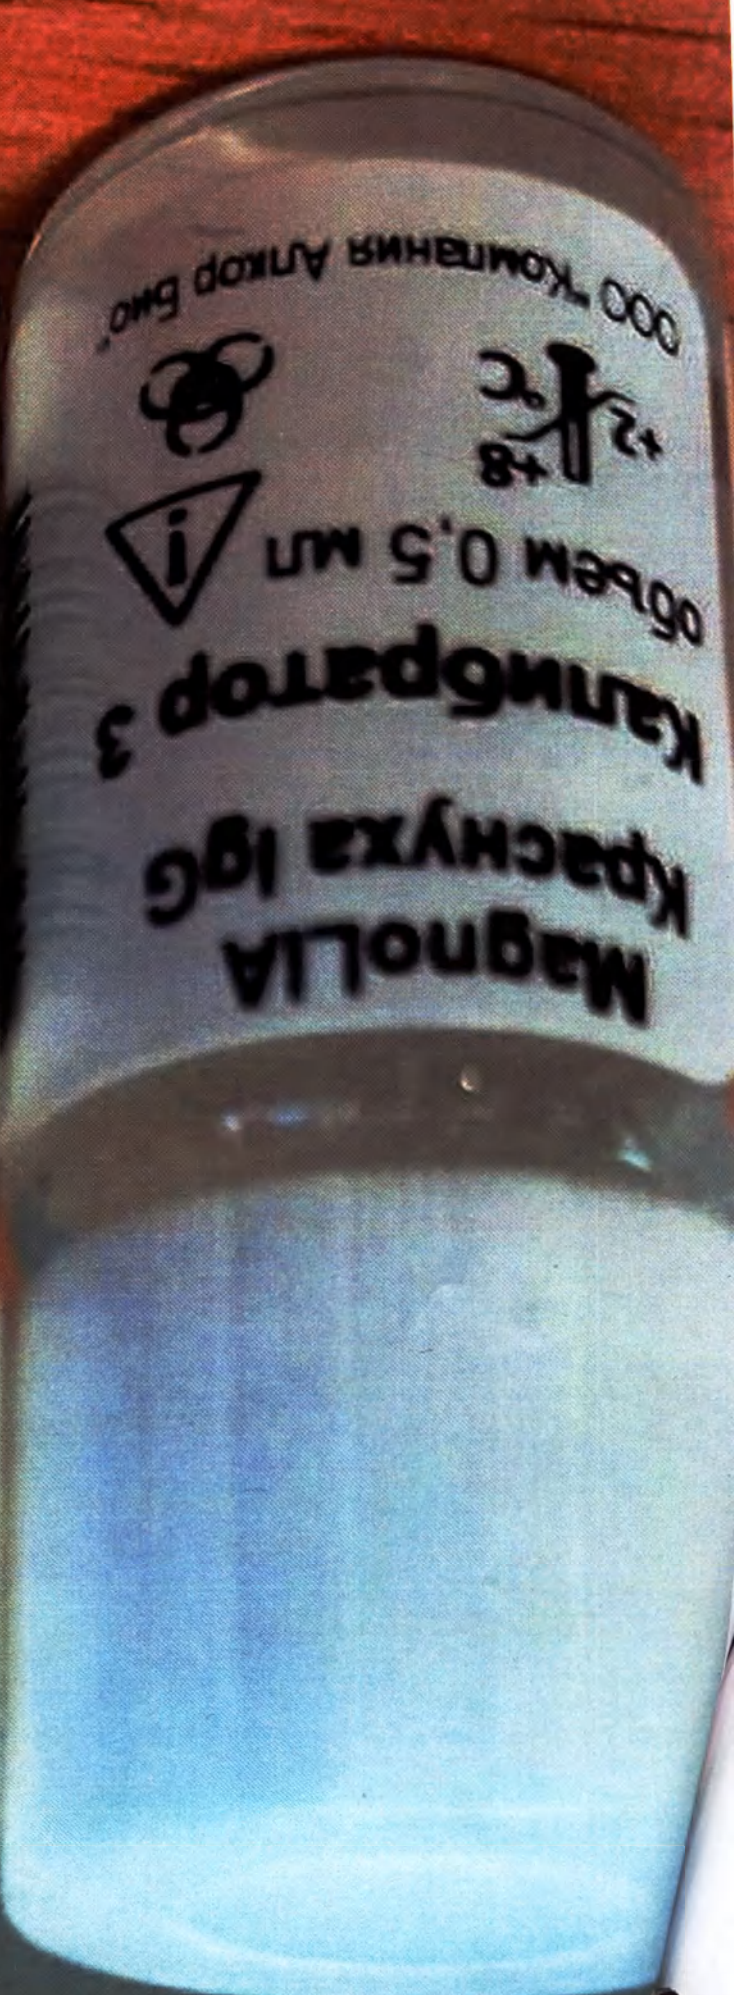

ООО "Компания Алкор Био"



2+
8



объем 0,5 мл

Калибратор 3

Магнолия
Красная IgG



ООО "Компания Алкор Бино"



+2%
+8



объем 1,0 мл

Калибратор 4

Магнолия
Краснуха 196

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 11 (одинадцать) листов

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Д.Г. Польшцев

