


Фотографические изображения

«Реагенты в кассете для количественного определения фруктозамина в сыворотке и плазме крови на модулях биохимических cobas c (FRA/ Fructosamine cobas c systems)»

модули в кассете для количественного определения фруктозамина в сыворотке и плазме крови на модулях химических cobas c (FRA/ Fructosamine cobas c systems)




модулях в кассете для количественного определения фруктозамина в сыворотке и плазме крови на модулях химическх cobas c (FRA/ Fructosamine cobas c systems)

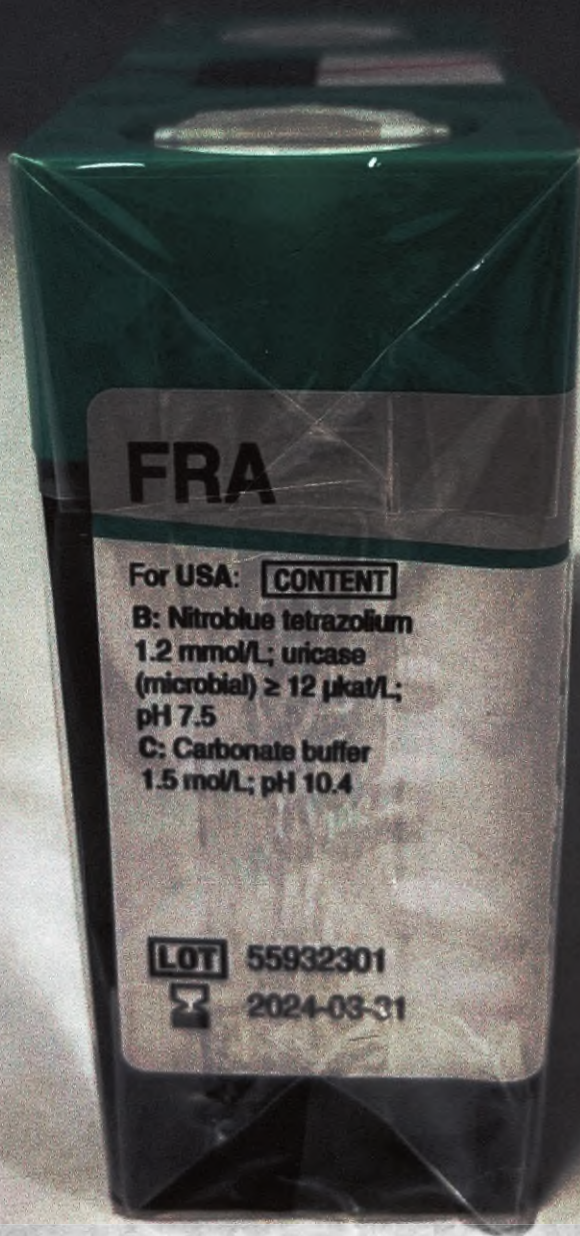

в кассете для количественного определения фруктозамина в сыворотке и плазме крови на модулях химических cobas c (FRA/ Fructosamine cobas c systems)



в кассете для количественного определения фруктозамина в сыворотке и плазме крови на модулях биохимических cobas c (FRA/ Fructosamine cobas c systems)

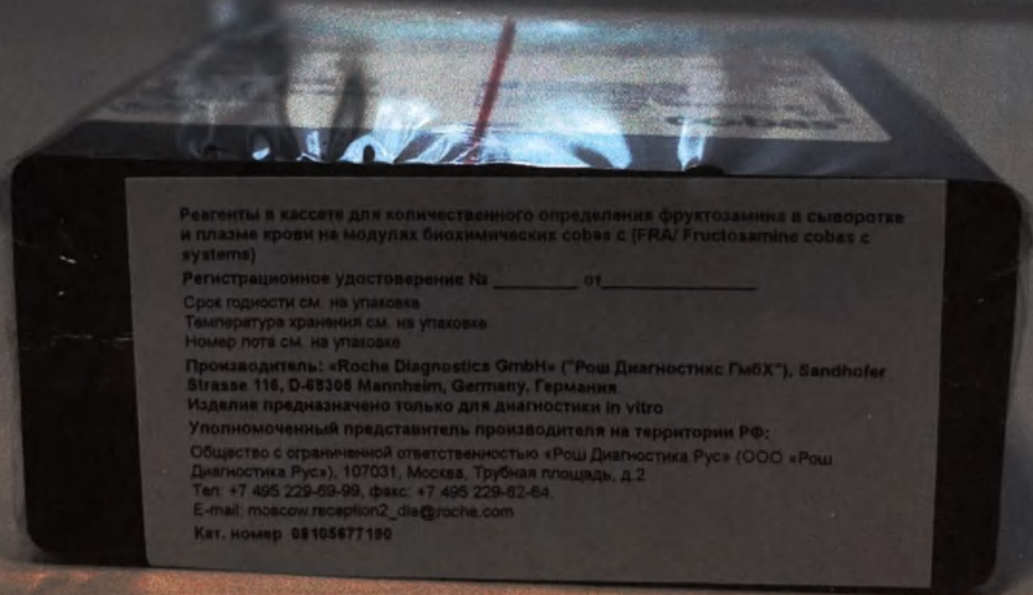

Реагенты в кассете для количественного определения фруктозамина в сыворотке и плазме крови на модулях биохимических cobas c (FRA/ Fructosamine cobas c systems)

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 118, D-68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2

Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64

E-mail: moscow_reception2_dia@roche.com

Кат. номер: 08105677190

Всего пронумеровано,
прощнуровано и
скреплено печатью

5 листа (ов)



по доверенности
от 04.02.2021