



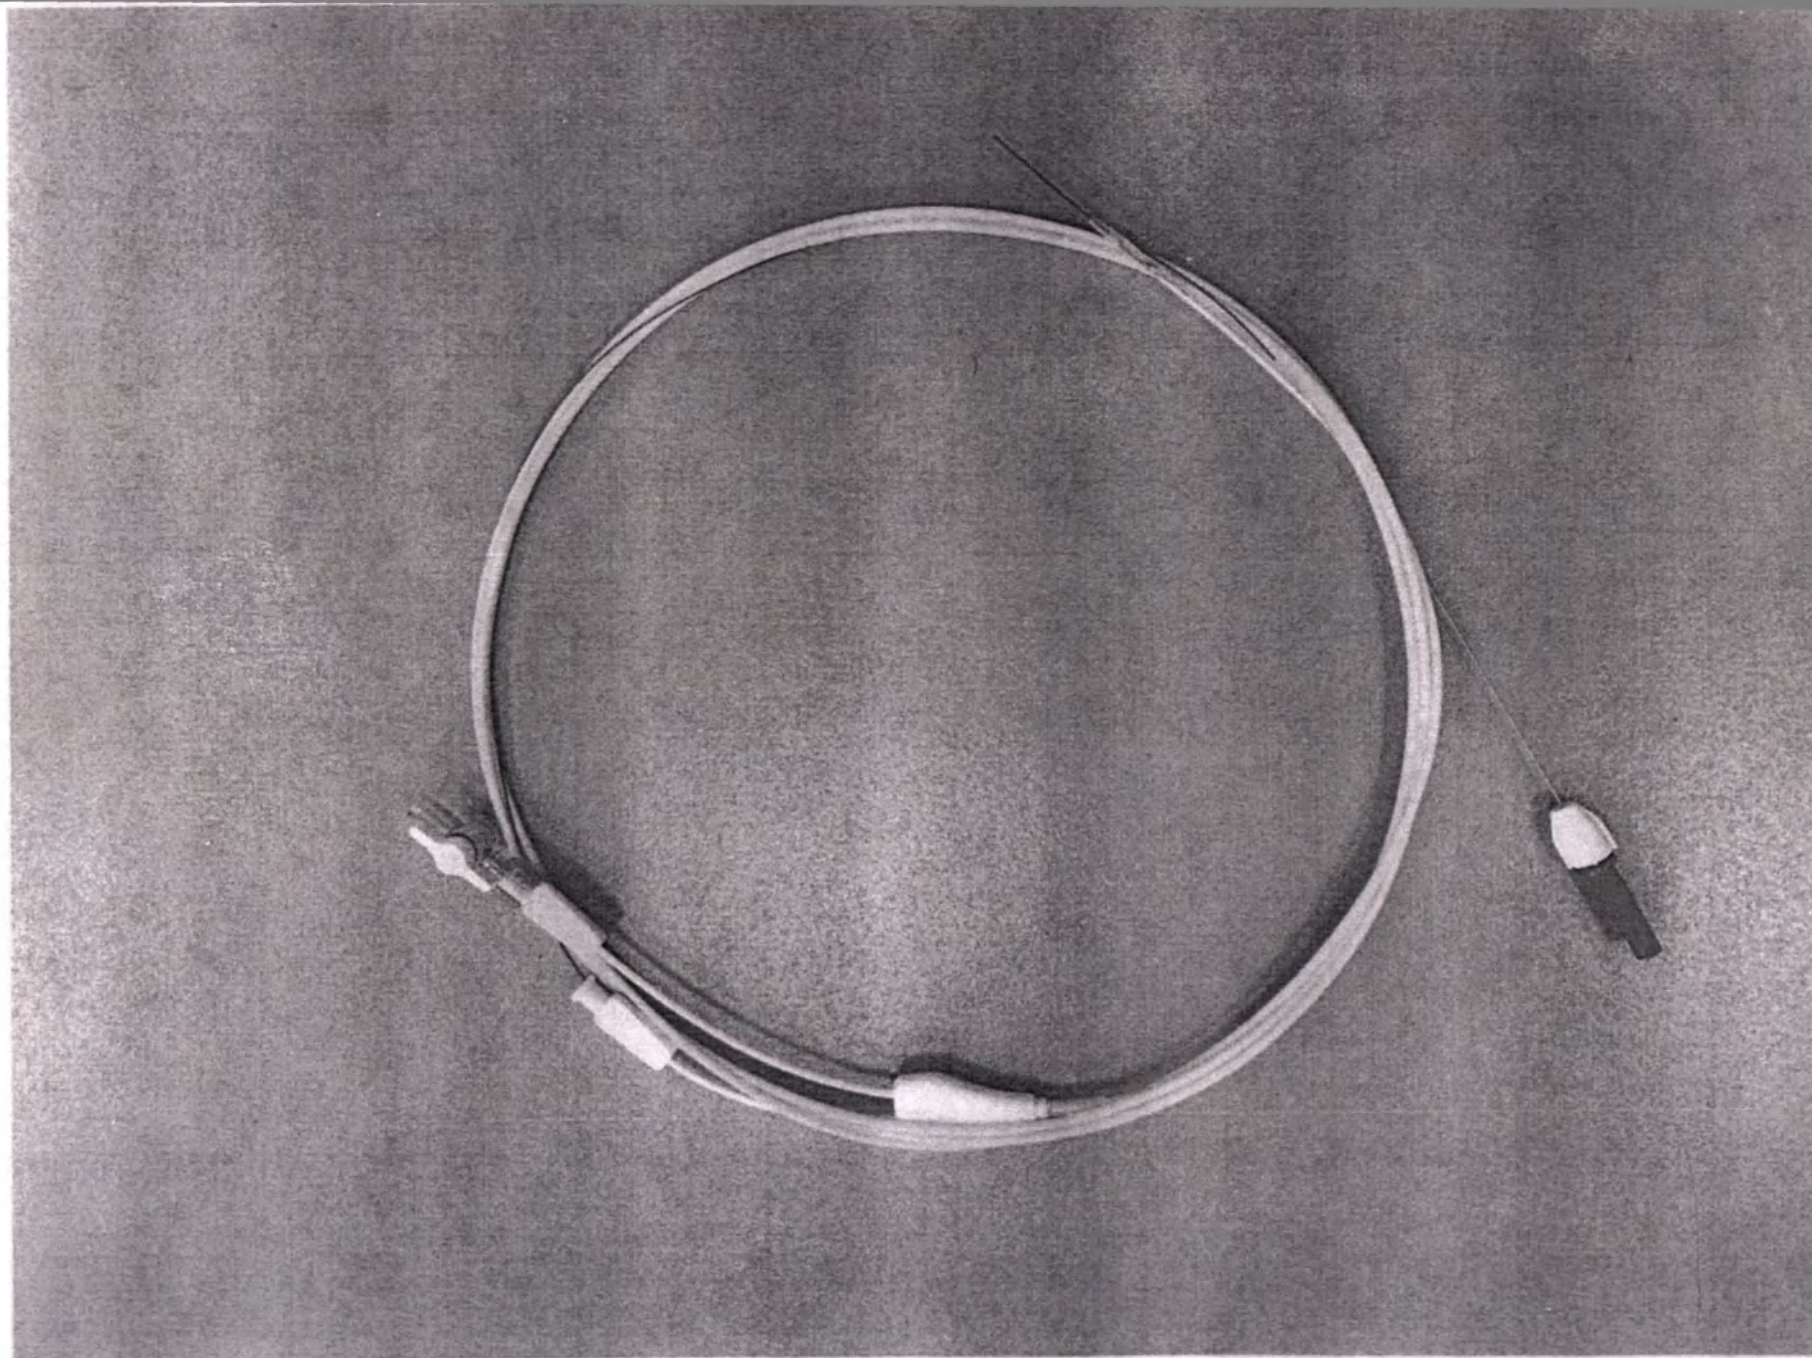

Инструменты эндоскопические расширители с принадлежностями по ТУ 32.50.13-208-89134710-2020 (Баллон-расширитель для экстракции, одноразовый, диаметр баллона 9-12 мм, диаметр тефлонового катетера 2,31 мм, длина катетера 200 см, для канала 2,8 мм, артикул EXT9-12-200)


ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

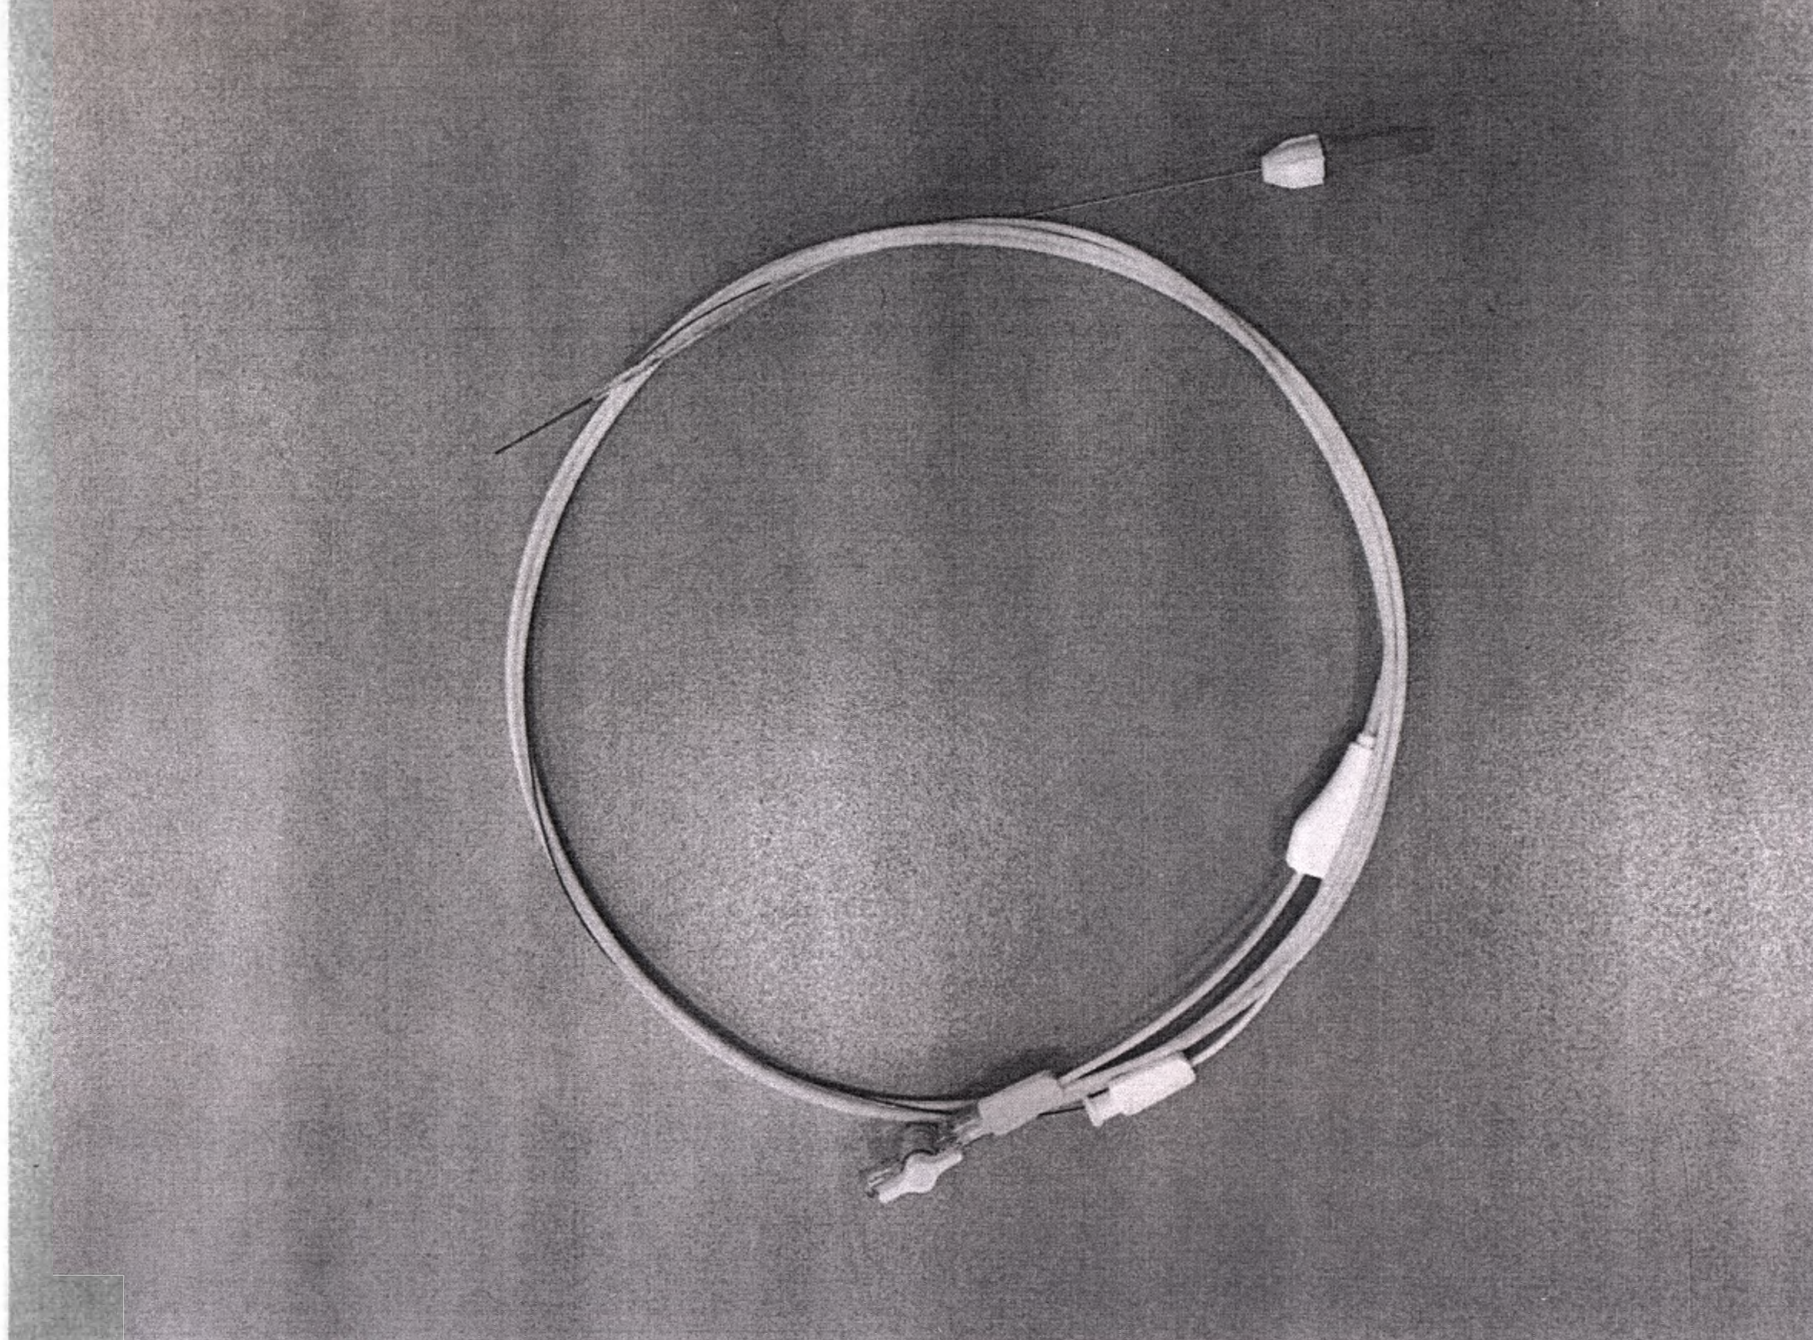


Инструменты эндоскопические расширители с принадлежностями по ТУ 32.50.13-208-89134710-2020 (Баллон-расширитель для дилатации трехшаговый с проводником, одноразовый,

диаметр баллона 18/19/20 мм, длина баллона 30 мм, диаметр тefлонового катетера 2,31 мм, длина катетера 180, для канала 2,8 мм, артикул DIL30-18-19-20-180)


ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru

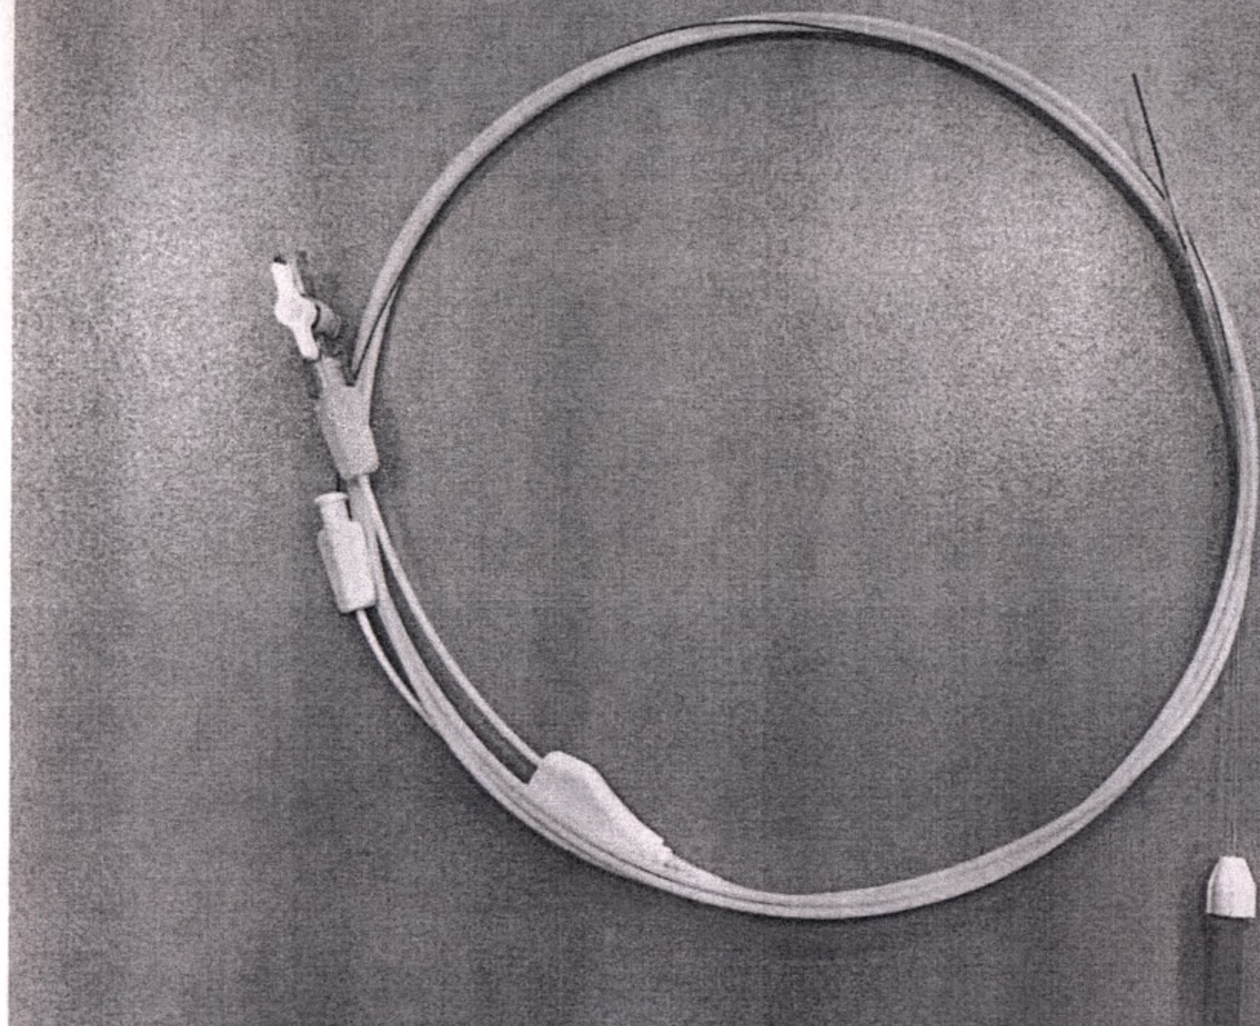

Инструменты эндоскопические расширители с принадлежностями по ТУ 32.50.13-208-89134710-2020 (Баллон-расширитель для ахалазии, одноразовый, диаметр баллона 30 мм, длина баллона 80 мм, диаметр тefлонового катетера 4,7 мм, длина катетера 100 см, артикул АСН80-30-100)

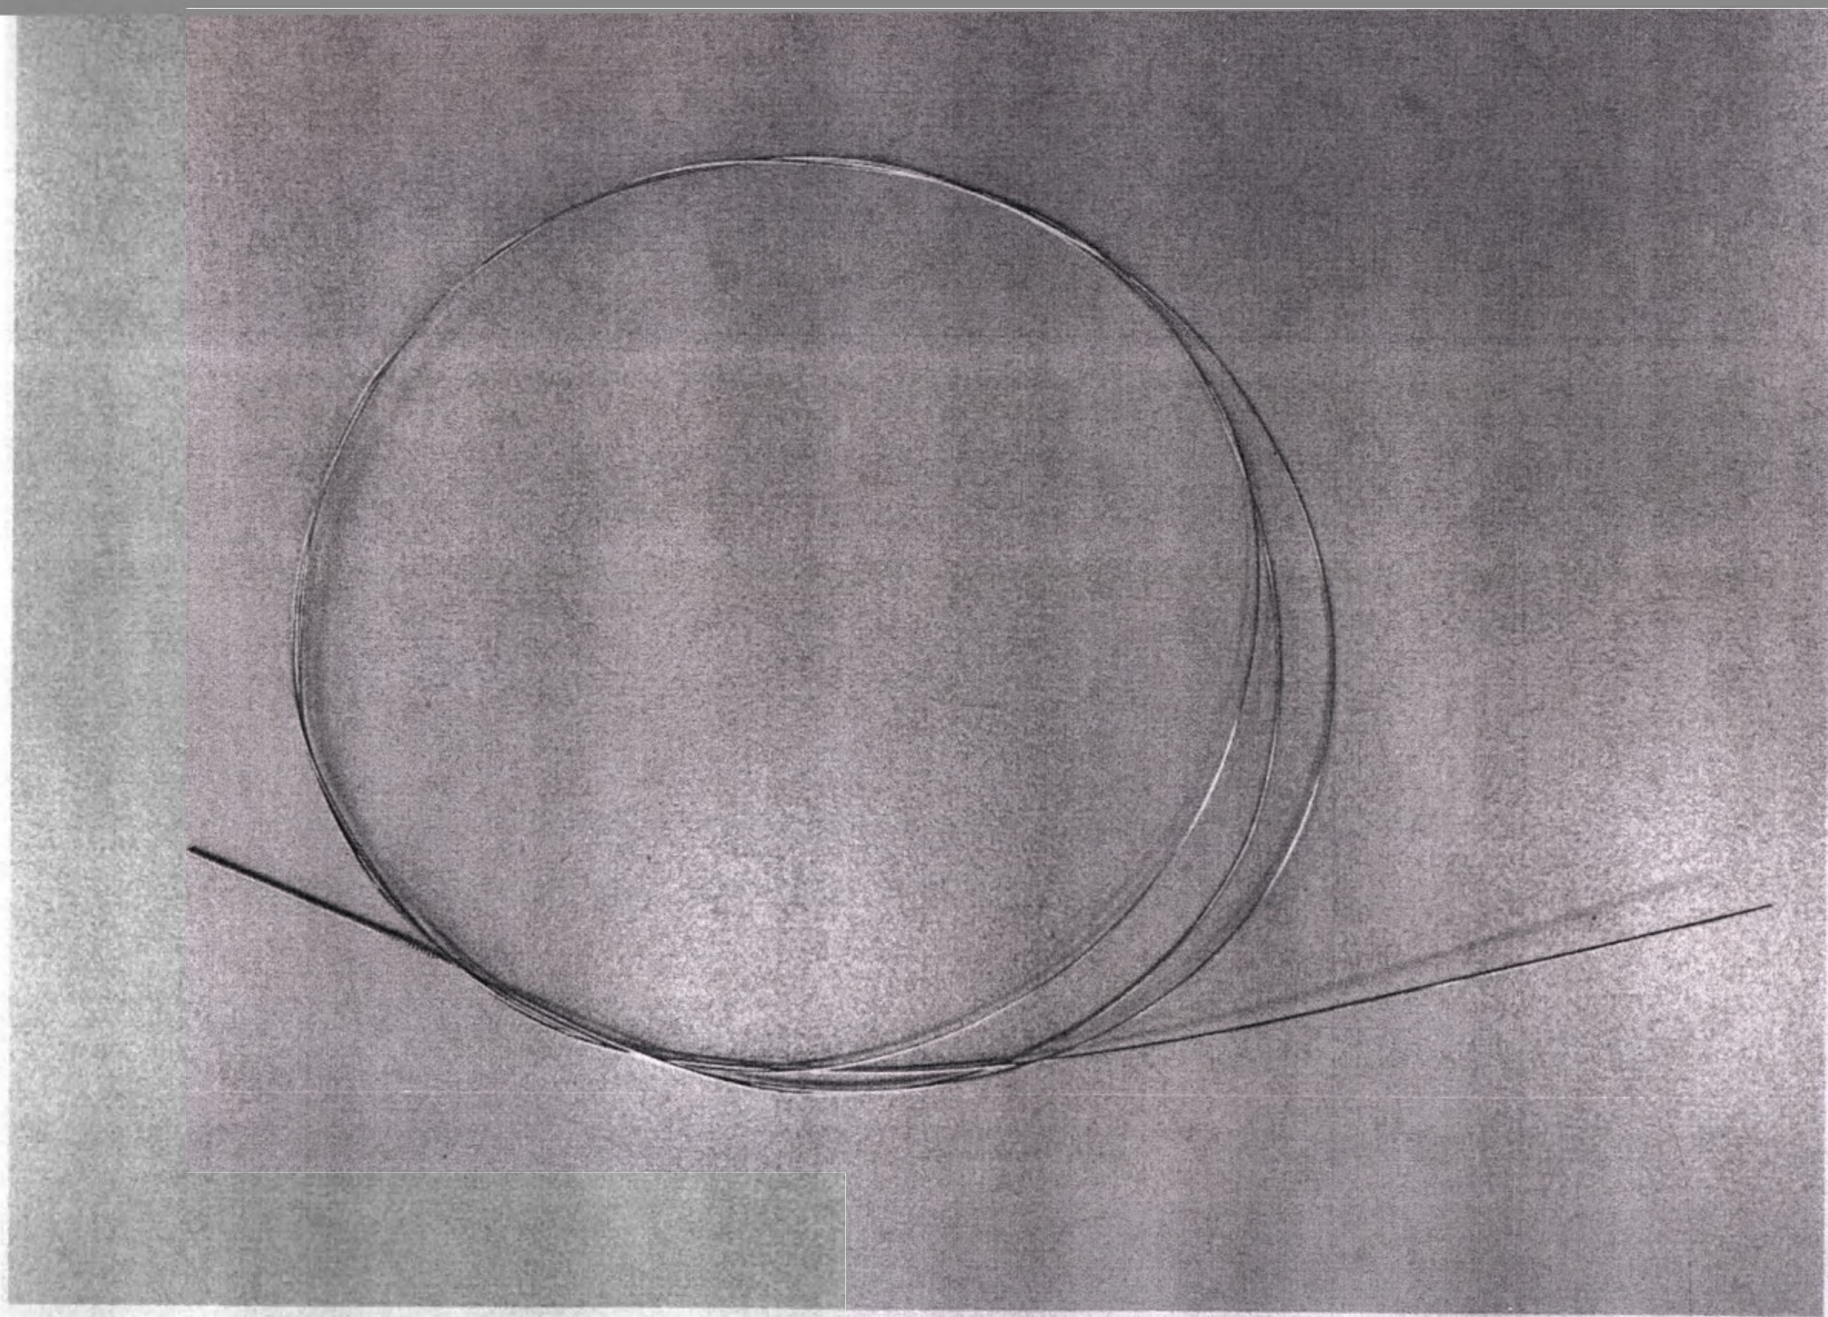


Инструменты эндоскопические расширители с принадлежностями по ТУ 32.50.13-208-89134710-2020 (Проводник, стальная струна, диаметр 0,635 мм, длина 400 см, артикул GW400ST-0

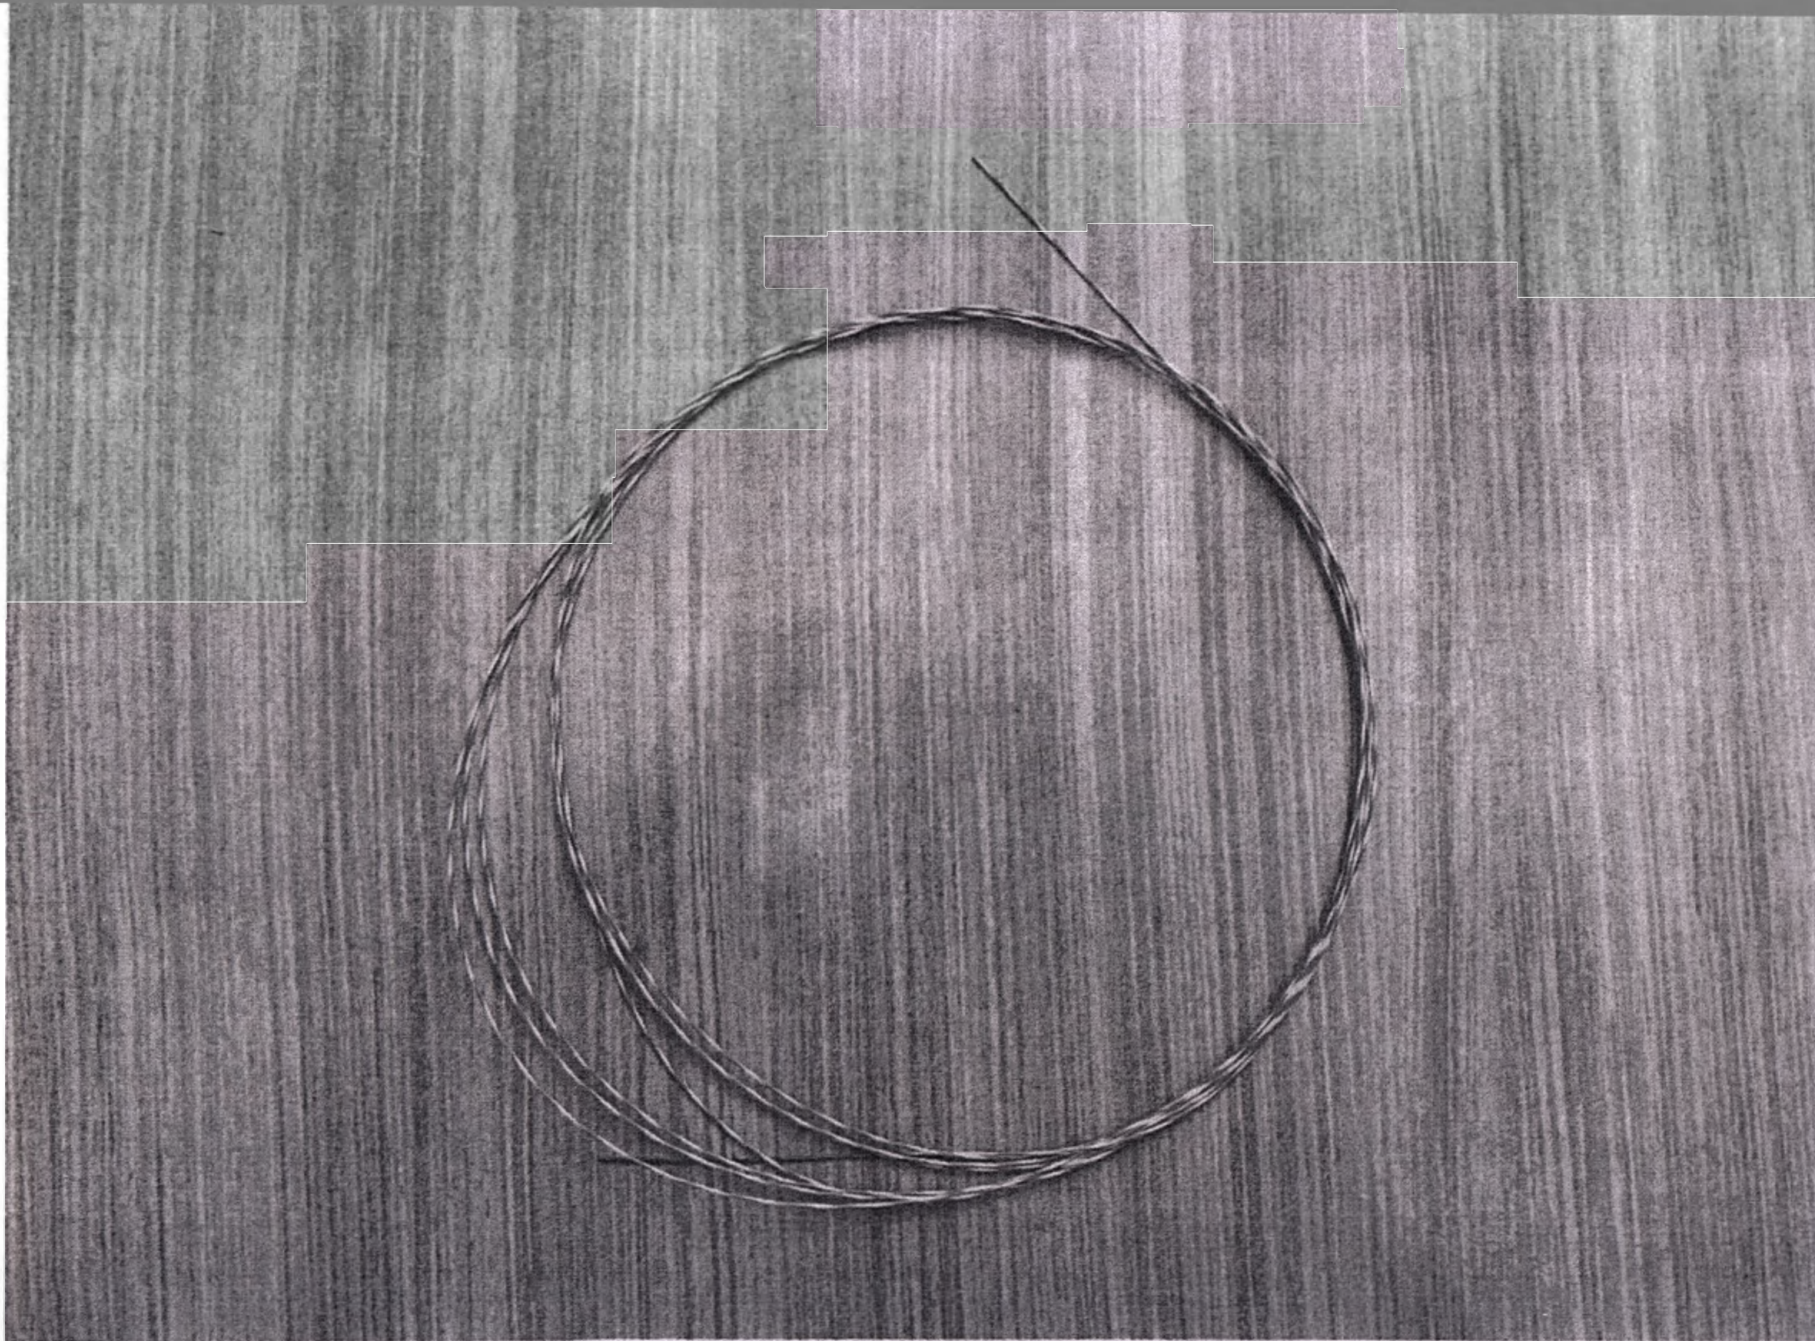


Инструменты эндоскопические расширители с принадлежностями по ТУ 32.50.13-208-89134710-2020 (Проводник нитиноловый изогнутый, диаметр 0,889 мм, длина 450 см, артикул

СМ460110.8.0


ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

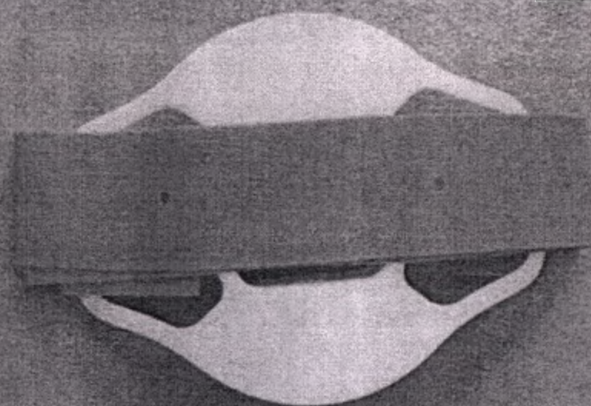


Инструменты эндоскопические расширители с принадлежностями по ТУ 32.50.13-208-89134710-2020 (Загубник с резиновым ремешком, артикул ВВ-02)

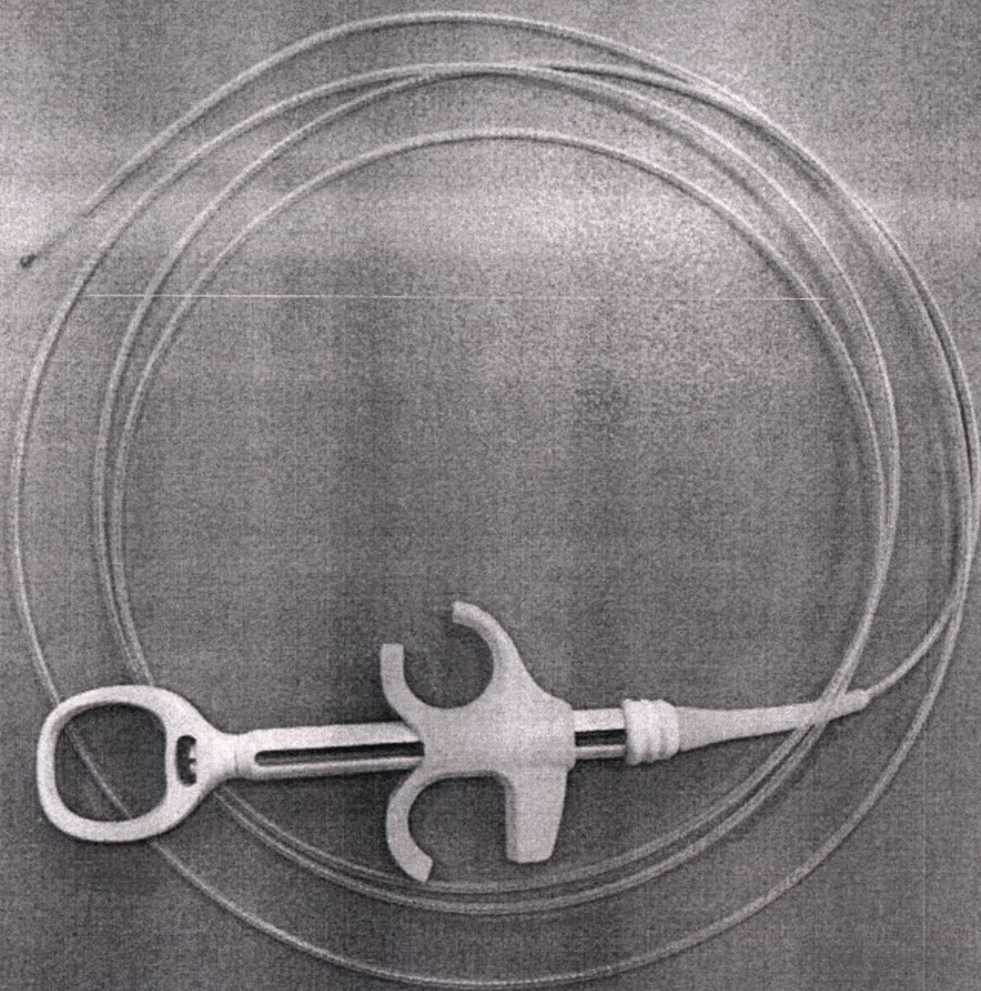

Инструменты эндоскопические расширители с принадлежностями по ТУ 32.50.13-208-89134710-2020 (Щетка цитологическая, диаметр инструмента 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 240 мм, длина щетки 12 мм, диаметр щетины 3,0 мм, артикул СВ-30-240)

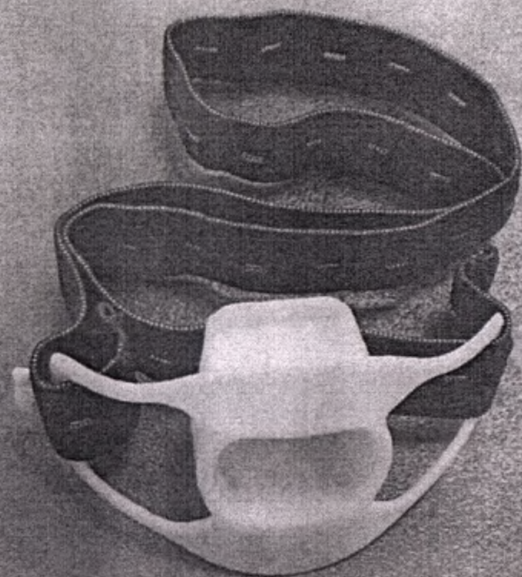

Инструменты эндоскопические расширители с принадлежностями по ТУ 32.50.13-208-89134710-2020 (Загубник с тканевым ремешком, артикул ВВ-03)

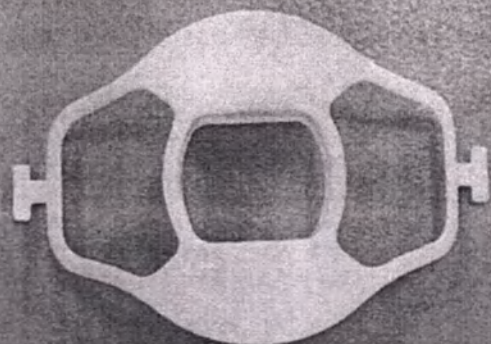

Инструменты эндоскопические расширители с принадлежностями по ТУ 32.50.13-208-89134710-2020 (Загубник без ремешка, артикул ВВ-01)

Баллон-расширитель для дилатации
трехшаговый с проводником

32 50 13-208-89134710-2020

сертификат № СДС НПС 1058МИ 05/18

REF DIL30-18-19-20-180

LOT 20201020-02



Диаметр баллона
18/19/20 мм

Длина баллона
30 мм

Длина
1800 мм

Для канала
2,8 мм

Диаметр
инструмента
2,31 мм



2020-10

STERILE EO



2023-09



(01)04048467004694(17)141126(10)91324



ООО «Эндо Старс» (Россия)
197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 27А, 12Н
тел.: 8(800) 555-56-57,
+7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-stars.ru
www.endo-stars.ru

EndoStarts

all you need for endoscopy

Инструменты эндоскопические расширители с принадлежностями по ТУ 32.50.13-208-89134710-2020 (Пример маркировки)

ООО «Эндо Старс»
Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 10
10/10/10 листах

Генеральный директор
Самарец В.С.

