
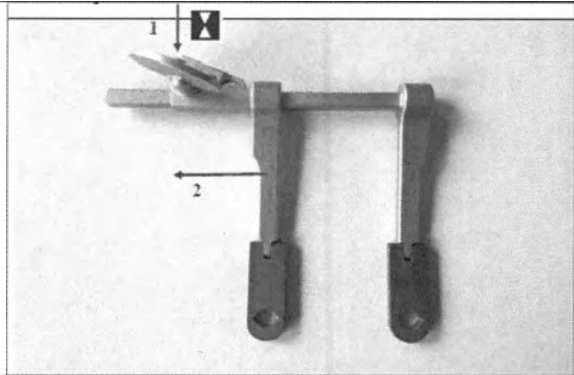
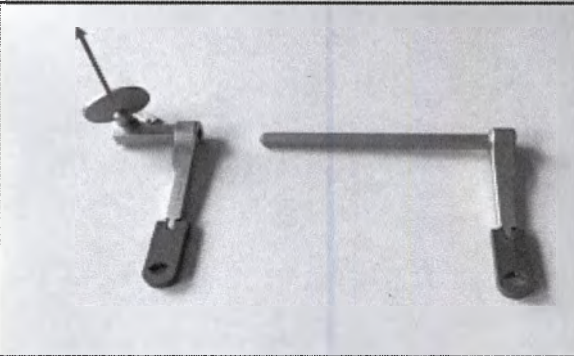
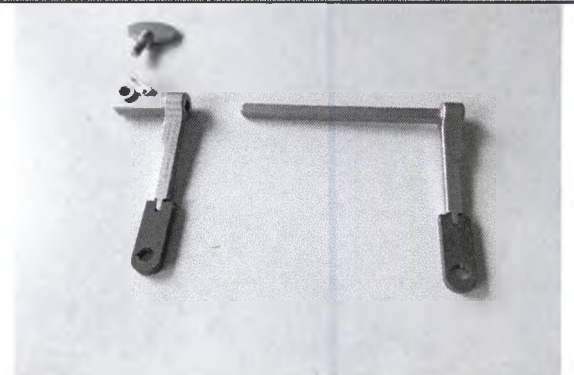


Сфотографируйте изделие или воспользуйтесь чертежами, чтобы как можно более подробно продемонстрировать все этапы сборки и разборки. Не используйте изображения большого объема во избежание проблем с загрузкой и скачиванием. Перечислите все этапы разборки в правильном порядке. Затем перечислите все этапы сборки, также соблюдая порядок. Если применимо, добавьте пиктограммы из набора пиктограмм ниже. Отправьте свои инструкции по разборке и сборке для получения первого одобрения гарантированного уровня стерильности.

Шейный ретрактор U22-73010 / U22-730110


1			
2			
3			

Держатель шейных кейджей 396.989, держатель для системы SynCage-C 396.990, держатель для системы Visios и 397.089

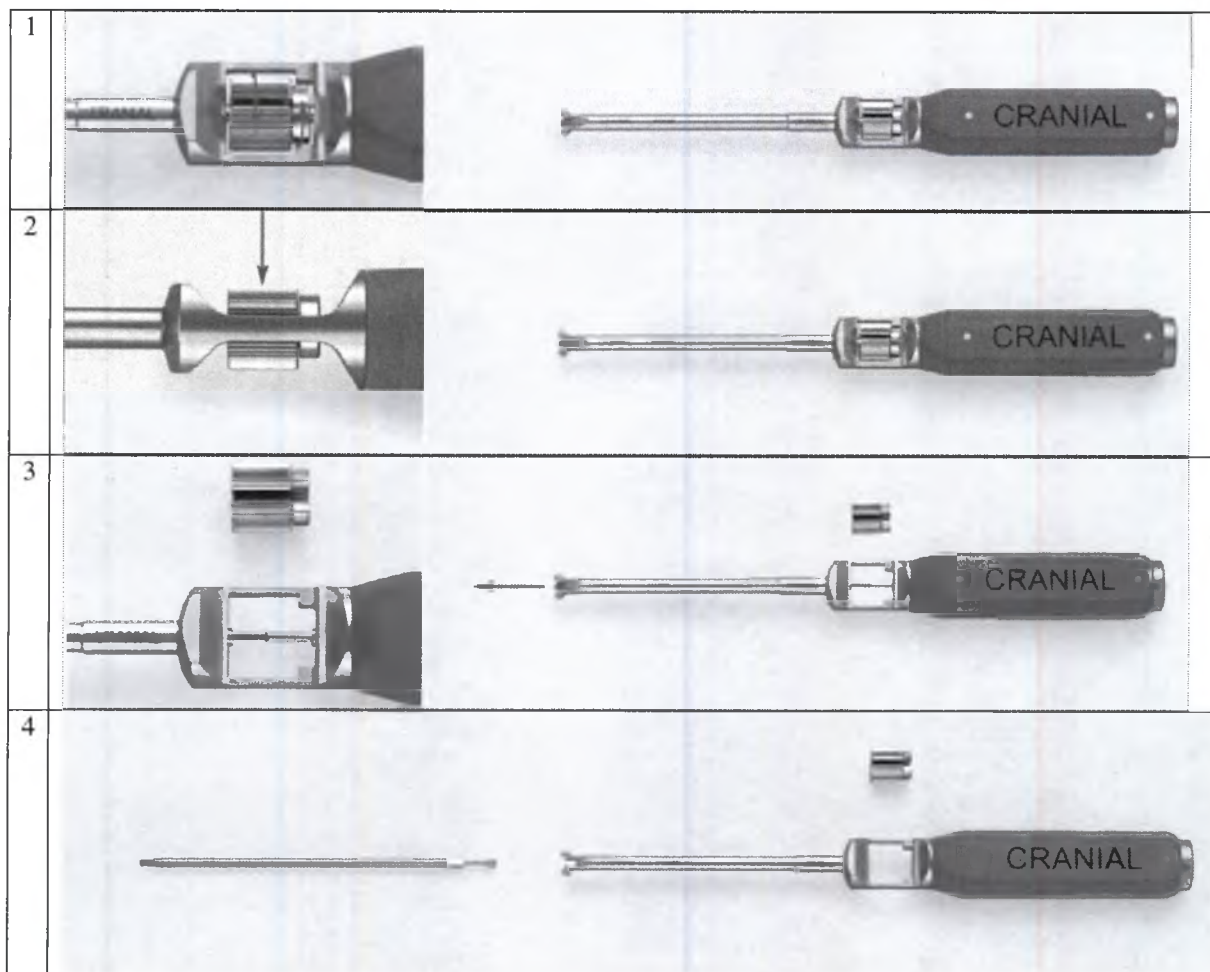



Модуль для Cervios 396.996



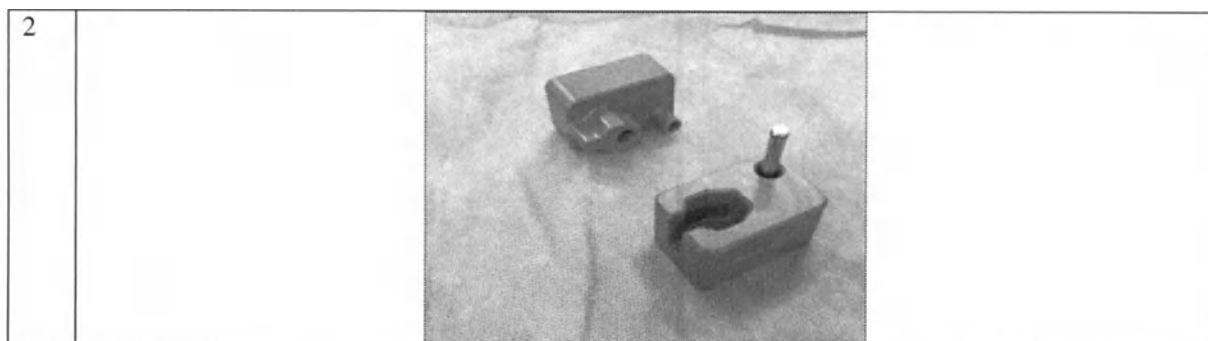


Шестигранный вкладыш 03.620.091

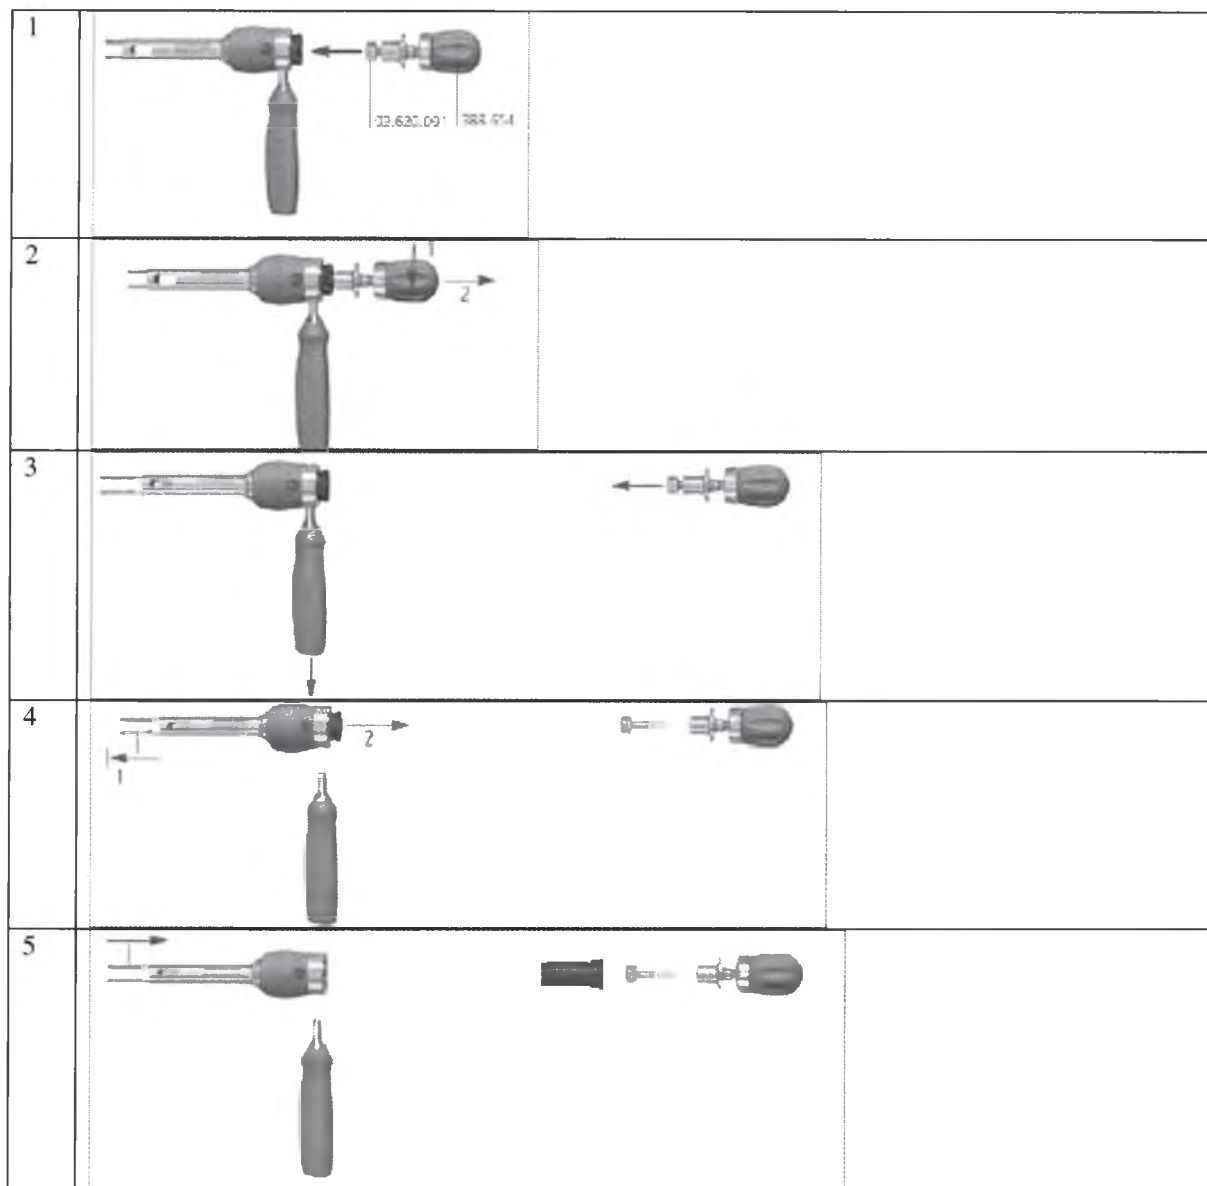



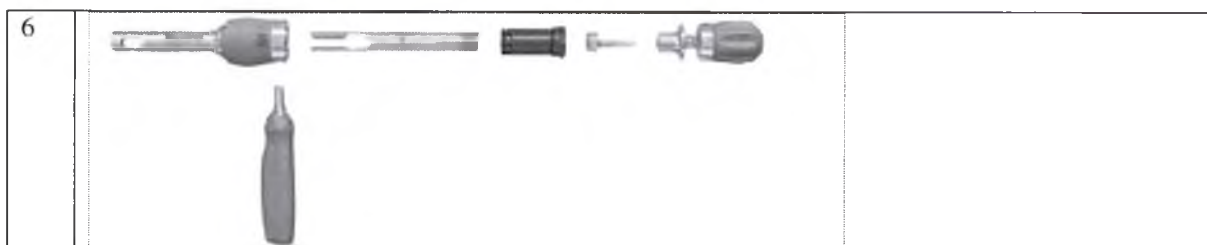


Троакары 03.606.020, 03.606.021, 03.606.020
 Канюлированное педикулярное шило диаметром 3,8 L255, 03.600.03, канюлированное
 педикулярное шило диаметром 5,6 L255, 03.600.030,
 Троакар для канюлированного шила 03.616.062



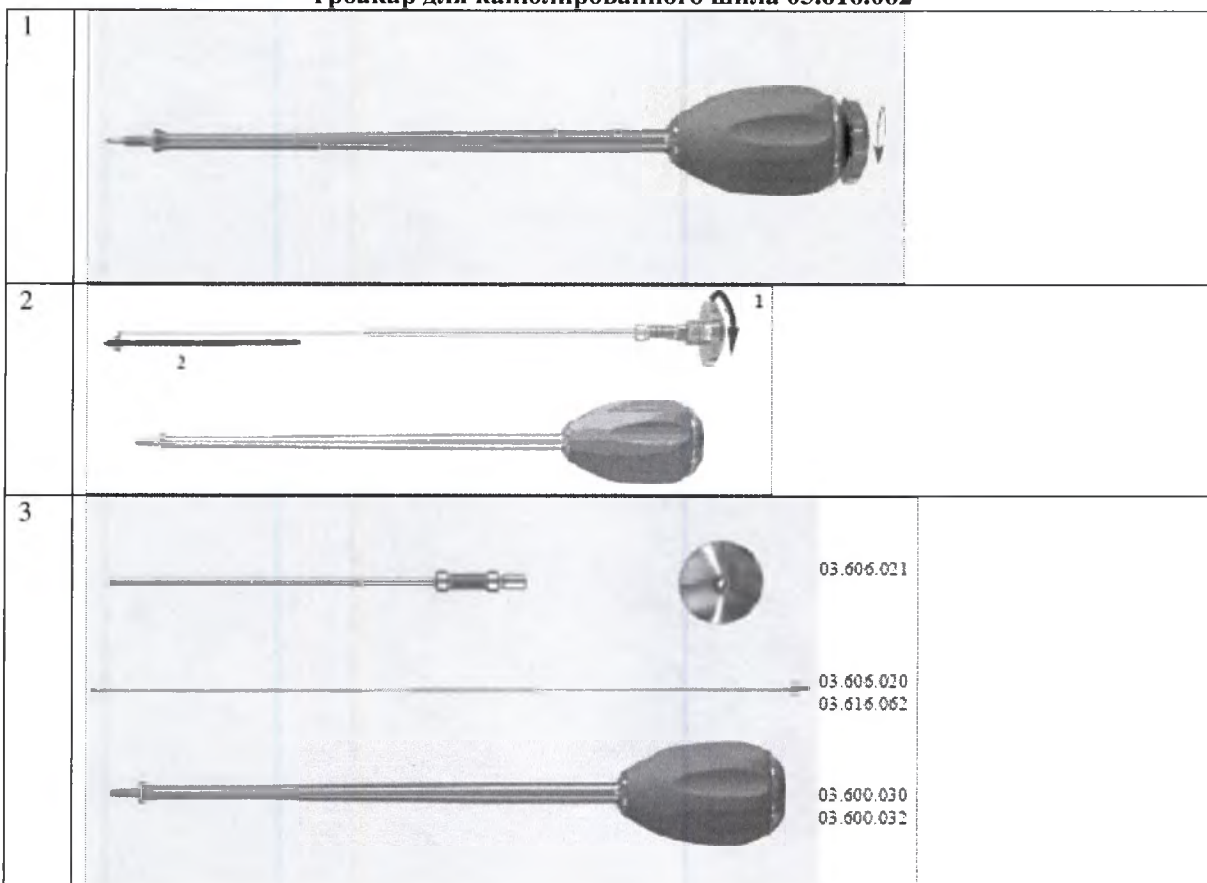


Экстрактор Click'X 388.353


Инструкции по разборке

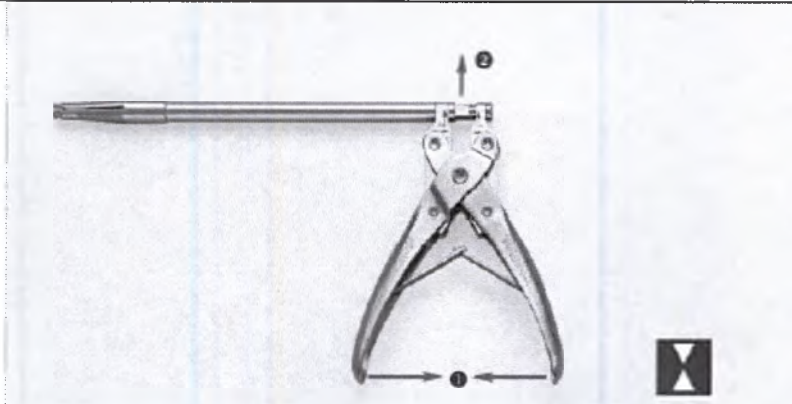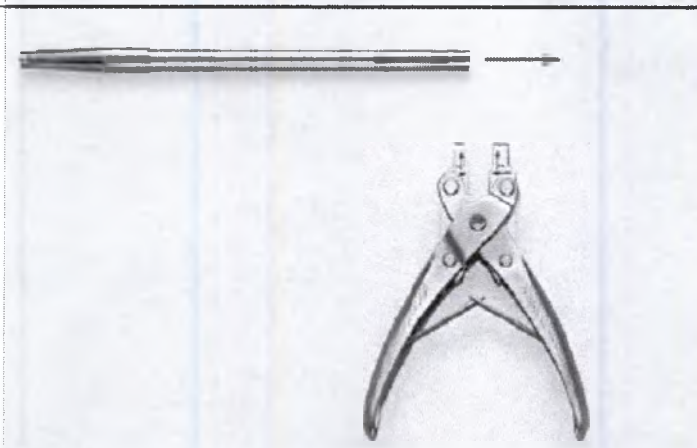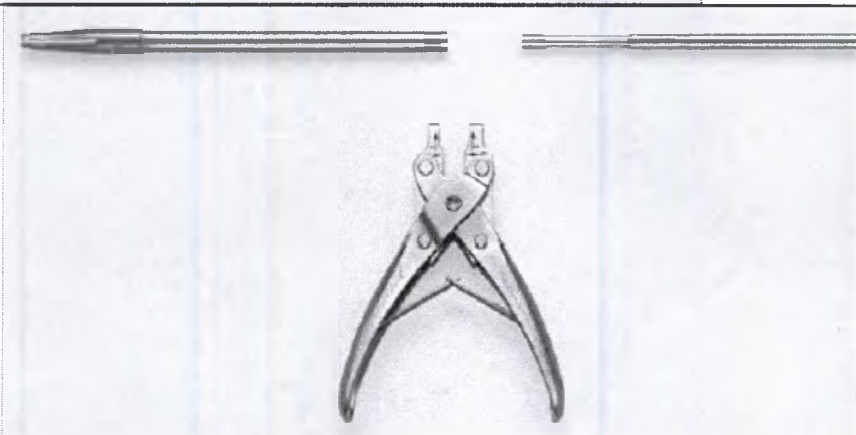1		
2		
3		


Инструкции по сборке

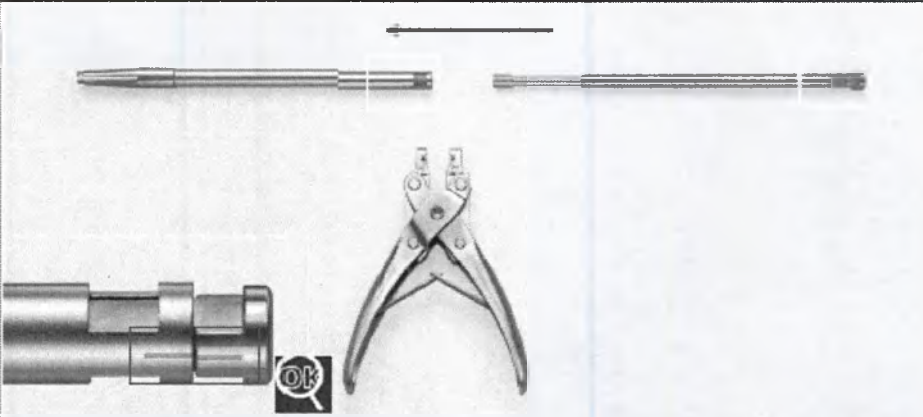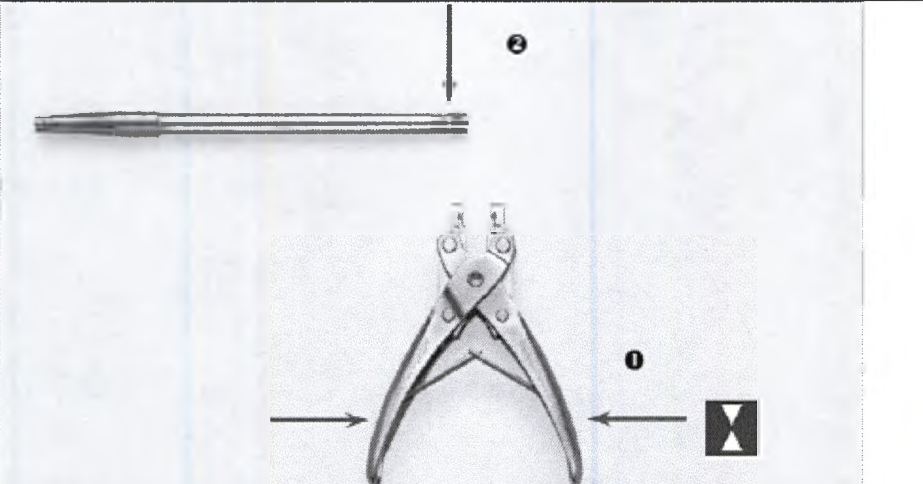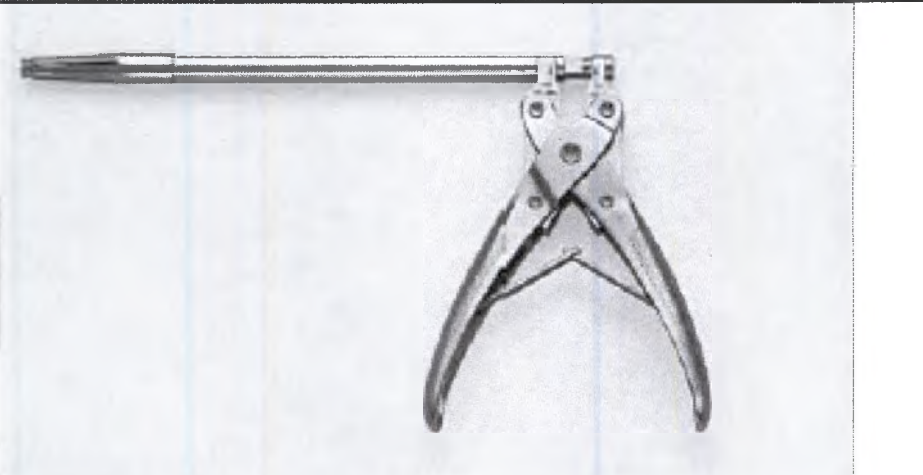
1		
2		
3		

Репозиционное устройство Click'X 388.358

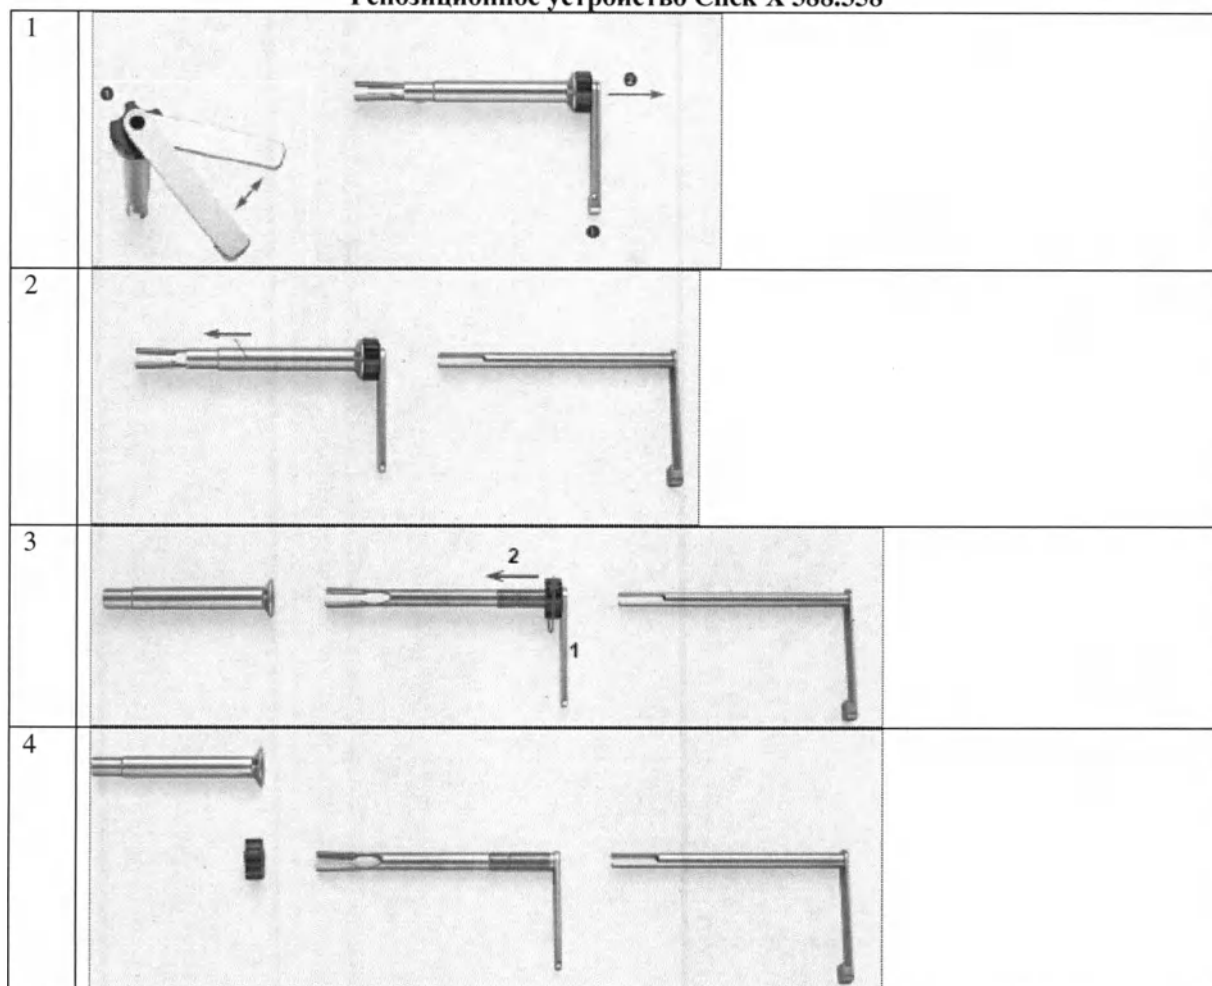


Держатель Click'X 388.362, длинная зажимная гильза длина 245 мм, 03.010.371

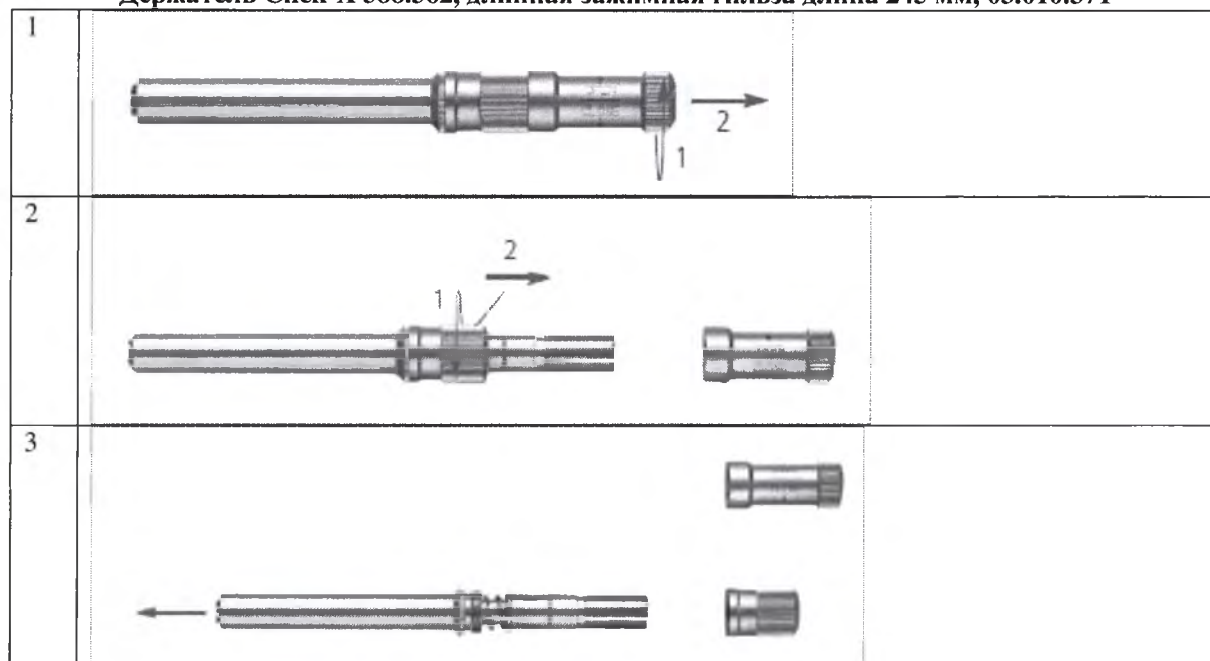


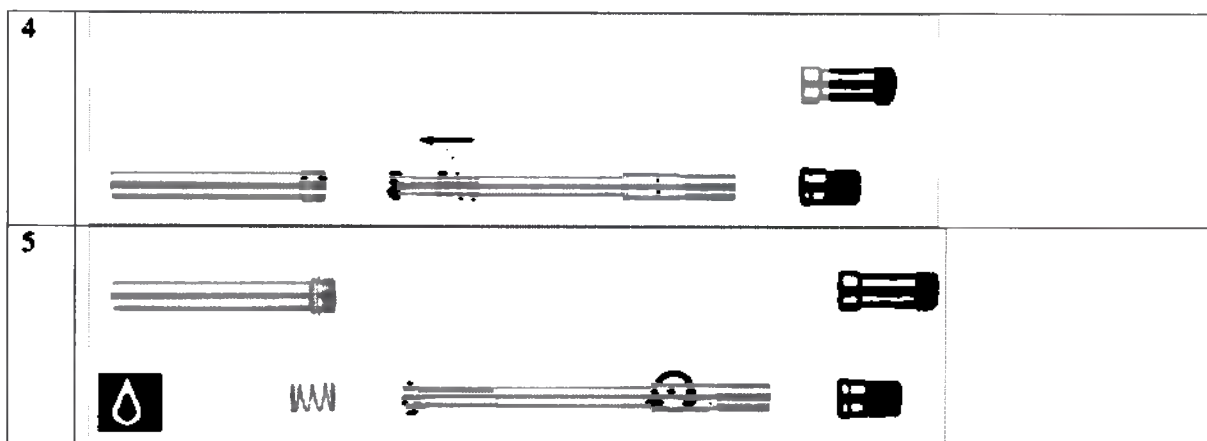


Направитель
Click'X 388.359

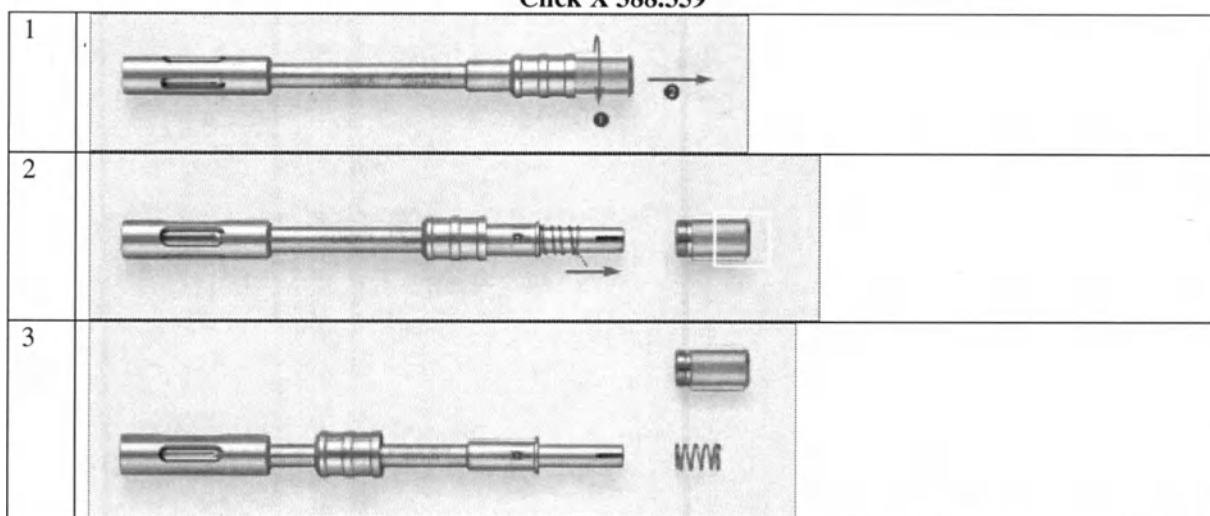


Измеритель 319.011


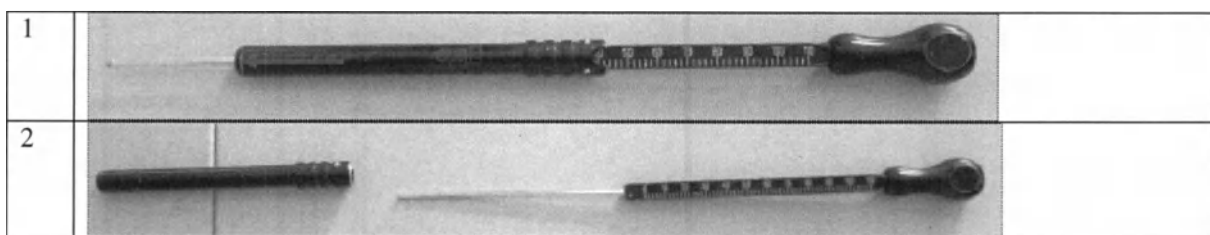


Направитель сверла CSLP 3,0 самоудерживающийся 387.201

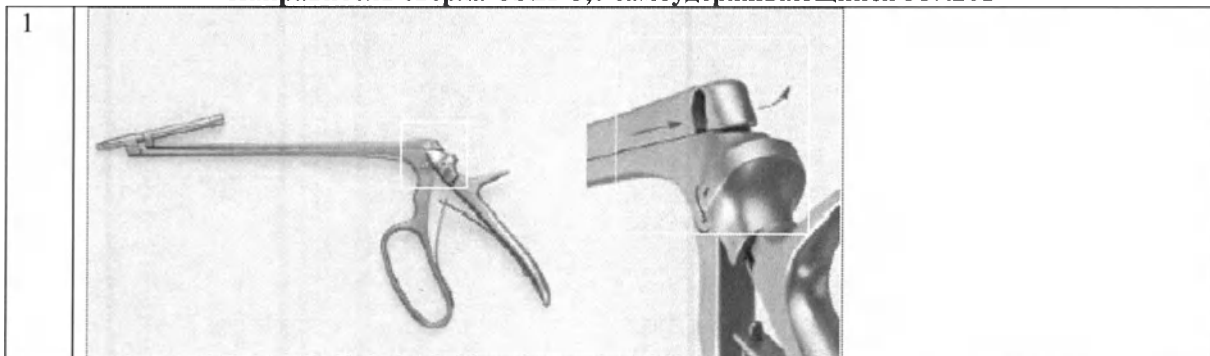


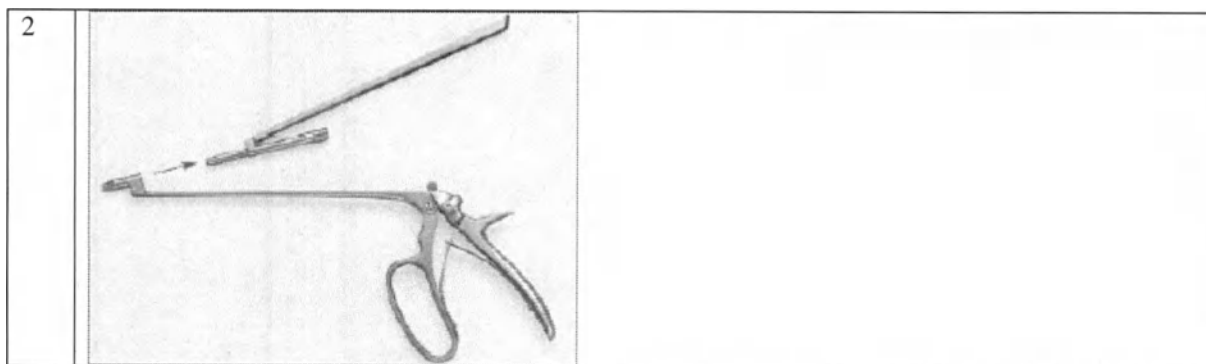


Т-рукоятка для быстроразъемного соединения, канюлированная 03.630.133

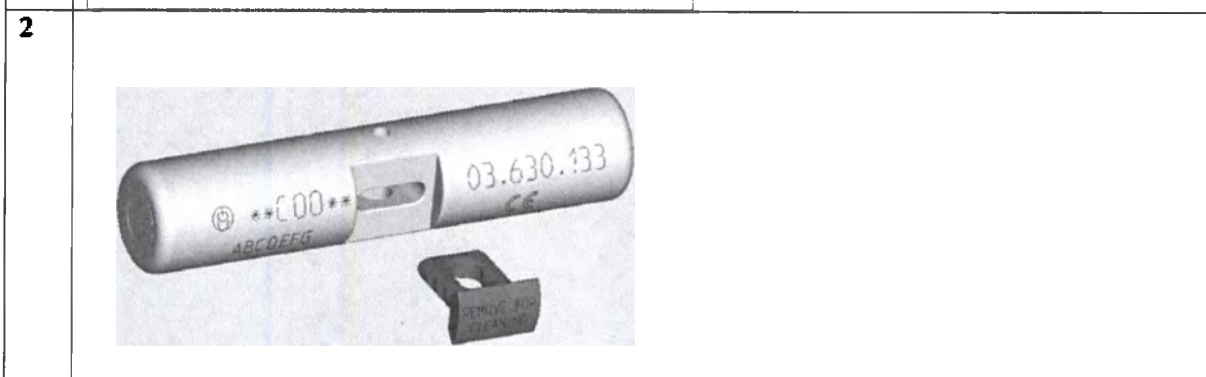
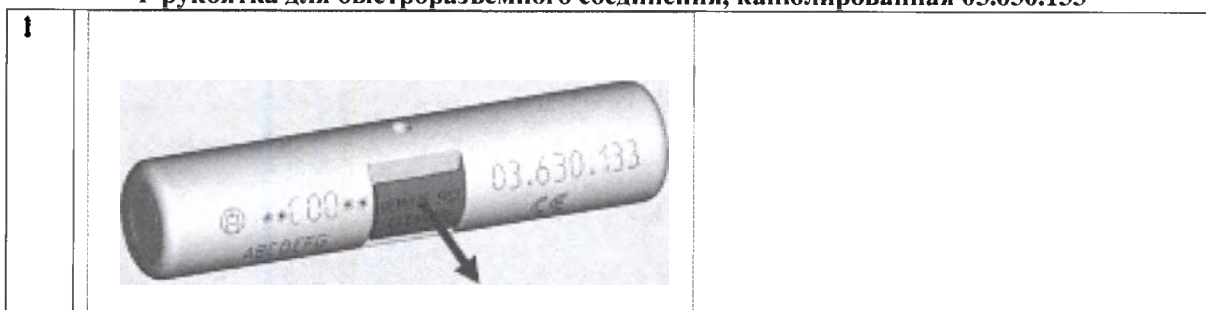


Держатель имплантата для системы FACET WEDGE 03.630.135

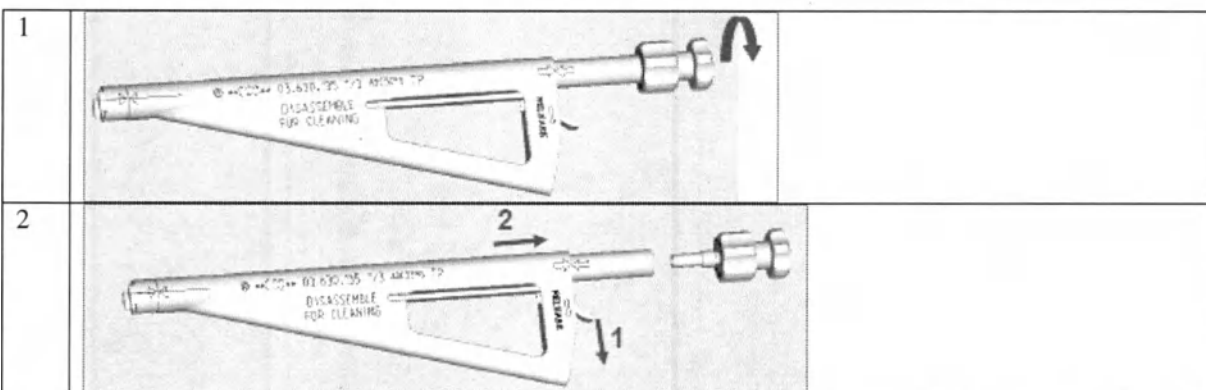


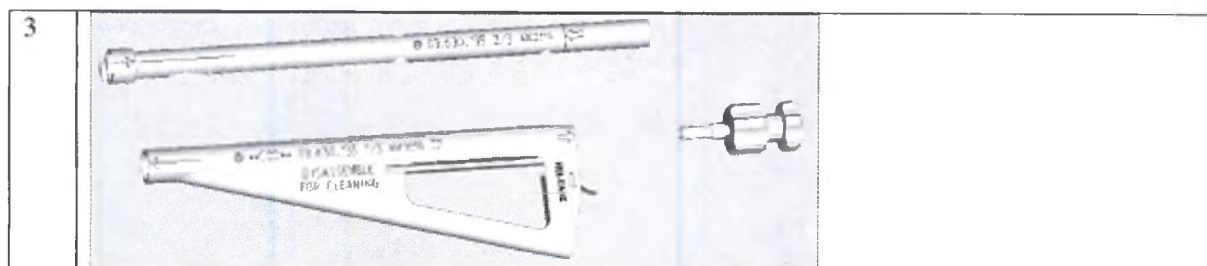


Ретрактор продольный 03.615.100, Ретрактор поперечный 03.615.002

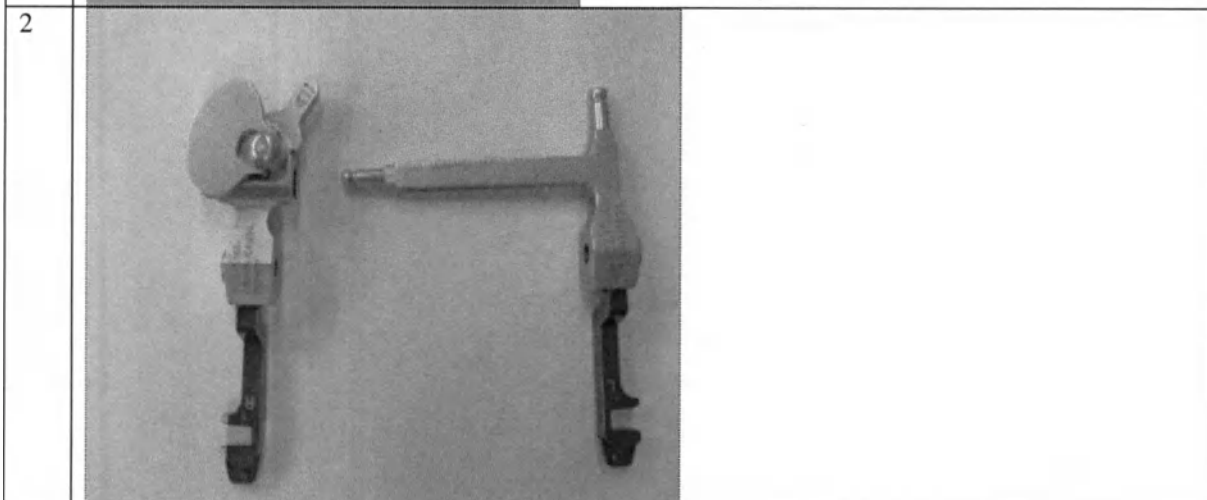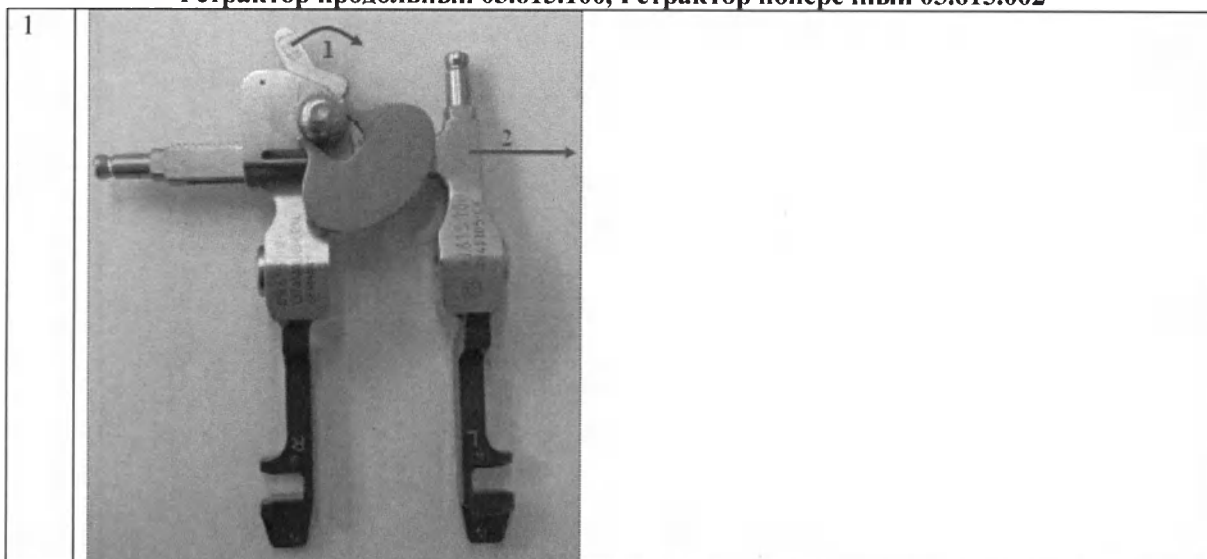


Удерживающая втулка
Matrix 5,5 03.632.001, удерживающая втулка длинная Matrix 5,5 03.632.036

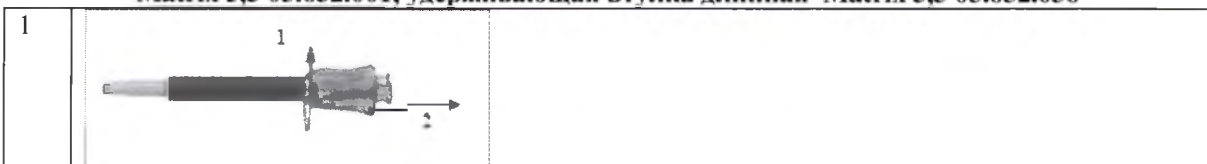


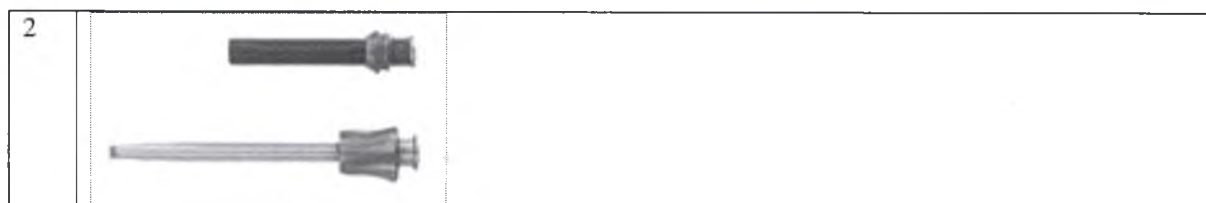


Удерживающая втулка съемная Matrix 03.632.085

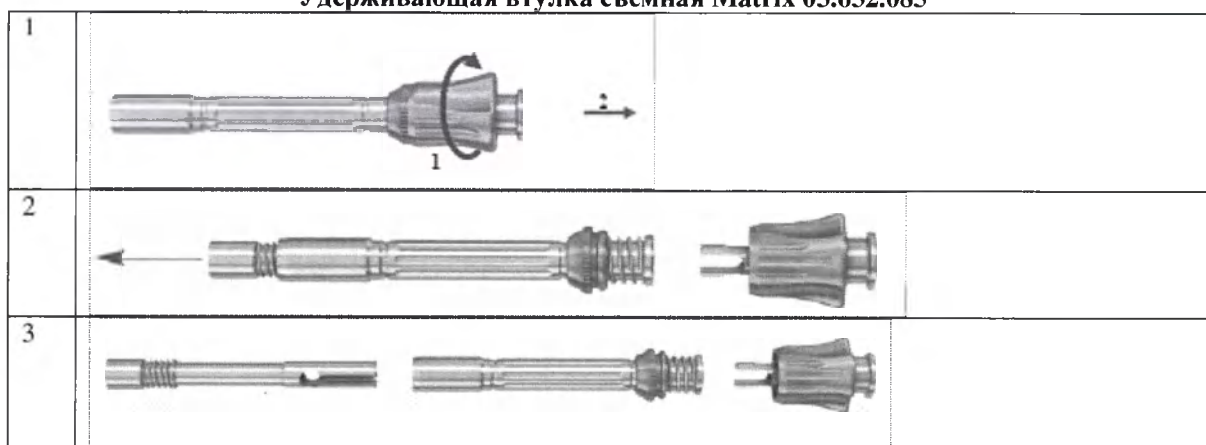


Устройство позиционное Matrix 5,5 03.632.037

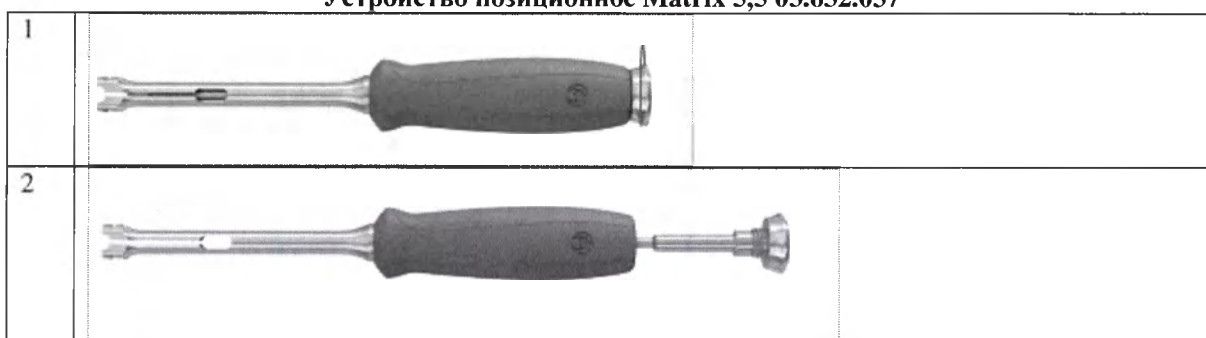


Ретрактор зубчатый Matrix 03.632.087

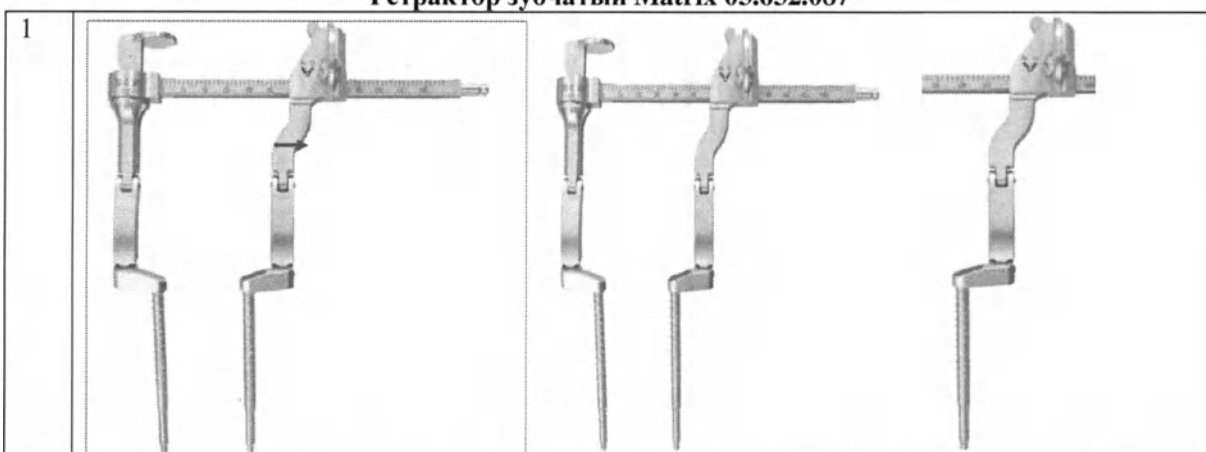

Экстрактор для винтов Matrix 03.632.045

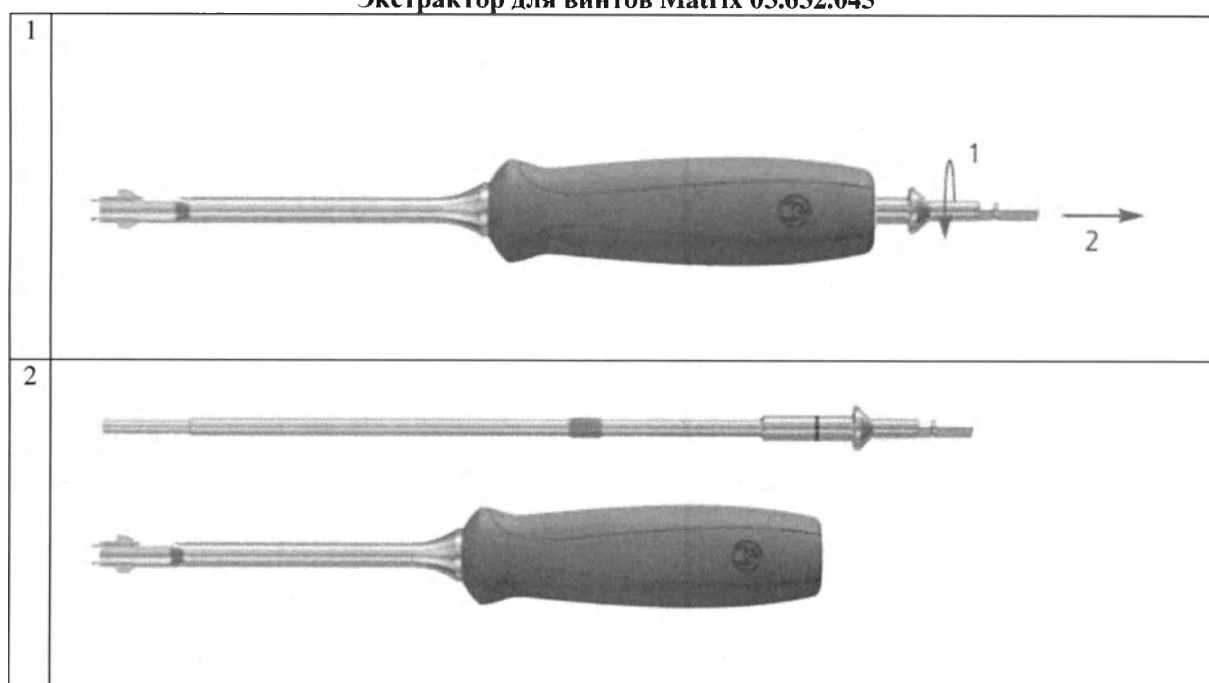


Втулка удерживающая для моноаксиальных винтов, стандартная
Matrix 5,5 03.632.024

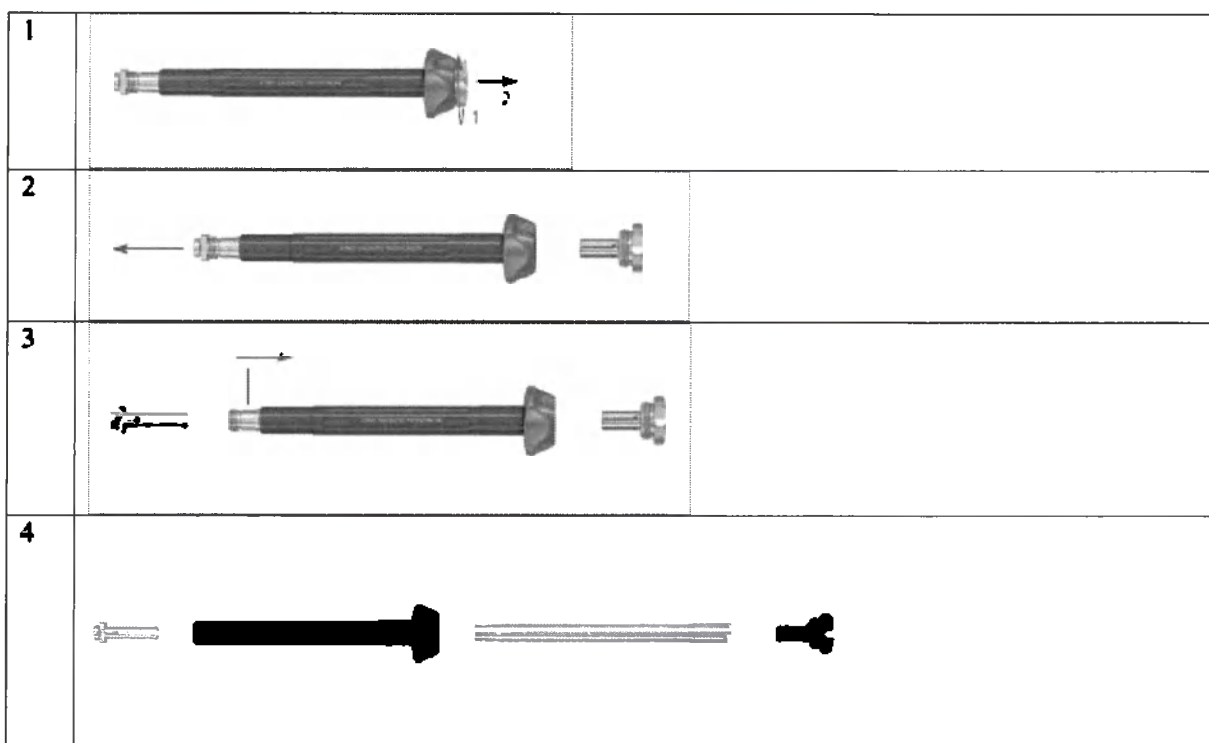


Щипцы для погружения стержня Matrix 5,5 03.632.009


1	
2	
3	

Держатель для троакара 03.606.020, троакары диаметром 1,6 03.606.020, канюлированное педикулярное шило диаметром 3,8 L25 03.600.032, канюлированное педикулярное шило диаметром 5,6 L255 03.600.030, троакары для канюлированного шила 03.616.062

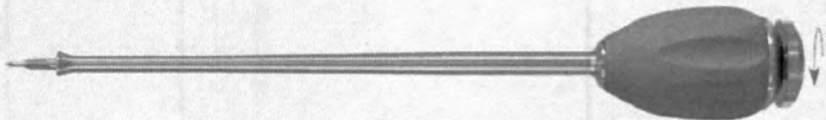1	
---	--

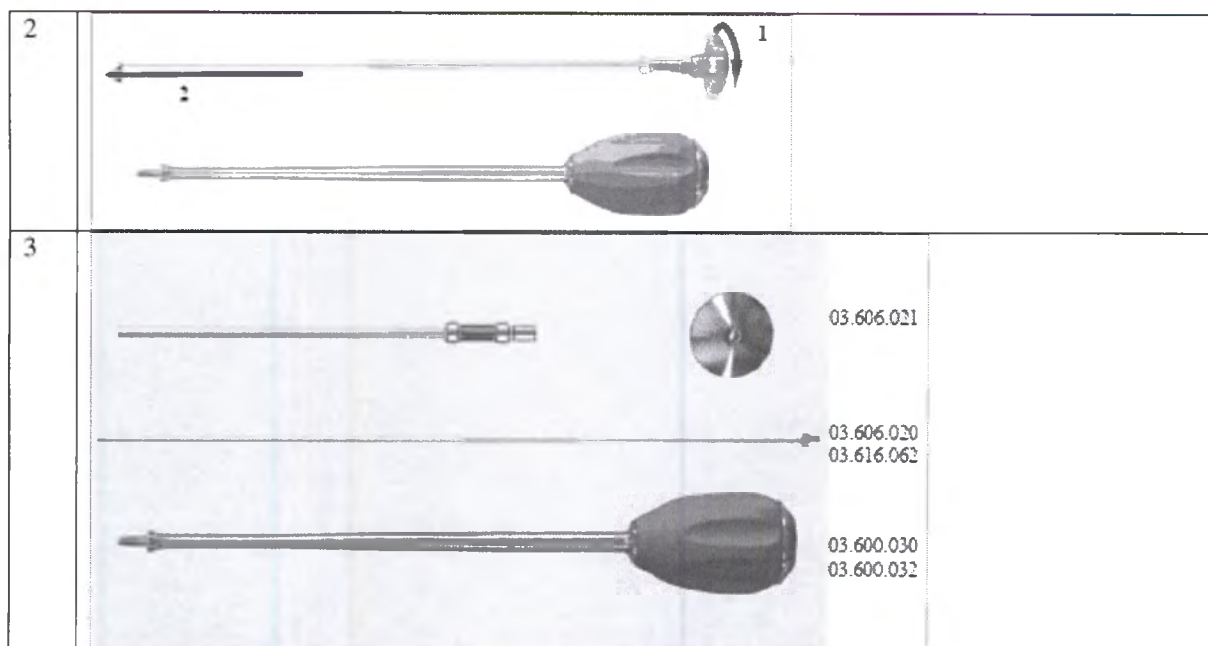


Наконечник дистрактора для головок винтов для системы Matrix 5 03.632.084

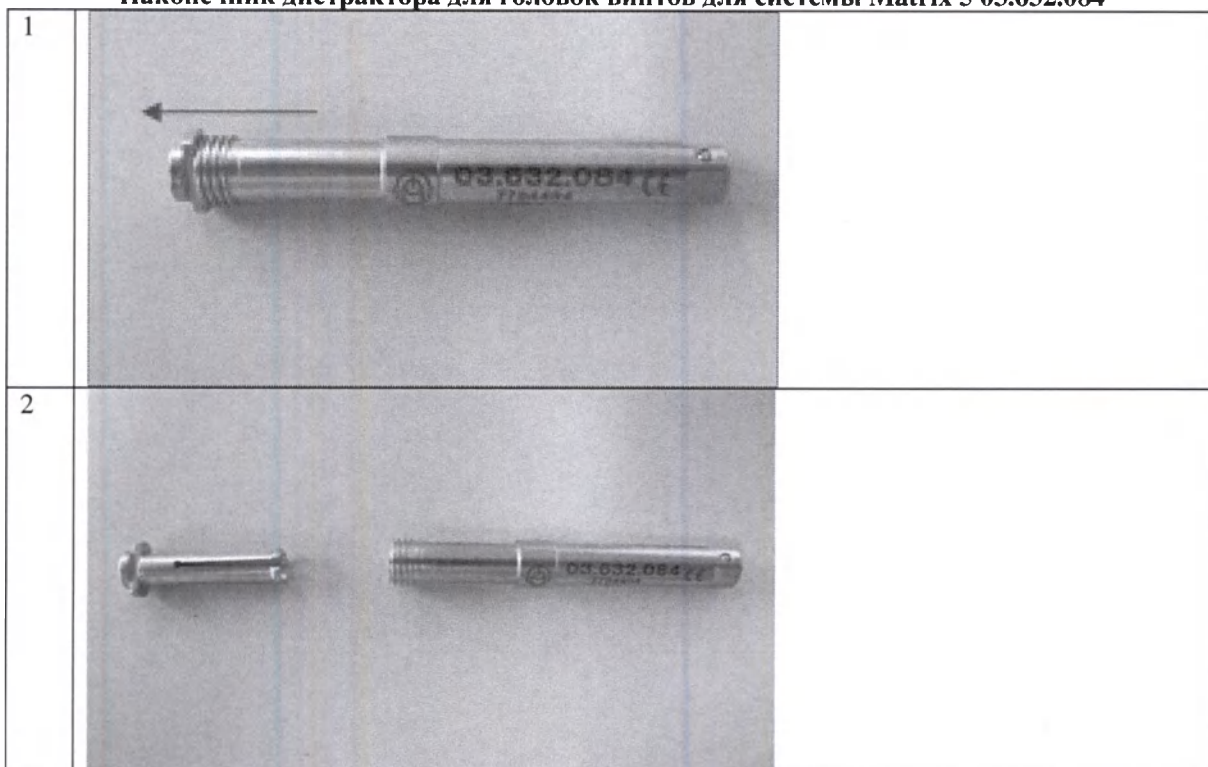


Наконечник дистрактора для головок винтов, длина 245 03.632.084




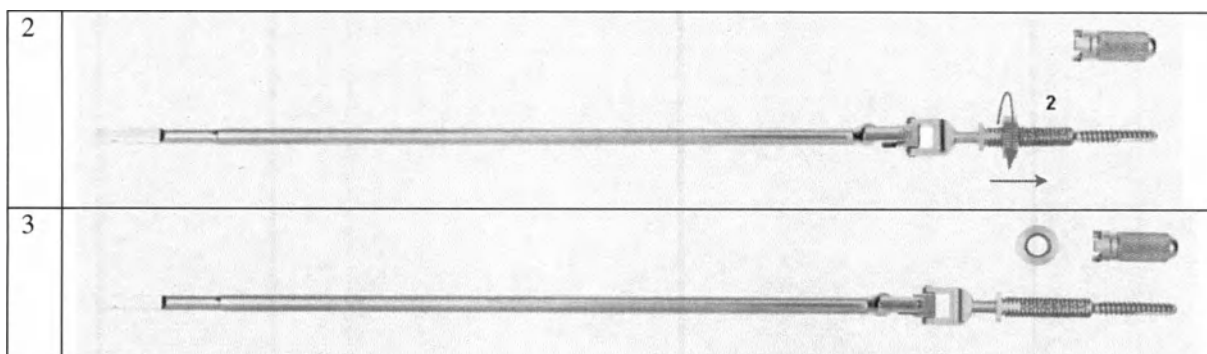


Измеритель глубины для винтов диаметром 3,5 до 4,0 мм 319.009, измеритель длины для бикортикальных винтов 387.292, измеритель для винтов, диапазон измерения диаметром 3,5–5 03.161.028

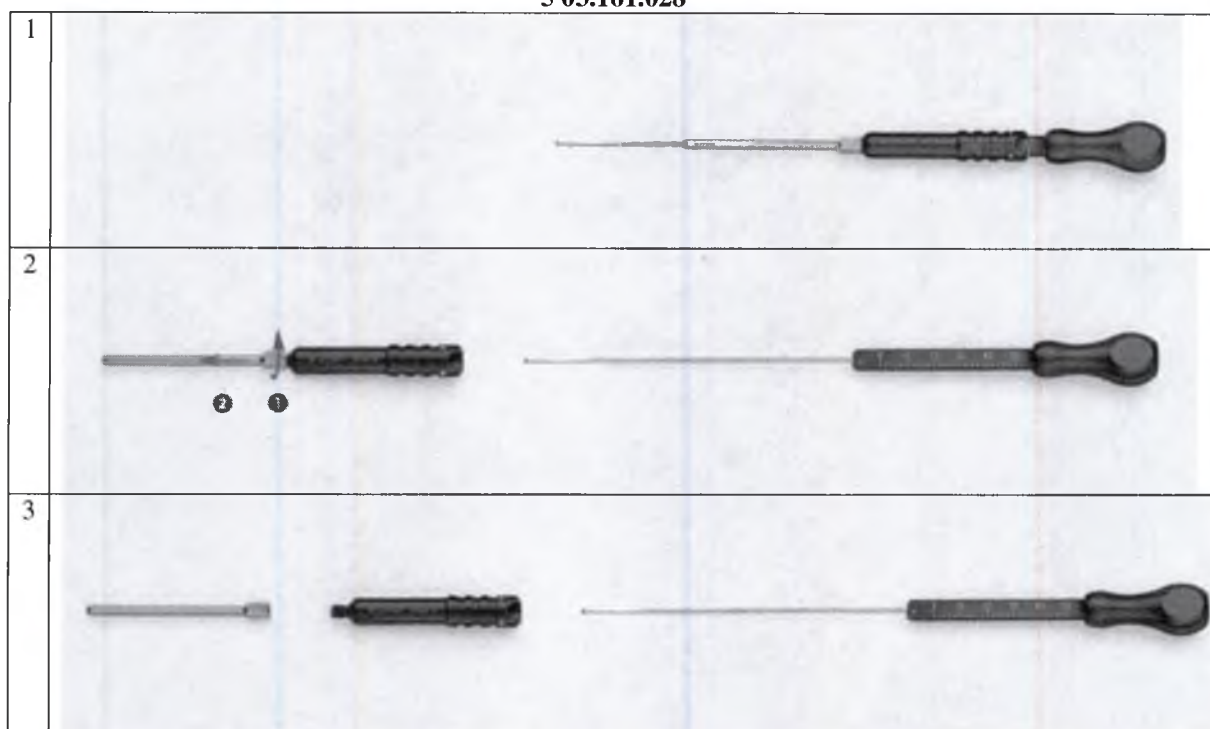


Направитель для сверла и метчика, градуированный для сверла диаметром 3,2 03.161.023

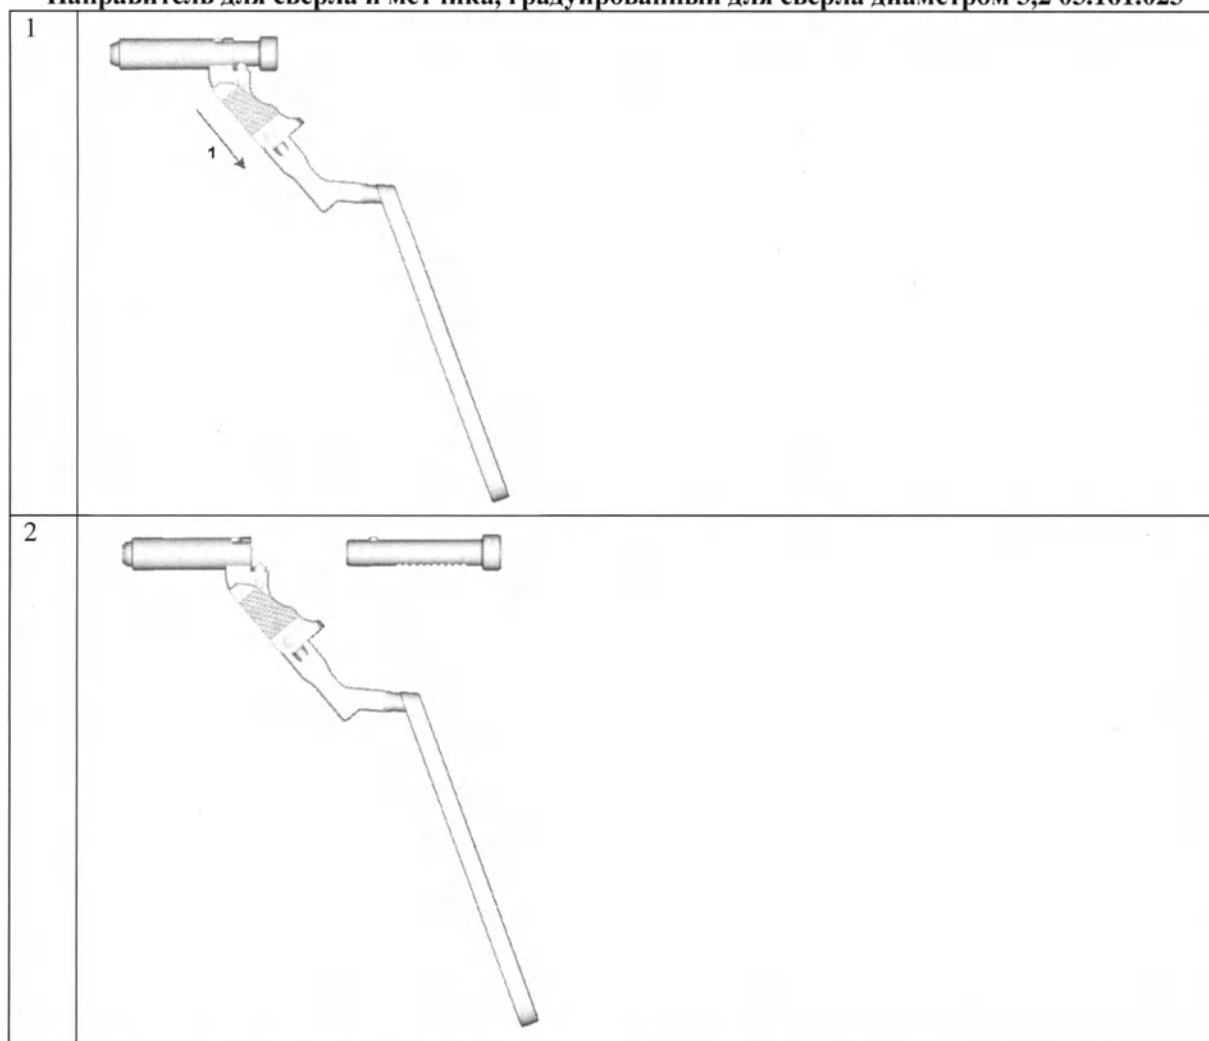


Держатель имплантата StenoFix 03.630.525

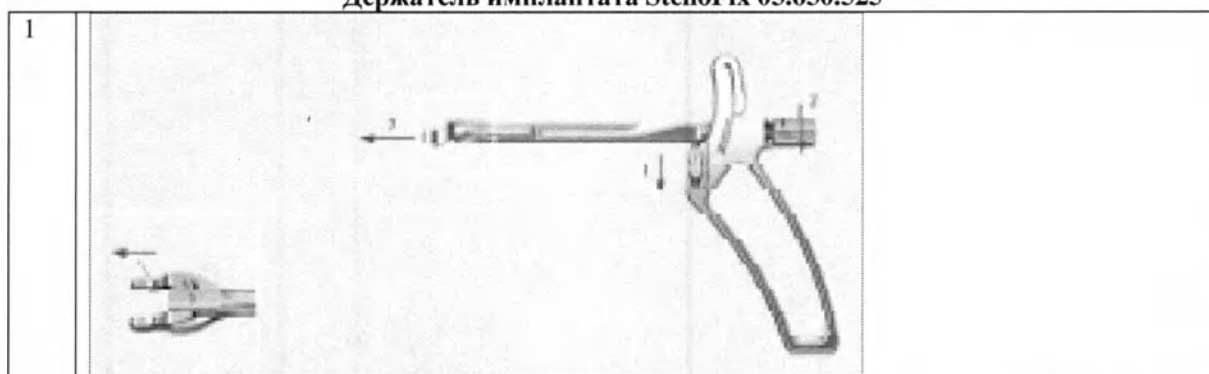


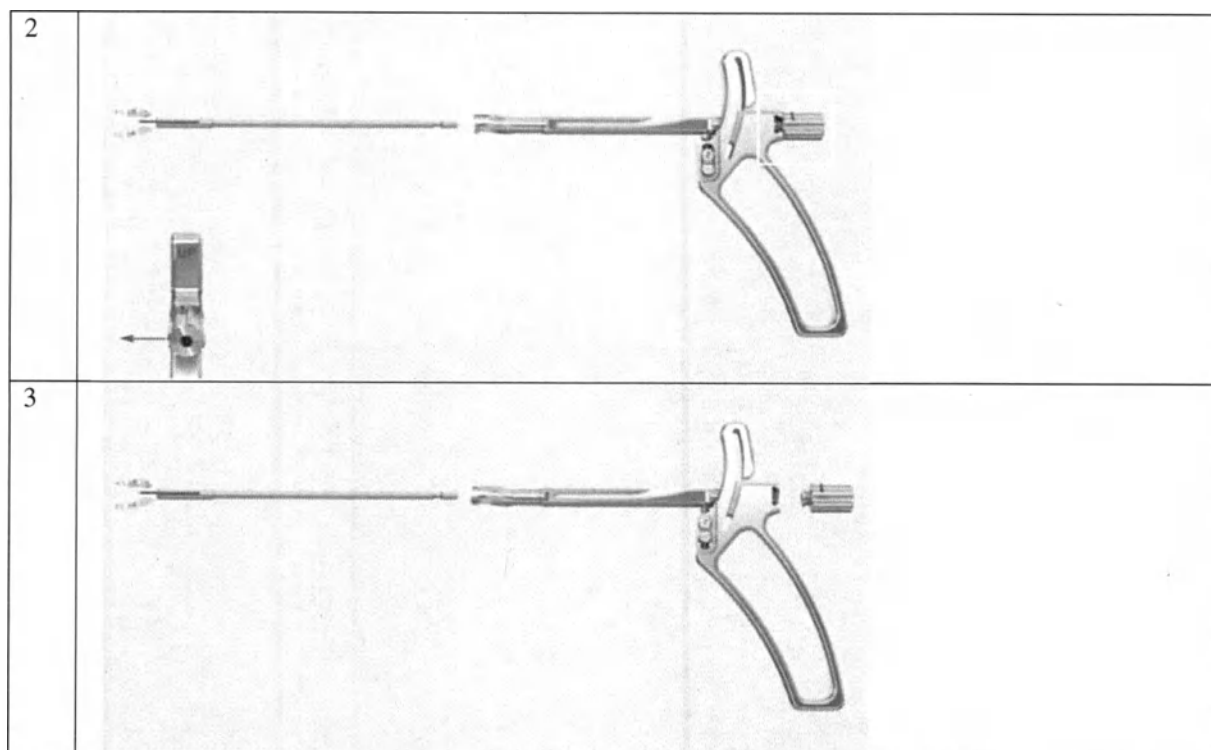


Винт для временной фиксации для ретрактора 03.809.943

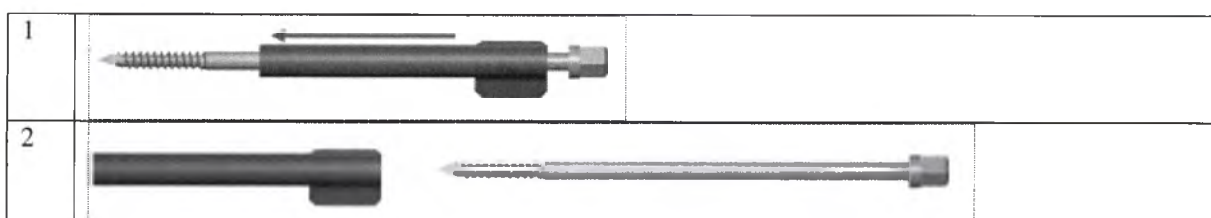


Позиционное устройство 03.809.921

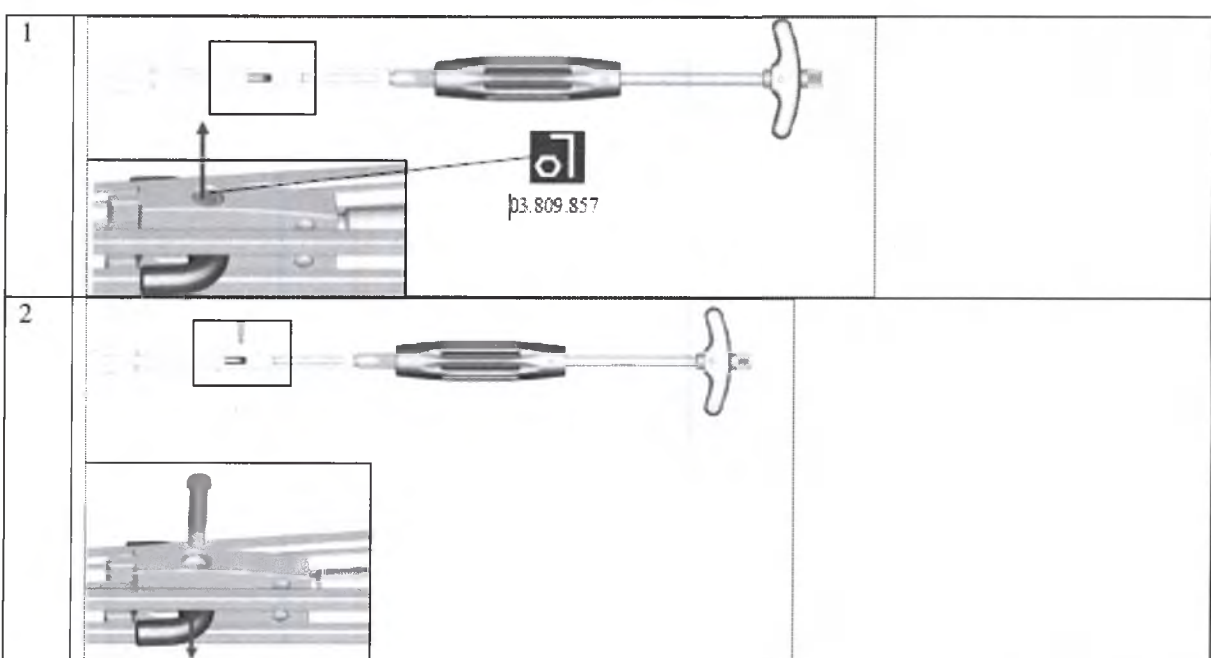


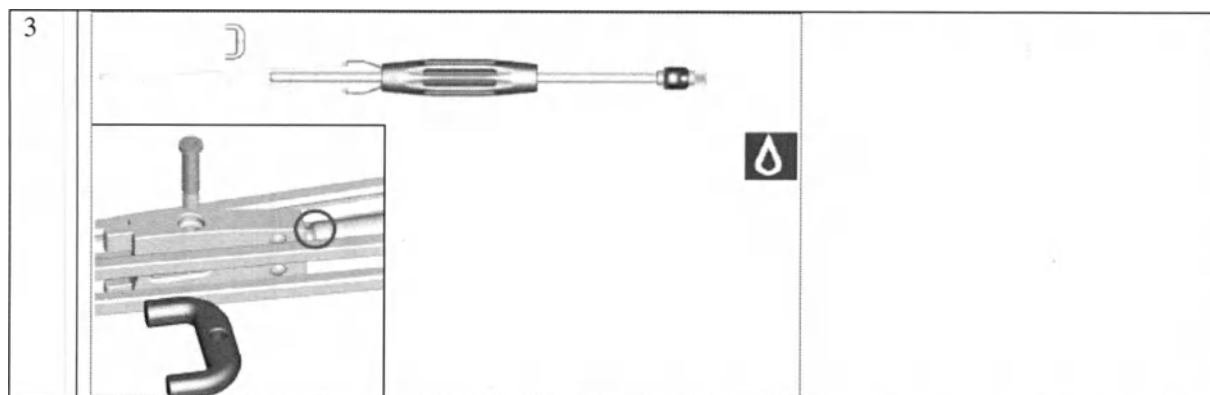


Наконечник отсоса длинный 03.809.975

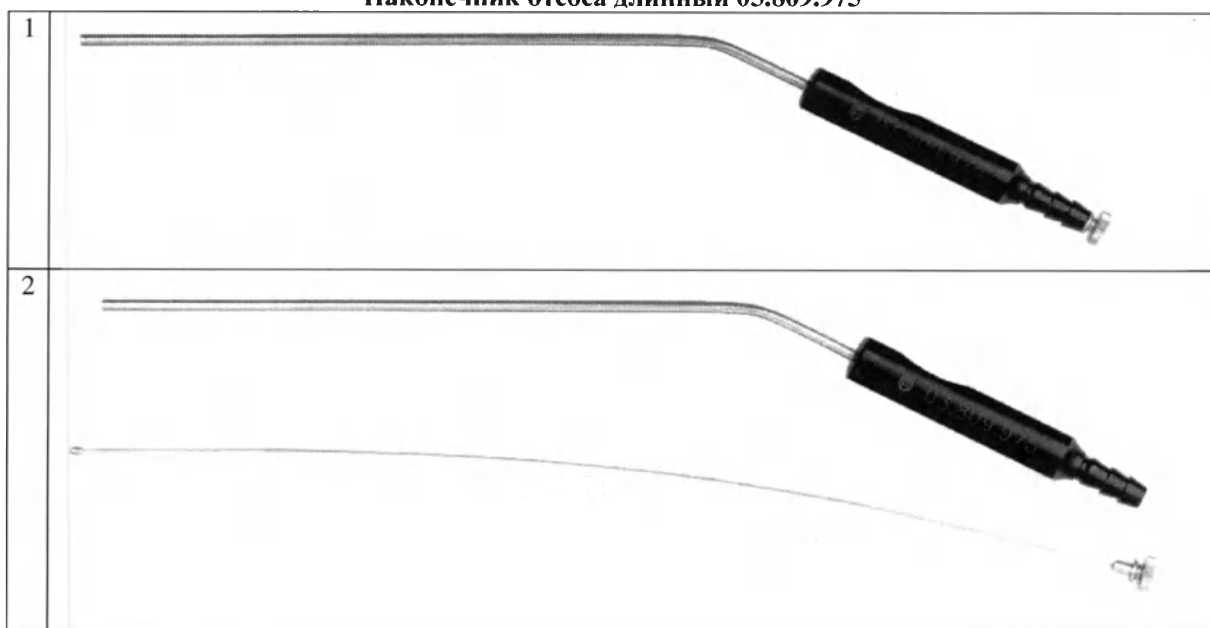


Рукоятка ретрактора Oracle 03.809.900

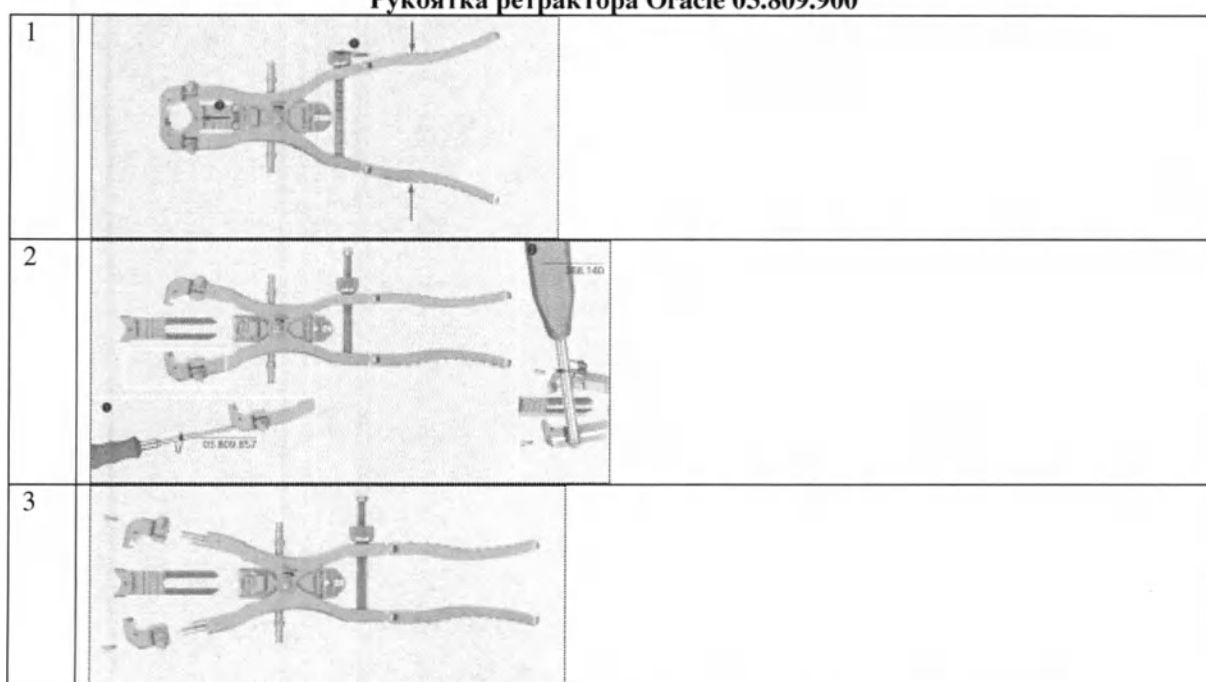


Держатель шейных кейджей 396.989, держатель для системы SynCage-C 396.990, держатель для системы Visios 397.089


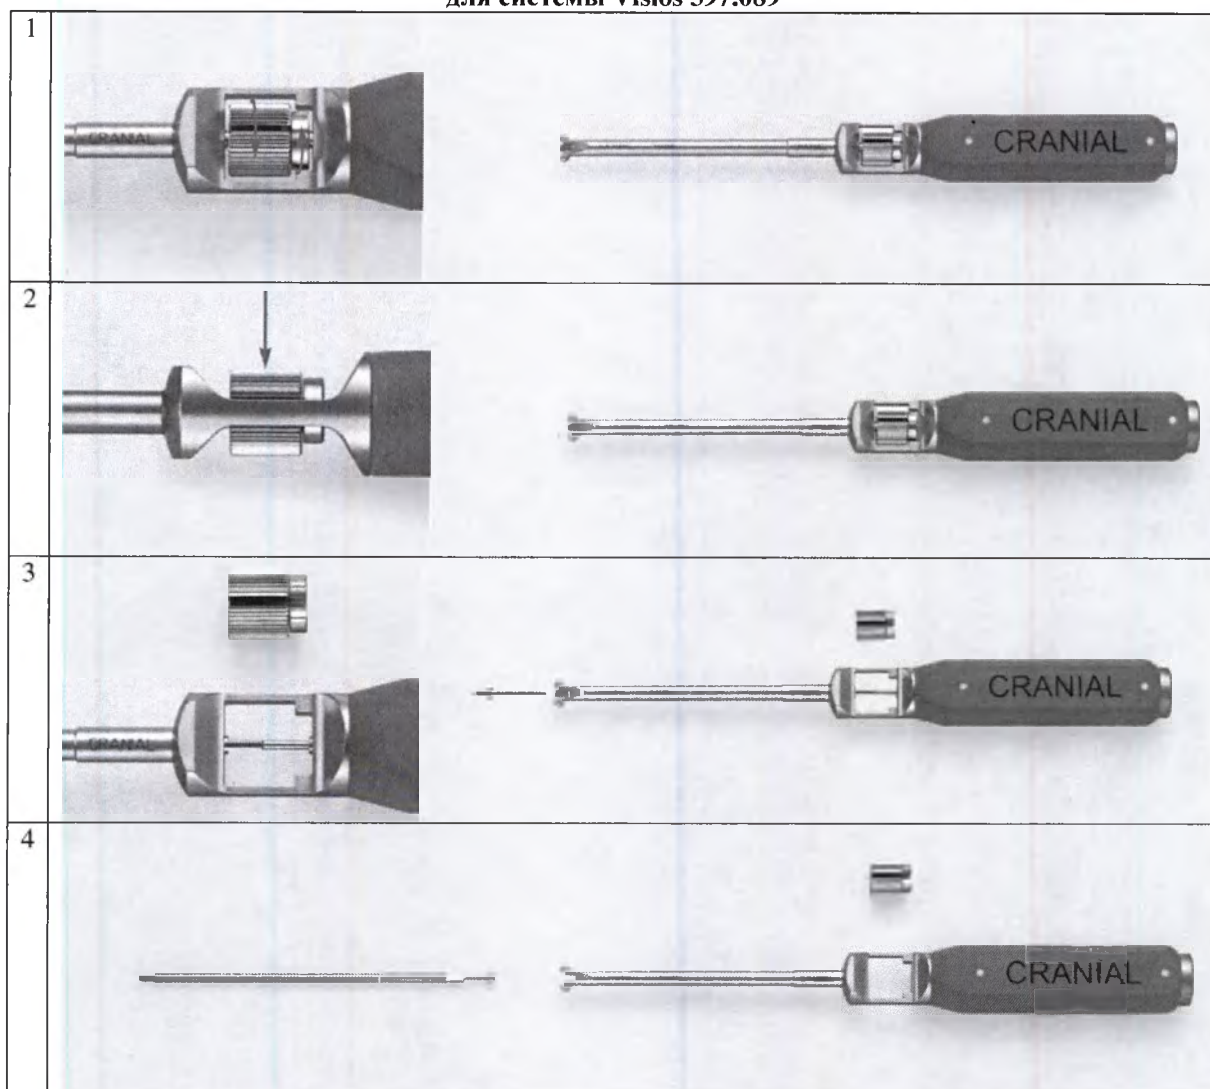


Модуль для системы SynCage C 396.991

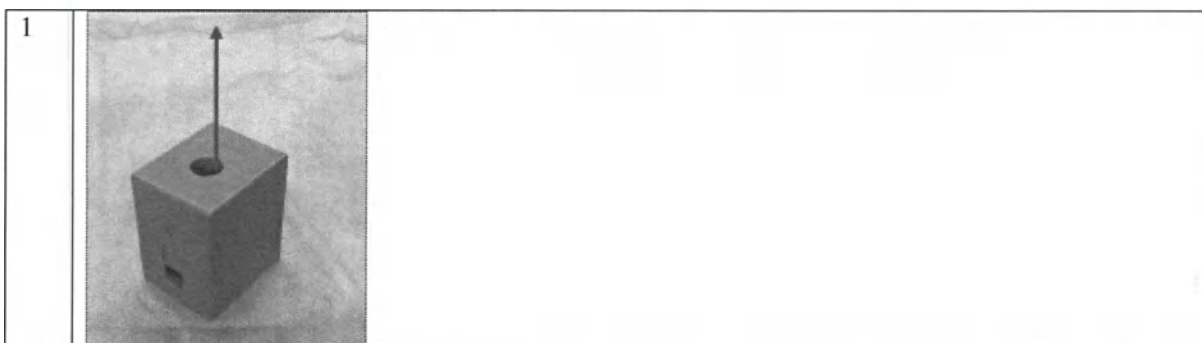


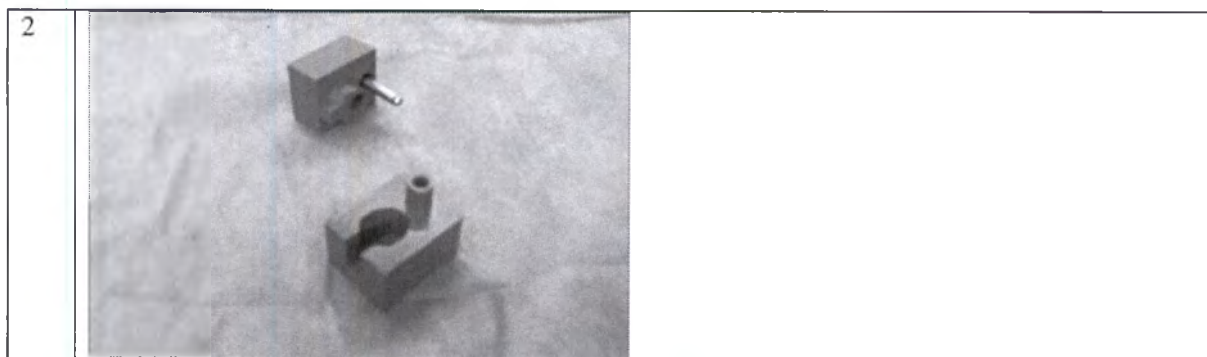


Держатель имплантата для системы SynFix-LR 03.802.039/-US

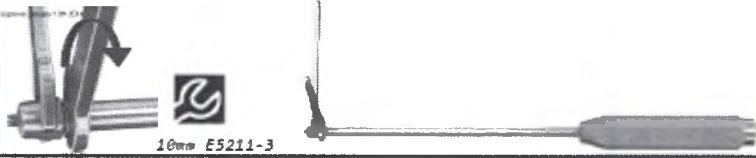
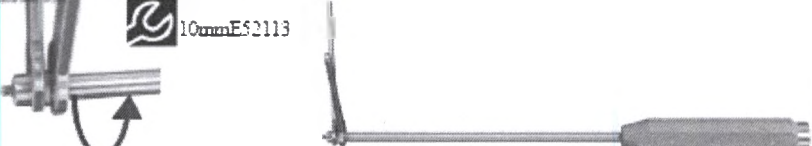
Инструкции по разборке		
1		
2		
3		
4		
Инструкции по сборке		
1		
2		
3		
4		

5		
---	--	--


Прицельное устройство SynFix-LR 03.802.032, 03.802.242, 03.802.020, 03.802.243, 03.802.033, 03.802.245, 03.802.034, 03.802.247, 03.802.036, 03.802.249

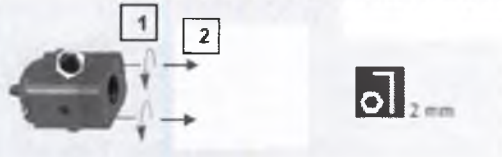1		
2		
3		
4		


Модуль для SynFix LR 26 03.802.041, 03.802.042

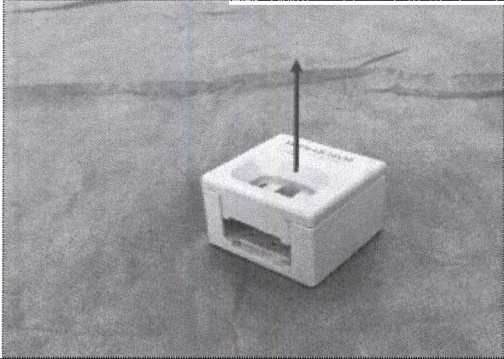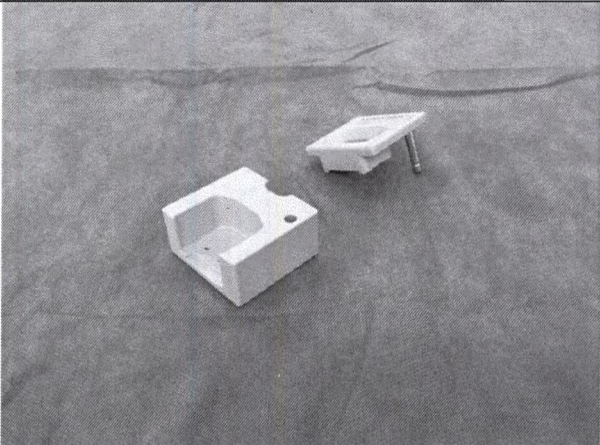1		
2		


Держатель прицельного устройства SynFix-LR 03.802.031

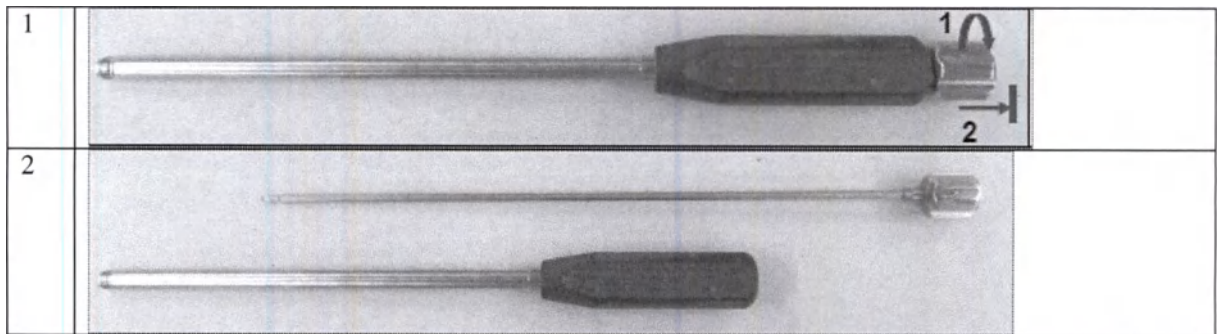

Направляющий стержень с регулируемым зажимом SynFrame для ретракторов мягких тканей и мышц

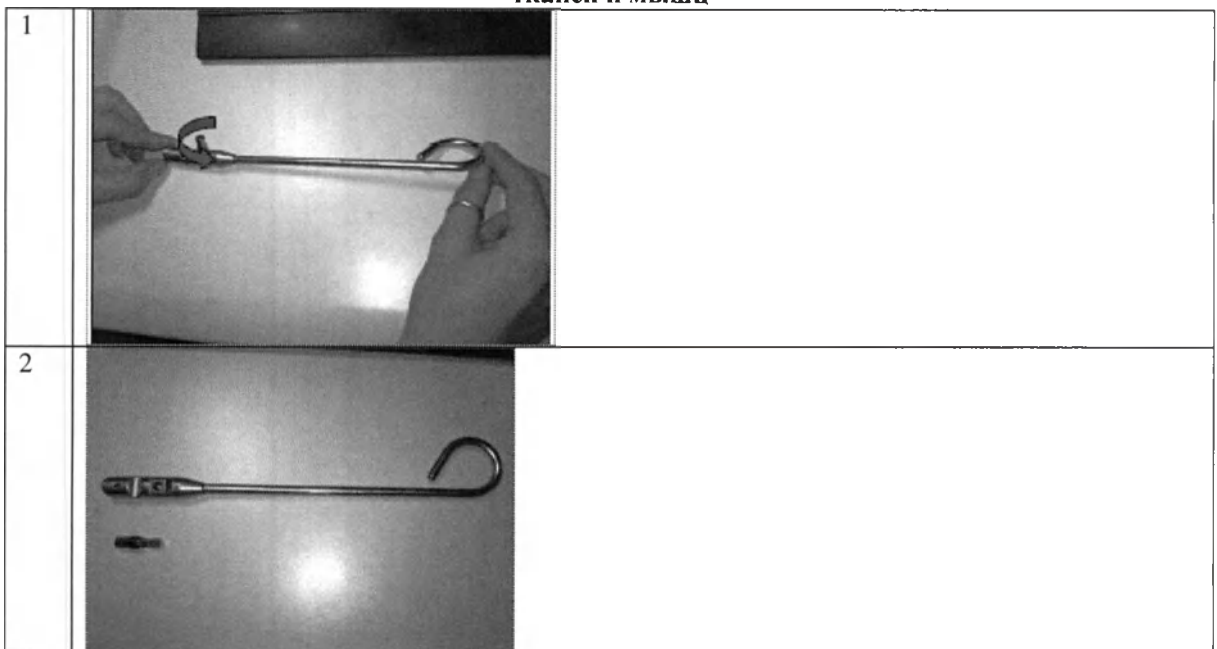


Головка держателя имплантата 03.812.001, Вкладыш держателя имплантата 03.812.003,
головка держателя имплантата 03.812.004

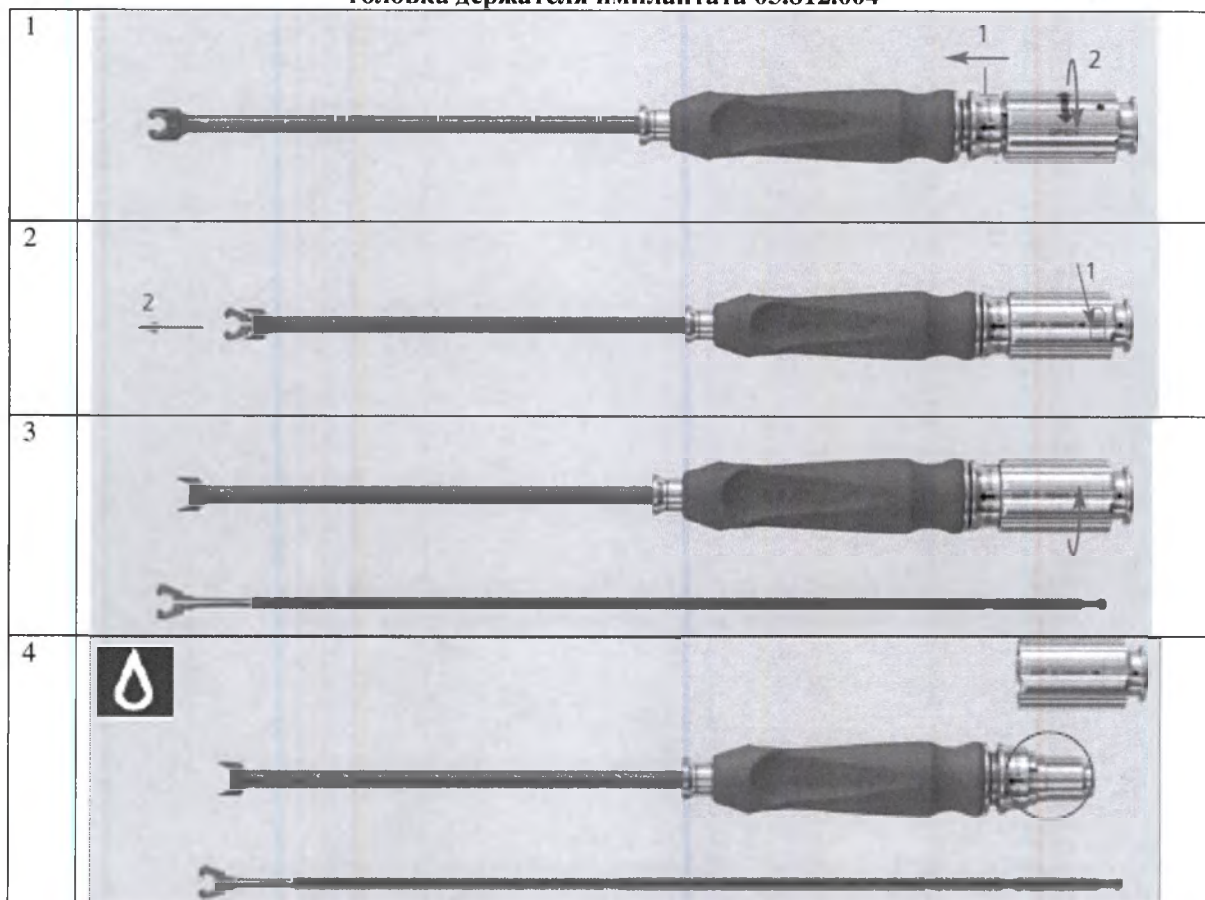


Репозиционное устройство 03.636.014




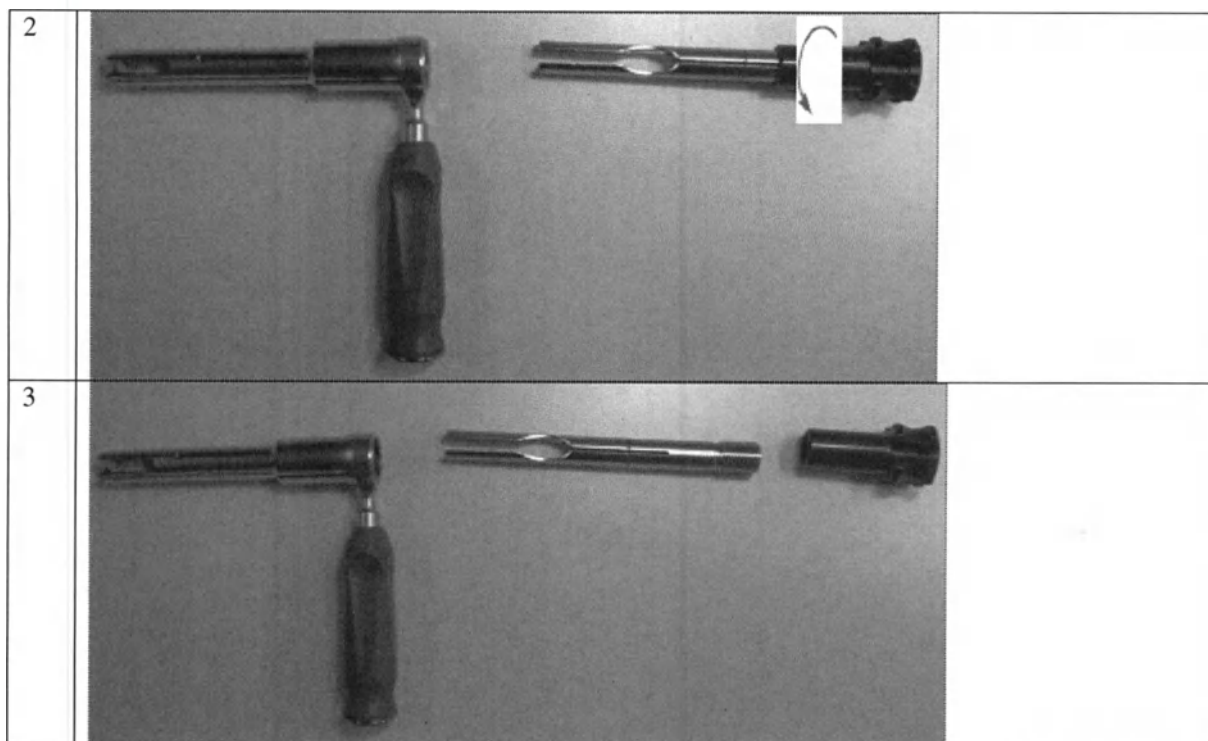


Держатель 388.363, зажимная гильза USS для 314.070, 388.360, зажимная гильза USS для 314.132 388.330+388.370, 388.380, держатель USS для 388.339, 388.379

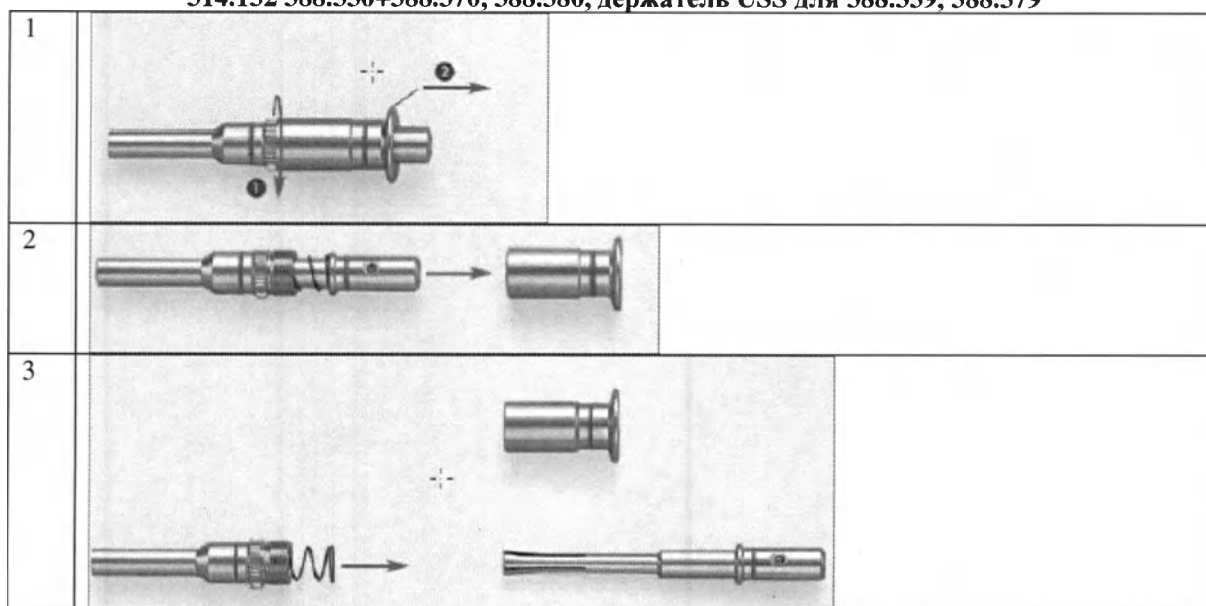


Головка для срезания болтов диаметром 5,0 мм 391.771

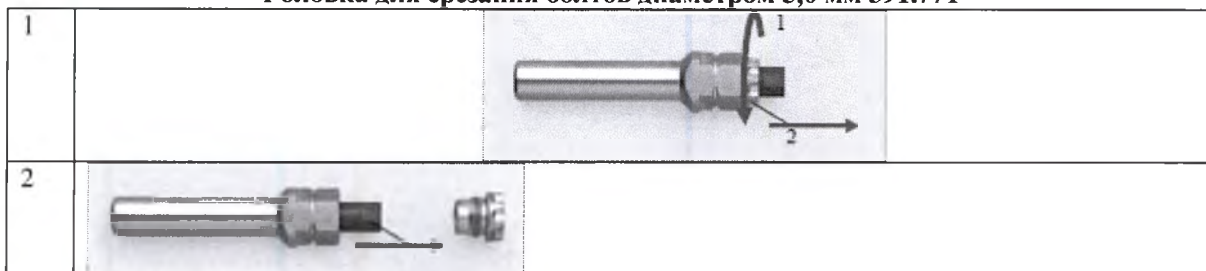


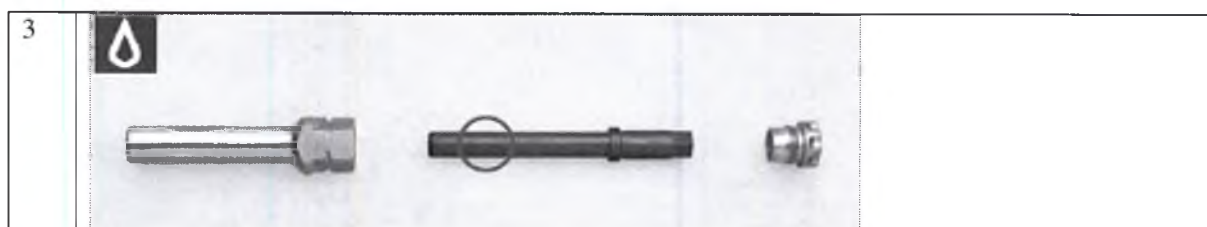

Шило Vectra диаметром 2,5 мм с троакарным кончиком 324.111

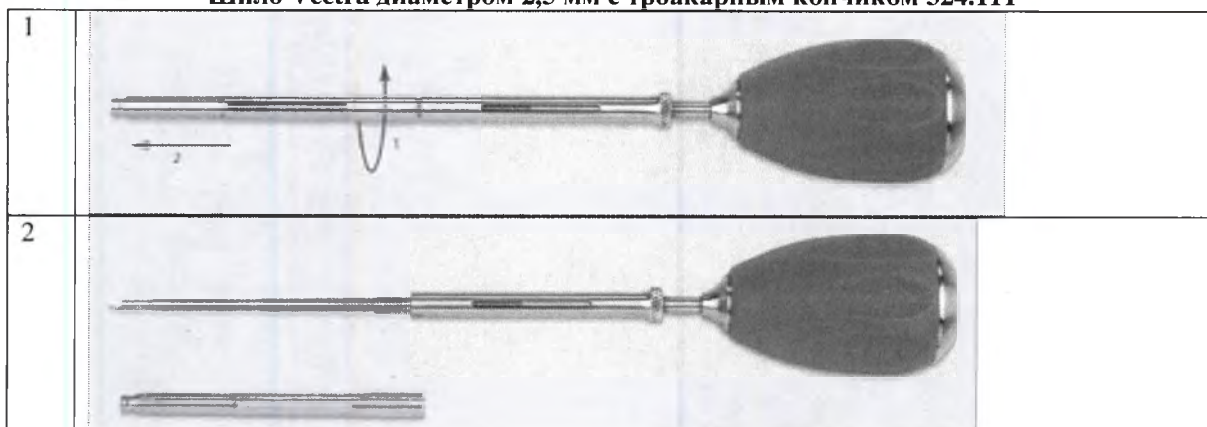



Отвертка для экстракции 352.311

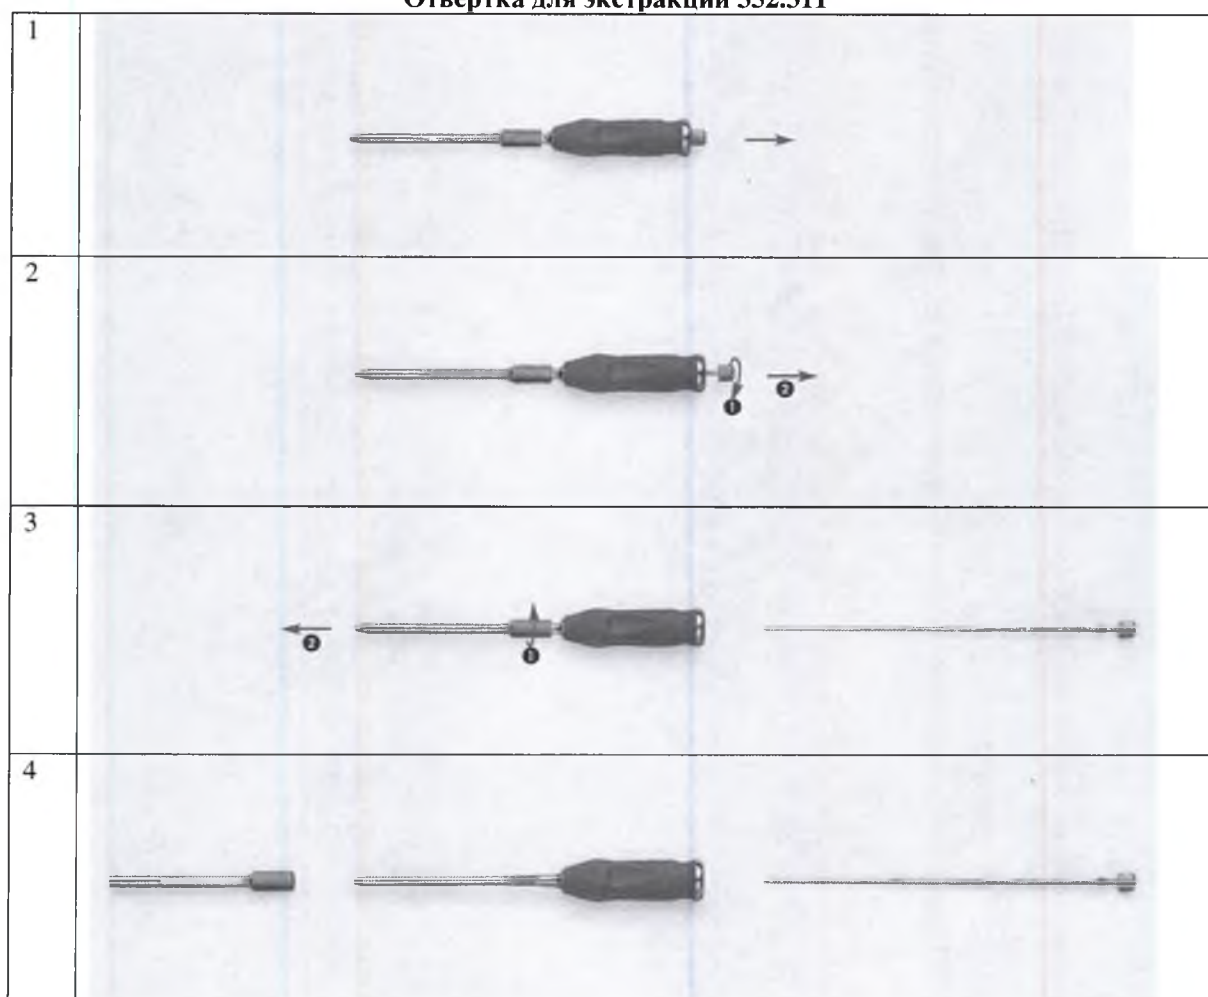


Измеритель для винтов диаметром 3,5 до 4,0 мм 319.009, Измеритель для винтов с расширительной головкой для шейного отдела позвоночника 387.292, измеритель для винтов, диапазон измерения диаметра 3,5-5 03.161.028


1		
2		
3		

Расширитель XRL 03.807.300, 03.807.348, 03.807.310

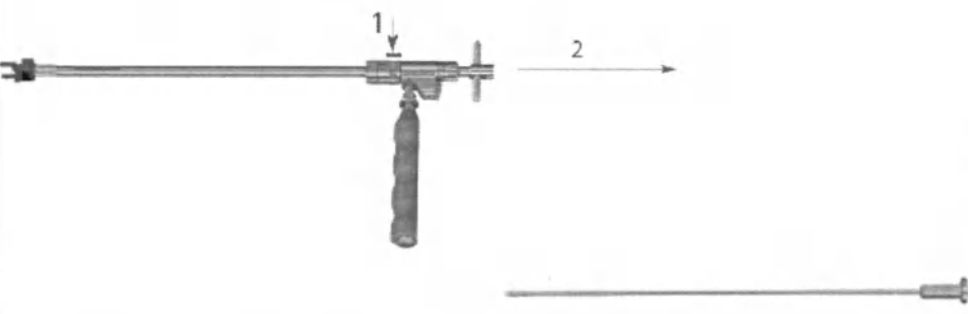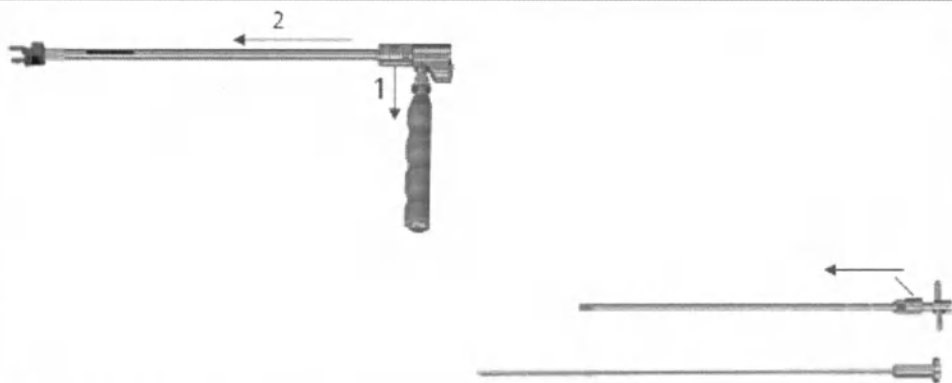
Инструкции по разборке		
1		
2		
3		

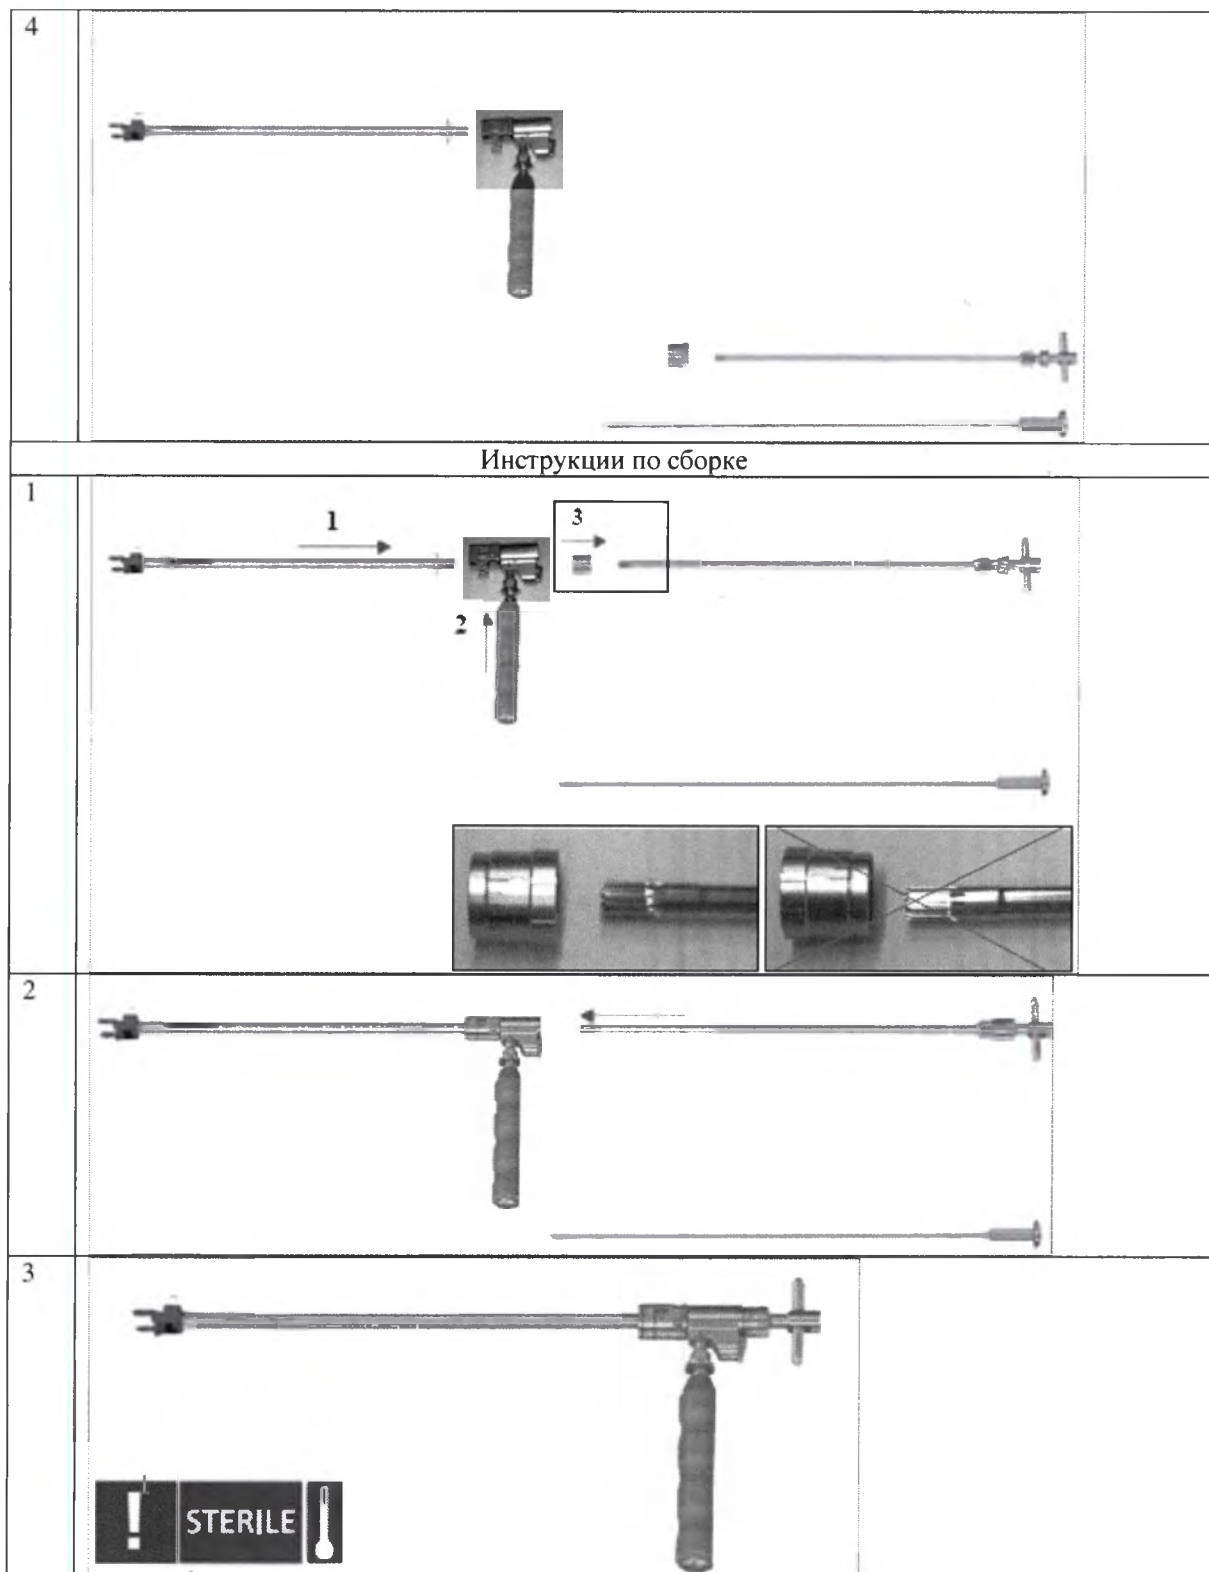


Шило с рукояткой диаметром 2,5 03.647.990, шило с рукояткой диаметром 2 03.617.990, шило 03.662.008

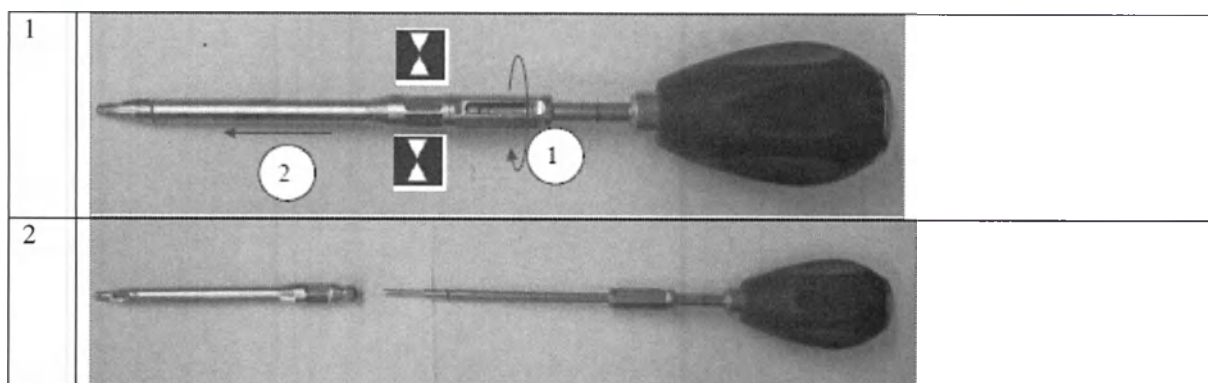


Модуль для заполнения Zero-P 03.617.984/-US, подкладка для системы Zero-P VA 03.647.984

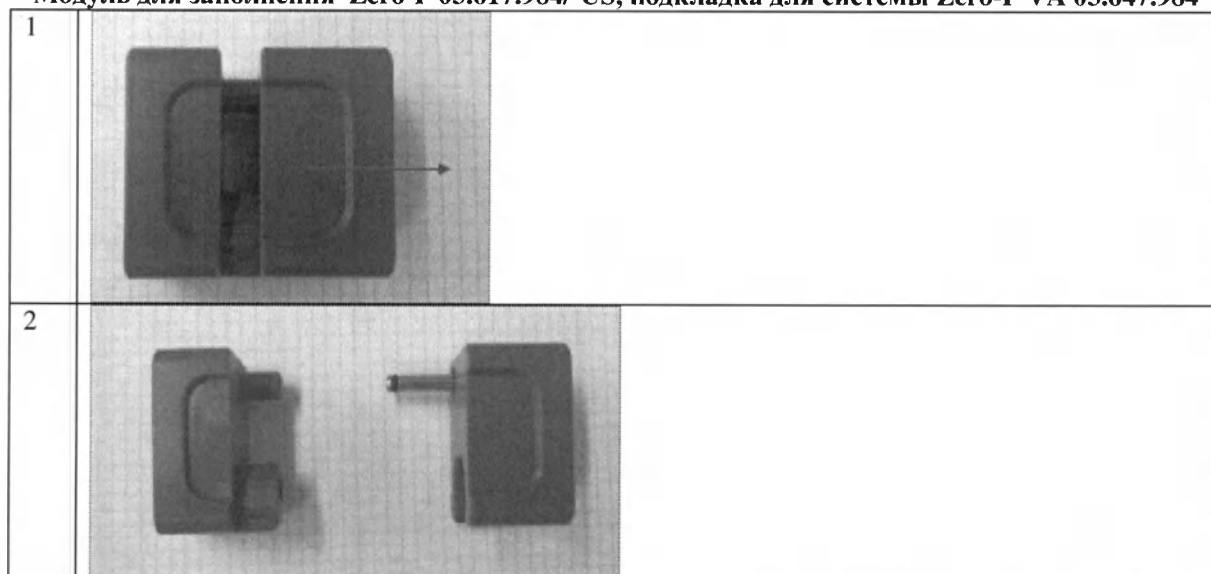

Рукоятка с быстрым соединением 03.617.903
рукоятка с быстрым соединением 03.647.903

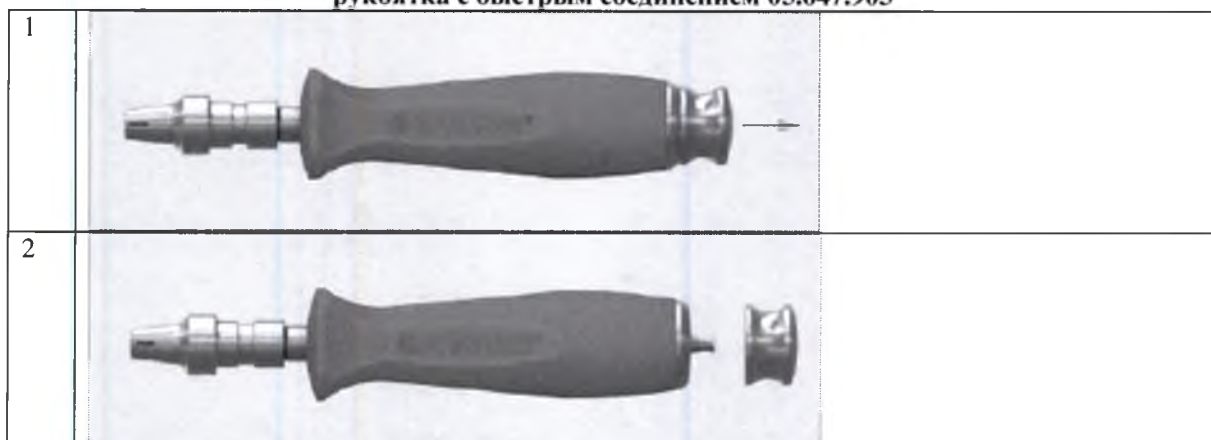

Держатель для винтов 03.617.902 03.617.901, Держатель для винтов 03.617.902 03.647.901-US,
Держатель для винтов 03.503.068 03.503.067, Держатель для винтов 03.503.066 03.503.069

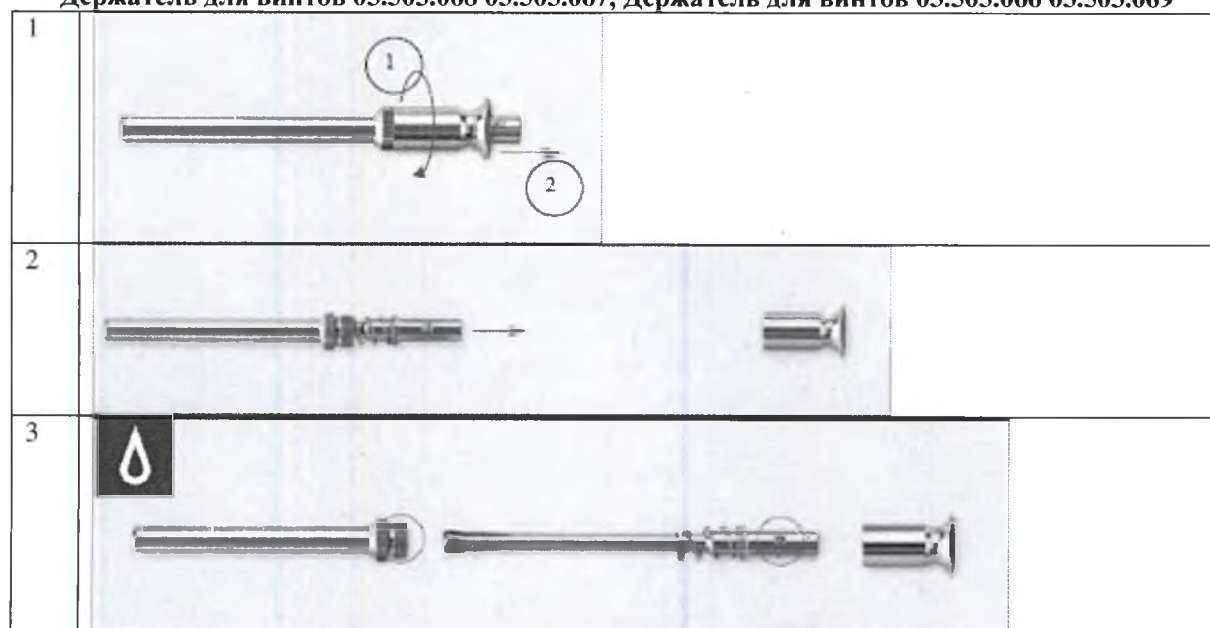

Отвертка Stardrive T8 03.617.900

