

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Биомедицинские инновации»

Золотухин П. В.
« 17 » 20 21 г.



УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ
ОБЛУЧАТЕЛИ-РЕЦИРКУЛЯТОРЫ
AIRCRYSTAL

ПО ТУ 32.50.50-009-15787371-2021
(серийные номера с 12800001 по 14710000)

Фотографические изображения медицинского изделия

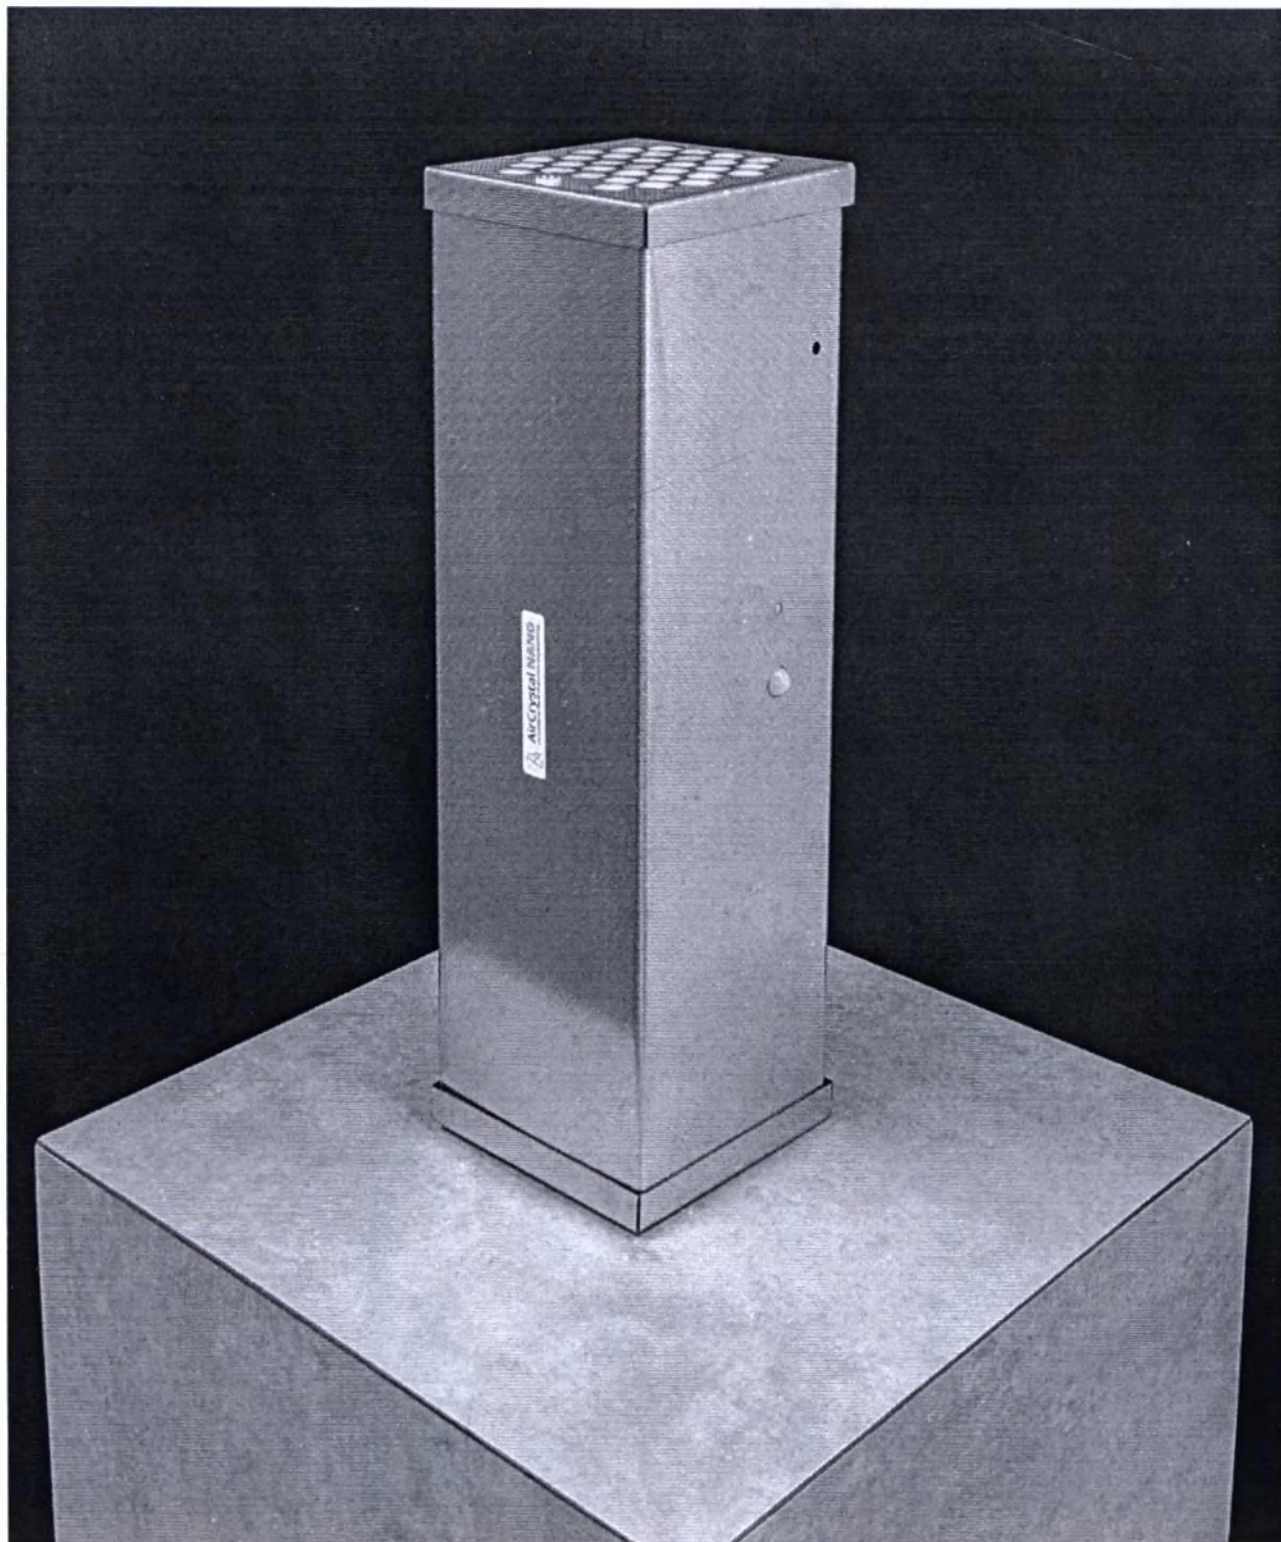


Рисунок 1 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal Nano med
(нержавеющая сталь, текстура «Лен») по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021.

Общий вид

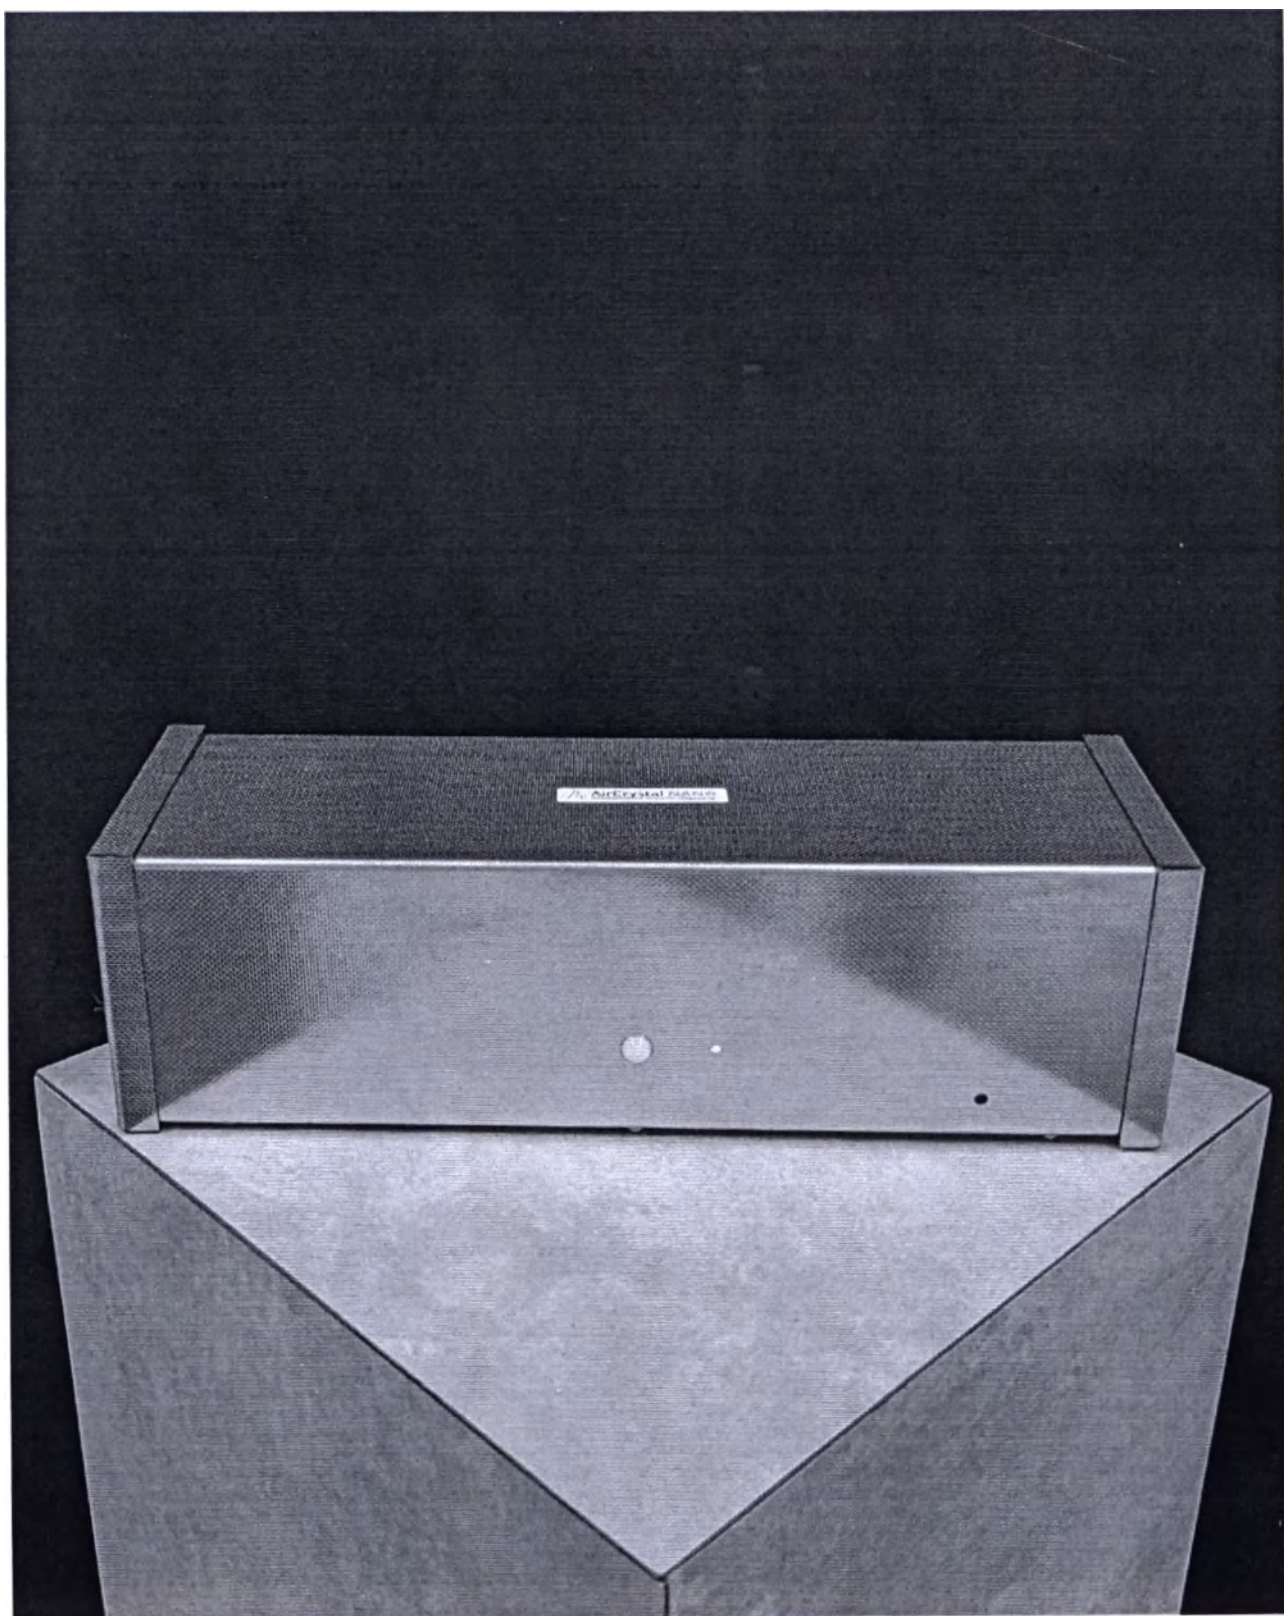


Рисунок 2 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal Nano med
(нержавеющая сталь, текстура «Лен») по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021.

Общий вид

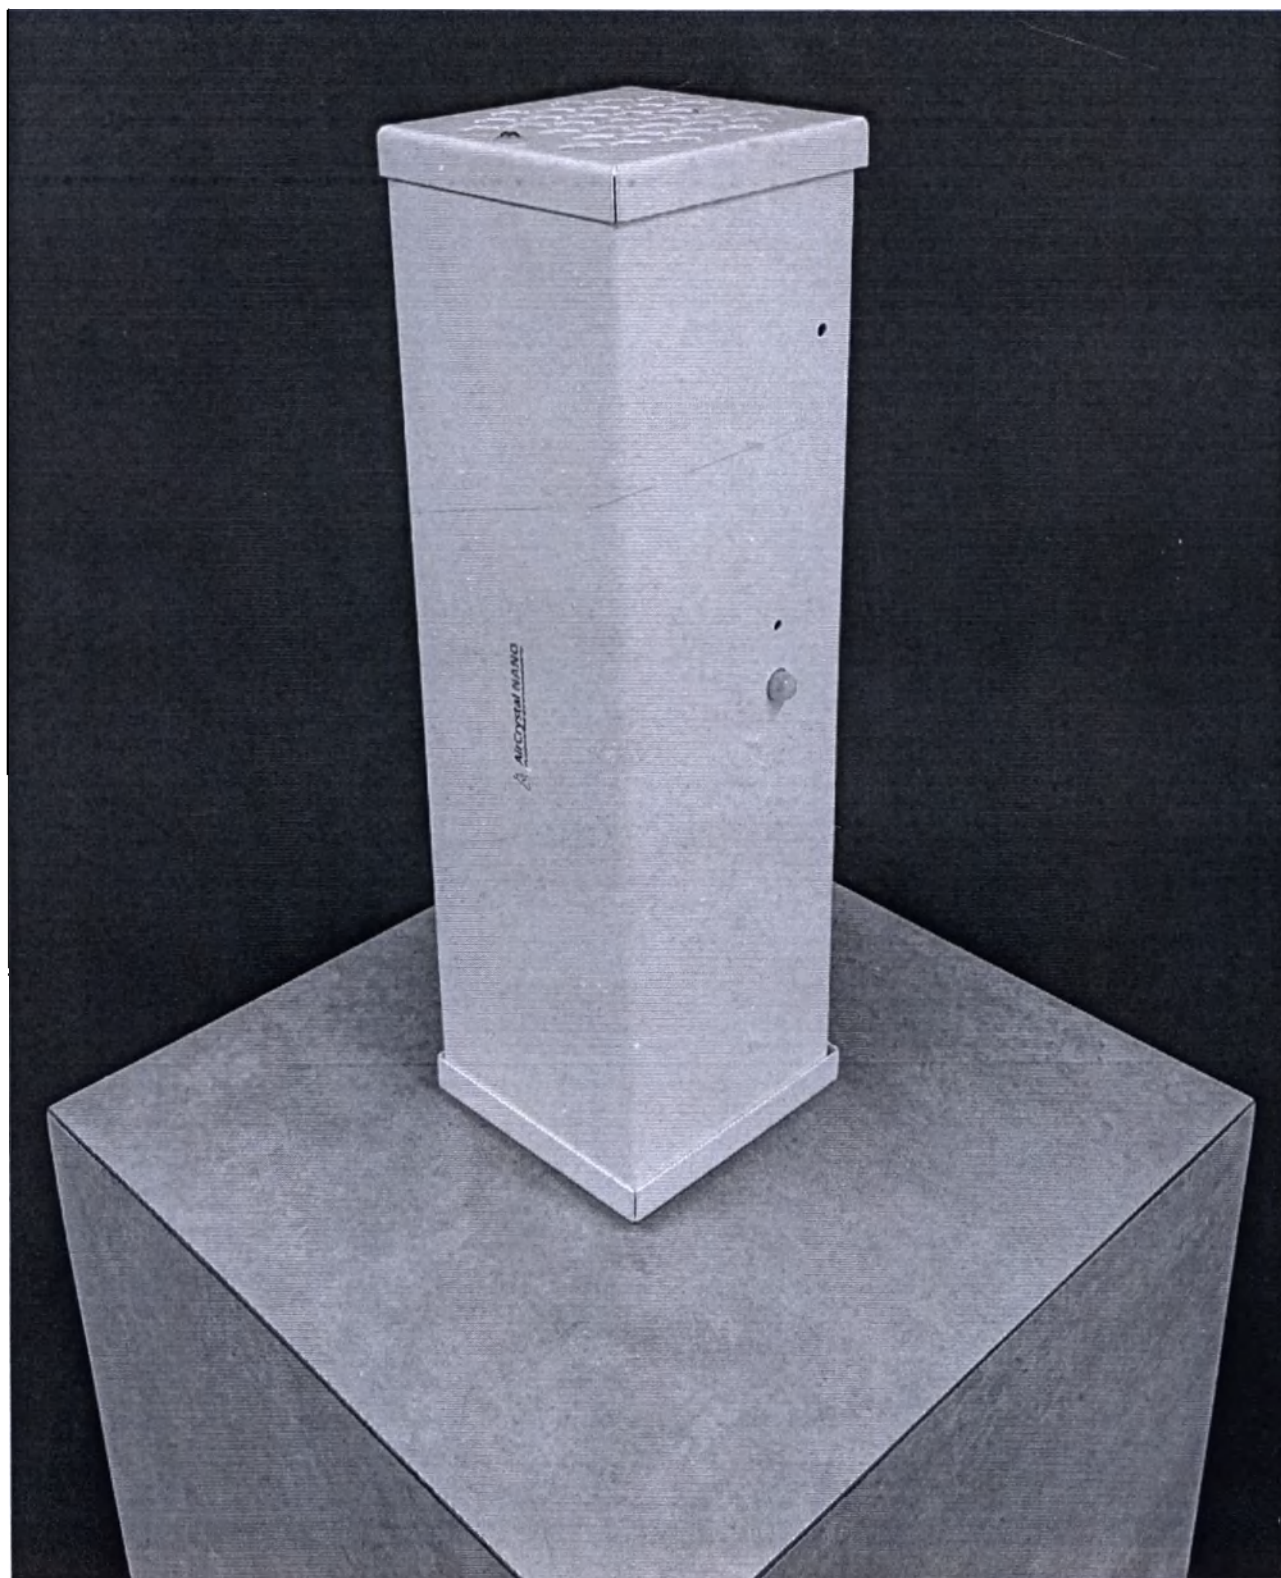


Рисунок 3 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal Nano med (белый) по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021. Общий вид

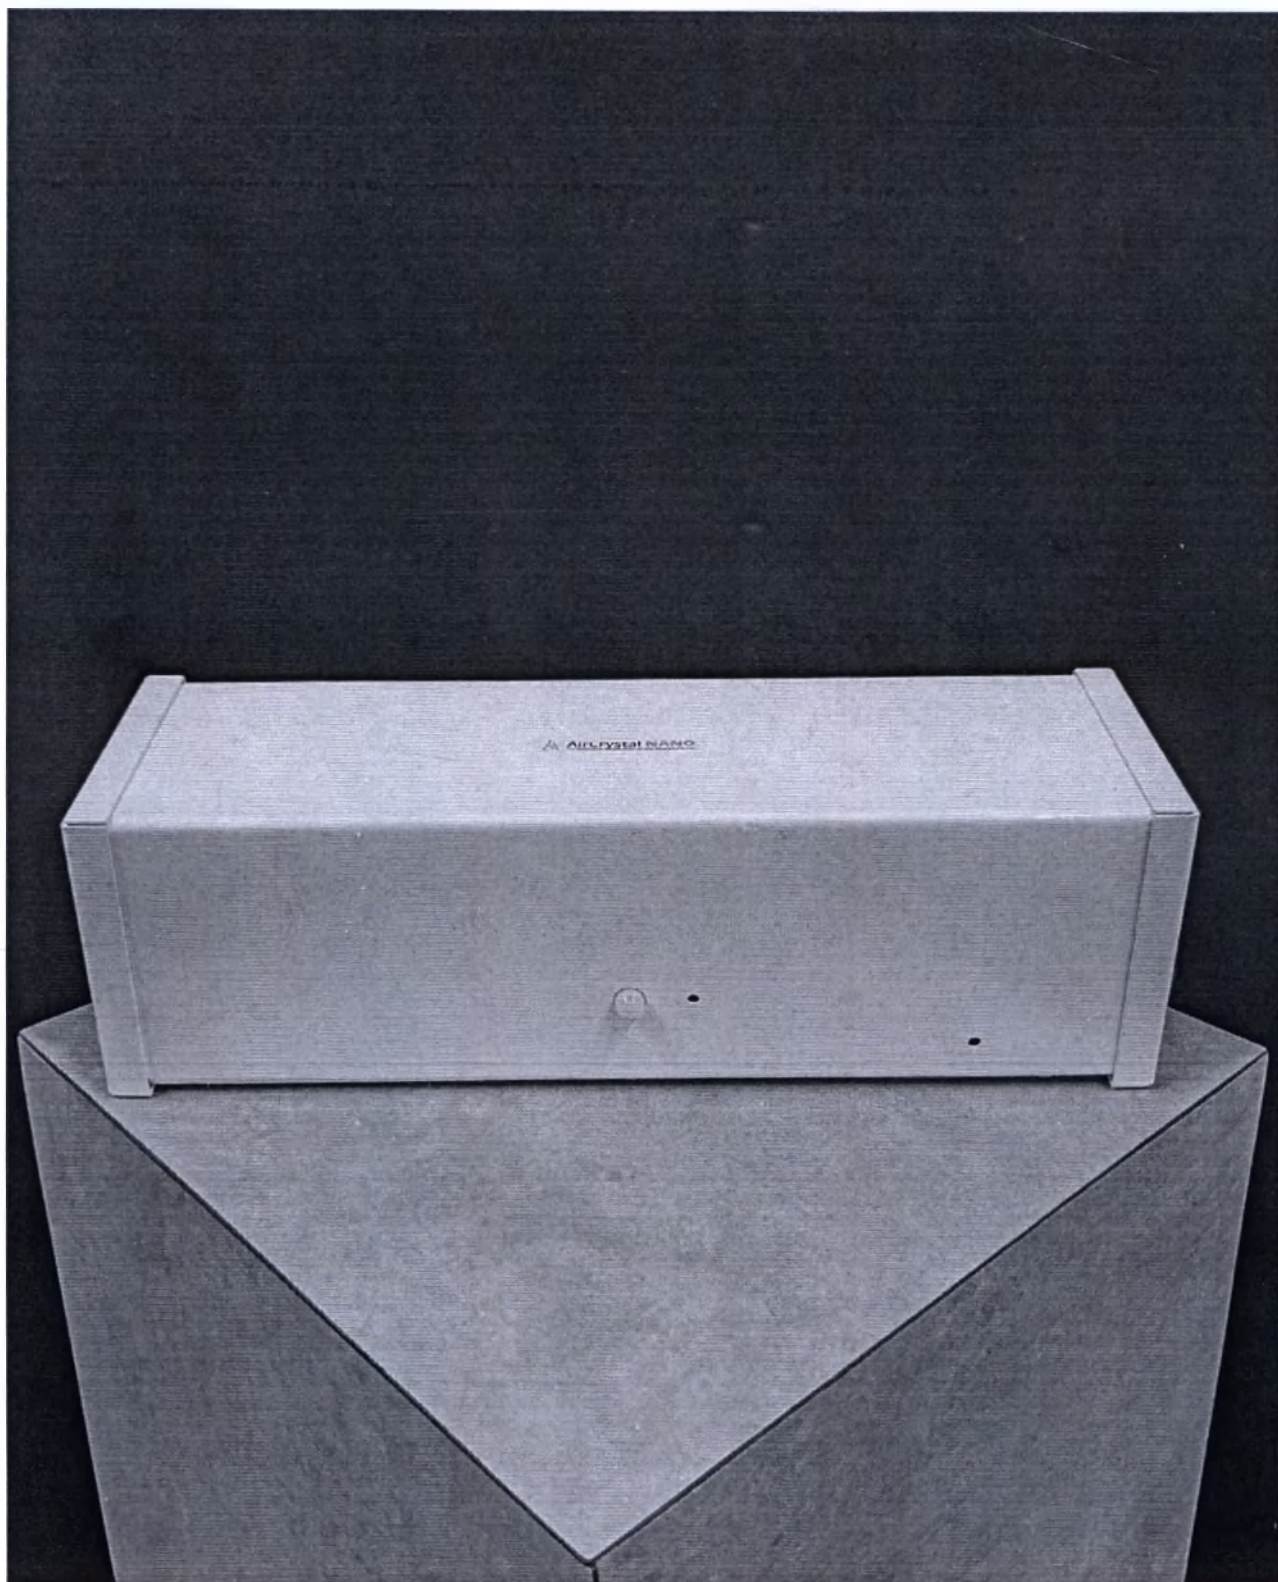


Рисунок 4 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal Nano med (белый) по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021. Общий вид. Общий вид

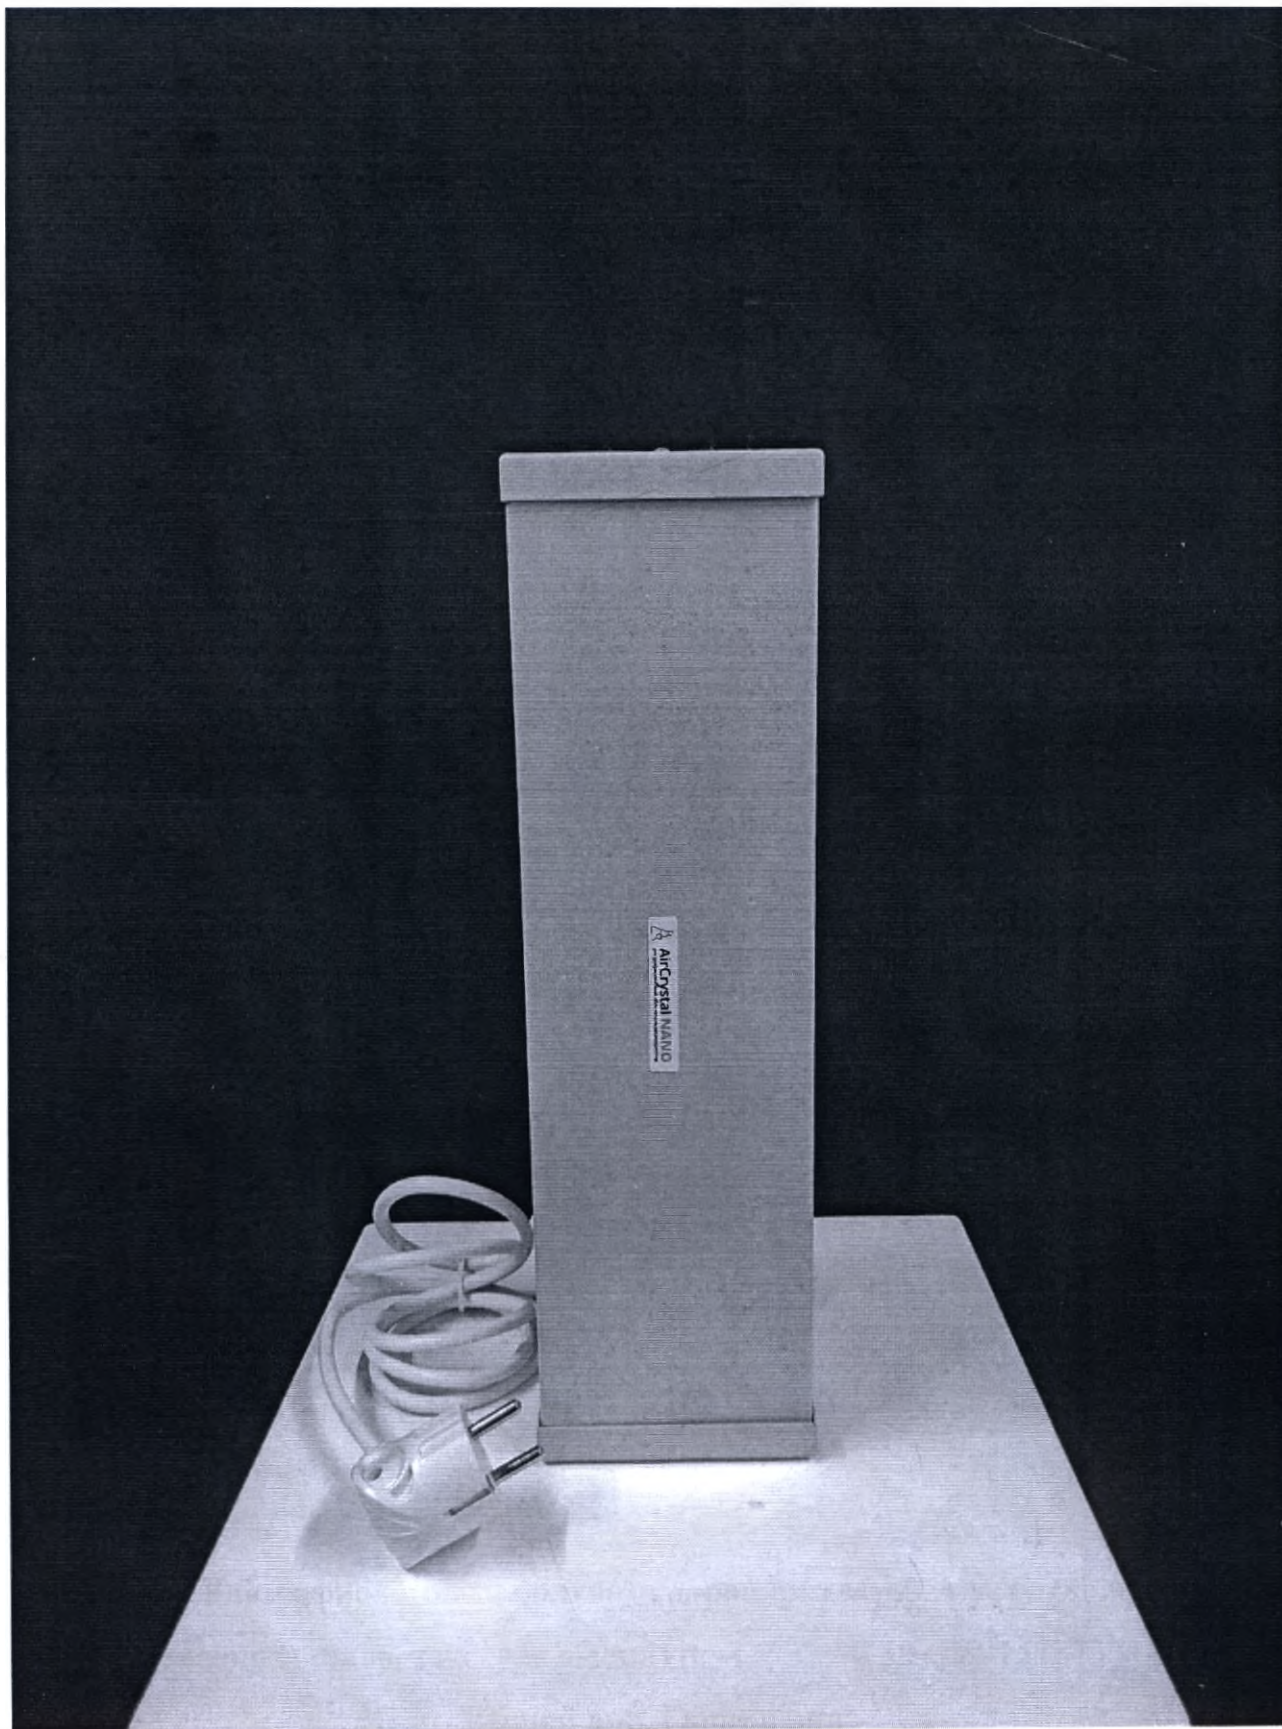


Рисунок 5 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal Nano med (серый) по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021. Общий вид. Общий вид

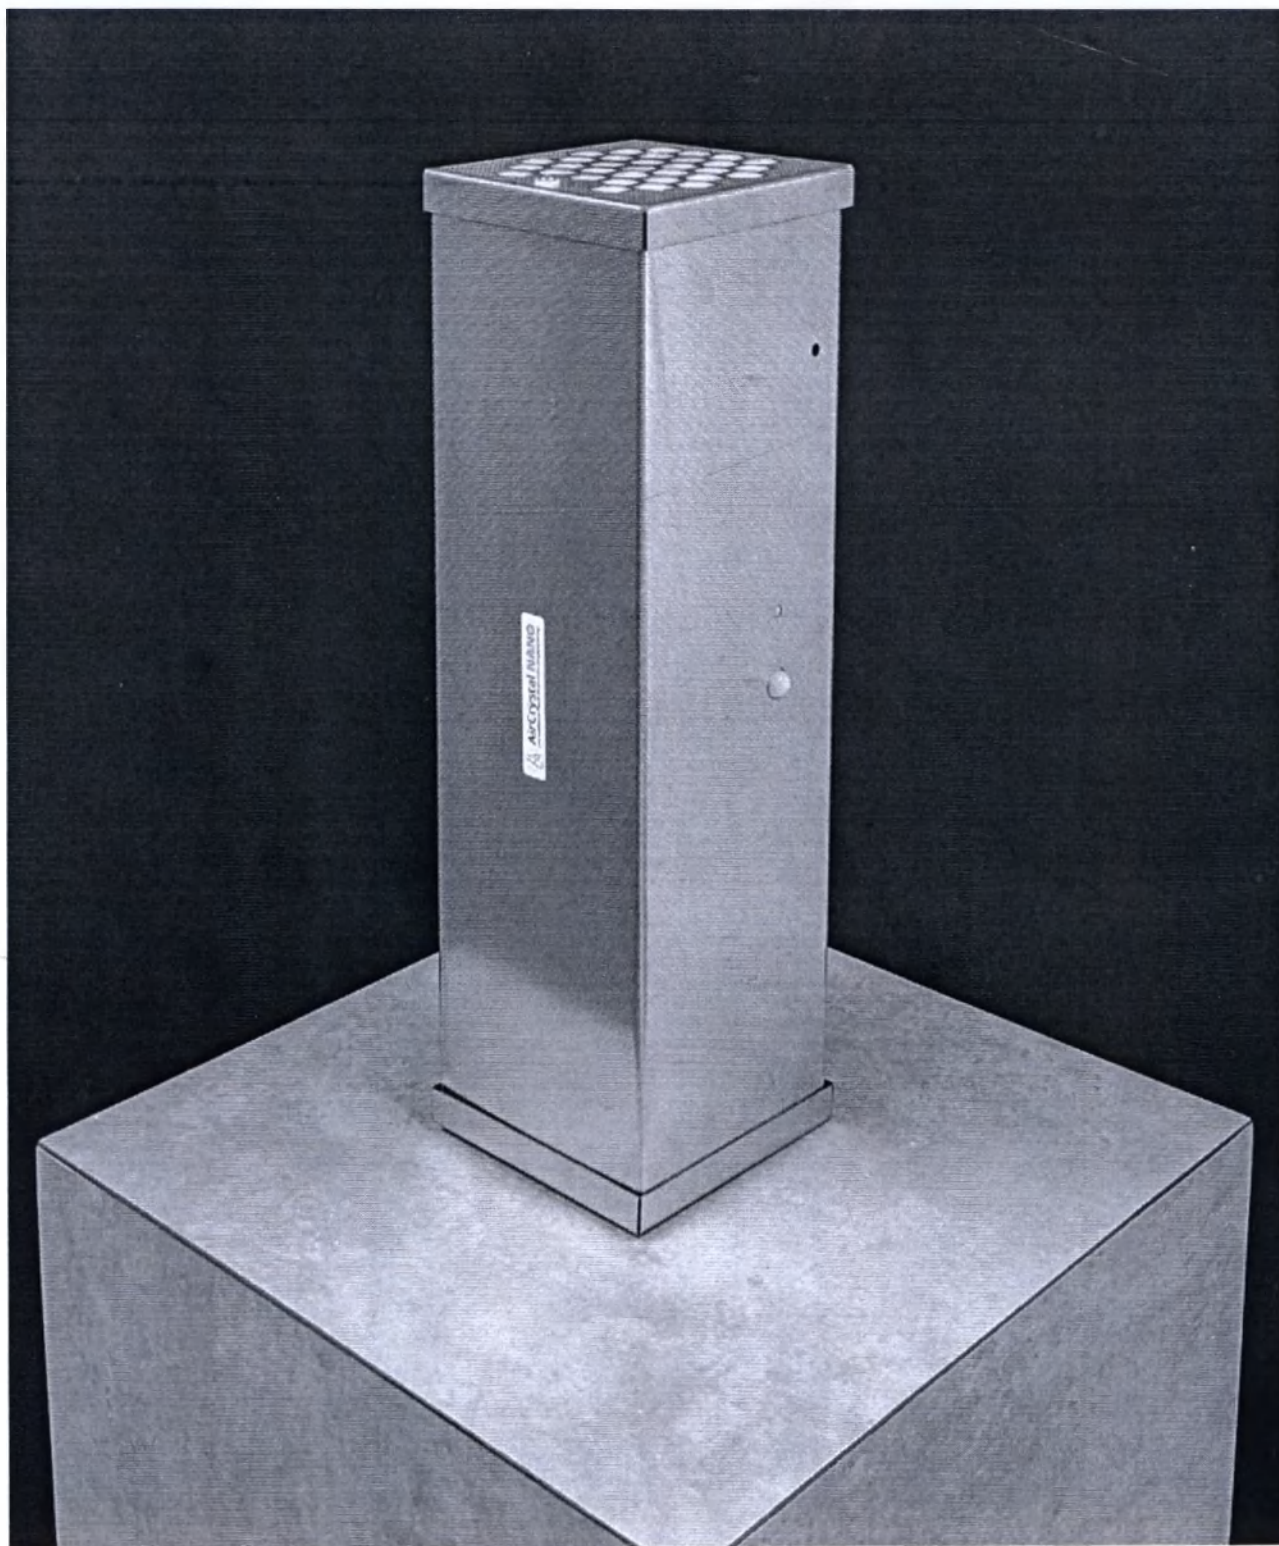


Рисунок 6 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal Nano X2 med
(нержавеющая сталь, текстура «Лен») по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021.

Общий вид. Общий вид

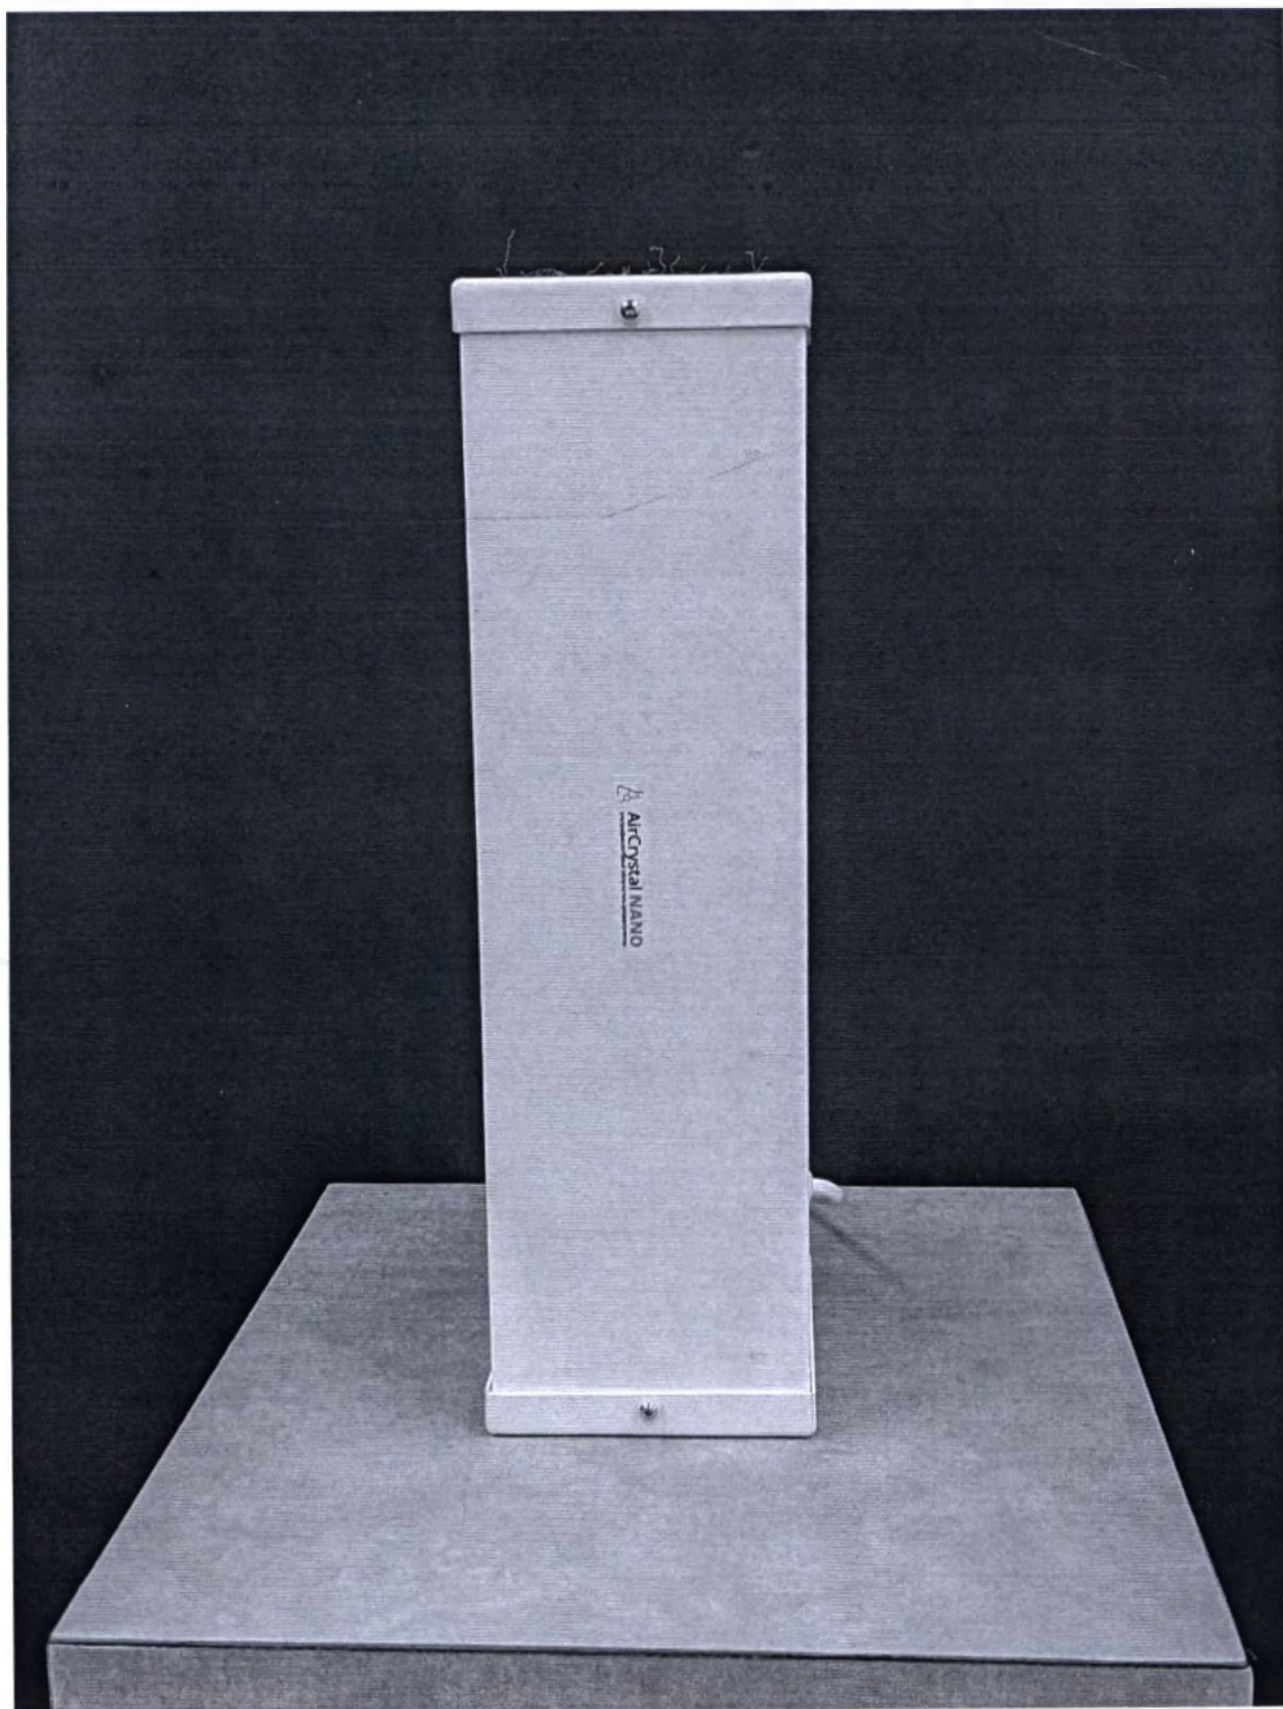


Рисунок 7 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal Nano X2 med (белый) по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021. Общий вид

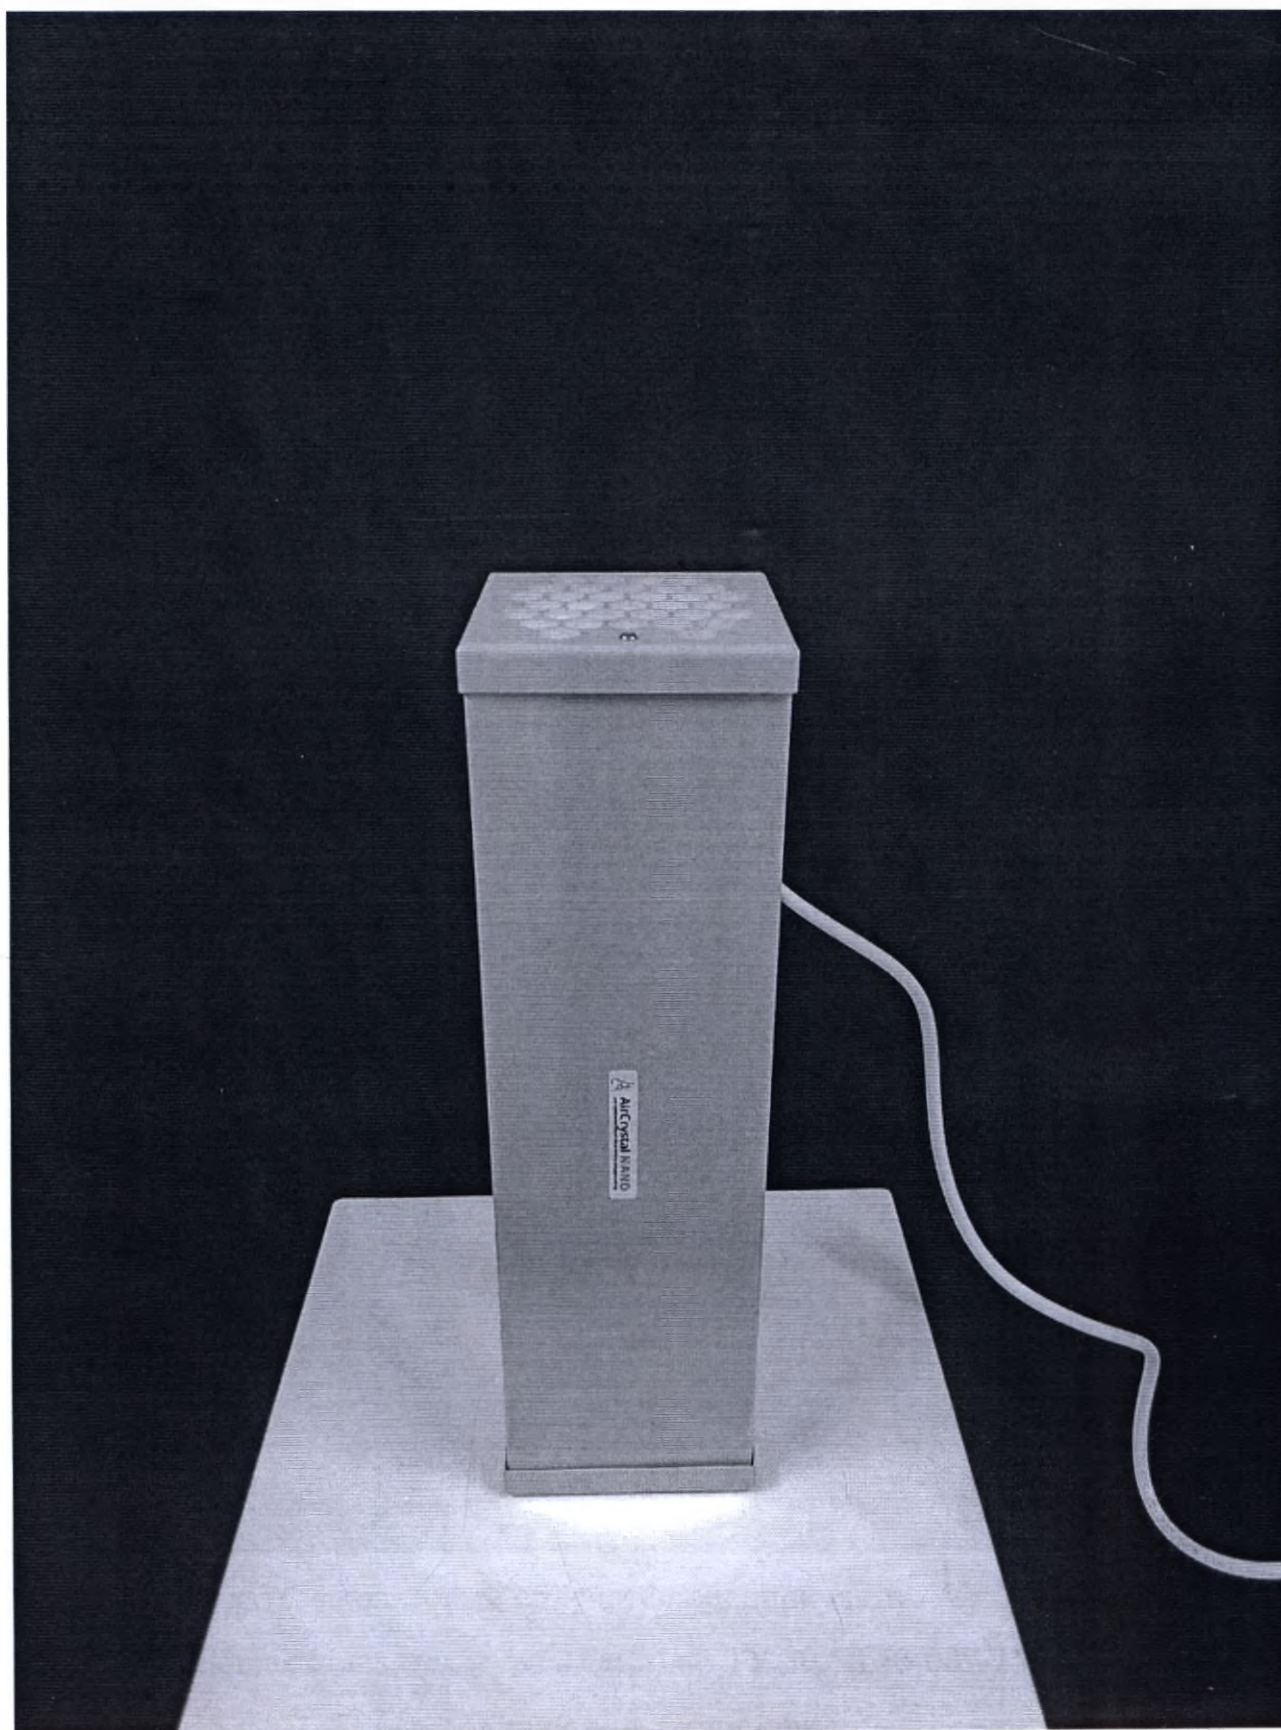


Рисунок 8 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal Nano X2 med (серый) по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021. Общий вид

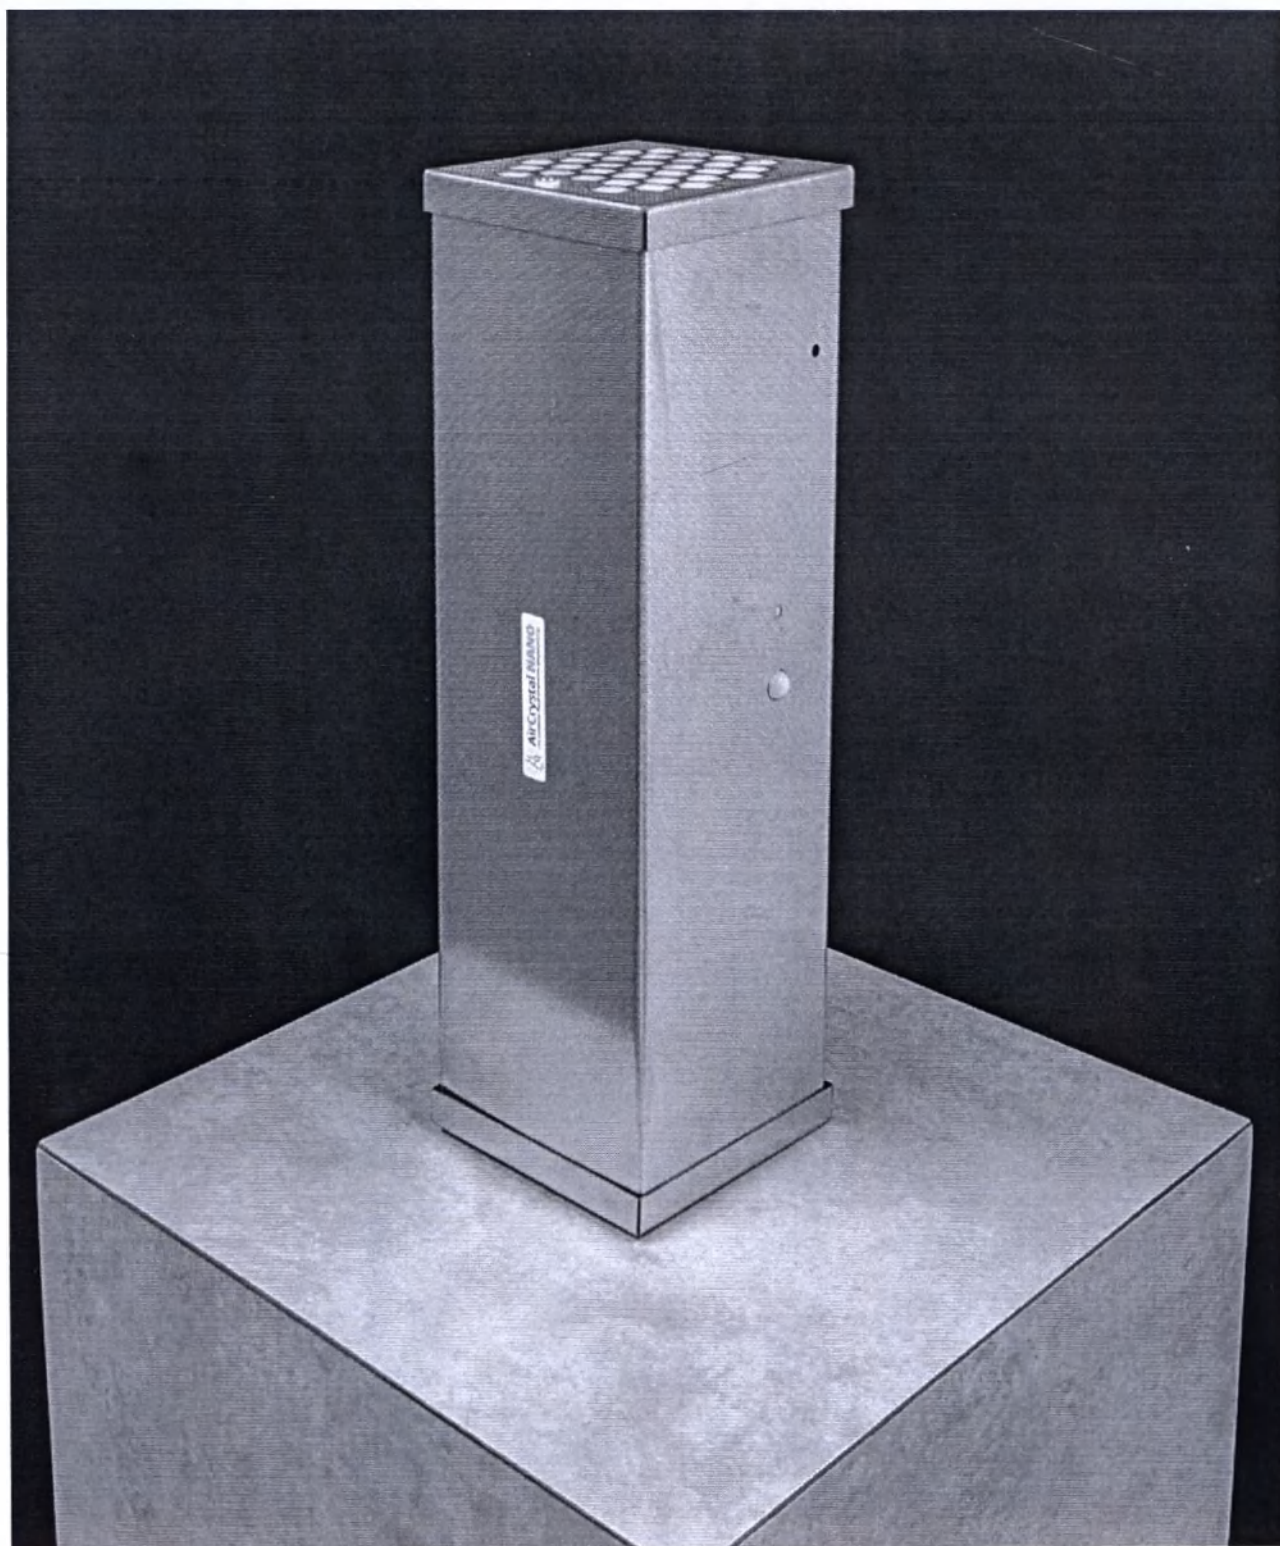


Рисунок 9 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal Nano 12 med
(нержавеющая сталь, текстура «Лен») по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021.

Общий вид. Общий вид

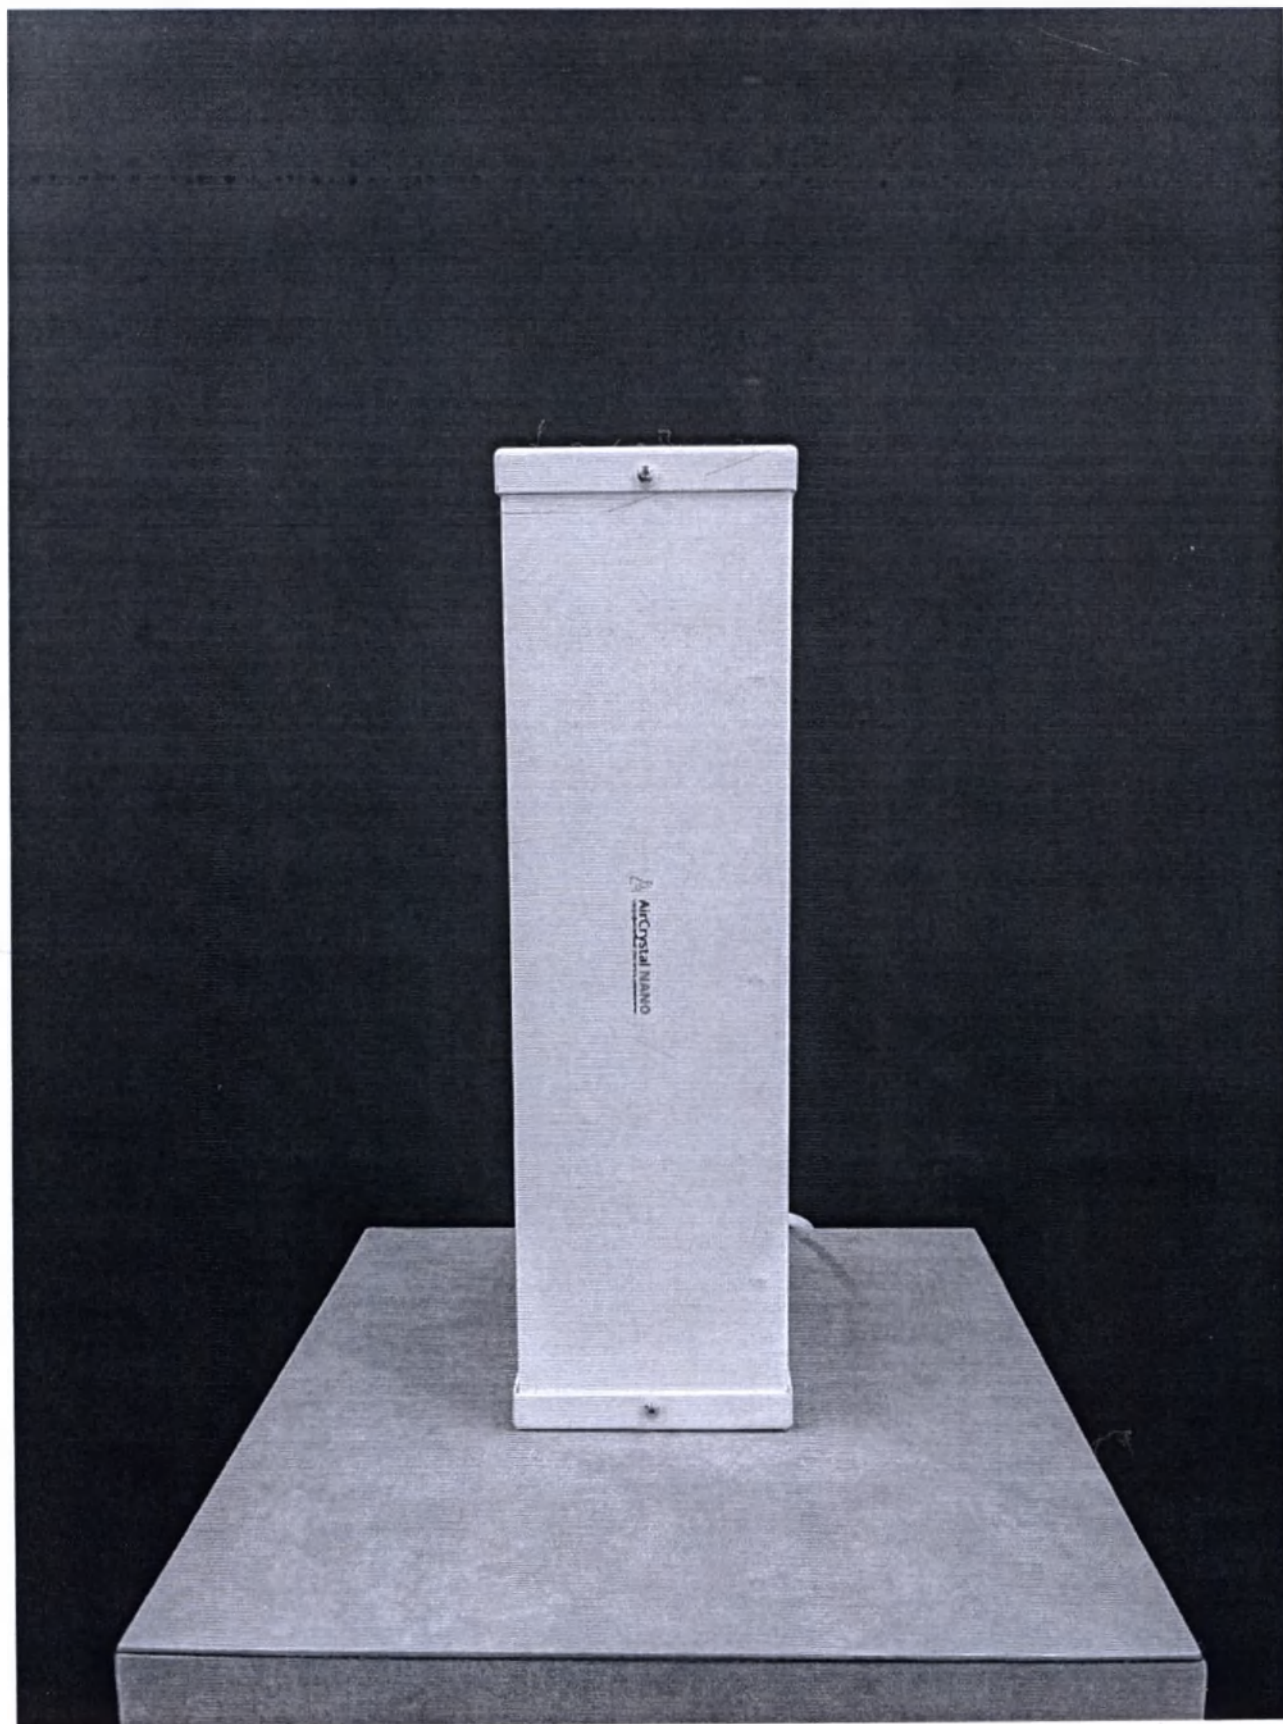


Рисунок 10 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal Nano 12 med
(белый) по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021.

Общий вид. Общий вид

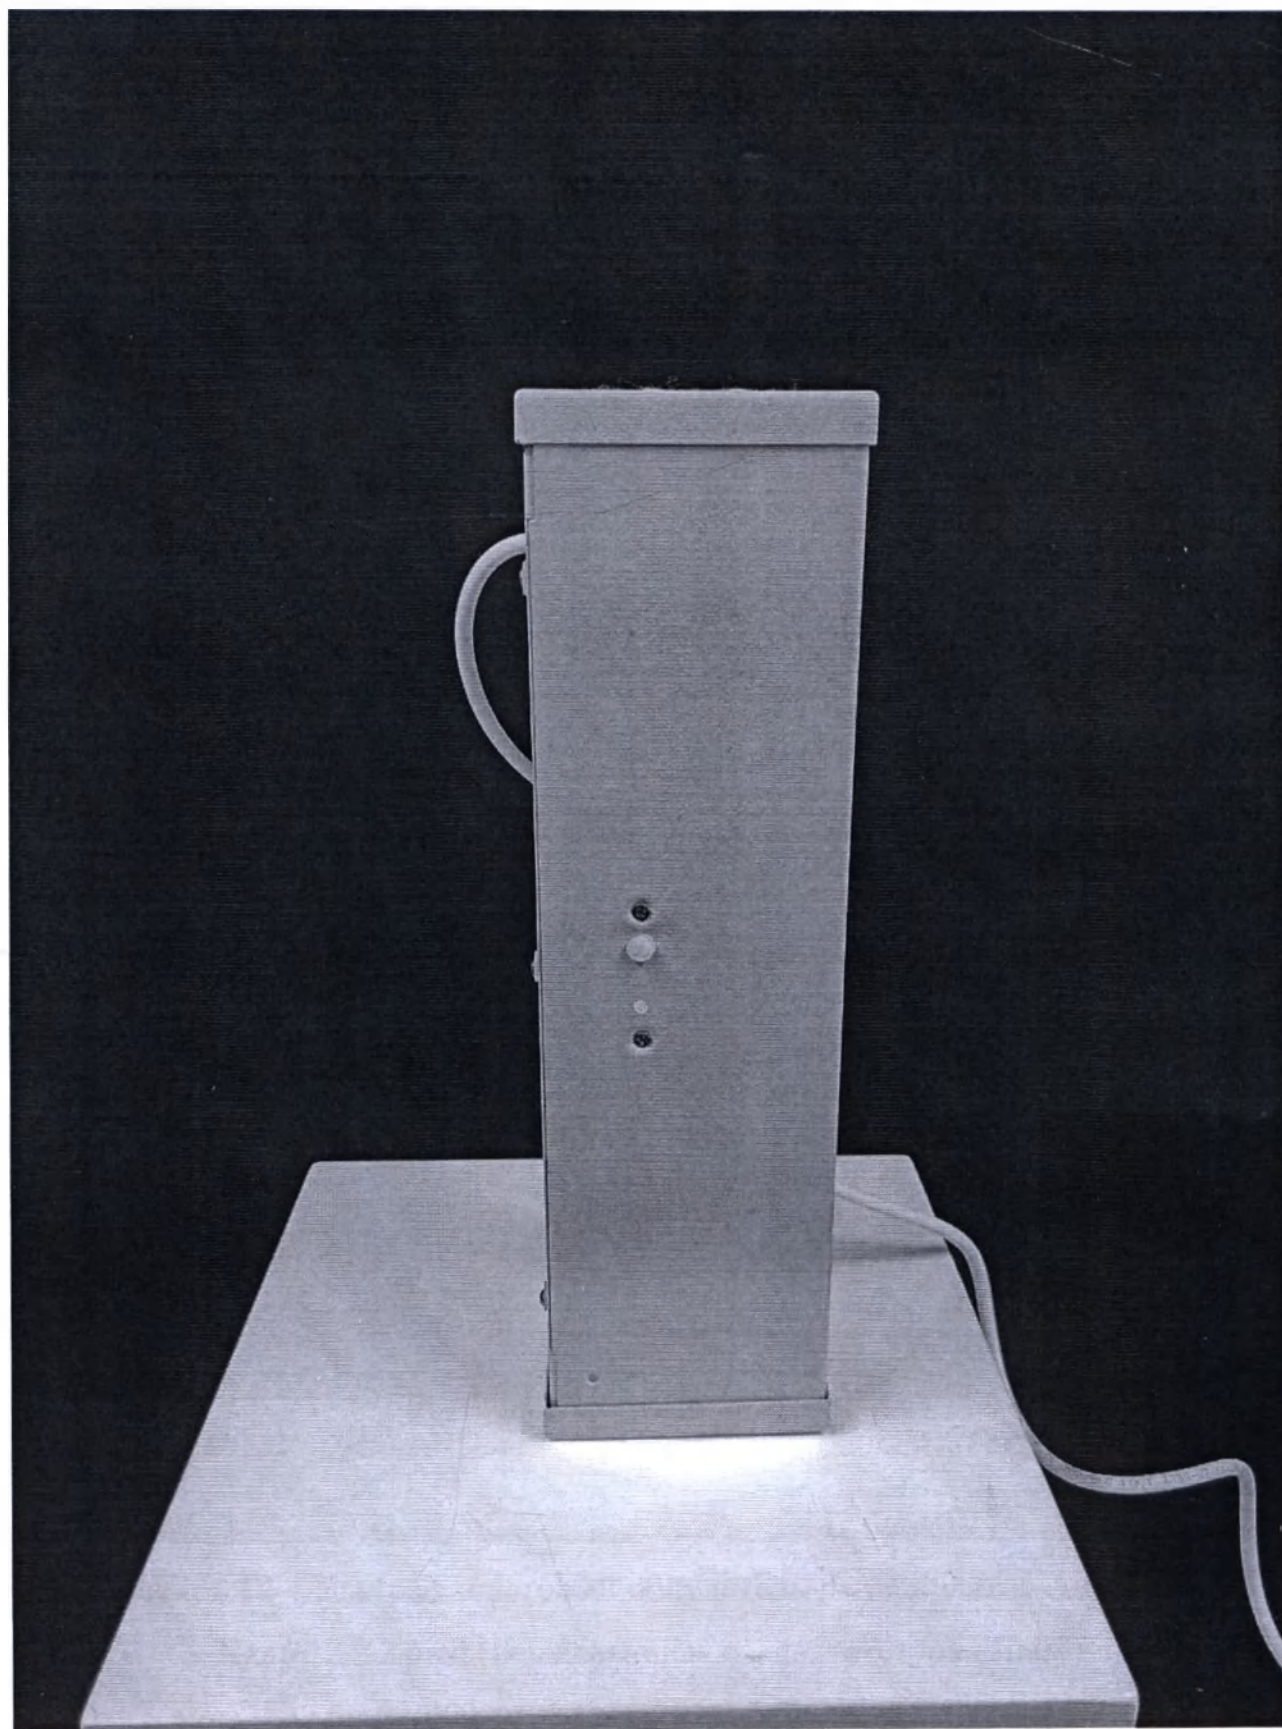


Рисунок 11 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal Nano 12 med
(серый) по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021.

Общий вид. Общий вид

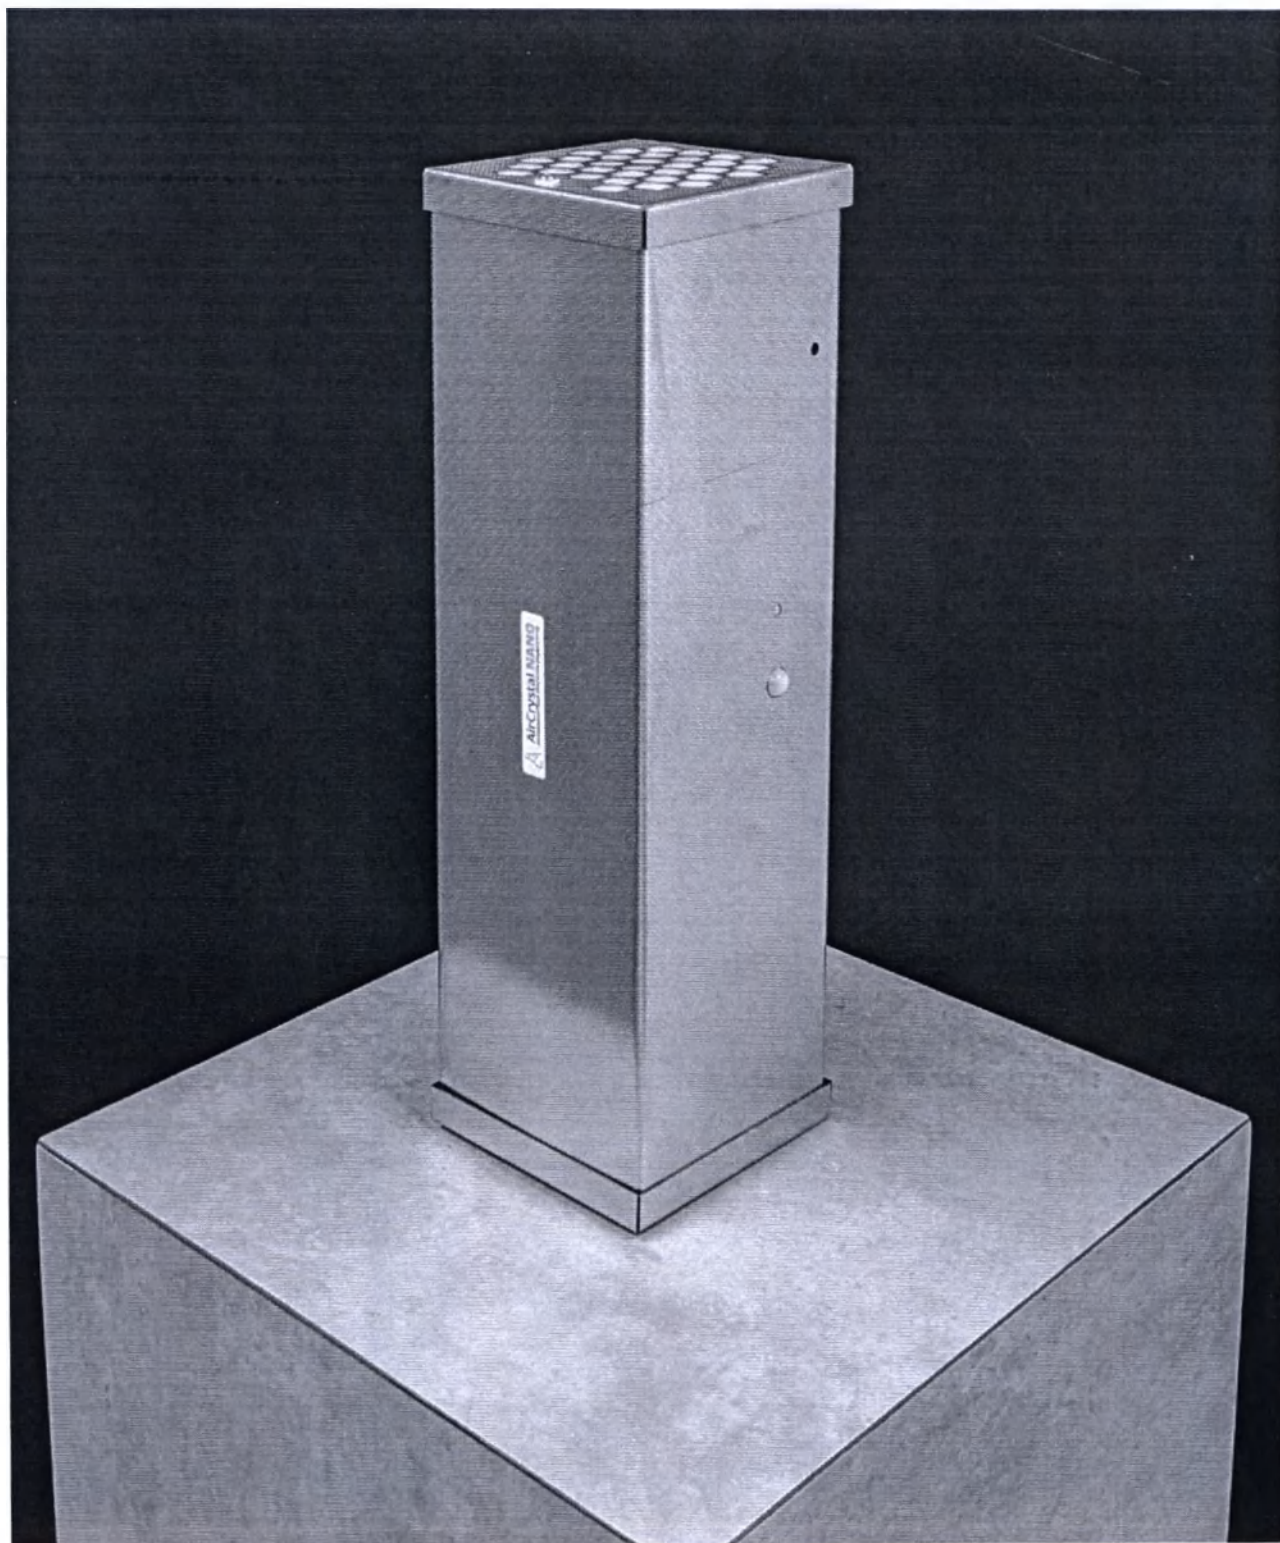


Рисунок 12 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal
Nano 12 X2 med (нержавеющая сталь, текстура «Лен»)
по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021. Общий вид. Общий вид

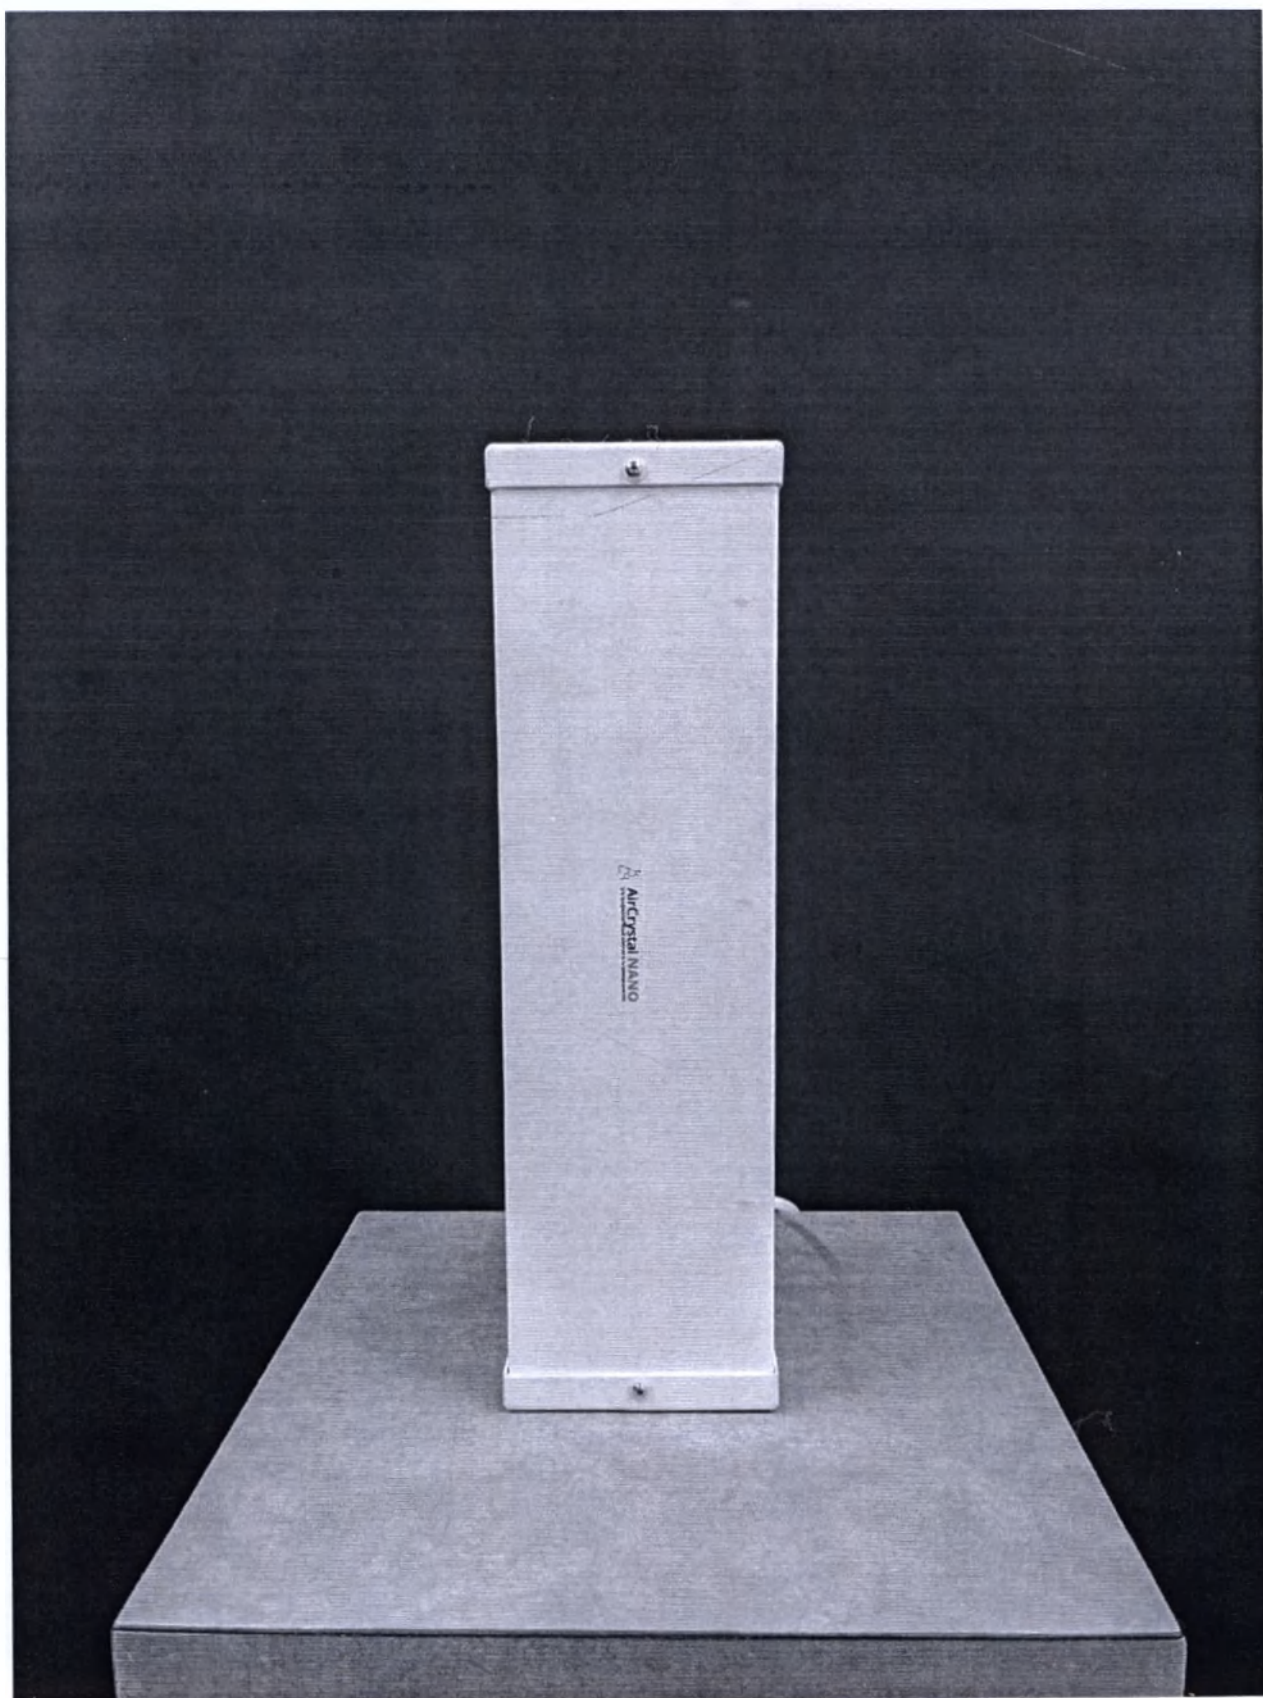


Рисунок 13 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal Nano 12 X2 med (белый) по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021.

Общий вид. Общий вид

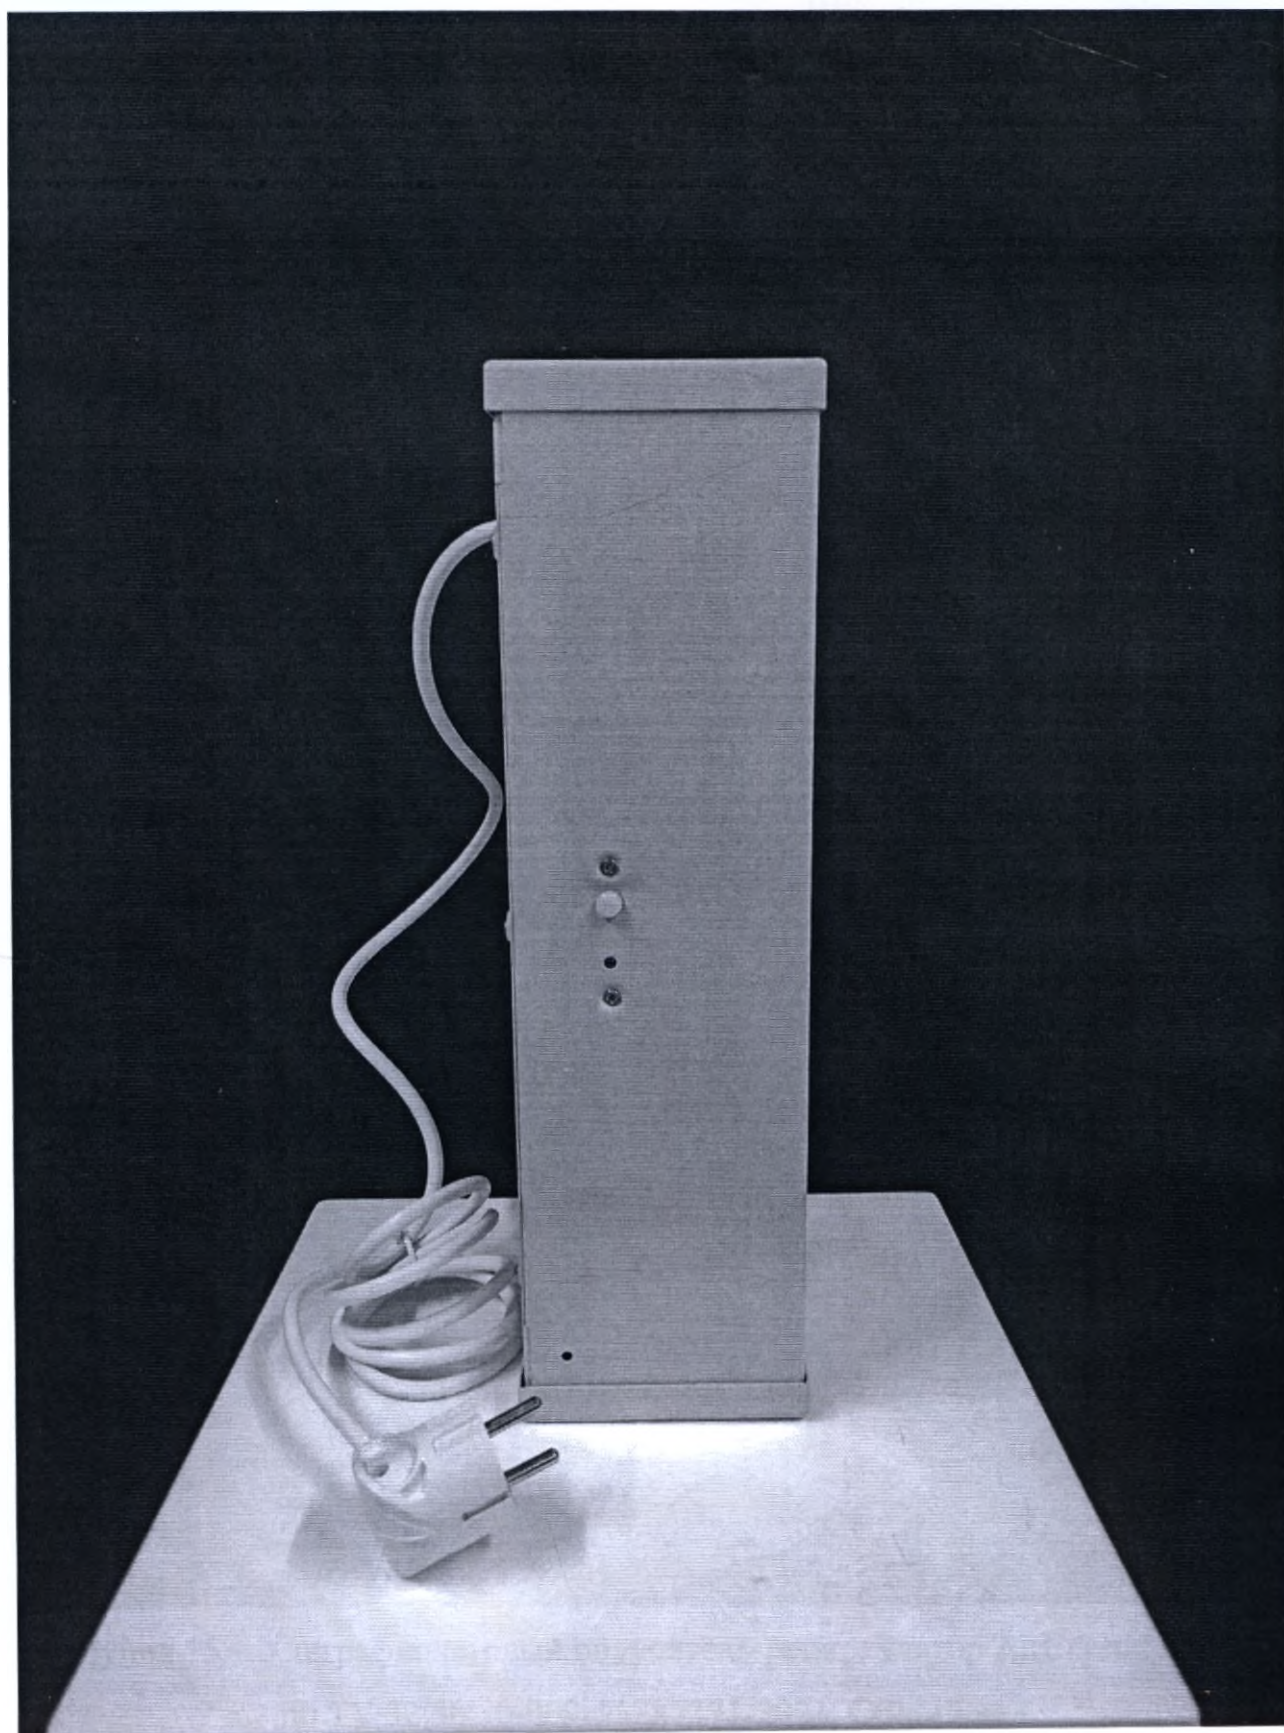


Рисунок 14 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal Nano 12 X2 med (серый) по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021.

Общий вид. Общий вид

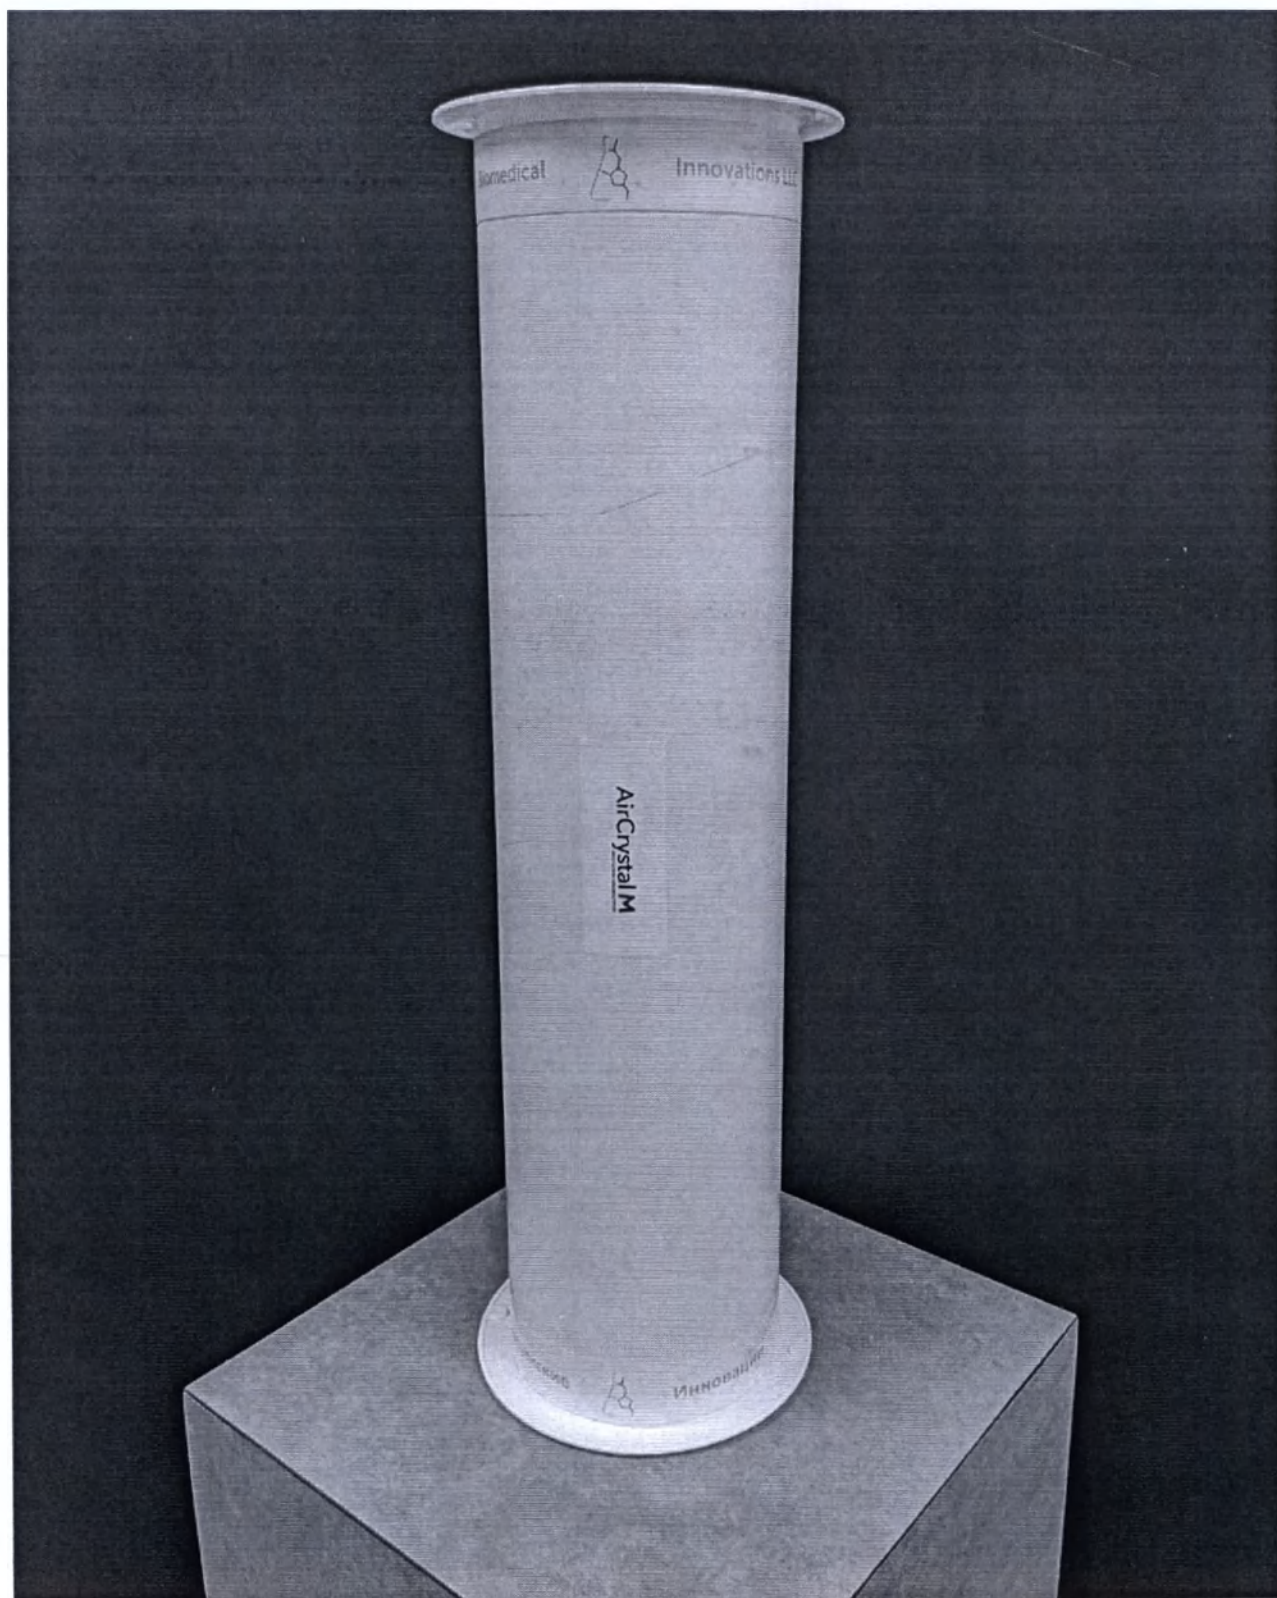


Рисунок 15 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal M med
по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021. Общий вид

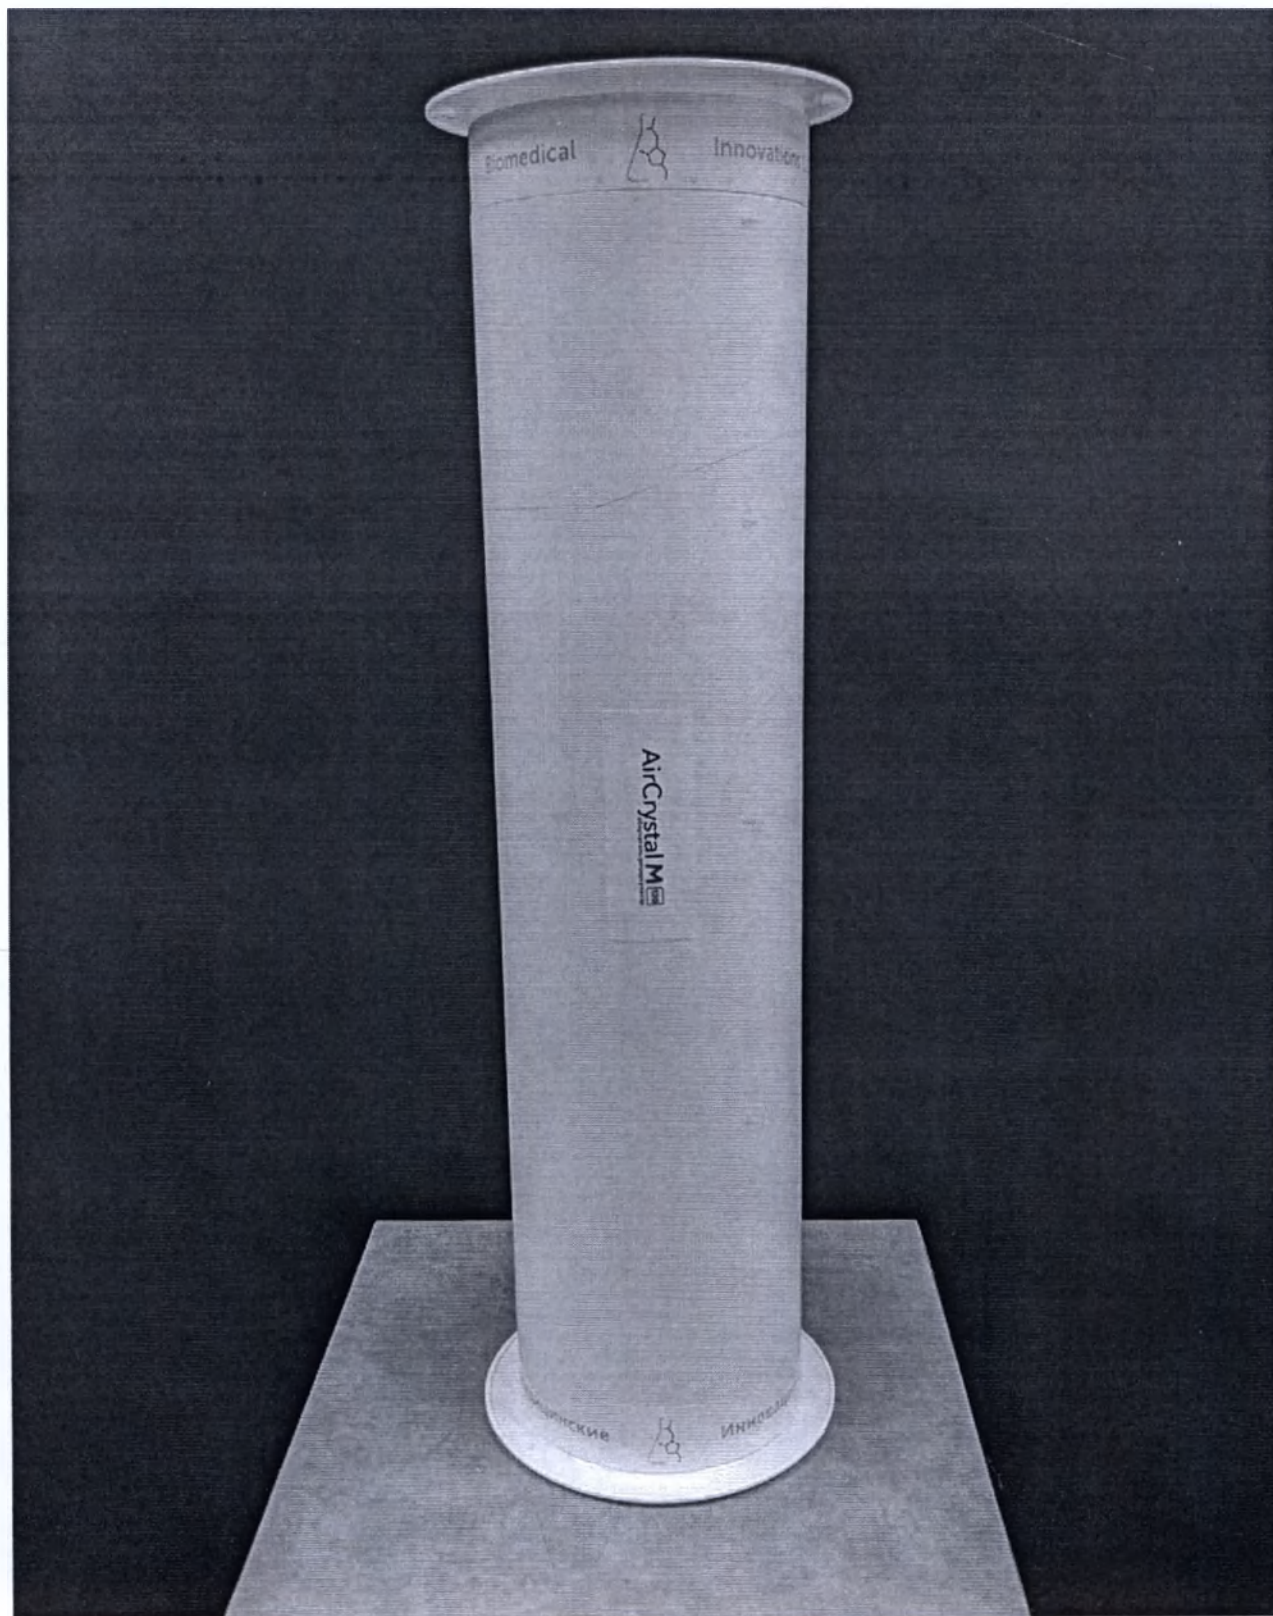


Рисунок 16 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal M 120 med по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021. Общий вид

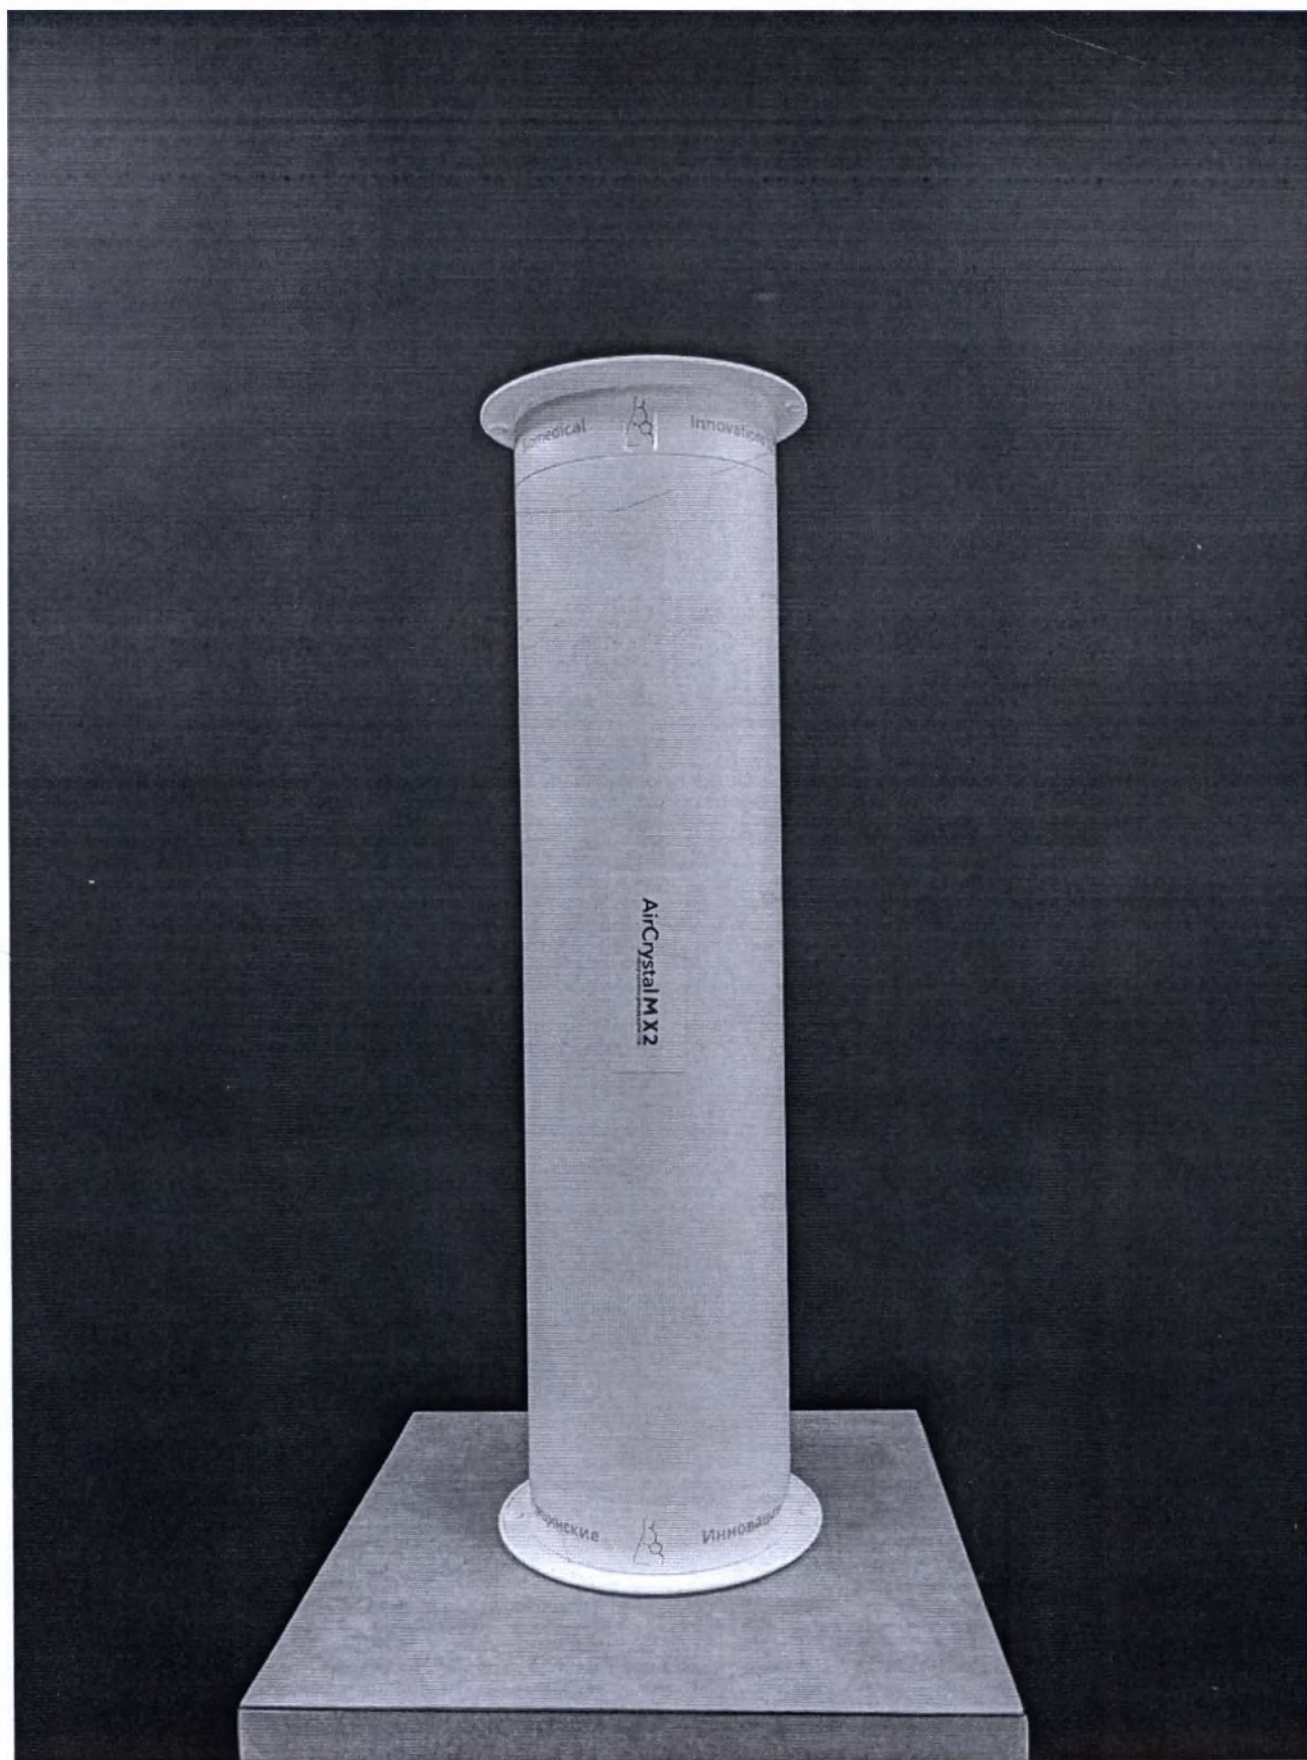


Рисунок 17 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal M X2 med
по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021. Общий вид

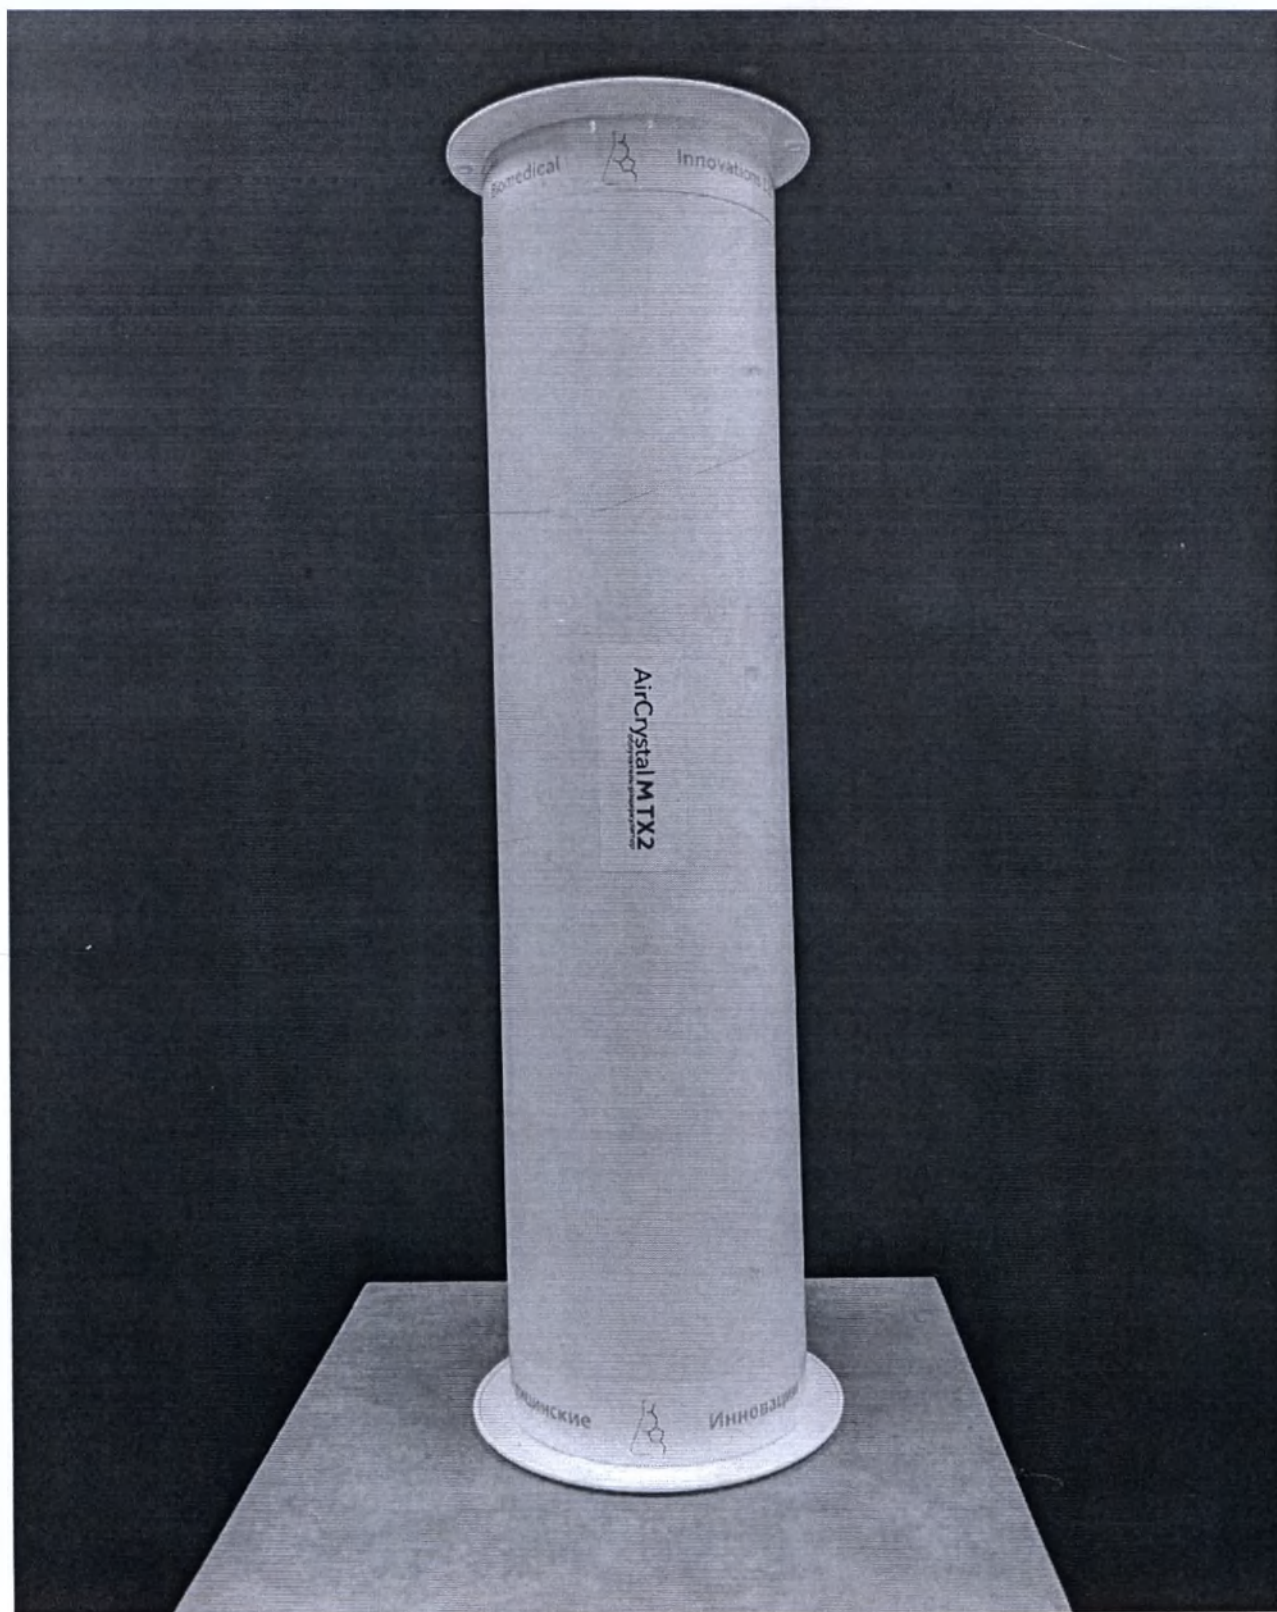


Рисунок 18 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal M TX2 med по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021. Общий вид



Рисунок 19 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal M UTX2 med по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021. Общий вид

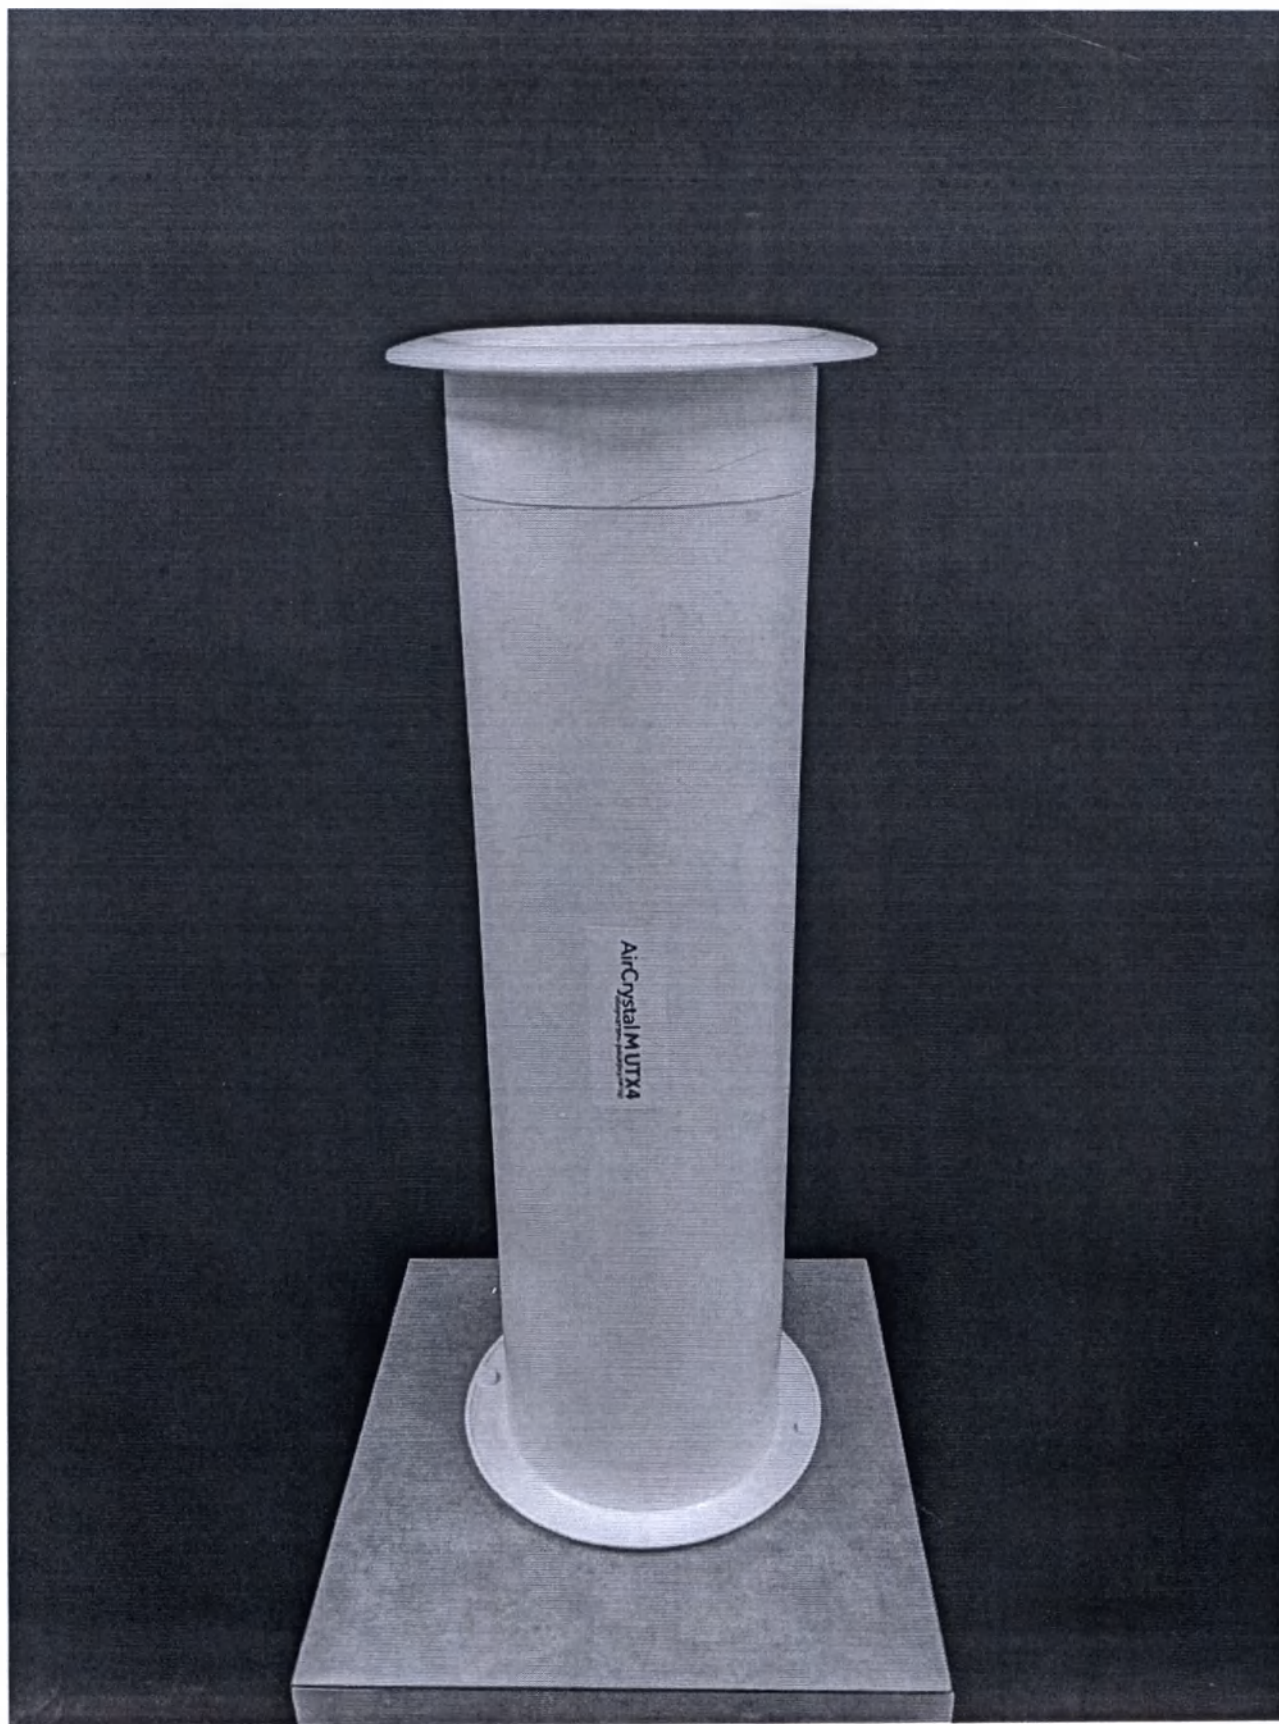


Рисунок 20 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal M UTX4 med по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021. Общий вид

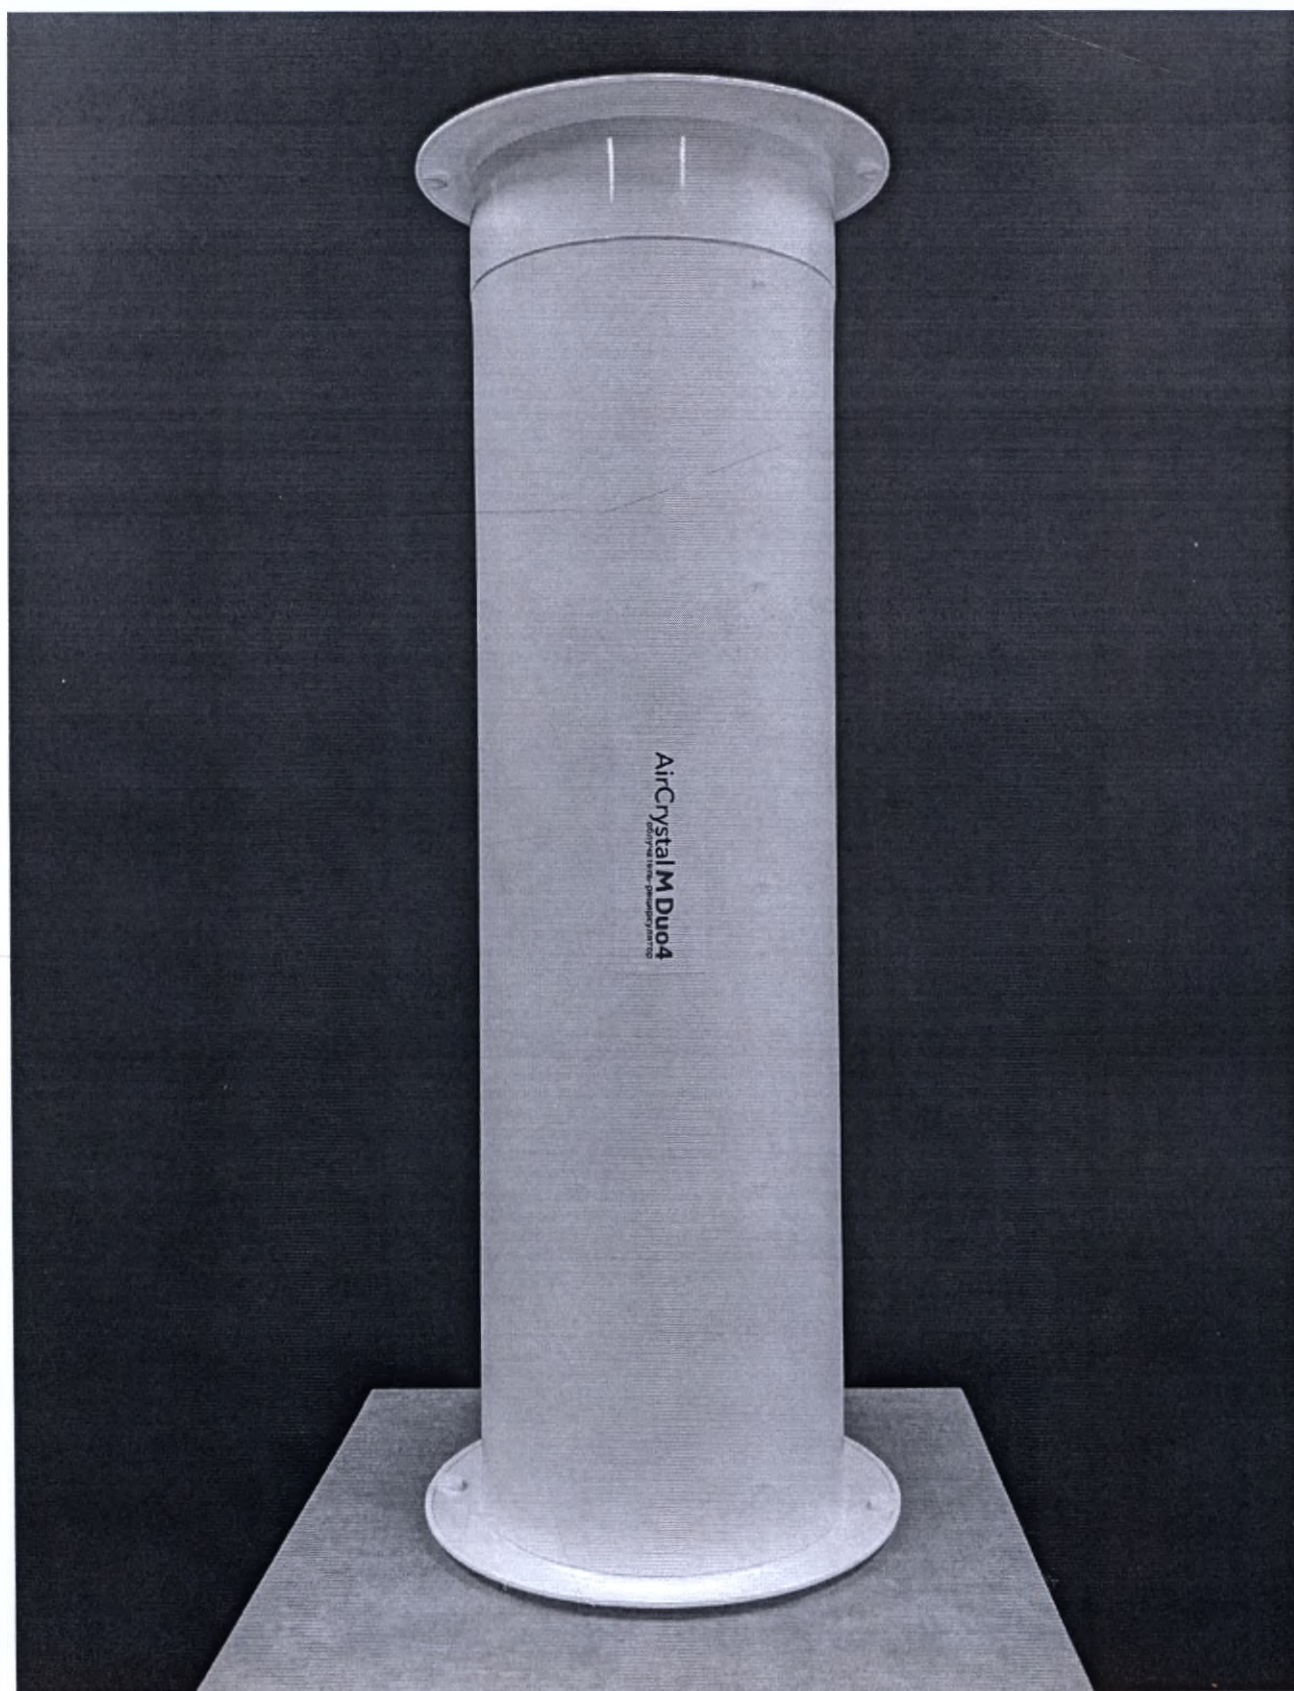


Рисунок 21 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal M Duo 4 med
по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021. Общий вид

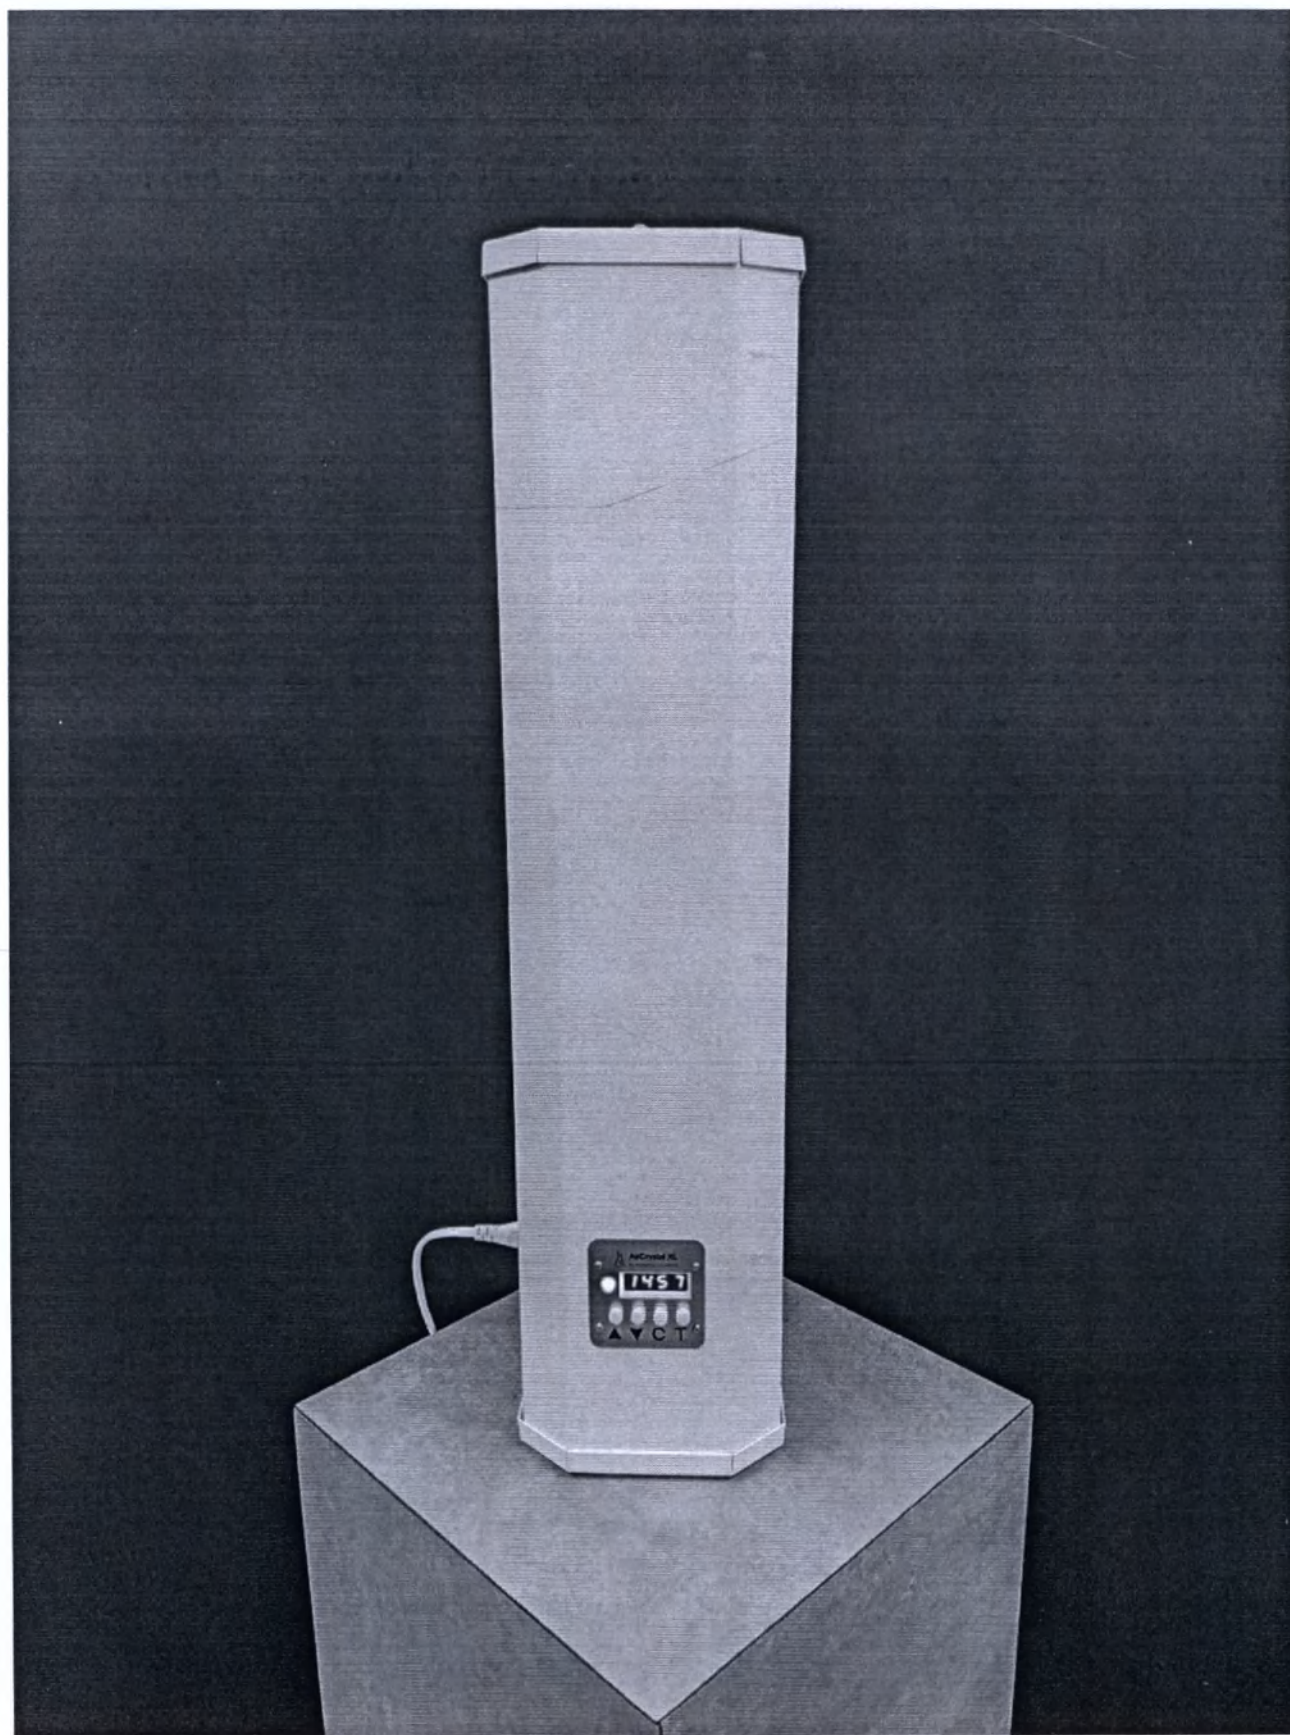


Рисунок 22 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal XL b2 med по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021. Общий вид

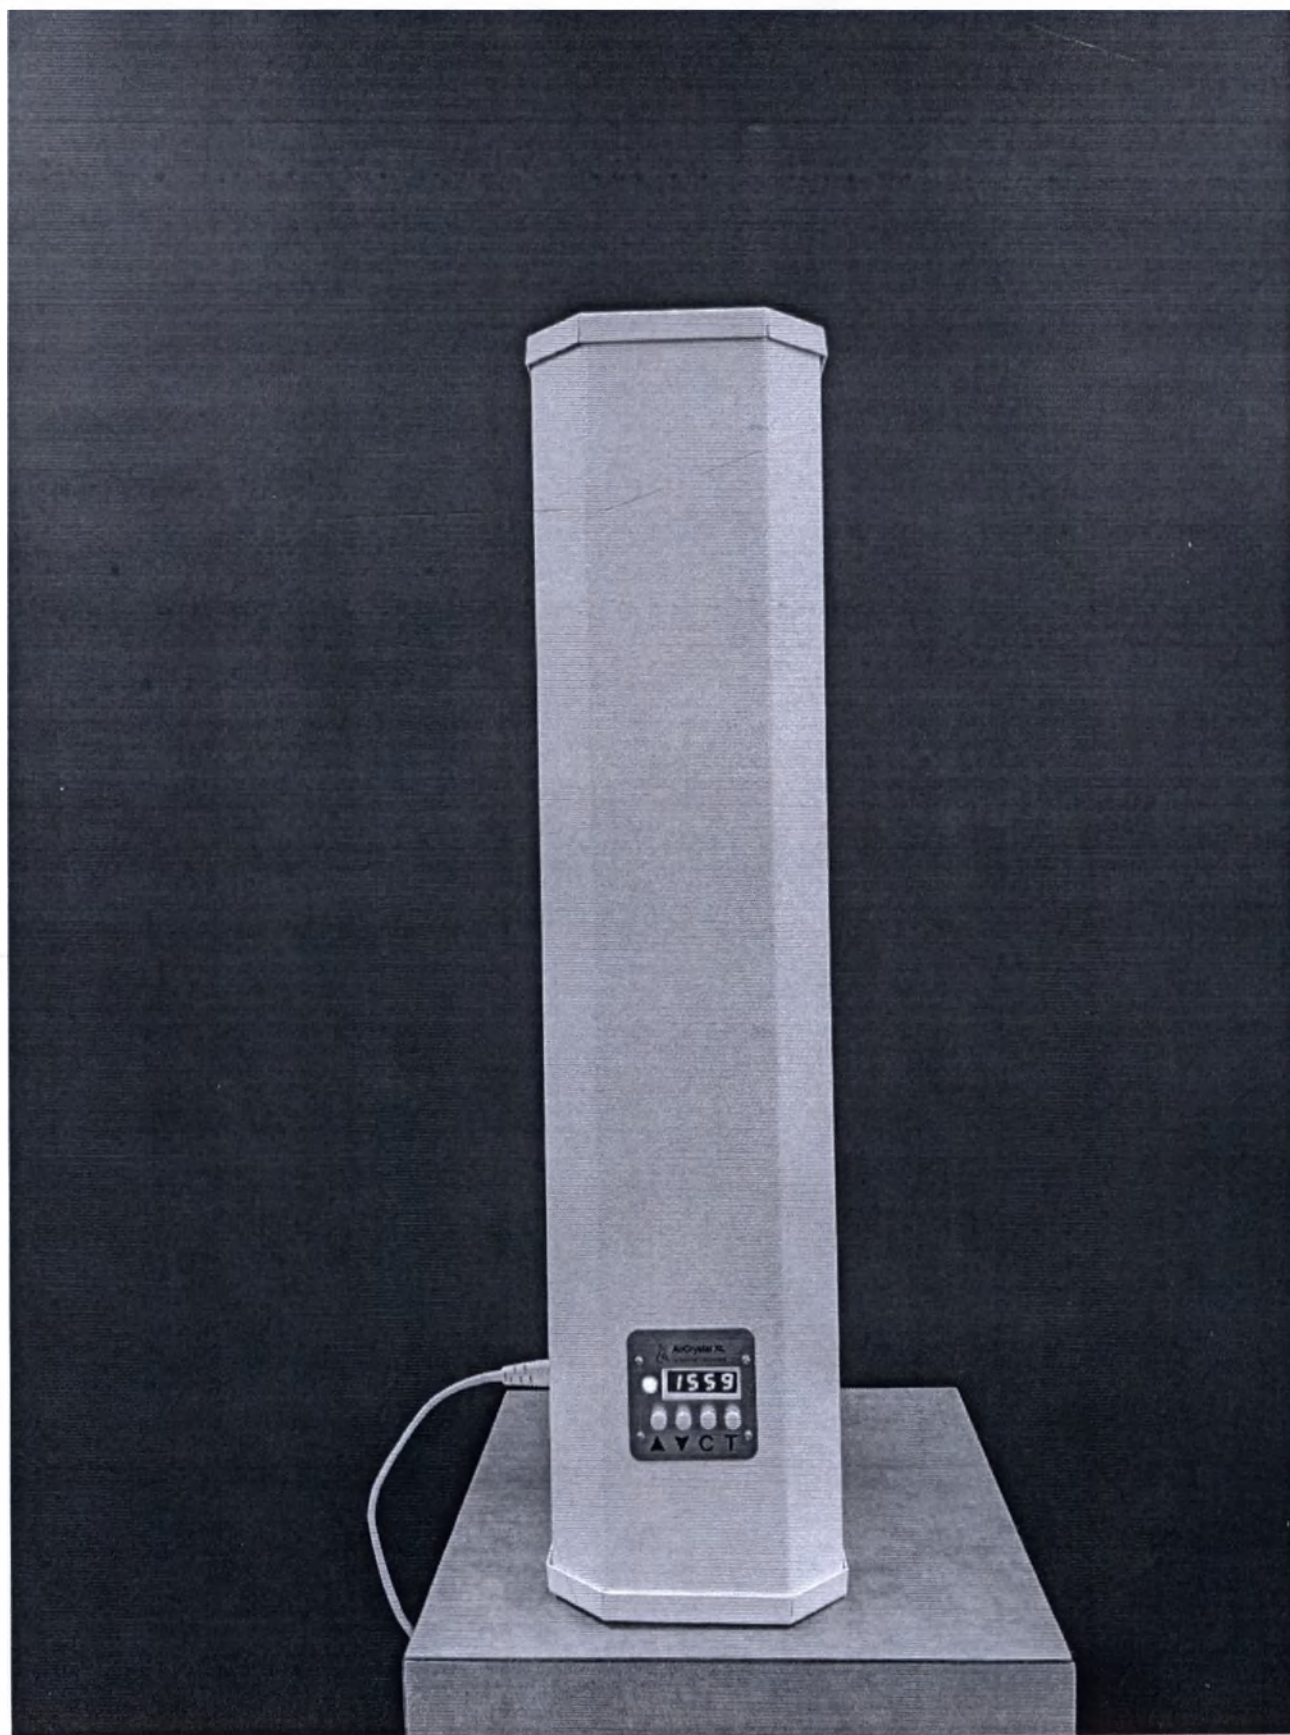


Рисунок 23 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal XL b3 med по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021. Общий вид

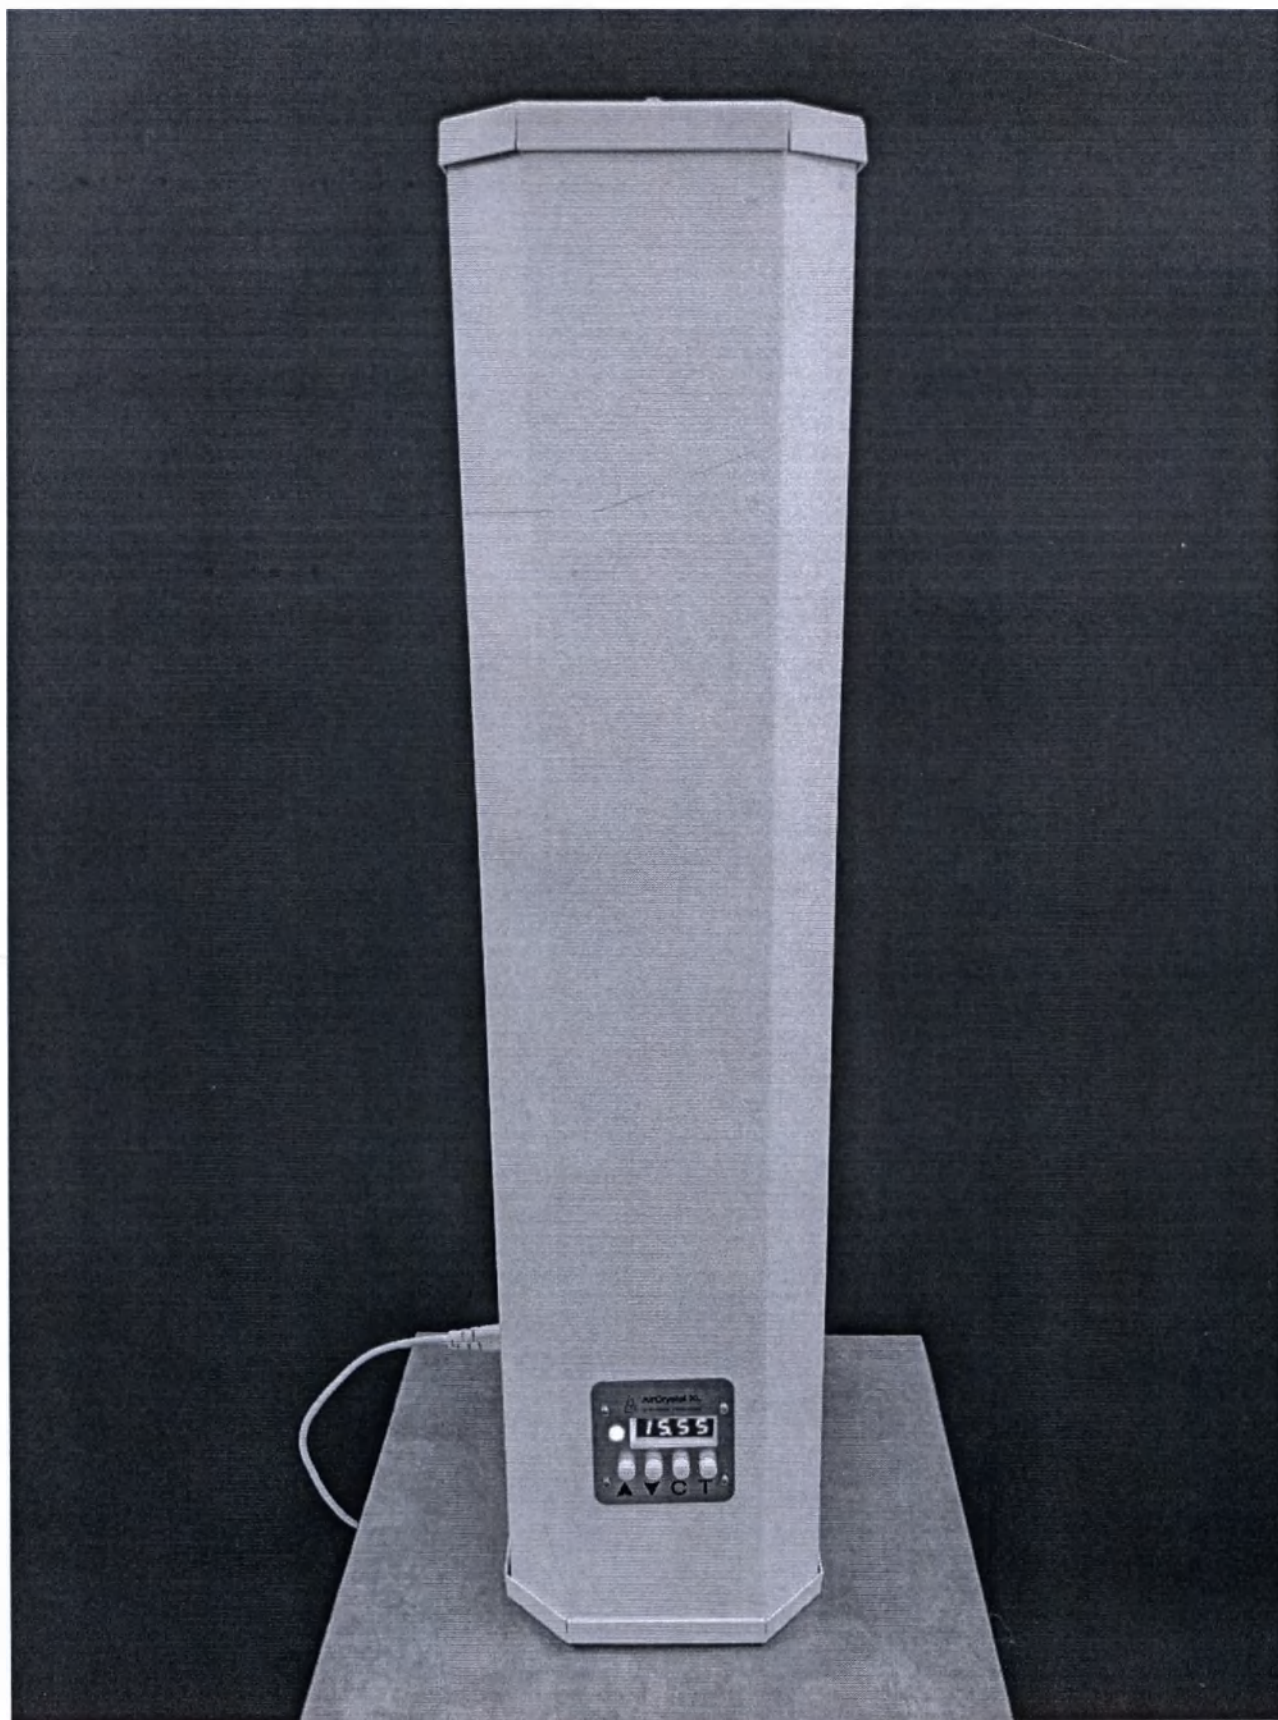


Рисунок 24 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal XL b4 med по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021. Общий вид

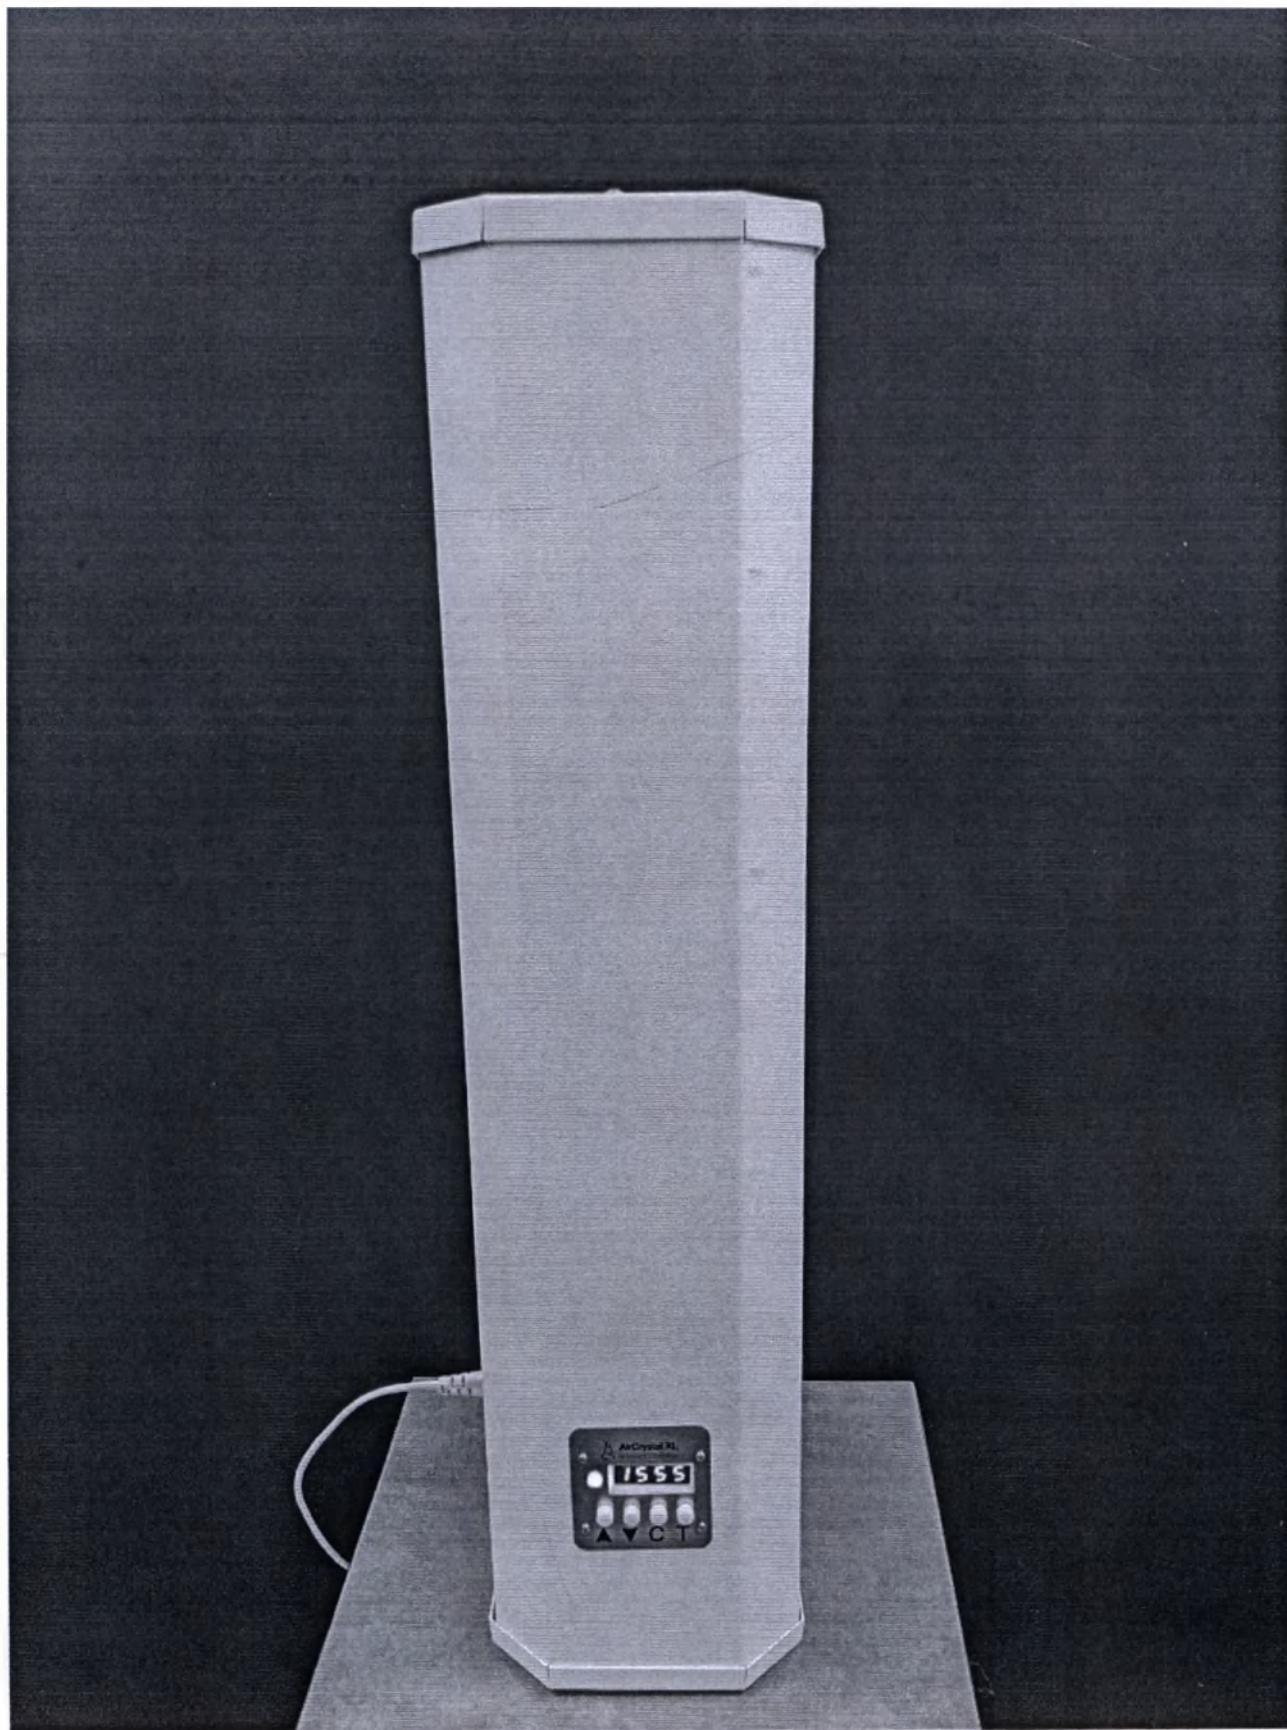


Рисунок 25 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal XL b5 med по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021. Общий вид

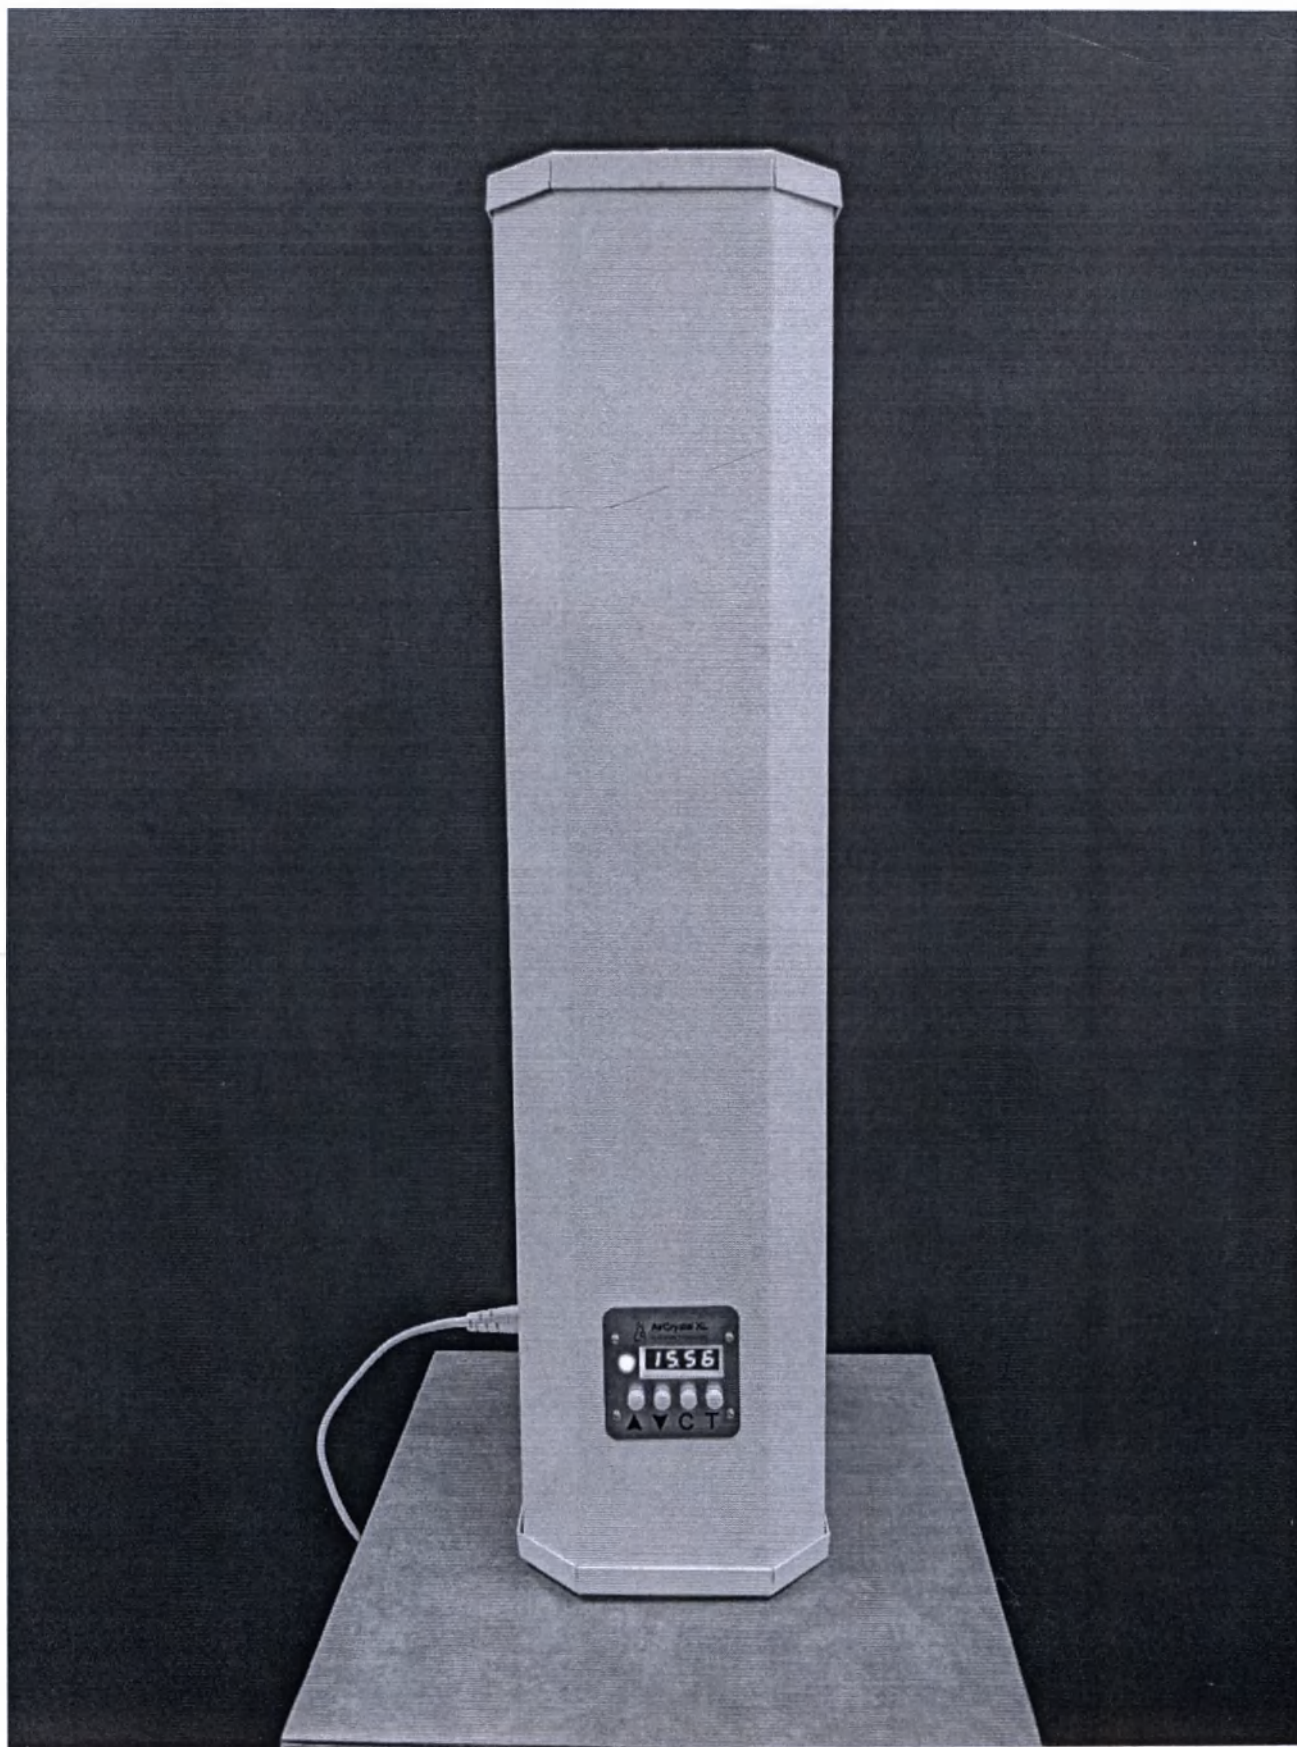


Рисунок 26 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal XL c2 med
по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021. Общий вид

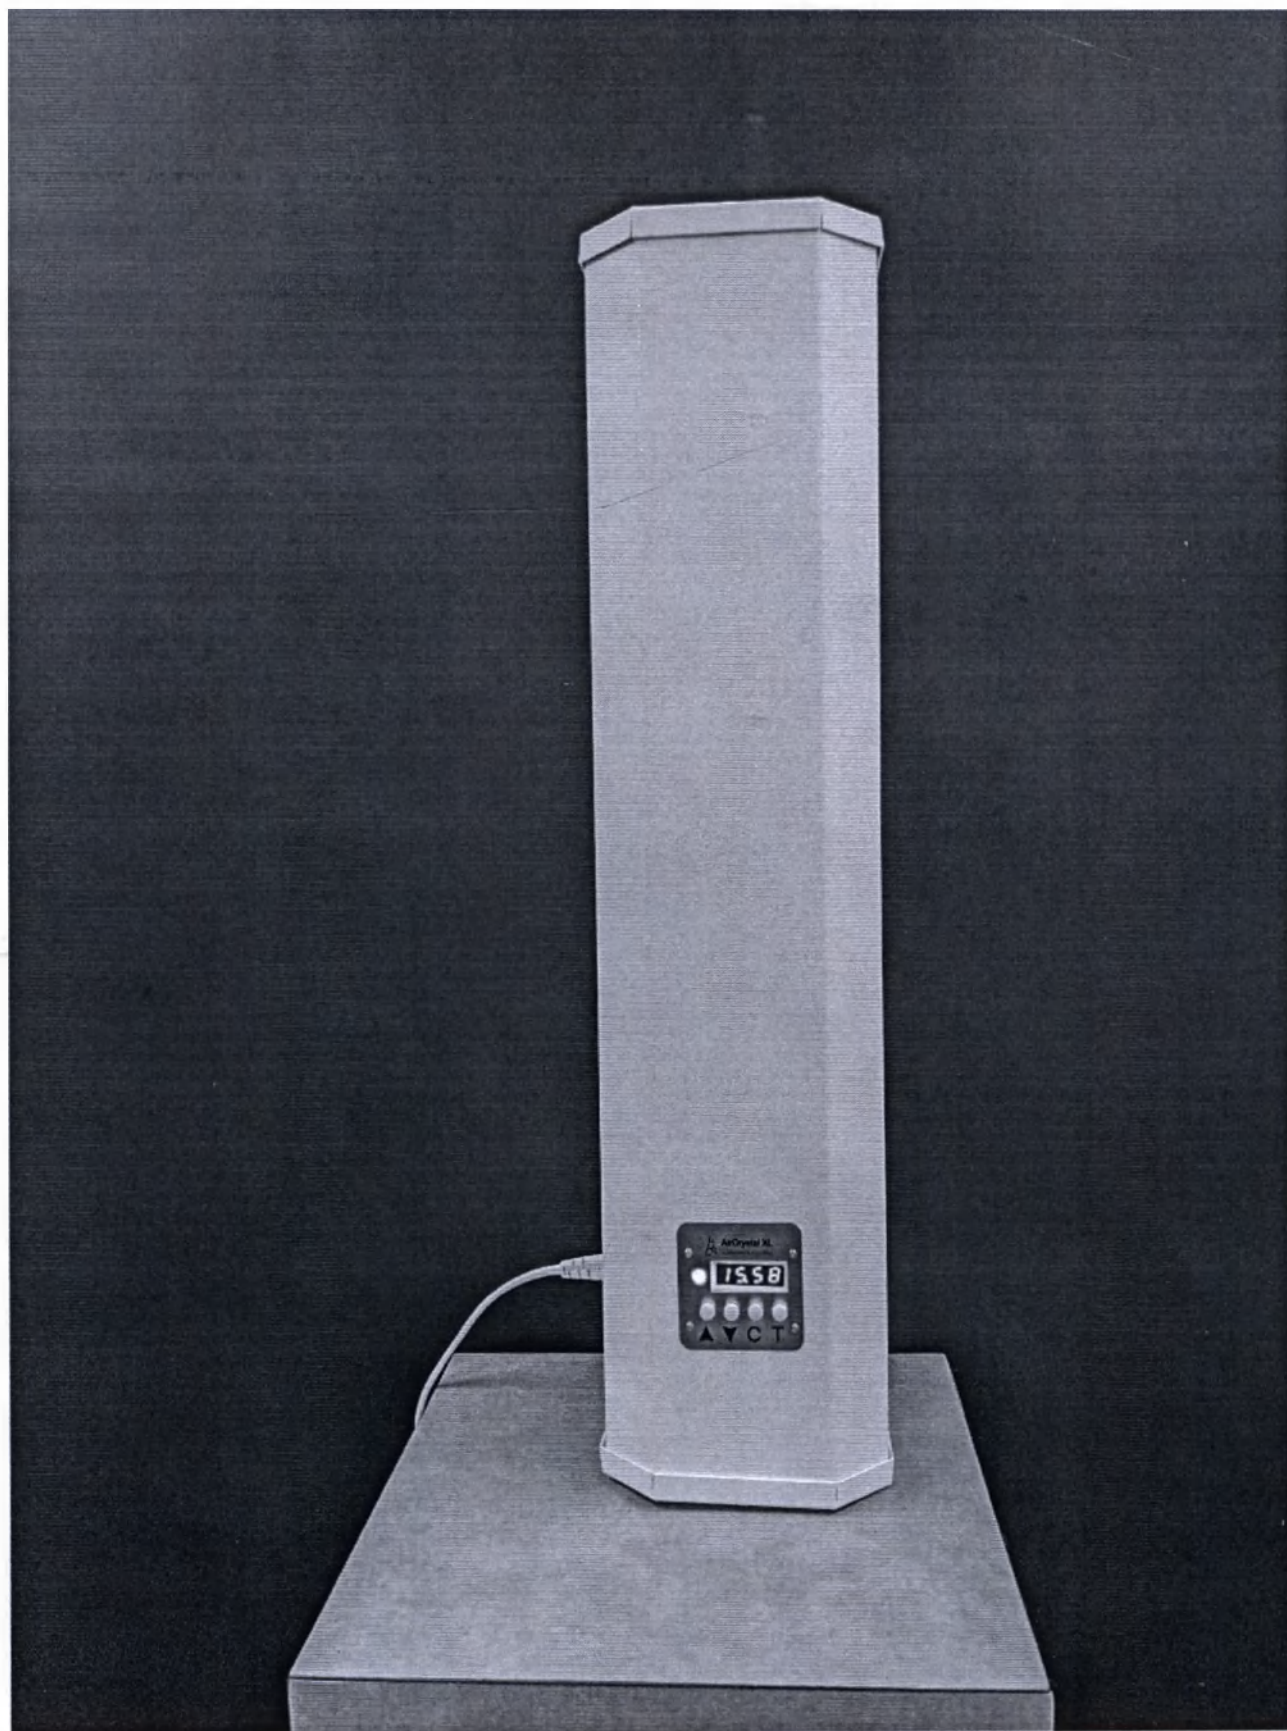


Рисунок 27 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal XL c3 med по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021. Общий вид

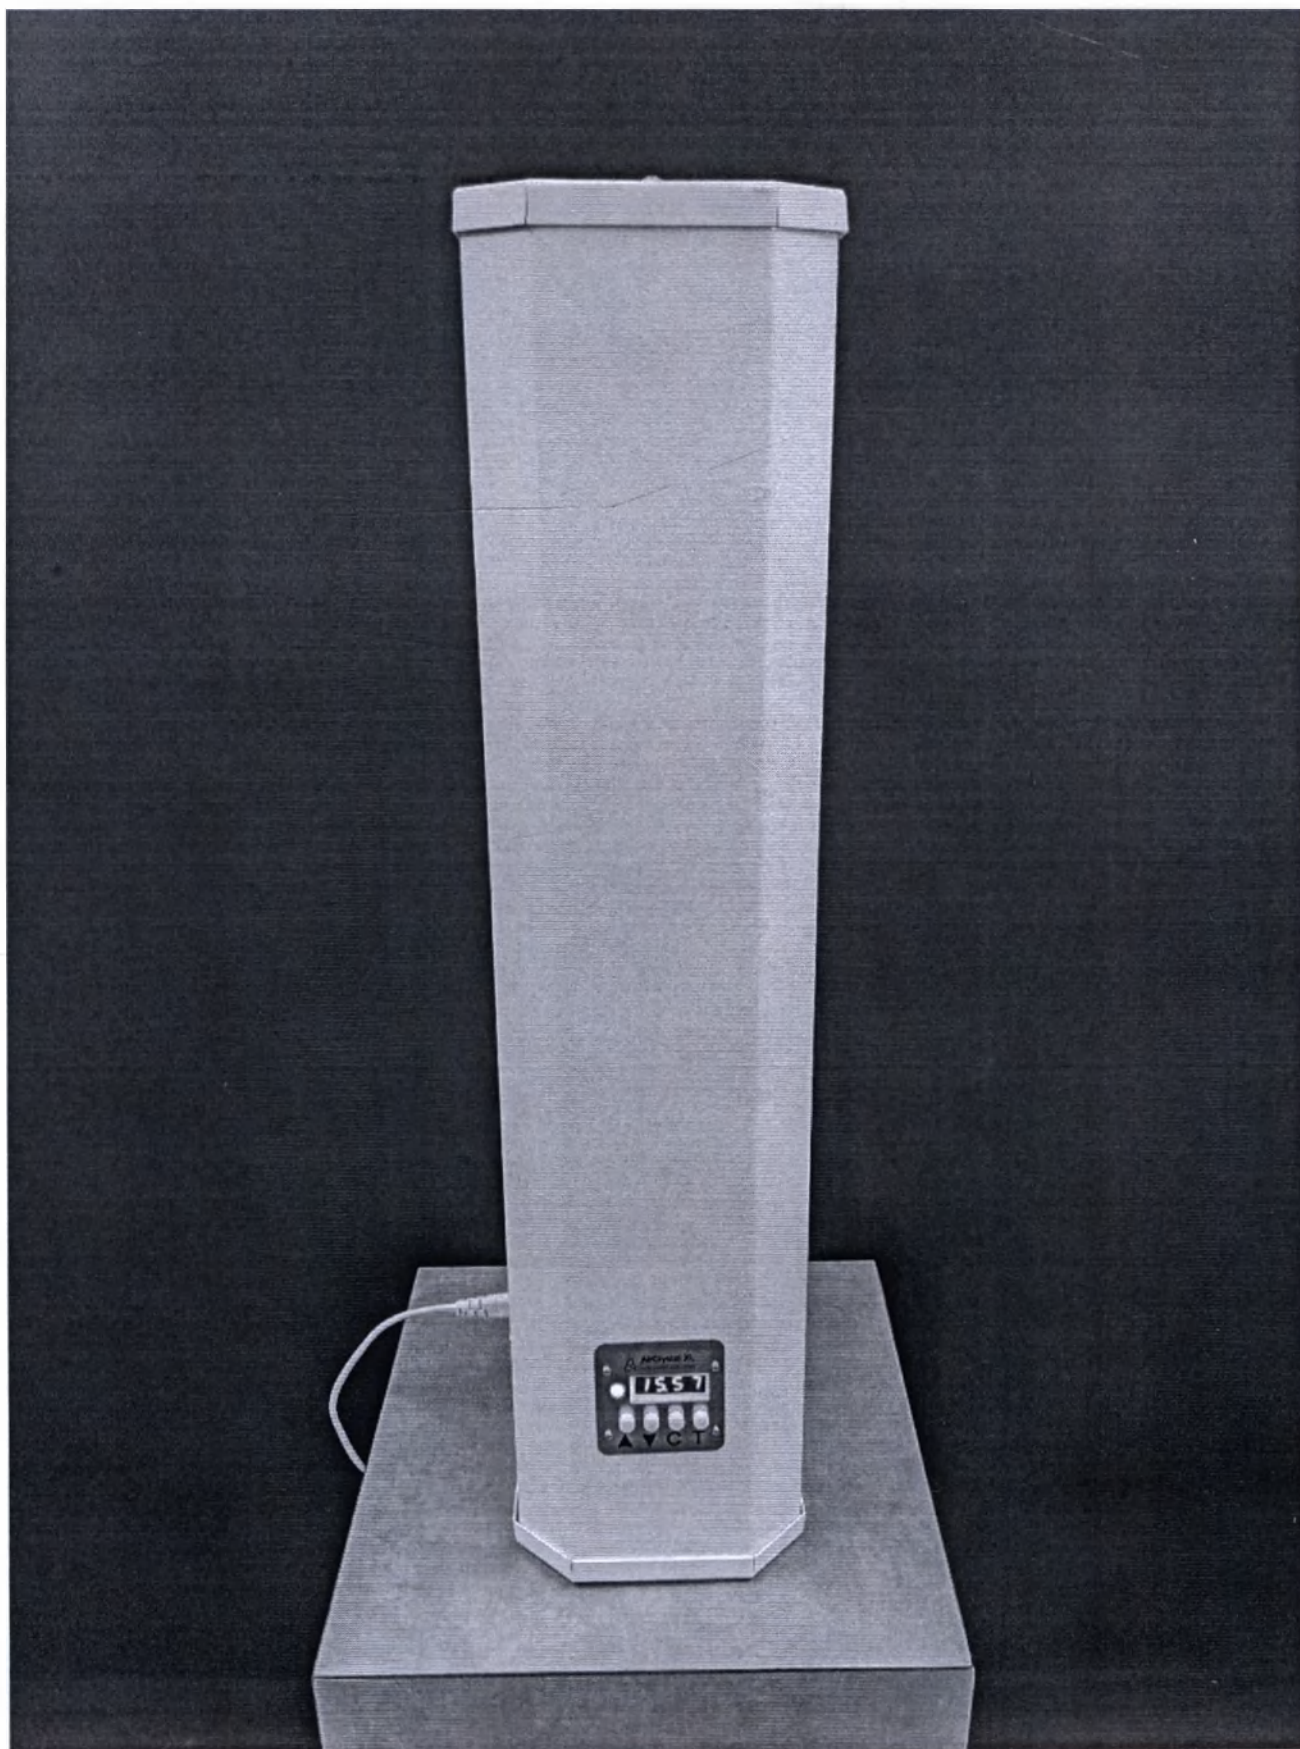


Рисунок 28 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal XL c4 med по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021. Общий вид

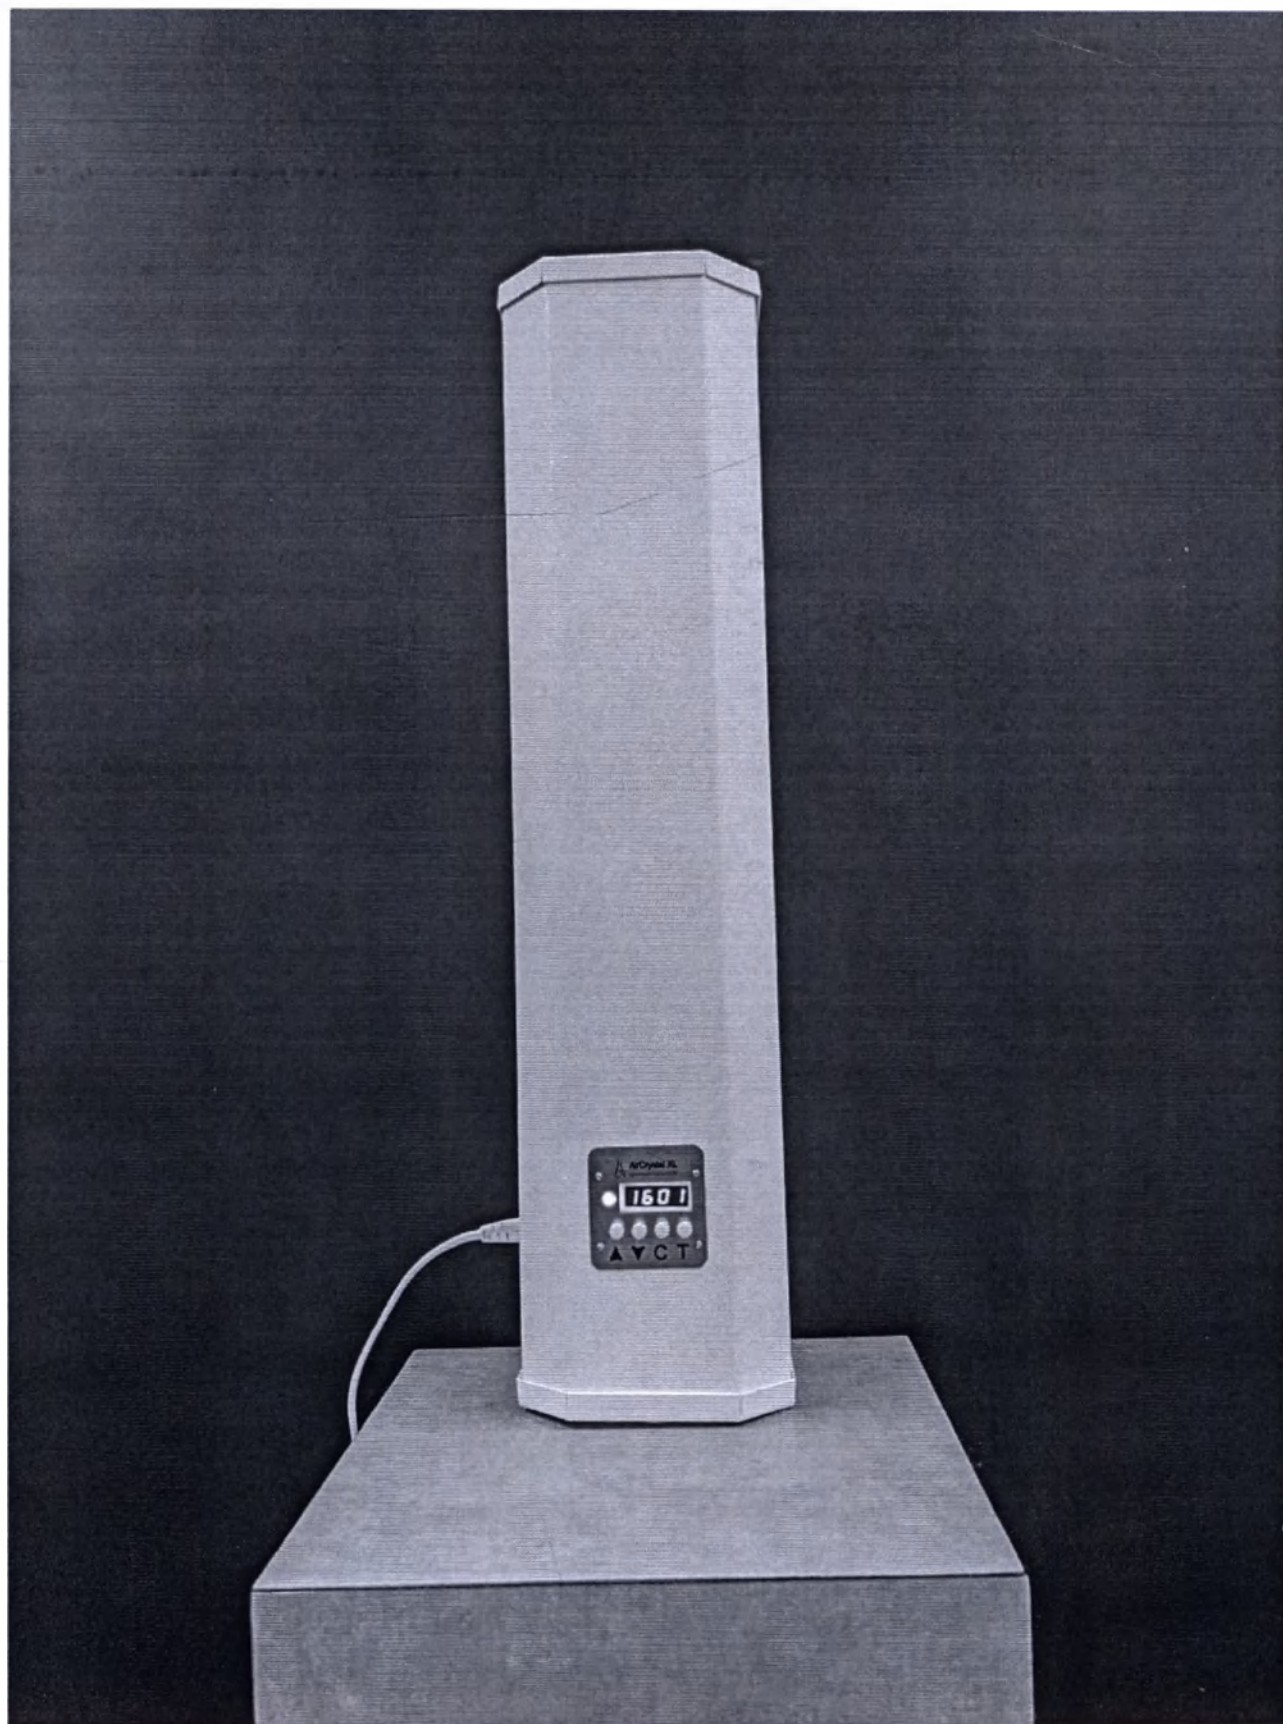


Рисунок 29 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal XL c5 med по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021. Общий вид

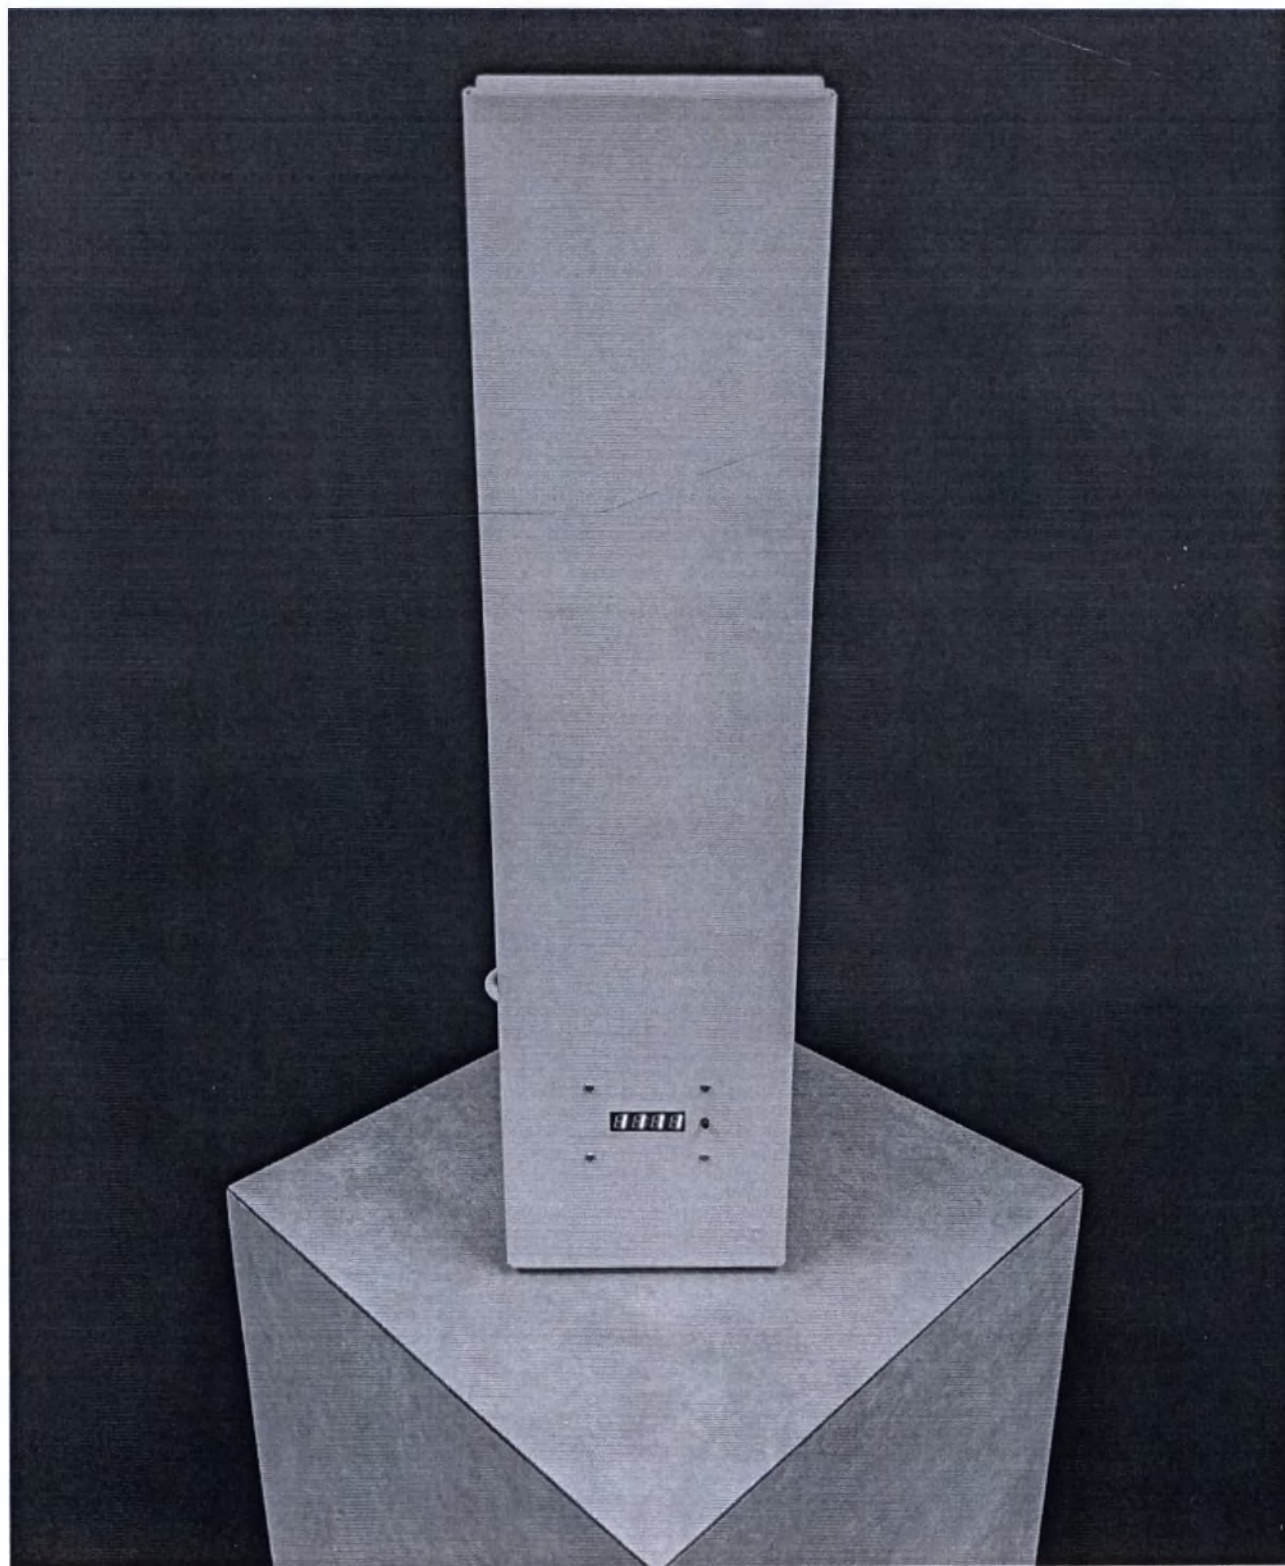


Рисунок 30 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal V med
по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021. Общий вид

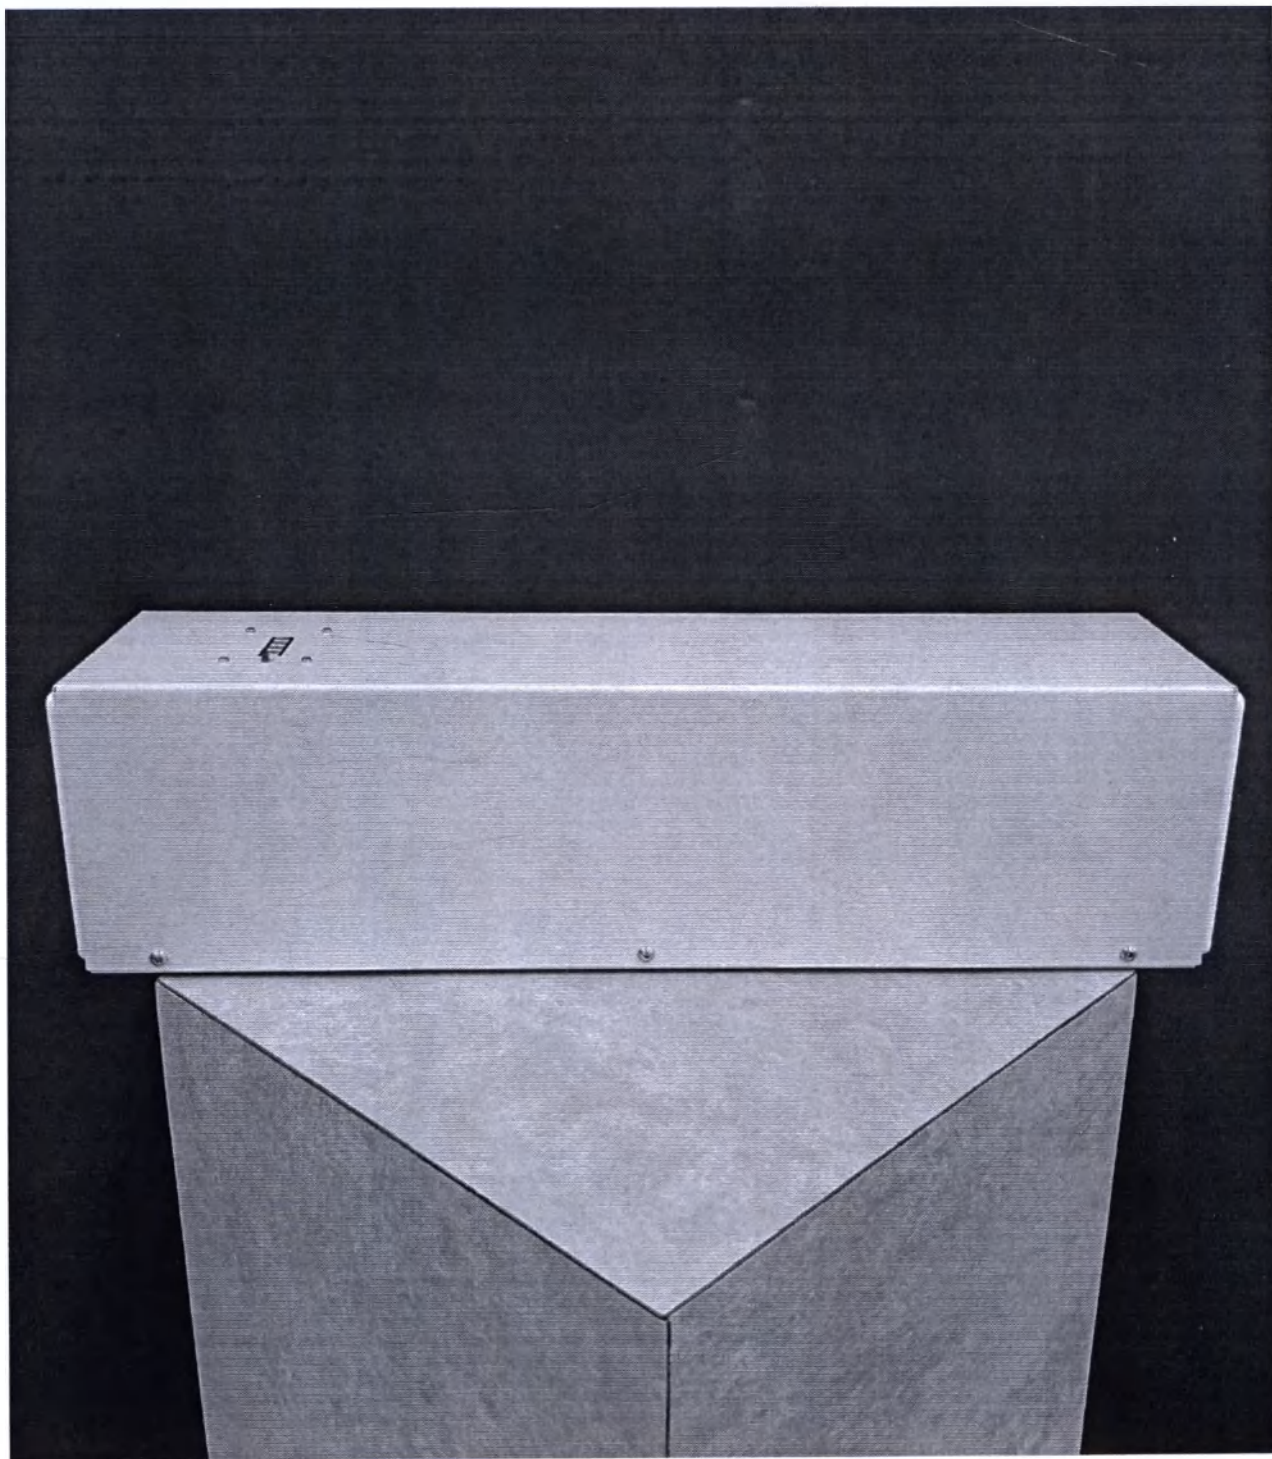


Рисунок 31 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal V med
по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021. Общий вид

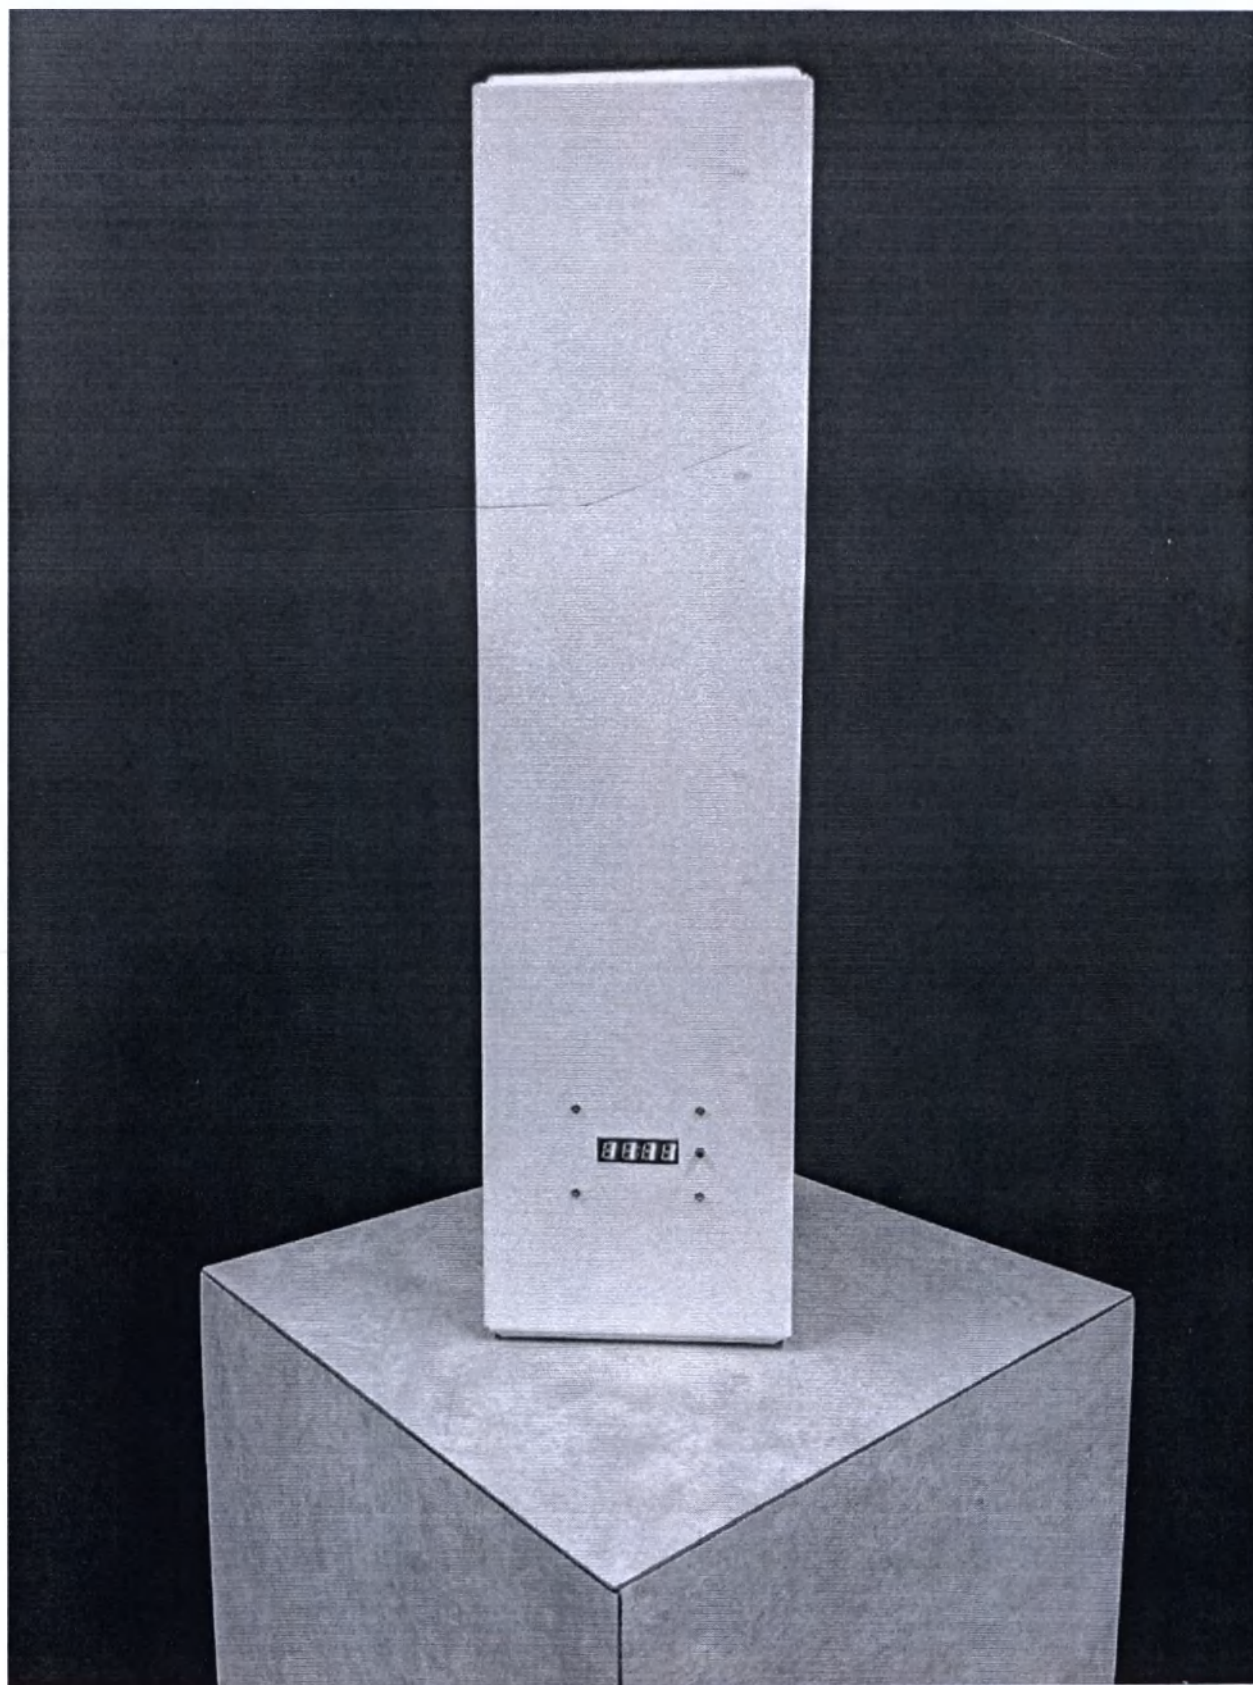
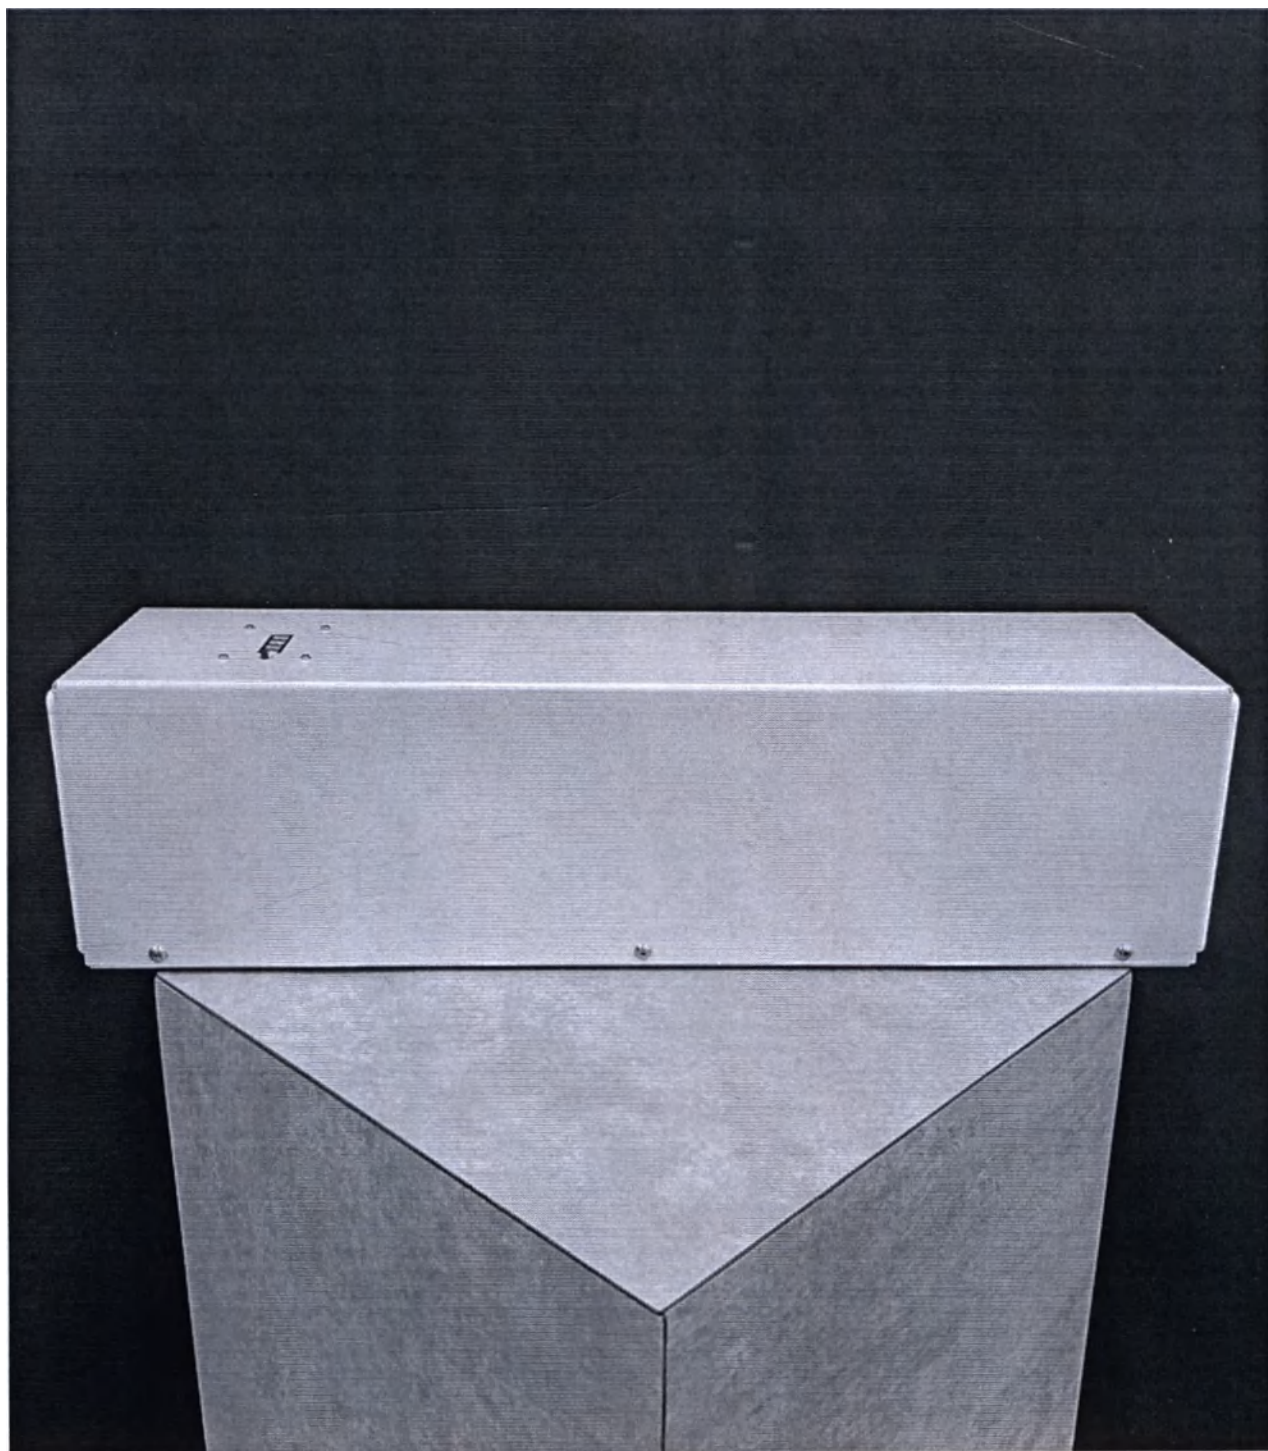
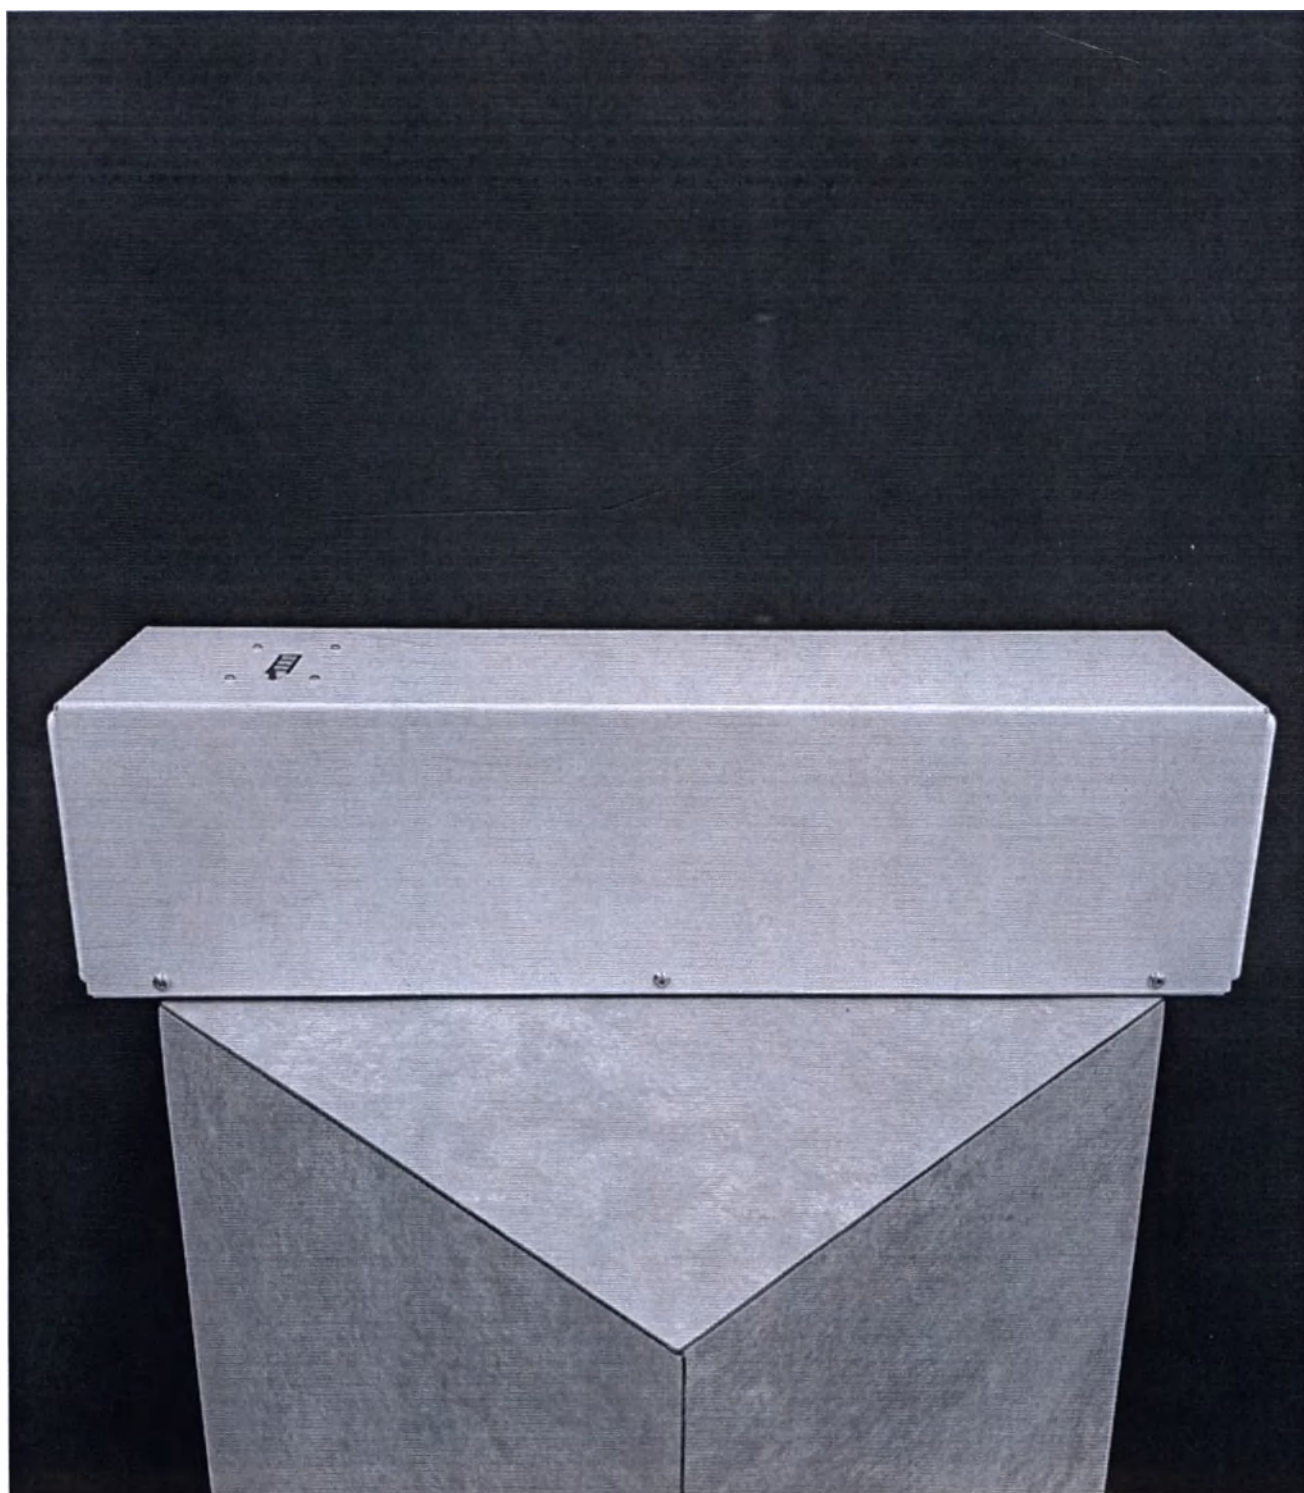


Рисунок 32 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal V X2 med
по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021. Общий вид



**Рисунок 33 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal V X3 med
по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021. Общий вид**



**Рисунок 34 – Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal V X4 med
по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021. Общий вид**



**Рисунок 35 – Упаковка исполнений Nano med, Nano X2 med, Nano 12 med,
Nano 12 X2 med. Общий вид**



Рисунок 36 – Упаковка исполнений M med, M 120 med, M X2 med, M TX2 med, M UTX2 med, M UTX4 med, M Duo 4 med. Общий вид



Рисунок 37 – Упаковка исполнений XL b2 med, XL b3 med, XL b4 med, XL b5 med, XL c2 med, XL c3 med, XL c4 med, XL c5 med. Общий вид

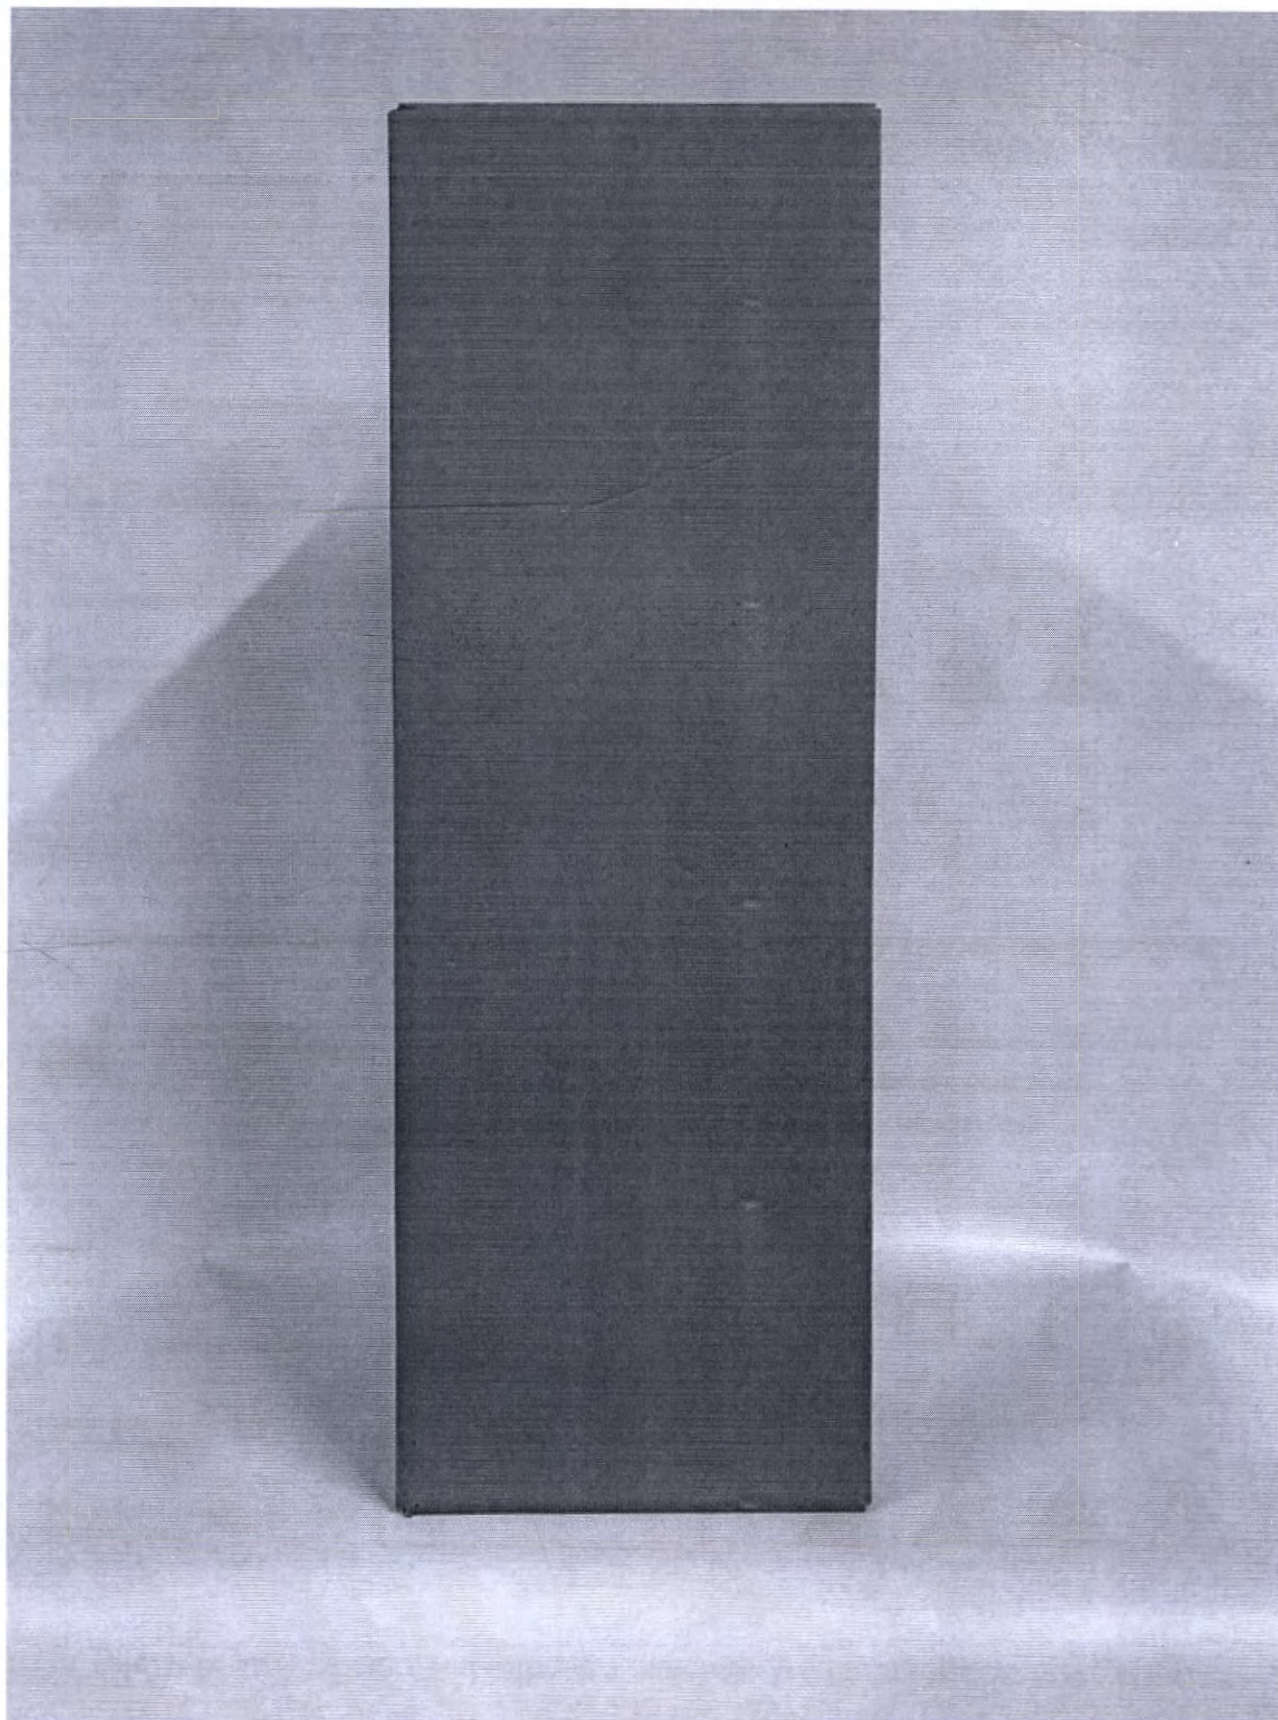


Рисунок 38 – Упаковка исполнений V med, V X2 med, V X3 med, V X4 med.

Общий вид

Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal Nano med
(нержавеющая сталь, текстура «Лен») по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021



Производитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Биомедицинские инновации»
(ООО «Биомедицинские инновации»),
Российская Федерация, 344022, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, пер. Крепостной, д. 183 лит. Г,
комн. 35

Соответствует требованиям ГОСТ Р 50444

Потребляемая мощность: 20,8 ВА

(230±10) В ~ (50±0,5) Гц AC

Без рабочей части

Класс I



Дата изготовления:



Серийный номер:

Номер регистрационного
удостоверения:

Дата выдачи регистрационного
удостоверения:



Гарантийный срок эксплуатации: 1 год



Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal M med по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021



Производитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Биомедицинские инновации»
(ООО «Биомедицинские инновации»),
Российская Федерация, 344022, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, пер. Крепостной, д. 183 лит. Г,
комн. 35

Соответствует требованиям ГОСТ Р 50444

Потребляемая мощность: 31 ВА

(230±10) В ~ (50±0,5) Гц AC

Без рабочей части



Дата изготовления:



Серийный номер:

Номер регистрационного
удостоверения:

Дата выдачи регистрационного
удостоверения:



Гарантийный срок эксплуатации: 1 год



Рисунок 39 – Проект маркировки основного функционального блока

Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор AirCrystal Nano med
(нержавеющая сталь, текстура «Лен») по ТУ 32.50.50-009-15787371-2021



Производитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Биомедицинские инновации»
(ООО «Биомедицинские инновации»),
Российская Федерация, 344022, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, пер. Крепостной, д. 183 лит. Г,
комн. 35

Потребляемая мощность: 20,8 ВА

(230±10) В ~ (50±0,5) Гц AC



Дата изготовления:

Гарантийный срок эксплуатации: 1 год




Серийный номер:

Номер регистрационного
удостоверения:

Дата выдачи регистрационного
удостоверения:

Хранение:



Транспортирование:




Рисунок 40 – Проект потребительской упаковки

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 41 листов

Подпись _____

М.П.

