



Фотографическое изображение


**Шина интраназальная для перегородки носа стерильная,
производства "Шпиггле унт Теис Медизинтехник ГмбХ" (Spiggle
& Theis Medizintechnik GmbH), Германия**

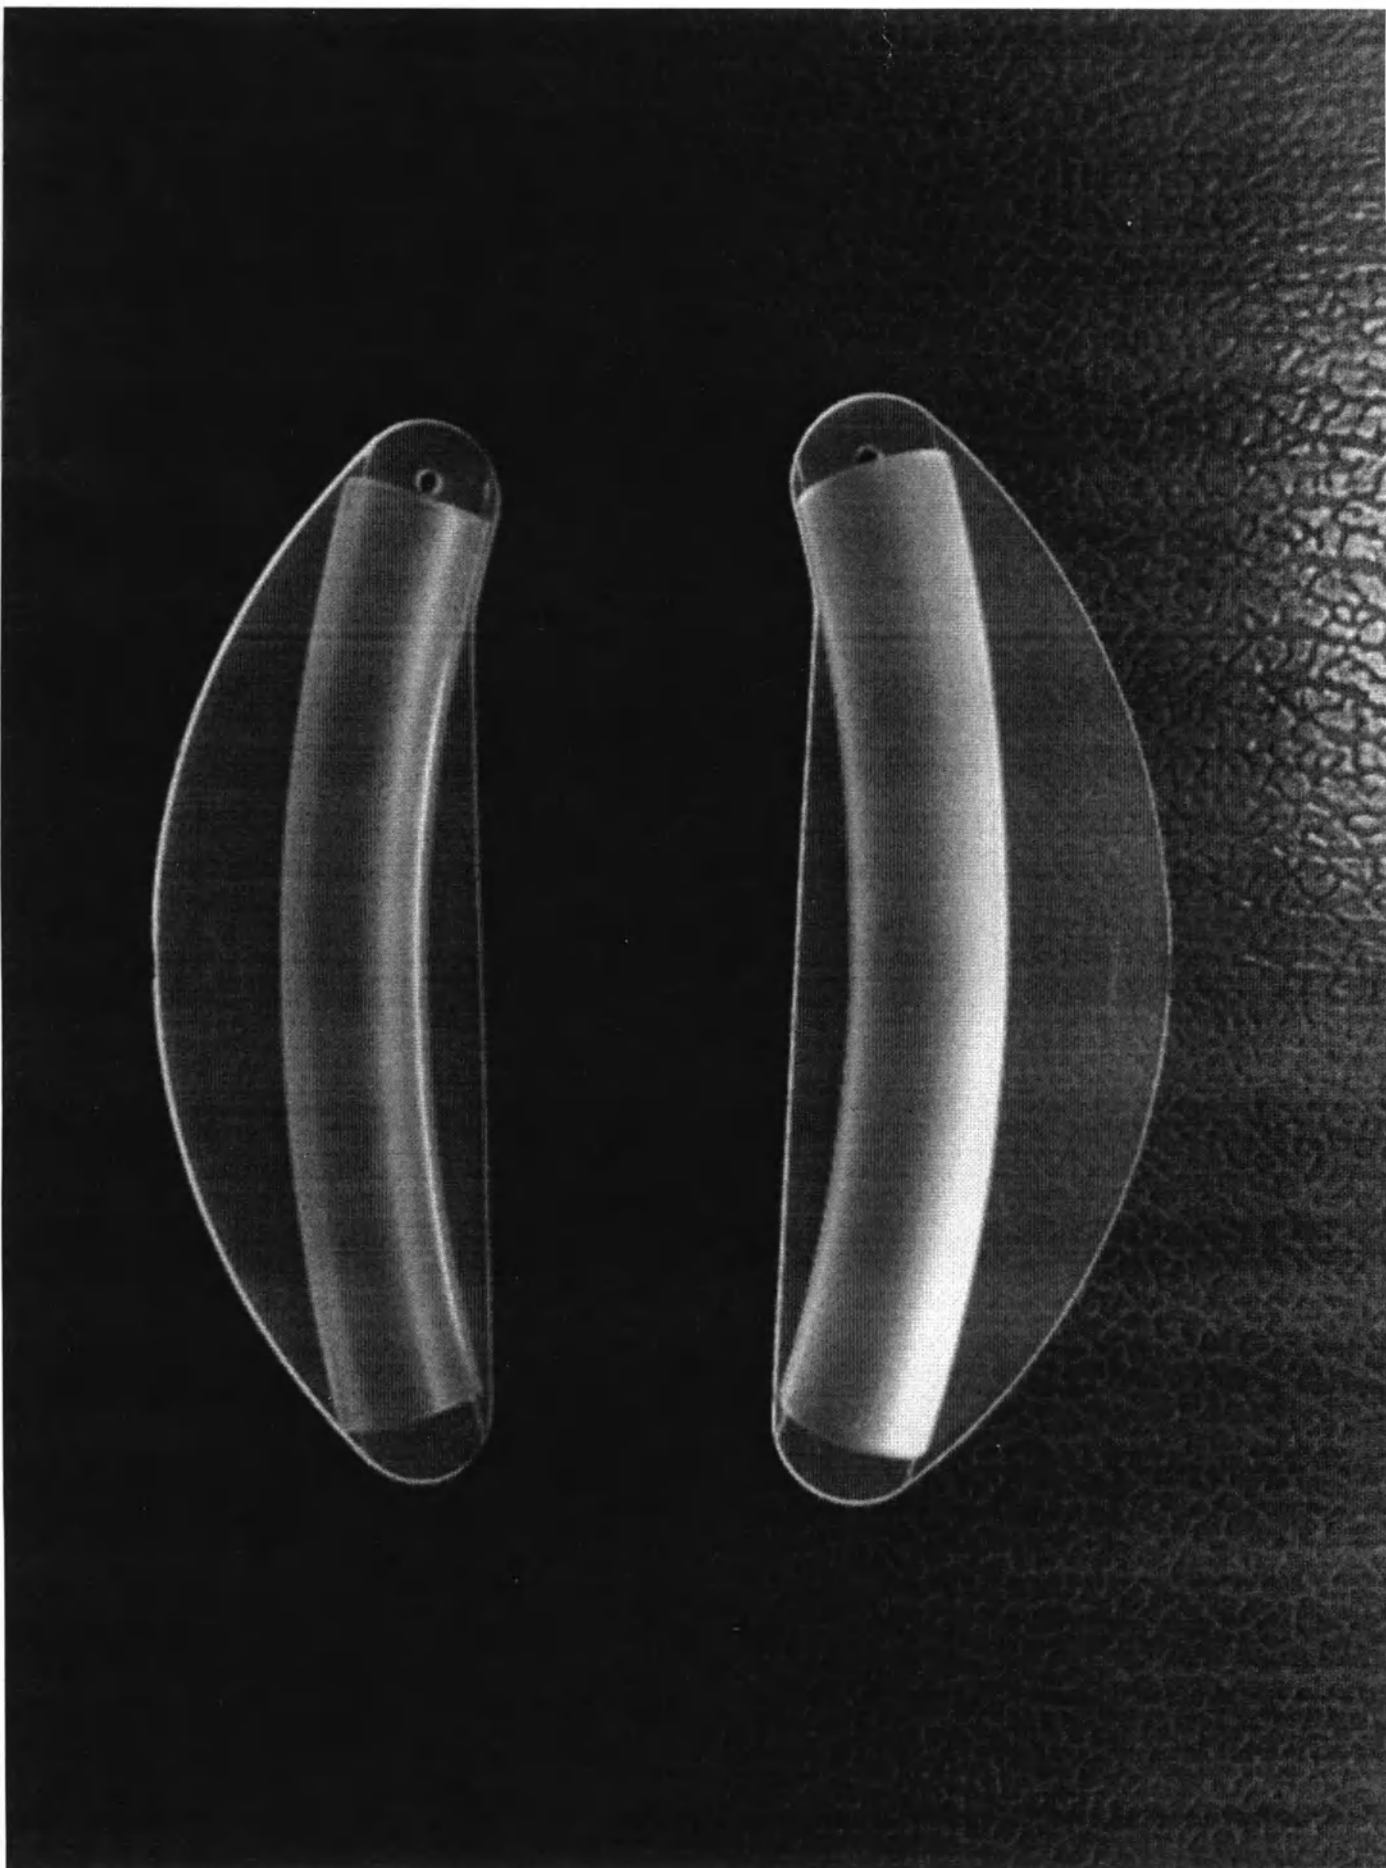


Шина интраназальная для перегородки носа стерильная силиконовая с воздушным каналом

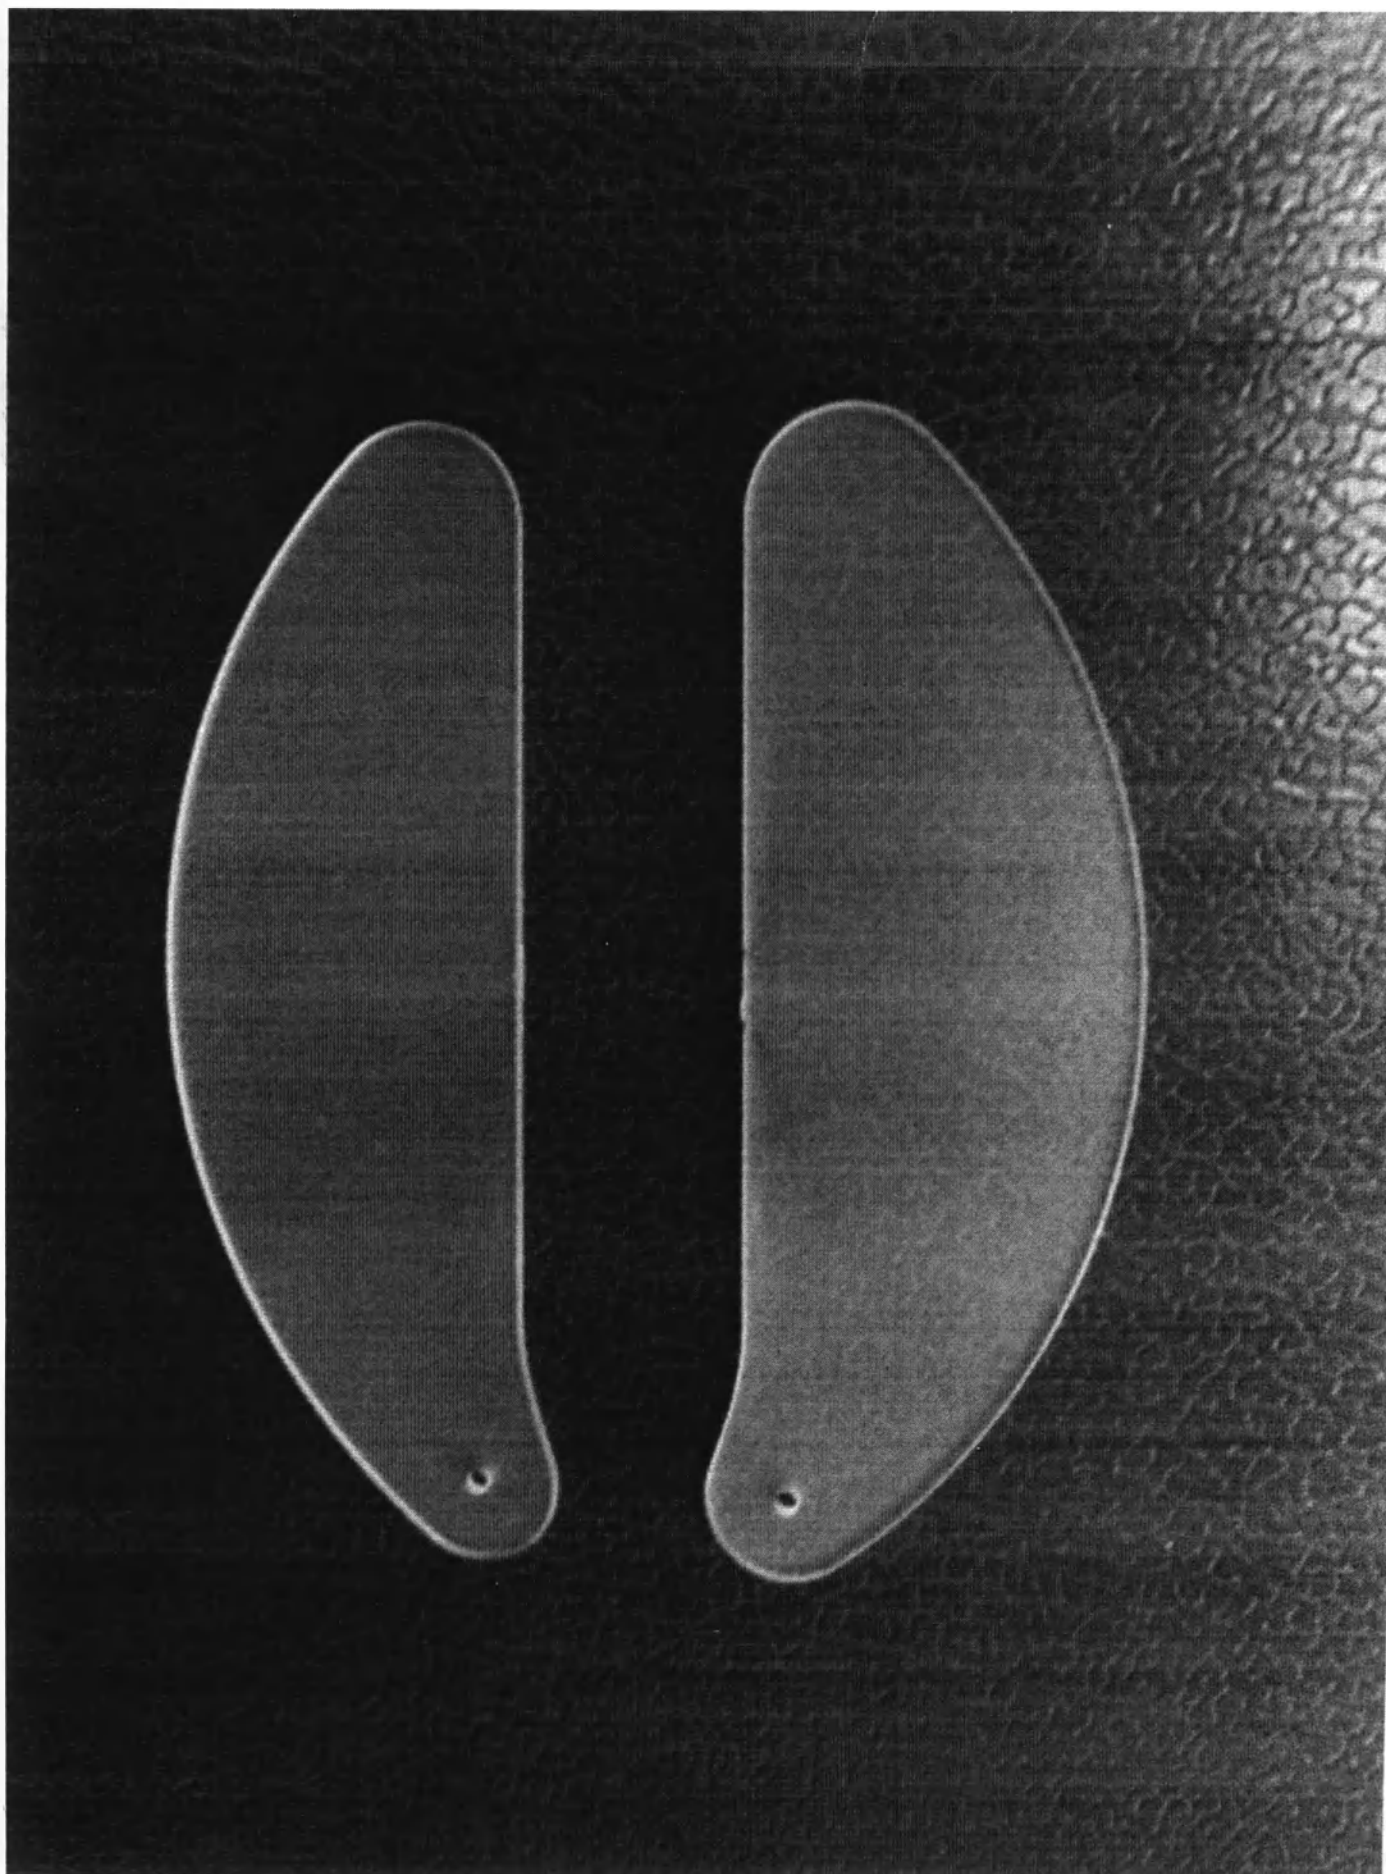


Шина интраназальная для перегородки носа стерильная силиконовая без воздушного канала

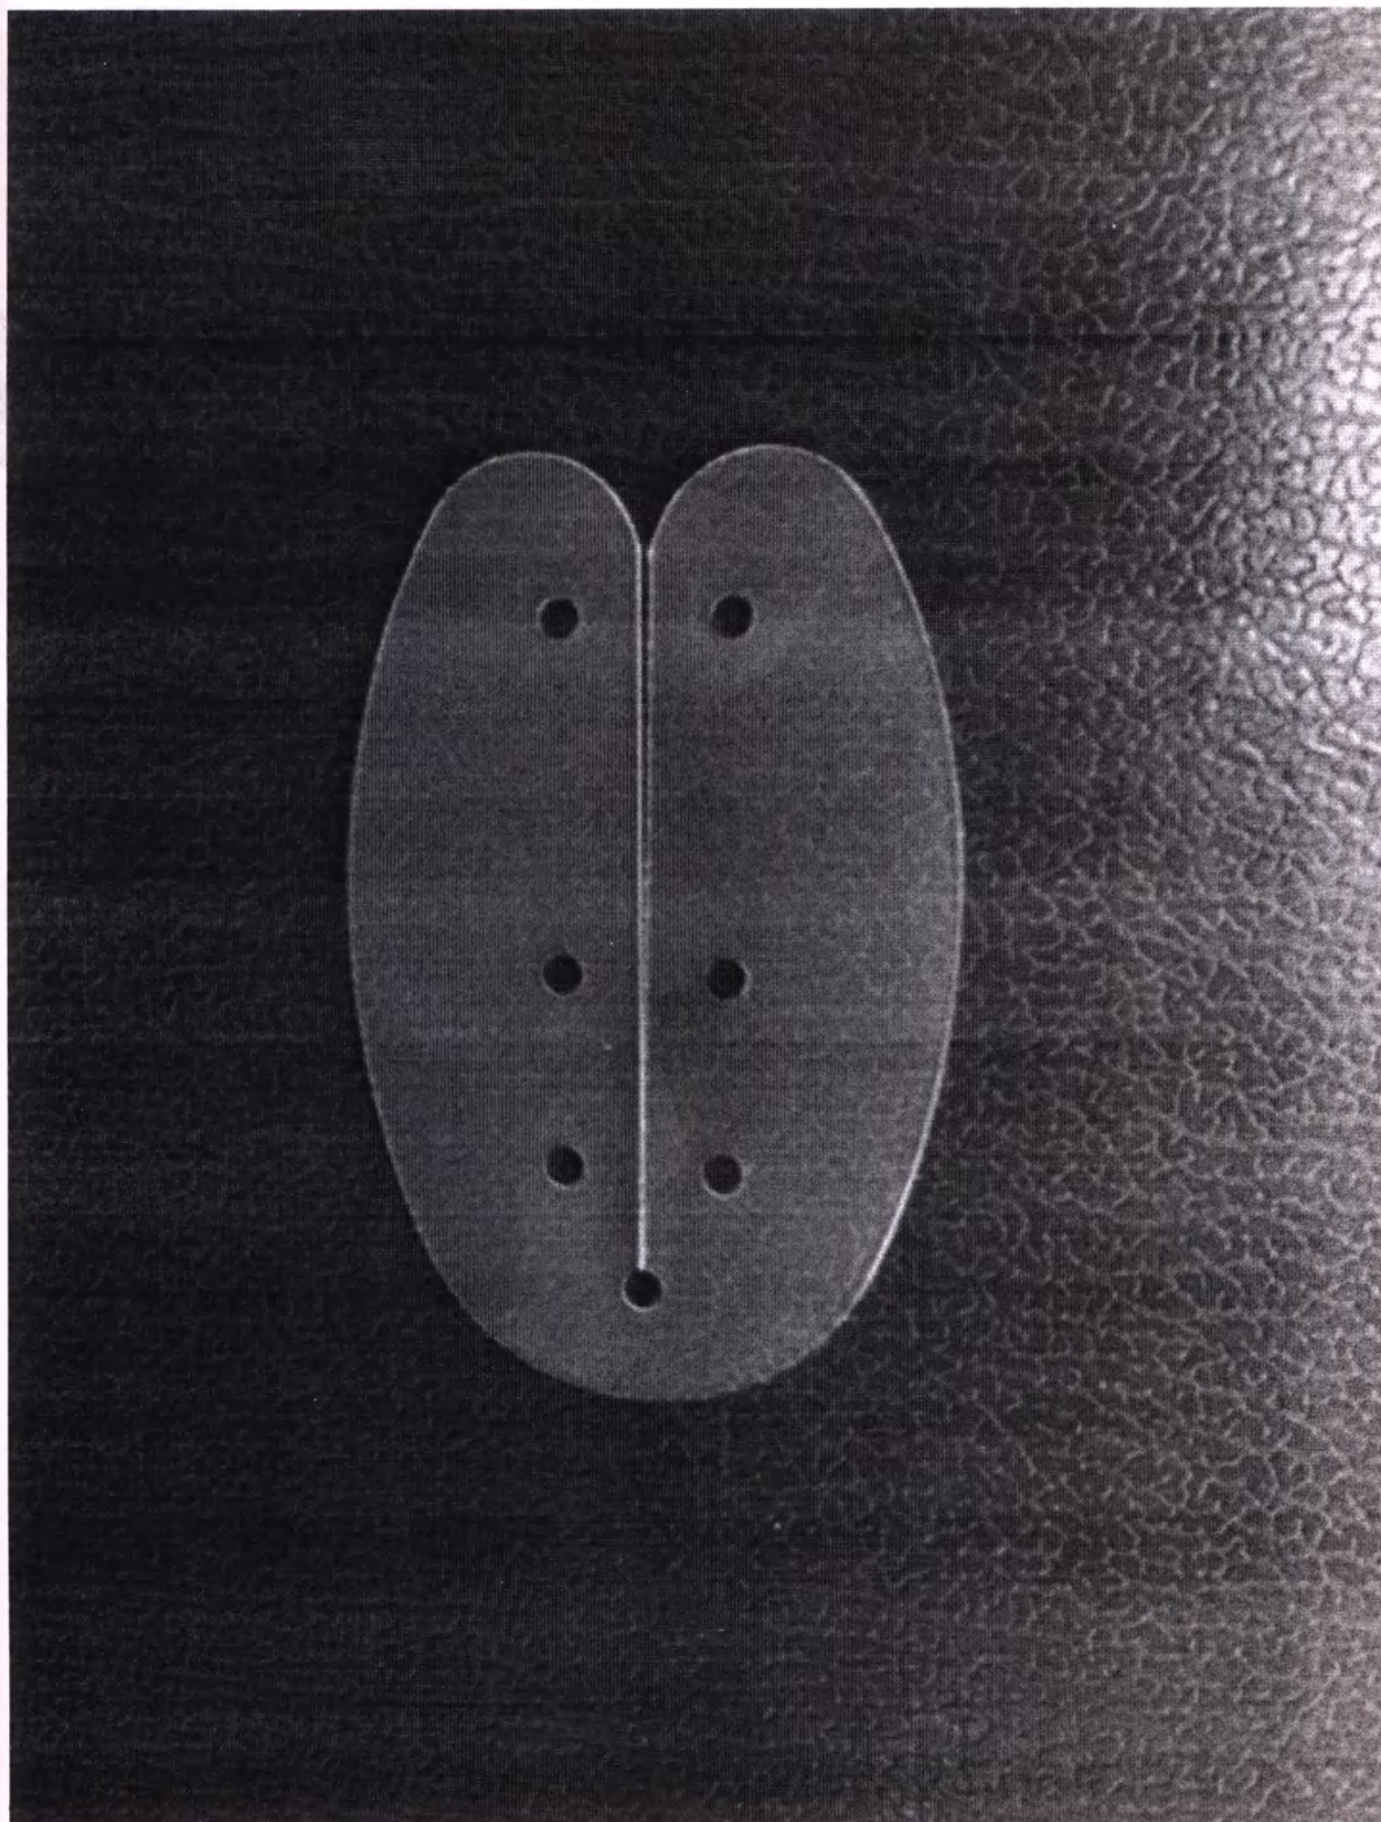

Шина интраназальная для перегородки носа стерильная из фторированного этилен-пропилена (FEP)

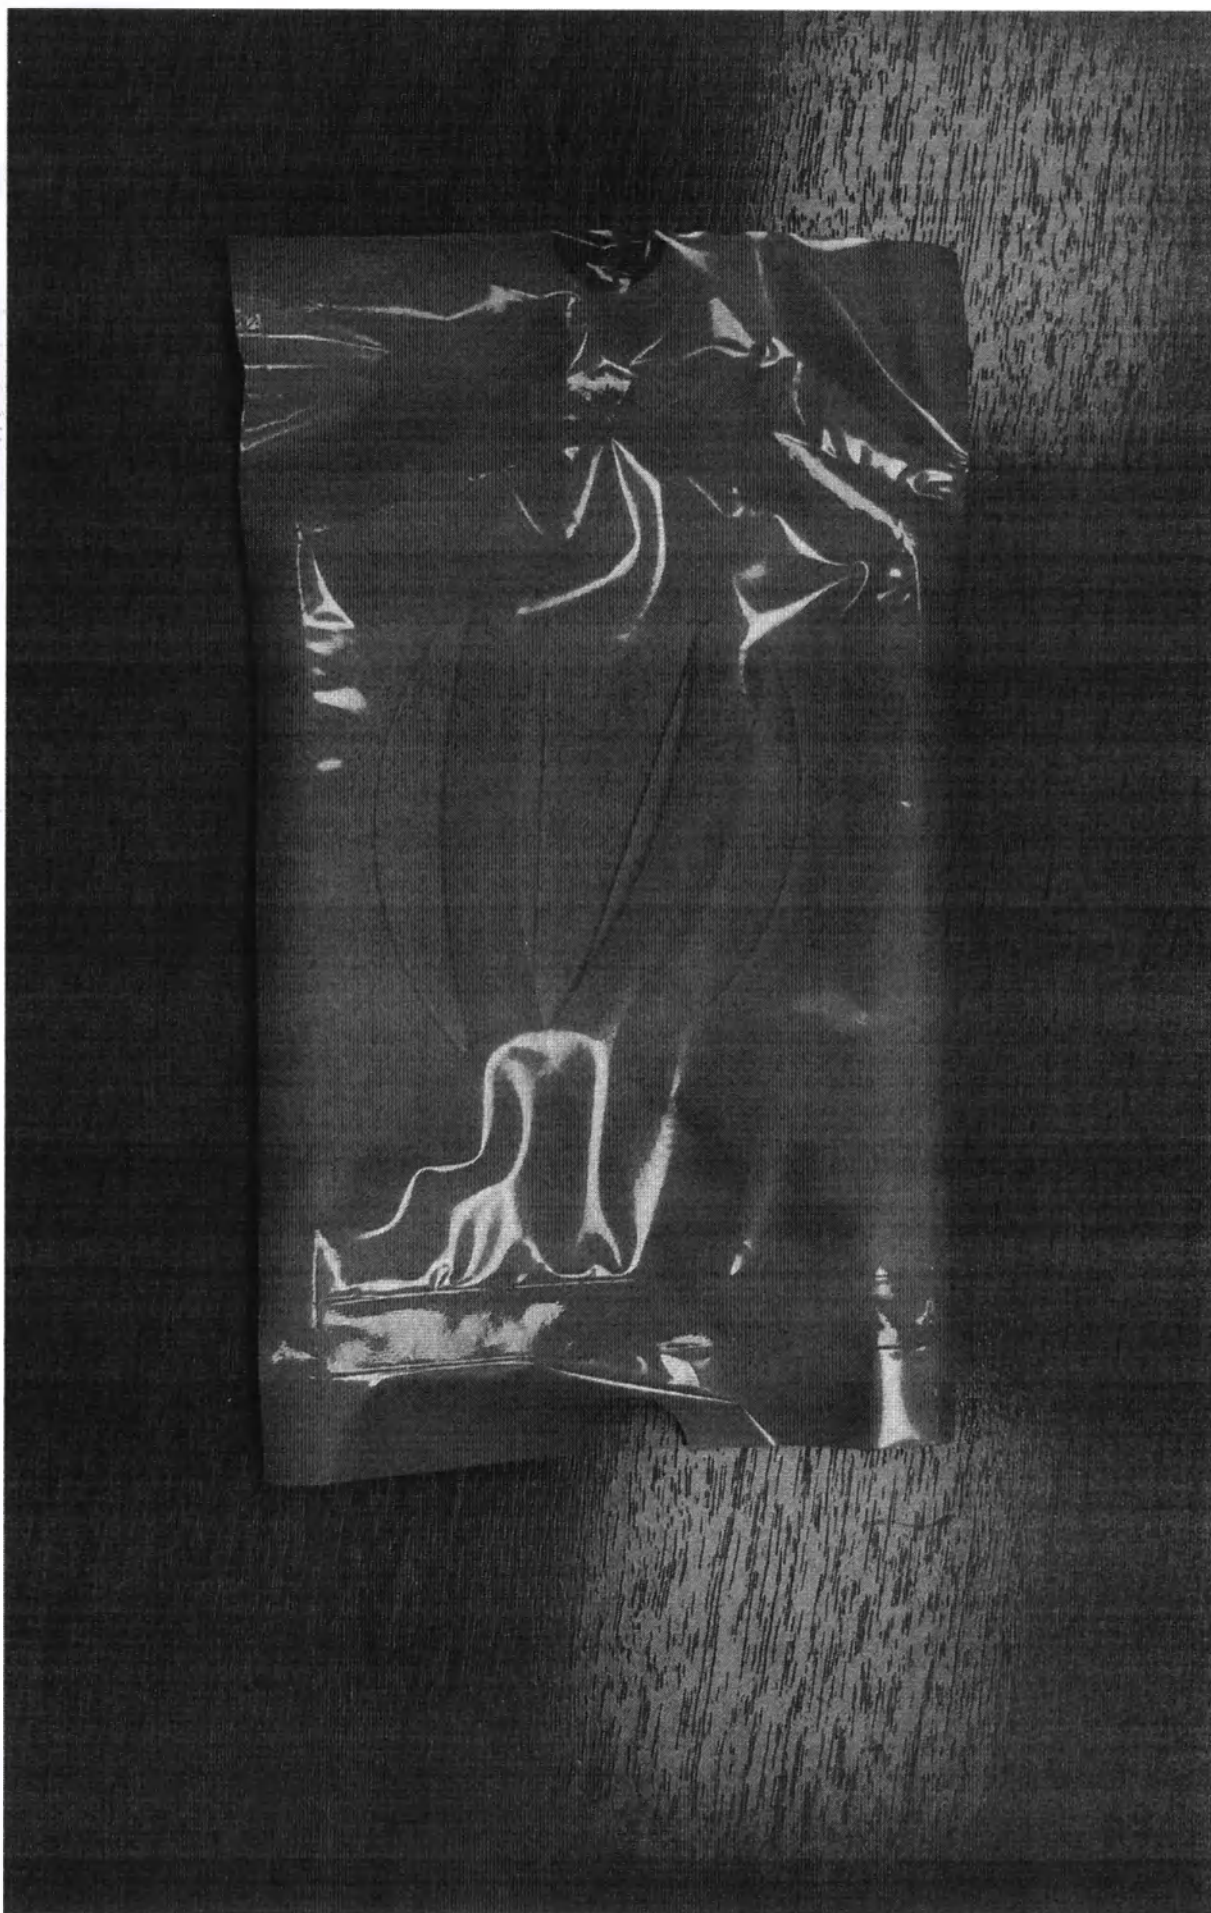

Первичная упаковка изделия, на примере варианта исполнения: Шина интраназальная для перегородки носа стерильная силиконовая с воздушным каналом

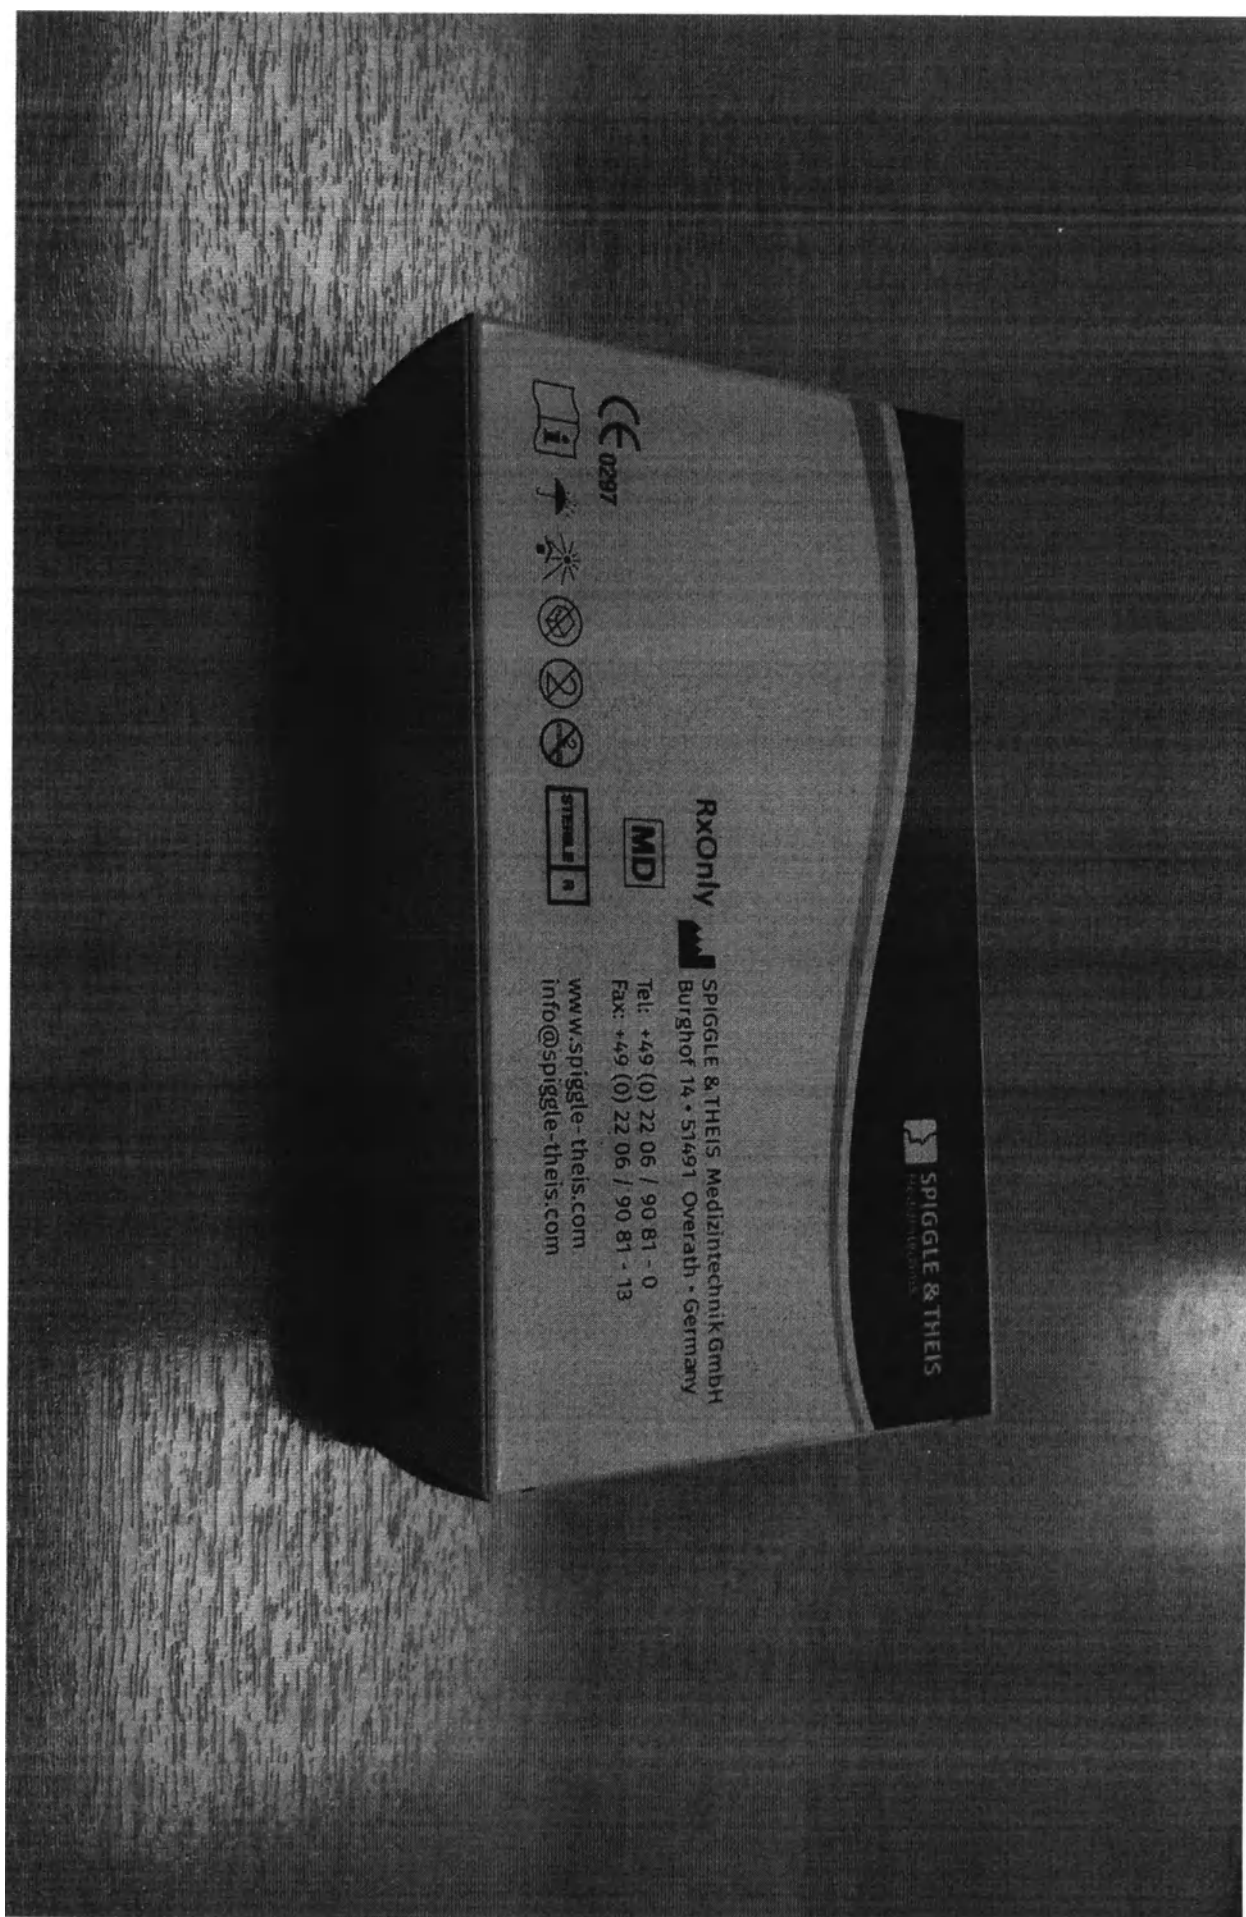

Вторичная упаковка изделия, на примере варианта исполнения: Шина интраназальная для перегородки носа стерильная силиконовая с воздушным каналом

Кат.№ 2030100	Шина интраназальная для перегородки носа стерильная Силиконовая с воздушным каналом, размер 68 x 22.4 мм
Регистрационное удостоверение:	№ РЗН 2015/2722 от _____
Производитель:	Spiggle & Theis Medizintechnik GmbH, Burghof 14, 51491 Overath, Germany
Уполномоченный представитель в РФ:	ООО «Вандермед», 119334, Москва г., Канатчиковский проезд, дом 7, строение 3, тел: +7-499-455-06-35
Срок годности указан на упаковке. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.	
Изготовлено в	

Маркировка изделия на русском языке, на примере варианта исполнения: Шина интраназальная для перегородки носа стерильная силиконовая с воздушным каналом

Всего прошито, пронумеровано

И скреплено печатью 7

(Семь)

Листов

Подпись

генеральный директор Абдуллаев Т.А.
Абдуллаев м.п.

