

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «МИЗ-Тумботино»

С.С. Гусев

2021г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

ШТАТИВЫ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ ИНФУЗИОННЫХ ВЛИВАНИЙ, С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

ТУ 32.50.50-005-39241292-2021

Общество с ограниченной ответственностью "Медико-инструментальный завод Тумботино" (ООО «МИЗ-ТУМБОТИНО»)

Место производства медицинского изделия: 606130, Нижегородская область, Павловский район, р.п. Тумботино, ул. Некрасова, 16

E-mail: info@miz-t.ru

МАКЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ И МАРКИРОВКИ МИ

Штатив для
длительных
инфузионных
вливаний разборный
ШВР-03.Н

RU Рег уд № РЗН 00000

REF ТУ 32 50 50-005-39241292-2021

LOT 0000 Нержавеющая сталь


 2021-08 

 Срок службы не ограничен

Количество: 1 шт.


 **made in RU**

Производитель: ООО "МИЗ-ТУМБОТИНО"
606130, Российская Федерация, Нижегородская
обл., Павловский район, р.п. Тумботино, ул.
Некрасова, д. 16
тел/факс +7 (831) 265-38-73
E-mail: info@miz-t.ru




МАКЕТ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ И МАРКИРОВКИ МИ


RU	Штатив для длительных инфузионных	Per уд № РЗН 00000
REF	вливаний разборный ШВР-03.Н	ТУ 32.50.50-005-39241292-2021
LOT	0000	Нержавеющая сталь
	2021-08	
	Срок службы не ограничен	
Количество:		1 шт.
	made in RU	
Производитель: ООО "МИЗ-ТУМБОТИНО"		
606130, Российская Федерация, Нижегородская		
обл., Павловский район, р.п. Тумботино, ул.		
Некрасова, д. 16		
тел/факс: +7 (831) 265-38-73		
E-mail: info@miz-t.ru		

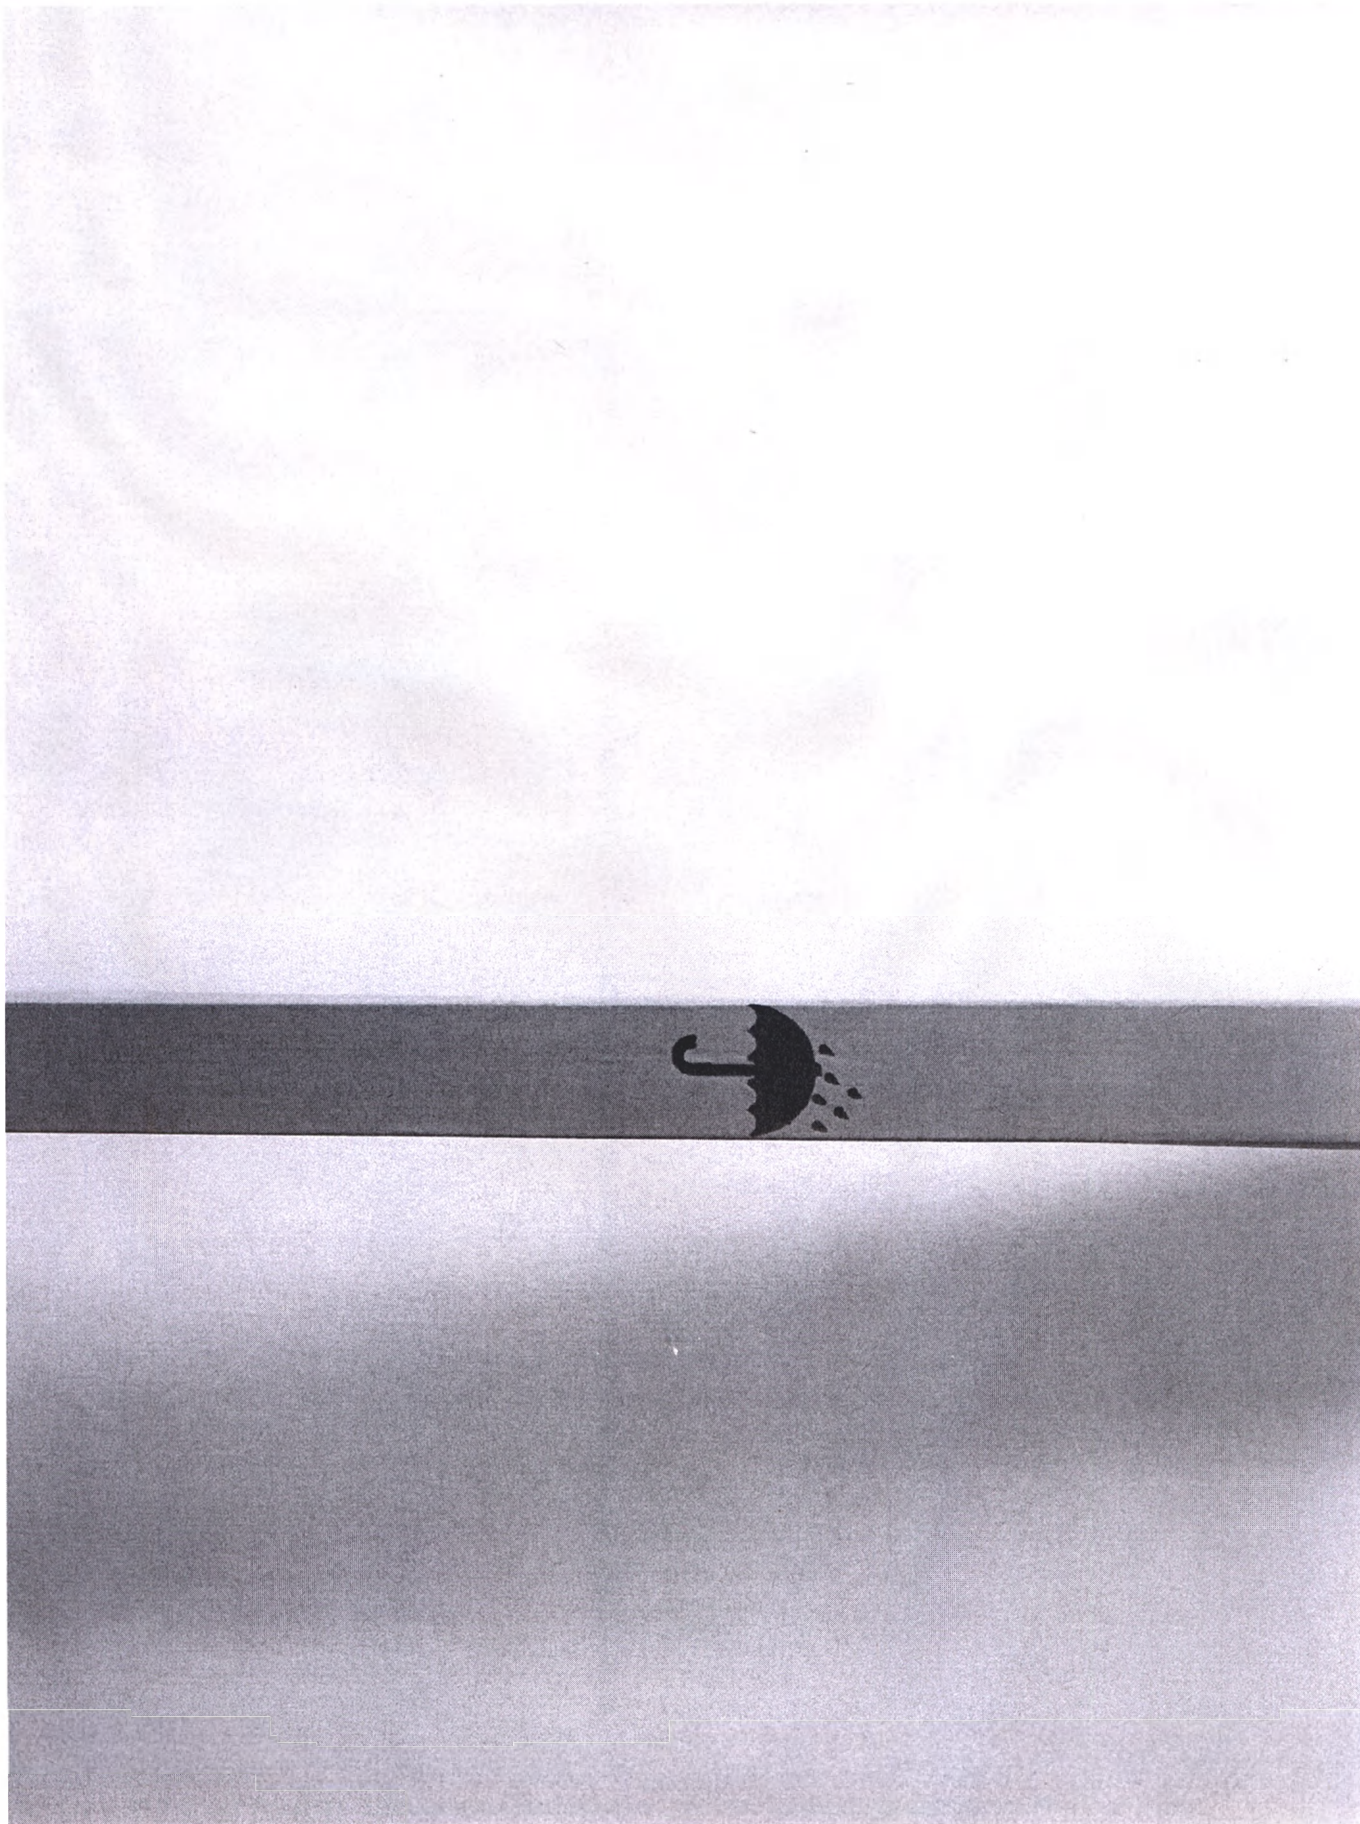


1. Штатив для длительных инфузионных вливаний на трех опорах, нерегулируемый: арт. ШВ-03.17.Н / ШВ-03.17 / Штатив для длительных инфузионных вливаний на трех опорах, нерегулируемый: арт. ШВ-03.18.Н / ШВ-03.18 / Штатив для длительных инфузионных вливаний на трех опорах, нерегулируемый: арт. ШВ-03.19.Н / ШВ-03.19 / Штатив для длительных инфузионных вливаний на трех опорах, нерегулируемый: арт. ШВ-03.20.Н / ШВ-03.20.

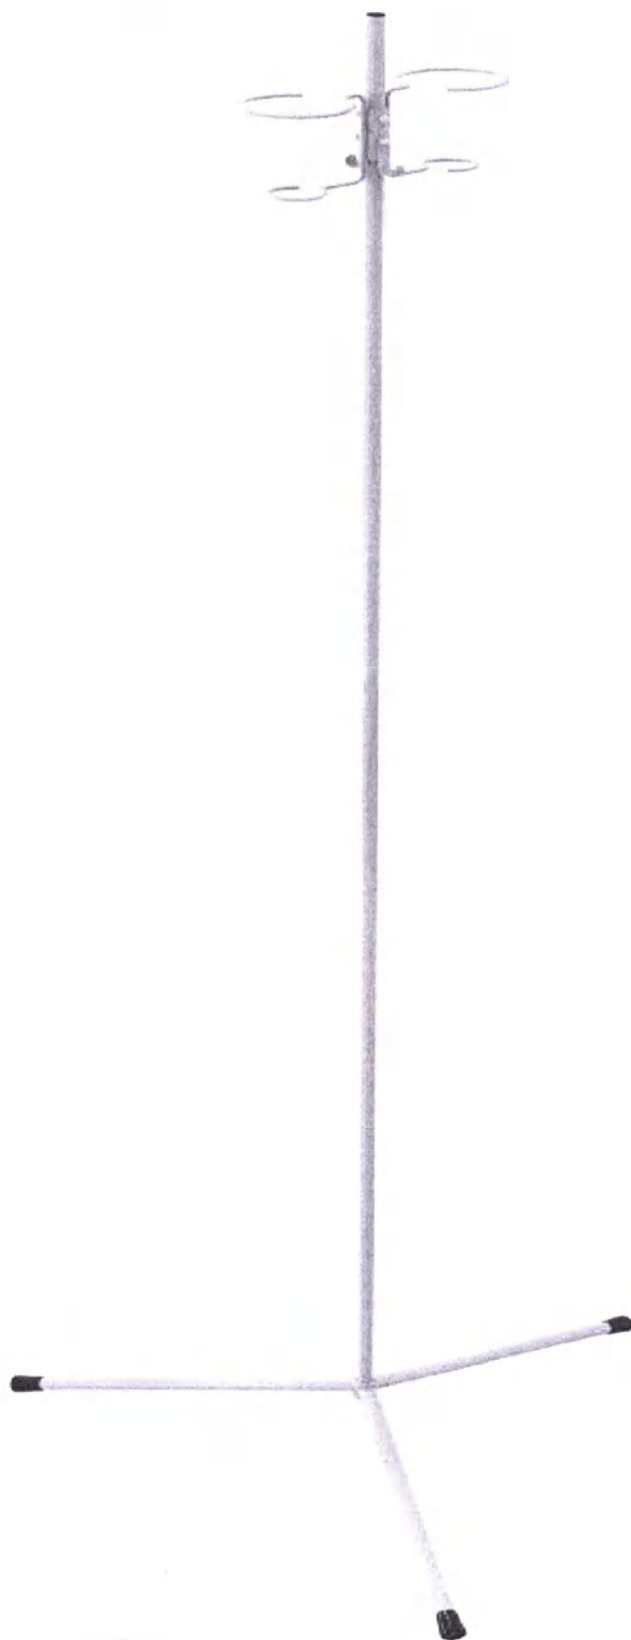


2. Штатив для длительных инфузионных вливаний на пяти опорах, нерегулируемый: арт. ШВ-05.17.Н / ШВ-05.17 / Штатив для длительных инфузионных вливаний на пяти опорах, нерегулируемый: арт. ШВ-05.18.Н / ШВ-05.18 / Штатив для длительных инфузионных вливаний на пяти опорах, нерегулируемый: арт. ШВ-05.19.Н / ШВ-05.19 / Штатив для длительных инфузионных вливаний на пяти опорах, нерегулируемый: арт. ШВ-05.20.Н / ШВ-05.20.

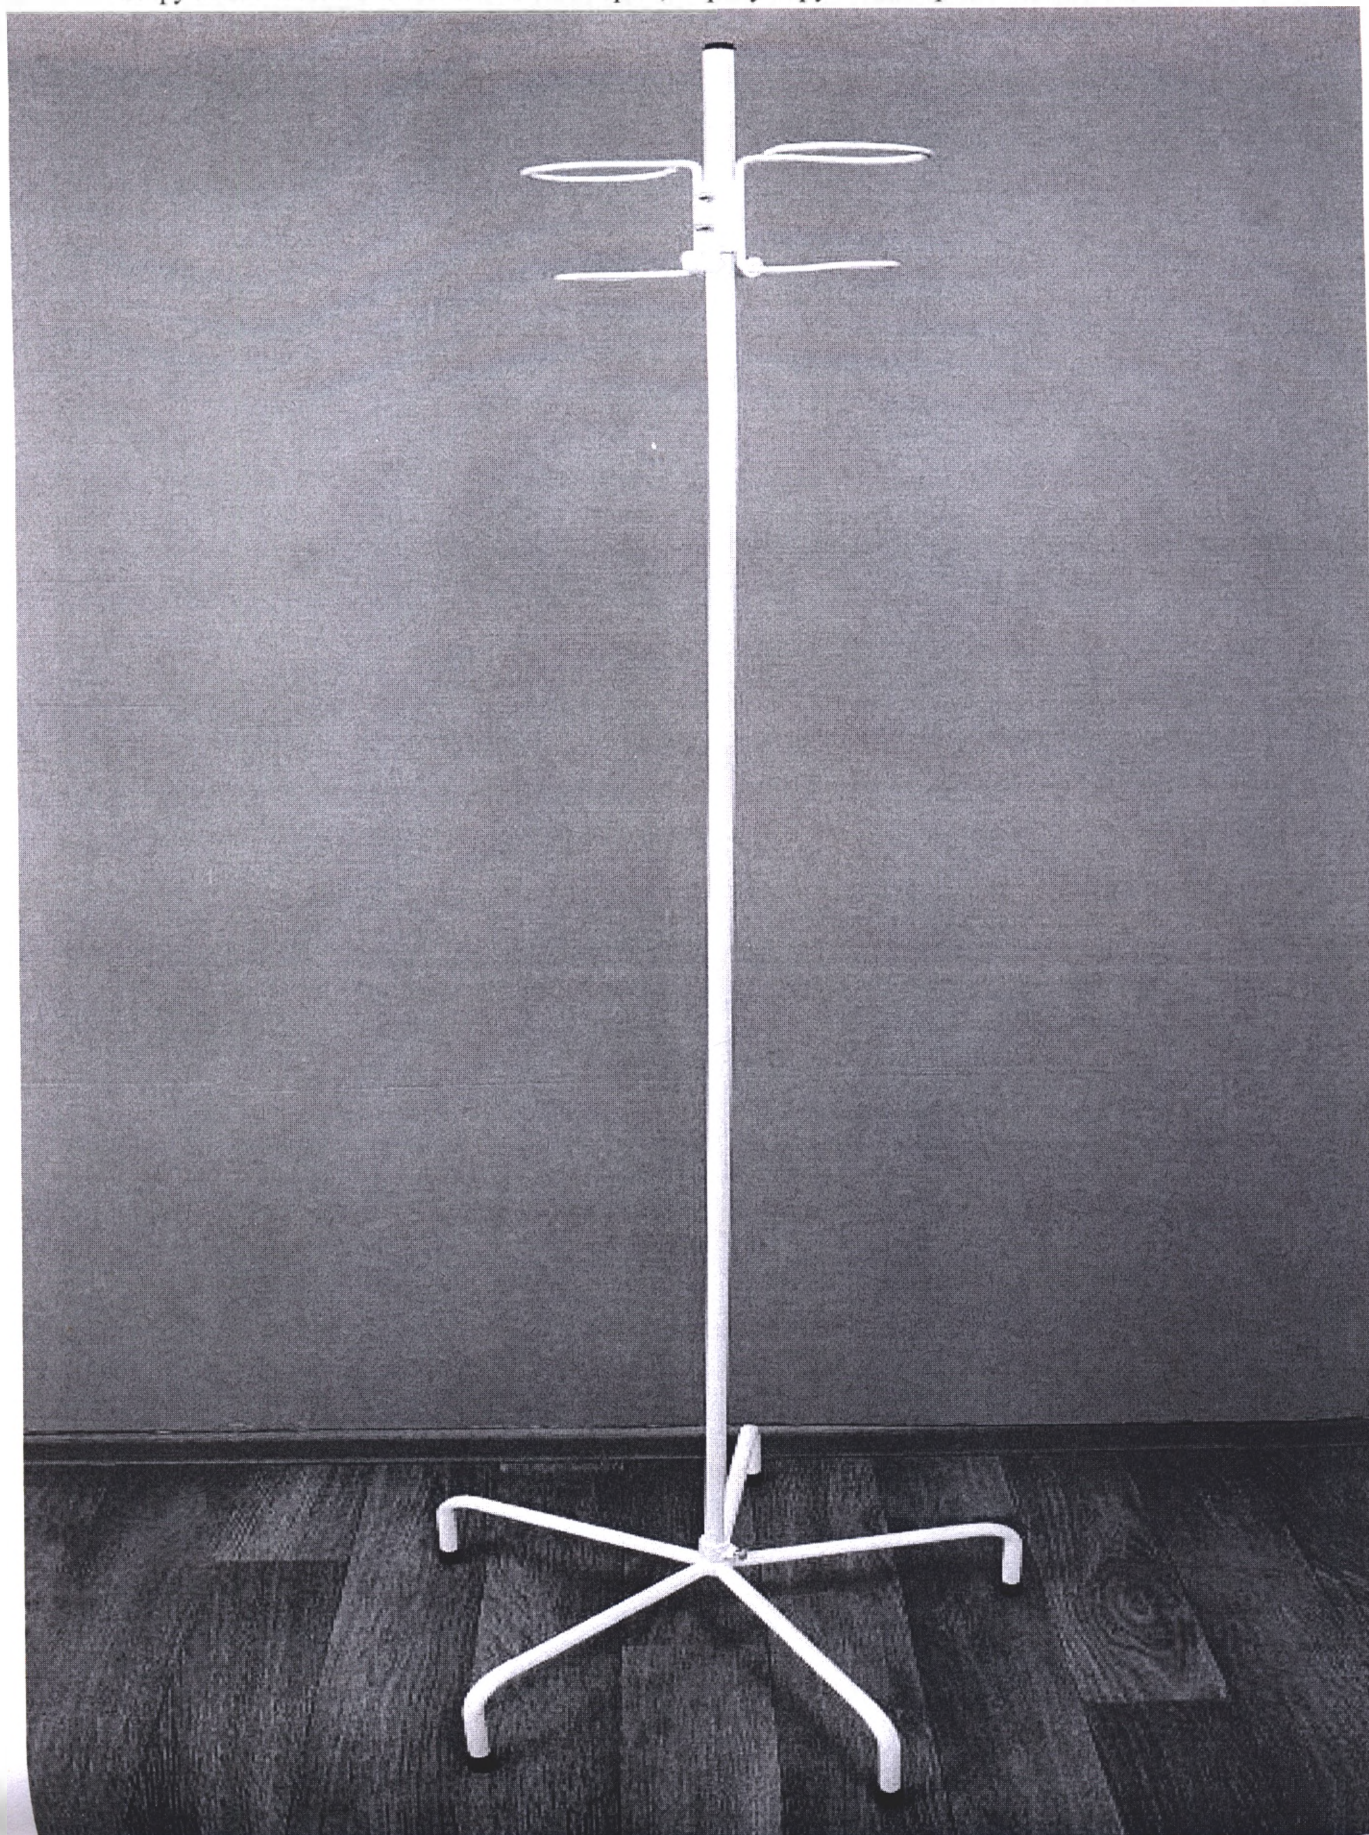


3. Штатив для длительных инфузионных вливаний на трёх опорах с подвижным флаконодержателем: арт. ШВ-13.17.Н / ШВ-13.17 / Штатив для длительных инфузионных вливаний на трёх опорах с подвижным флаконодержателем: арт. ШВ-13.18.Н / ШВ-13.18 / Штатив для длительных инфузионных вливаний на трёх опорах с подвижным флаконодержателем: арт. ШВ-13.19.Н / ШВ-13.19 / Штатив для длительных инфузионных вливаний на трёх опорах с подвижным флаконодержателем: арт. ШВ-13.20.Н / ШВ-13.20.

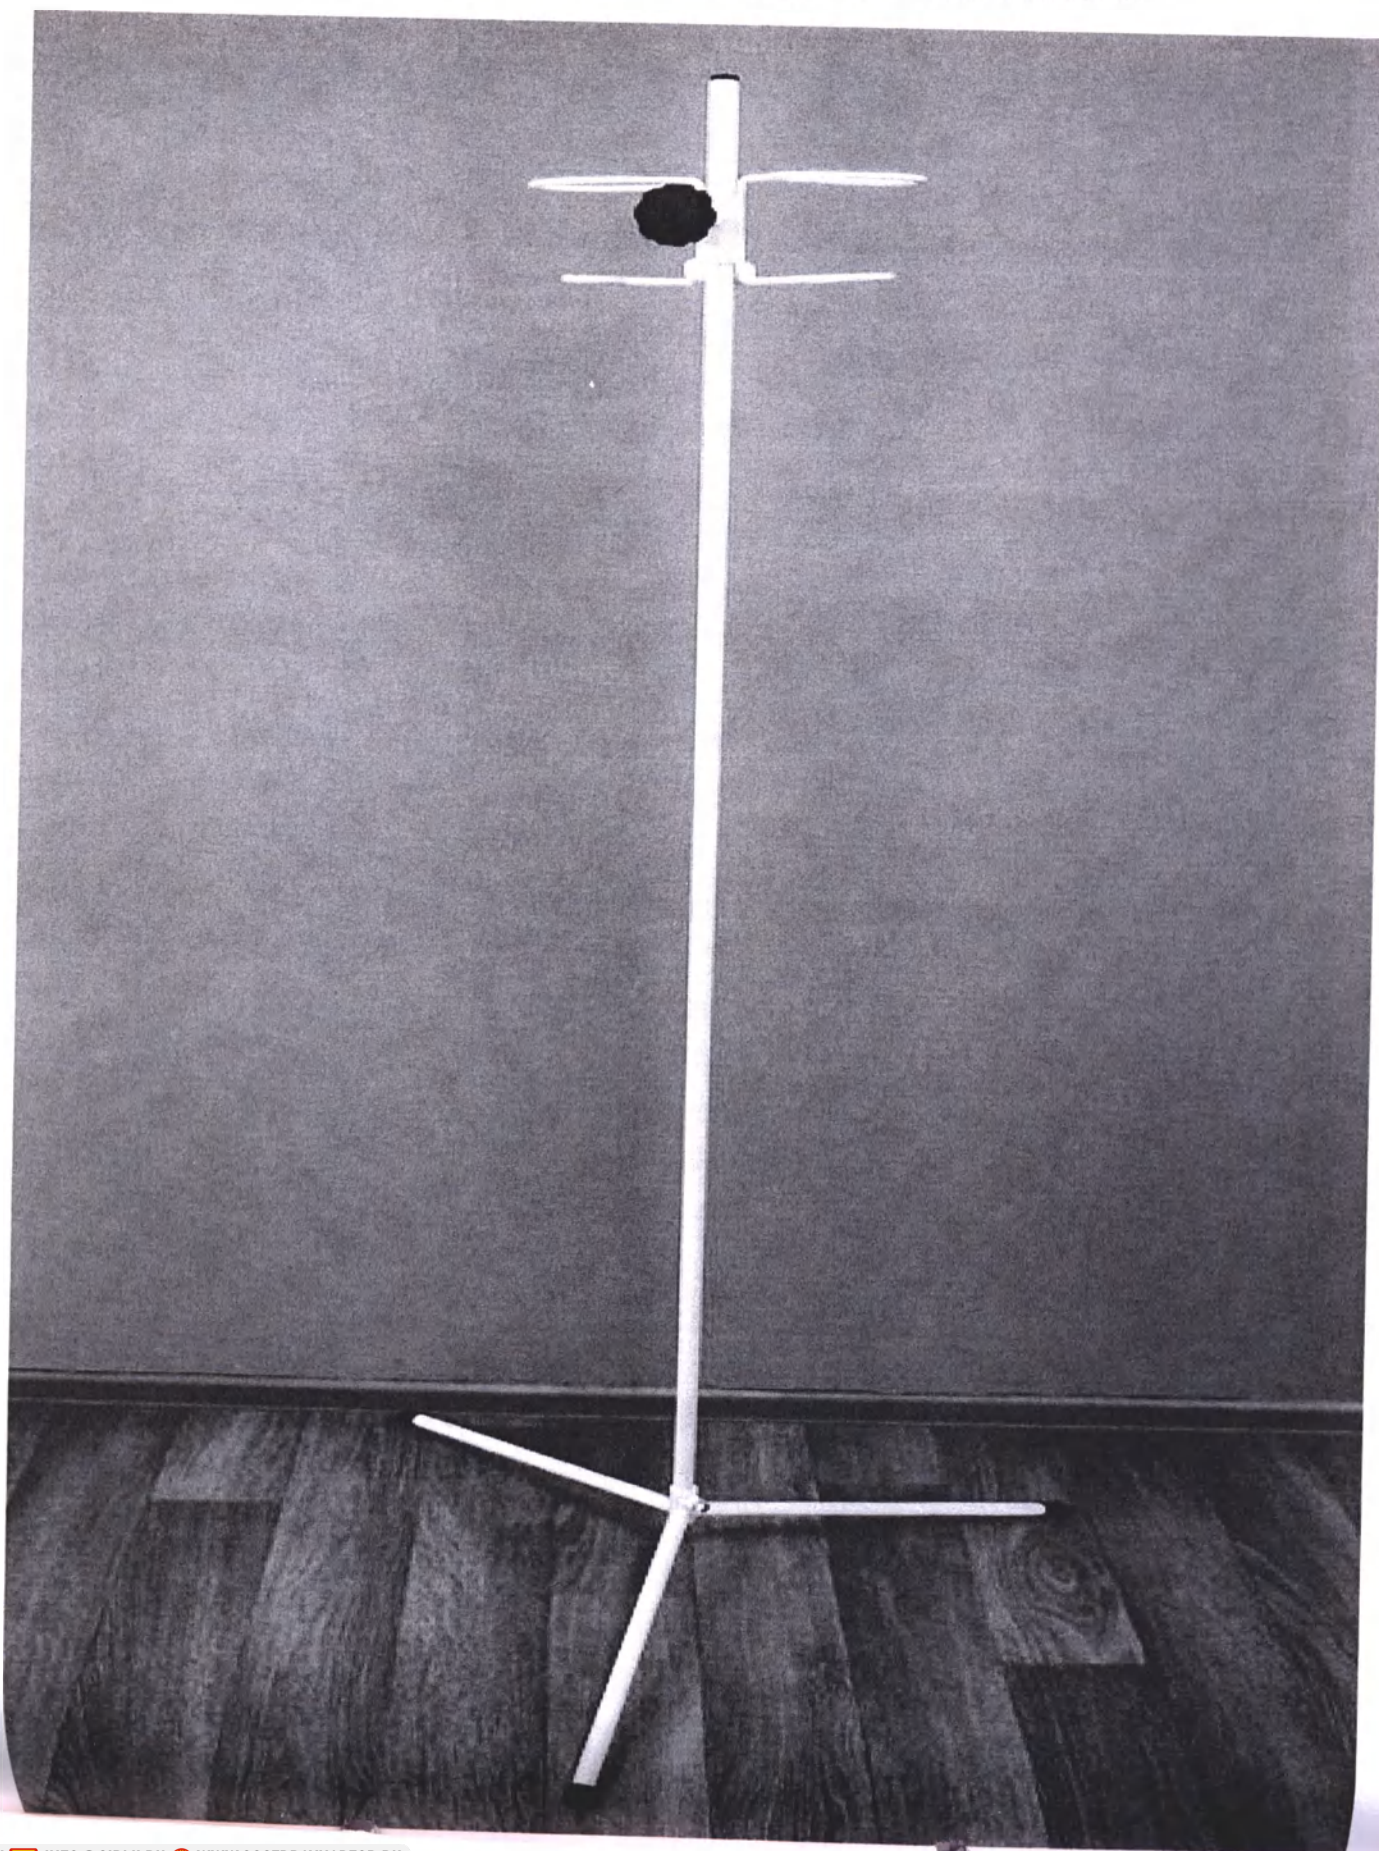


4. Штатив для длительных инфузионных вливаний на пяти опорах с подвижным флаконодержателем: арт. ШВ-15.17.Н / ШВ-15.17 / Штатив для длительных инфузионных вливаний на пяти опорах с подвижным флаконодержателем: арт. ШВ-15.18.Н / ШВ-15.18 / Штатив для длительных инфузионных вливаний на пяти опорах с подвижным флаконодержателем: арт. ШВ-15.19.Н / ШВ-15.19 / Штатив для длительных инфузионных вливаний на пяти опорах с подвижным флаконодержателем: арт. ШВ-15.20.Н / ШВ-15.20.

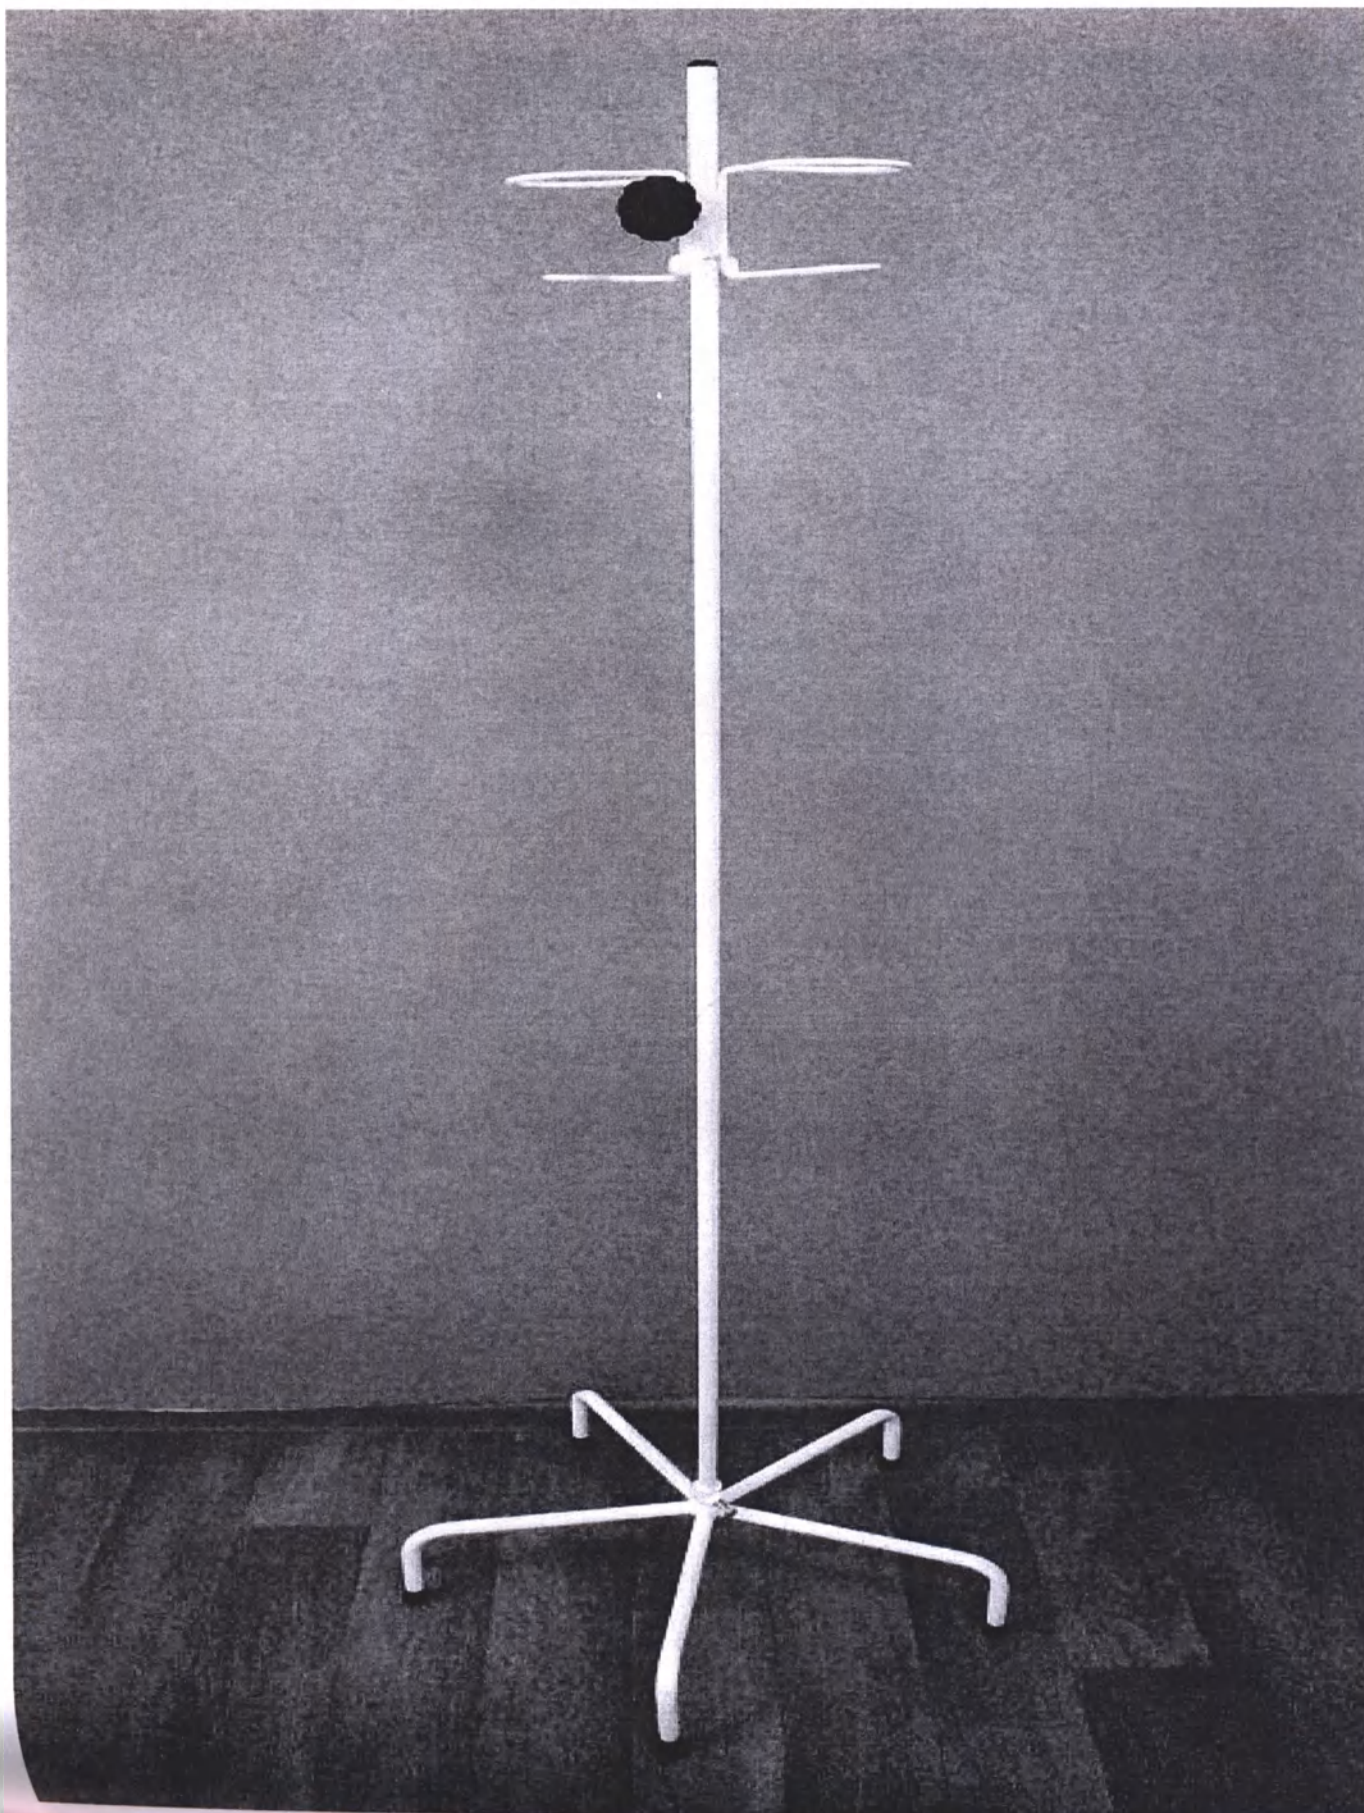


5. Штатив для длительных инфузионных вливаний на трех опорах с подвижным флаконодержателем, на колёсах: арт. ШВК-13.17.Н / ШВК-13.17 / Штатив для длительных инфузионных вливаний на трех опорах с подвижным флаконодержателем, на колёсах: арт. ШВК-13.18.Н / ШВК-13.18 / Штатив для длительных инфузионных вливаний на трех опорах с подвижным флаконодержателем, на колёсах: арт. ШВК-13.19.Н / ШВК-13.19 / Штатив для длительных инфузионных вливаний на трех опорах с подвижным флаконодержателем, на колёсах: арт. ШВК-13.20.Н / ШВК-13.20.

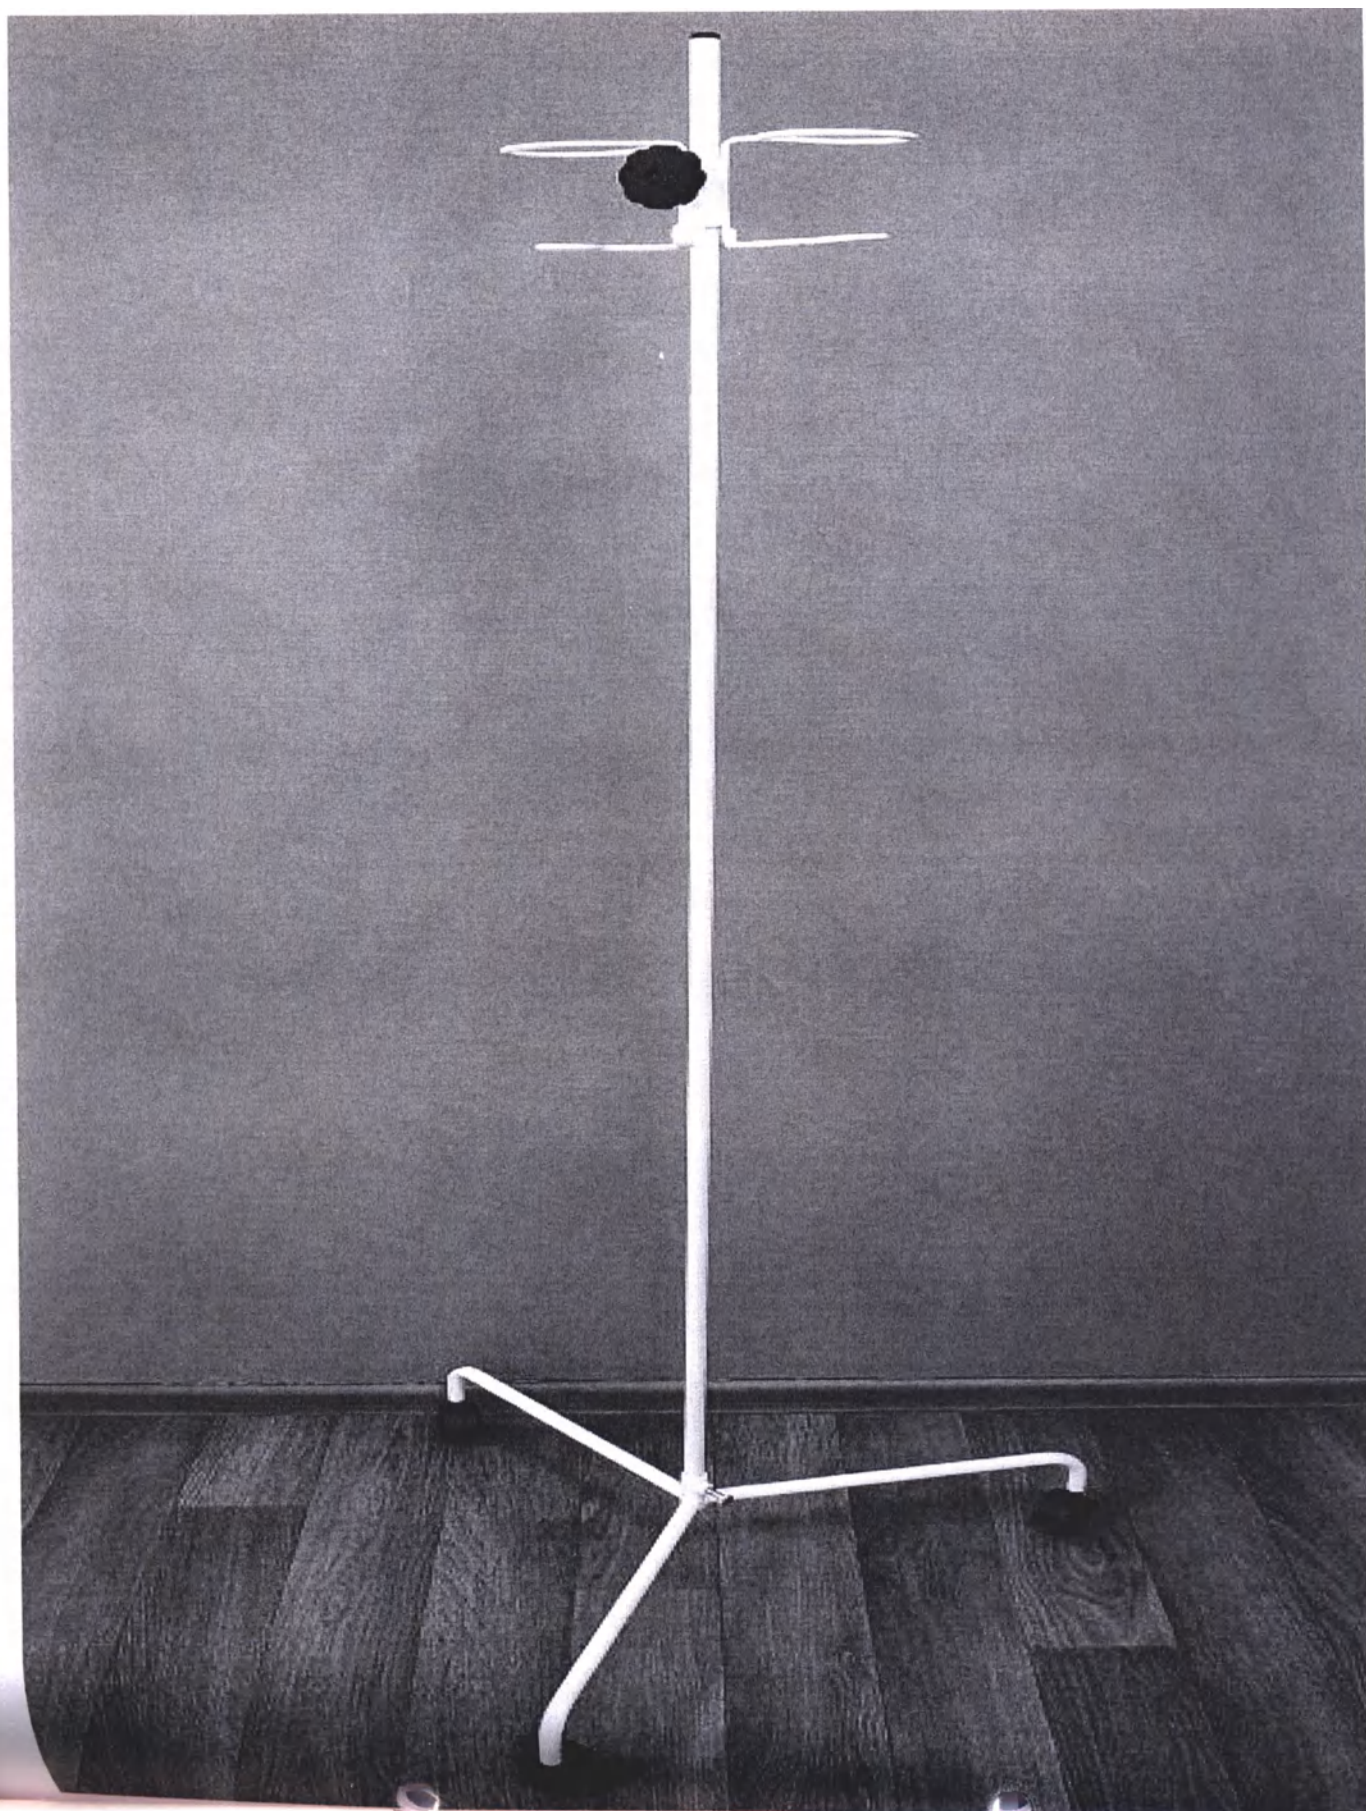


6. Штатив для длительных инфузионных вливаний на пяти опорах с подвижным флаконодержателем, на колёсах: арт. ШВК-15.17.Н / ШВК-15.17 / Штатив для длительных инфузионных вливаний на пяти опорах с подвижным флаконодержателем, на колёсах: арт. ШВК-15.18.Н / ШВК-15.18 / Штатив для длительных инфузионных вливаний на пяти опорах с подвижным флаконодержателем, на колёсах: арт. ШВК-15.19.Н / ШВК-15.19 / Штатив для длительных инфузионных вливаний на пяти опорах с подвижным флаконодержателем, на колёсах: арт. ШВК-15.20.Н / ШВК-15.20.

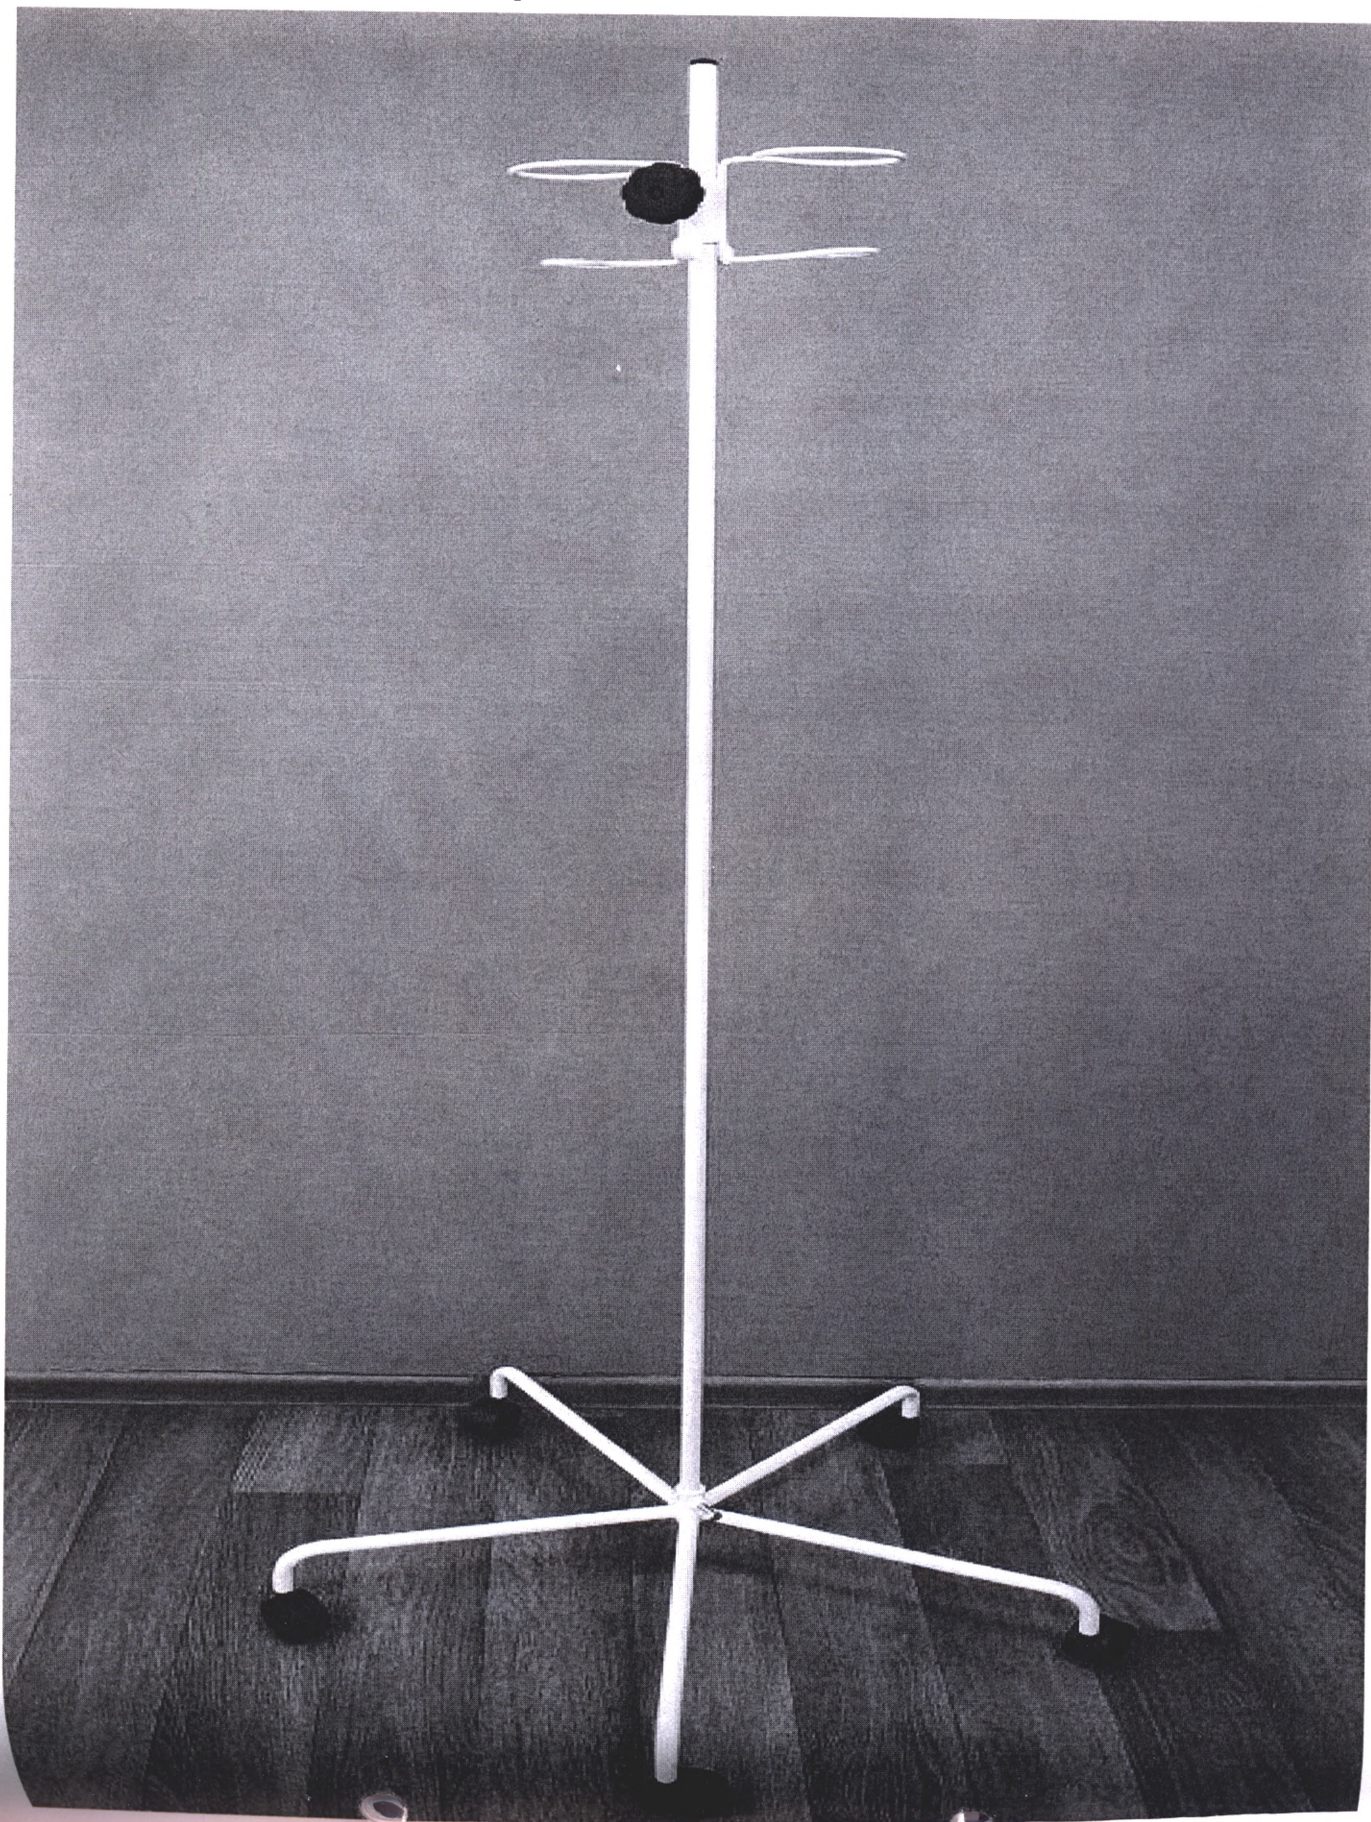

7. Штатив для длительных инфузионных вливаний на трёх опорах нерегулируемый, с колёсами: арт. ШВК-03.17.Н / ШВК-03.17 / Штатив для длительных инфузионных вливаний на трёх опорах нерегулируемый, с колёсами: арт. ШВК-03.18.Н / ШВК-03.18 / Штатив для длительных инфузионных вливаний на трёх опорах нерегулируемый, с колёсами: арт. ШВК-03.19.Н / ШВК-03.19 / Штатив для длительных инфузионных вливаний на трёх опорах нерегулируемый, с колёсами: арт. ШВК-03.20.Н / ШВК-03.20.

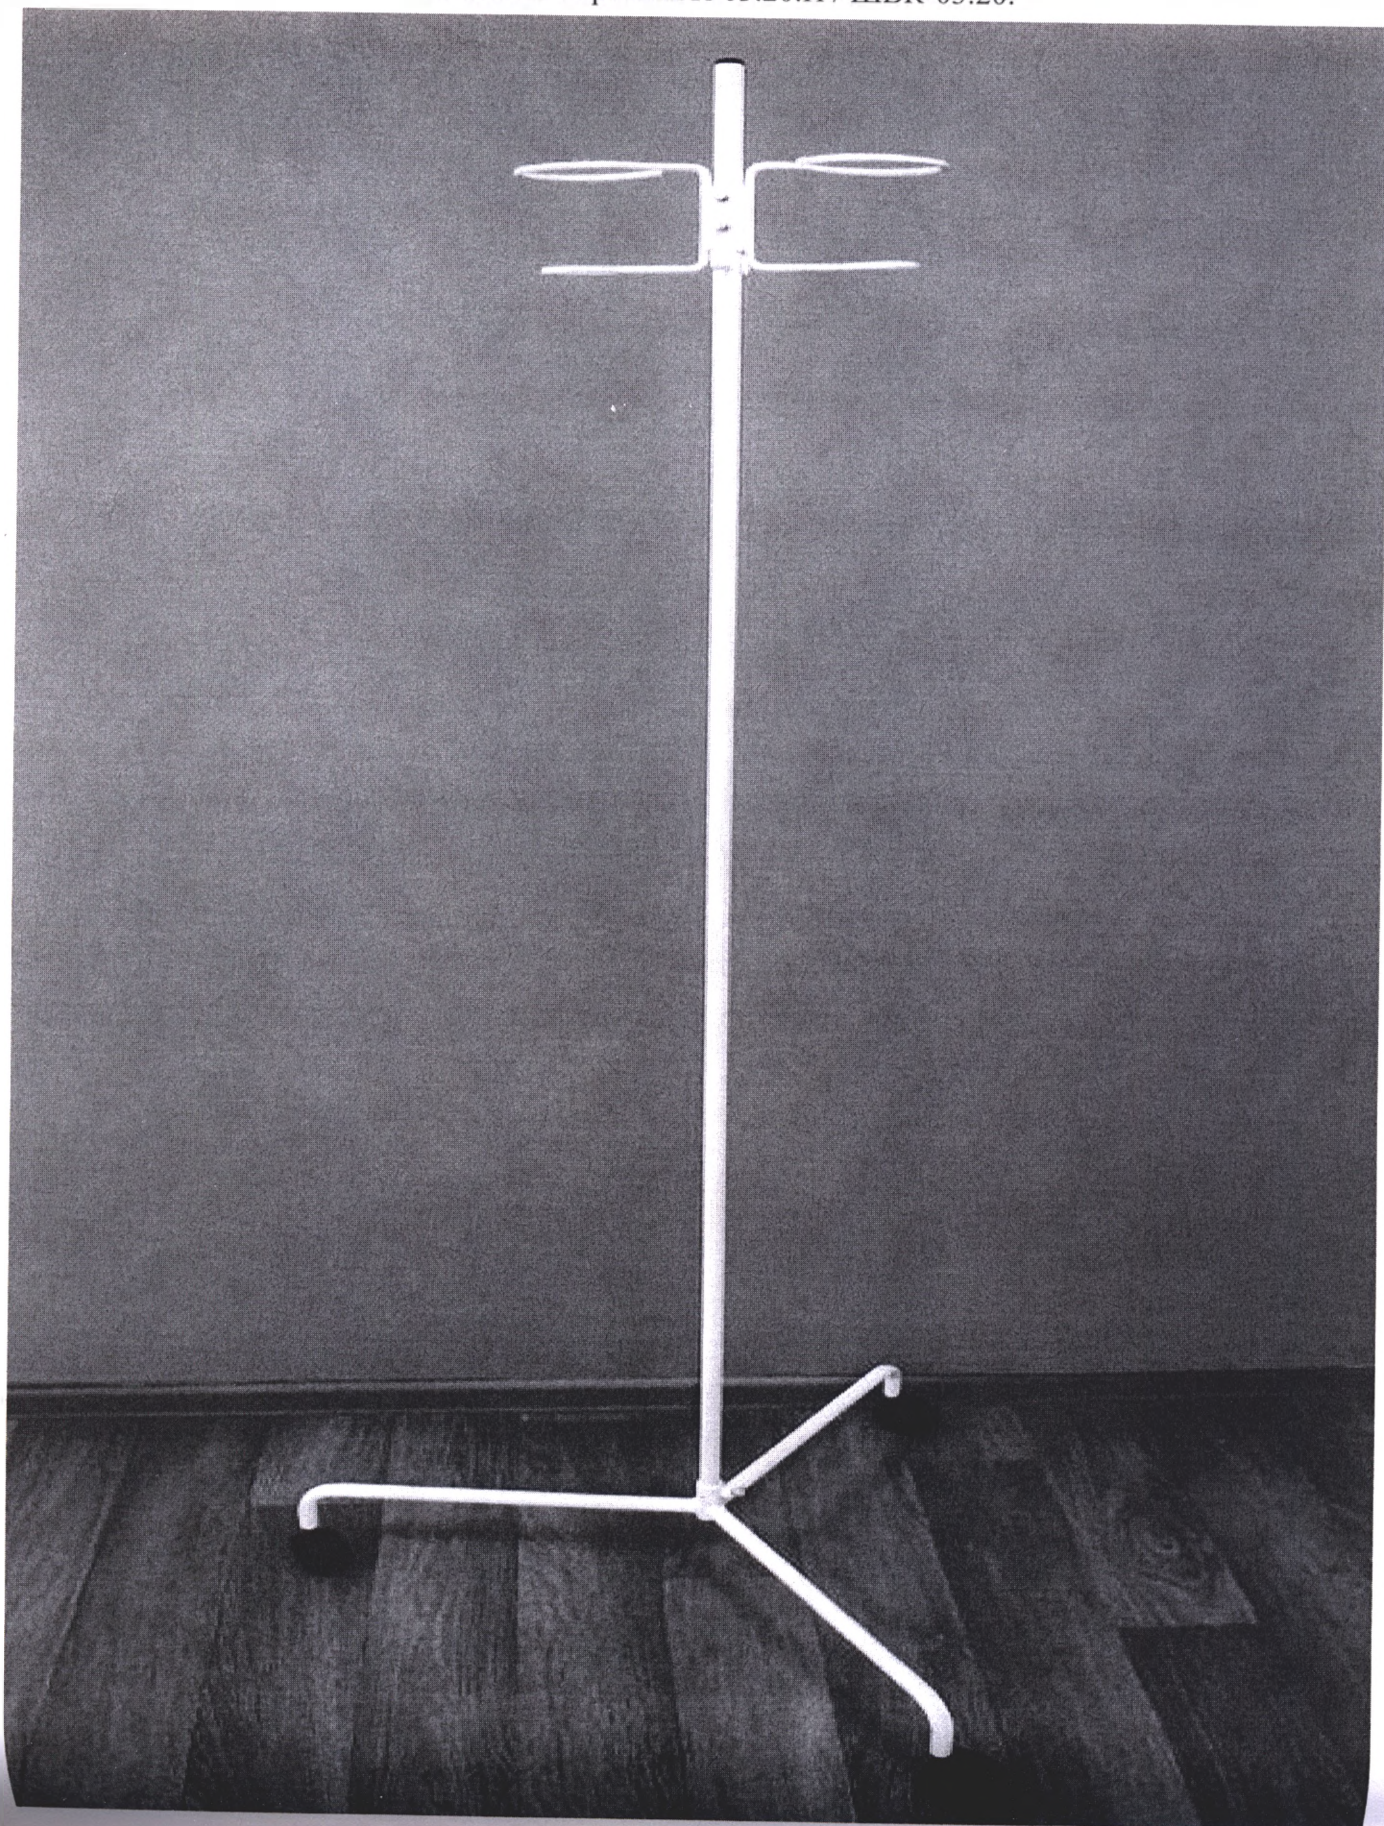


8. Штатив для длительных инфузионных вливаний на пяти опорах нерегулируемый, с колёсами: арт. ШВК-05.17.Н / ШВК-05.17 / Штатив для длительных инфузионных вливаний на пяти опорах нерегулируемый, с колёсами: арт. ШВК-05.18.Н / ШВК-05.18 / Штатив для длительных инфузионных вливаний на пяти опорах нерегулируемый, с колёсами: арт. ШВК-05.19.Н / ШВК-05.19 / Штатив для длительных инфузионных вливаний на пяти опорах нерегулируемый, с колёсами: арт. ШВК-05.20.Н / ШВК-05.20.

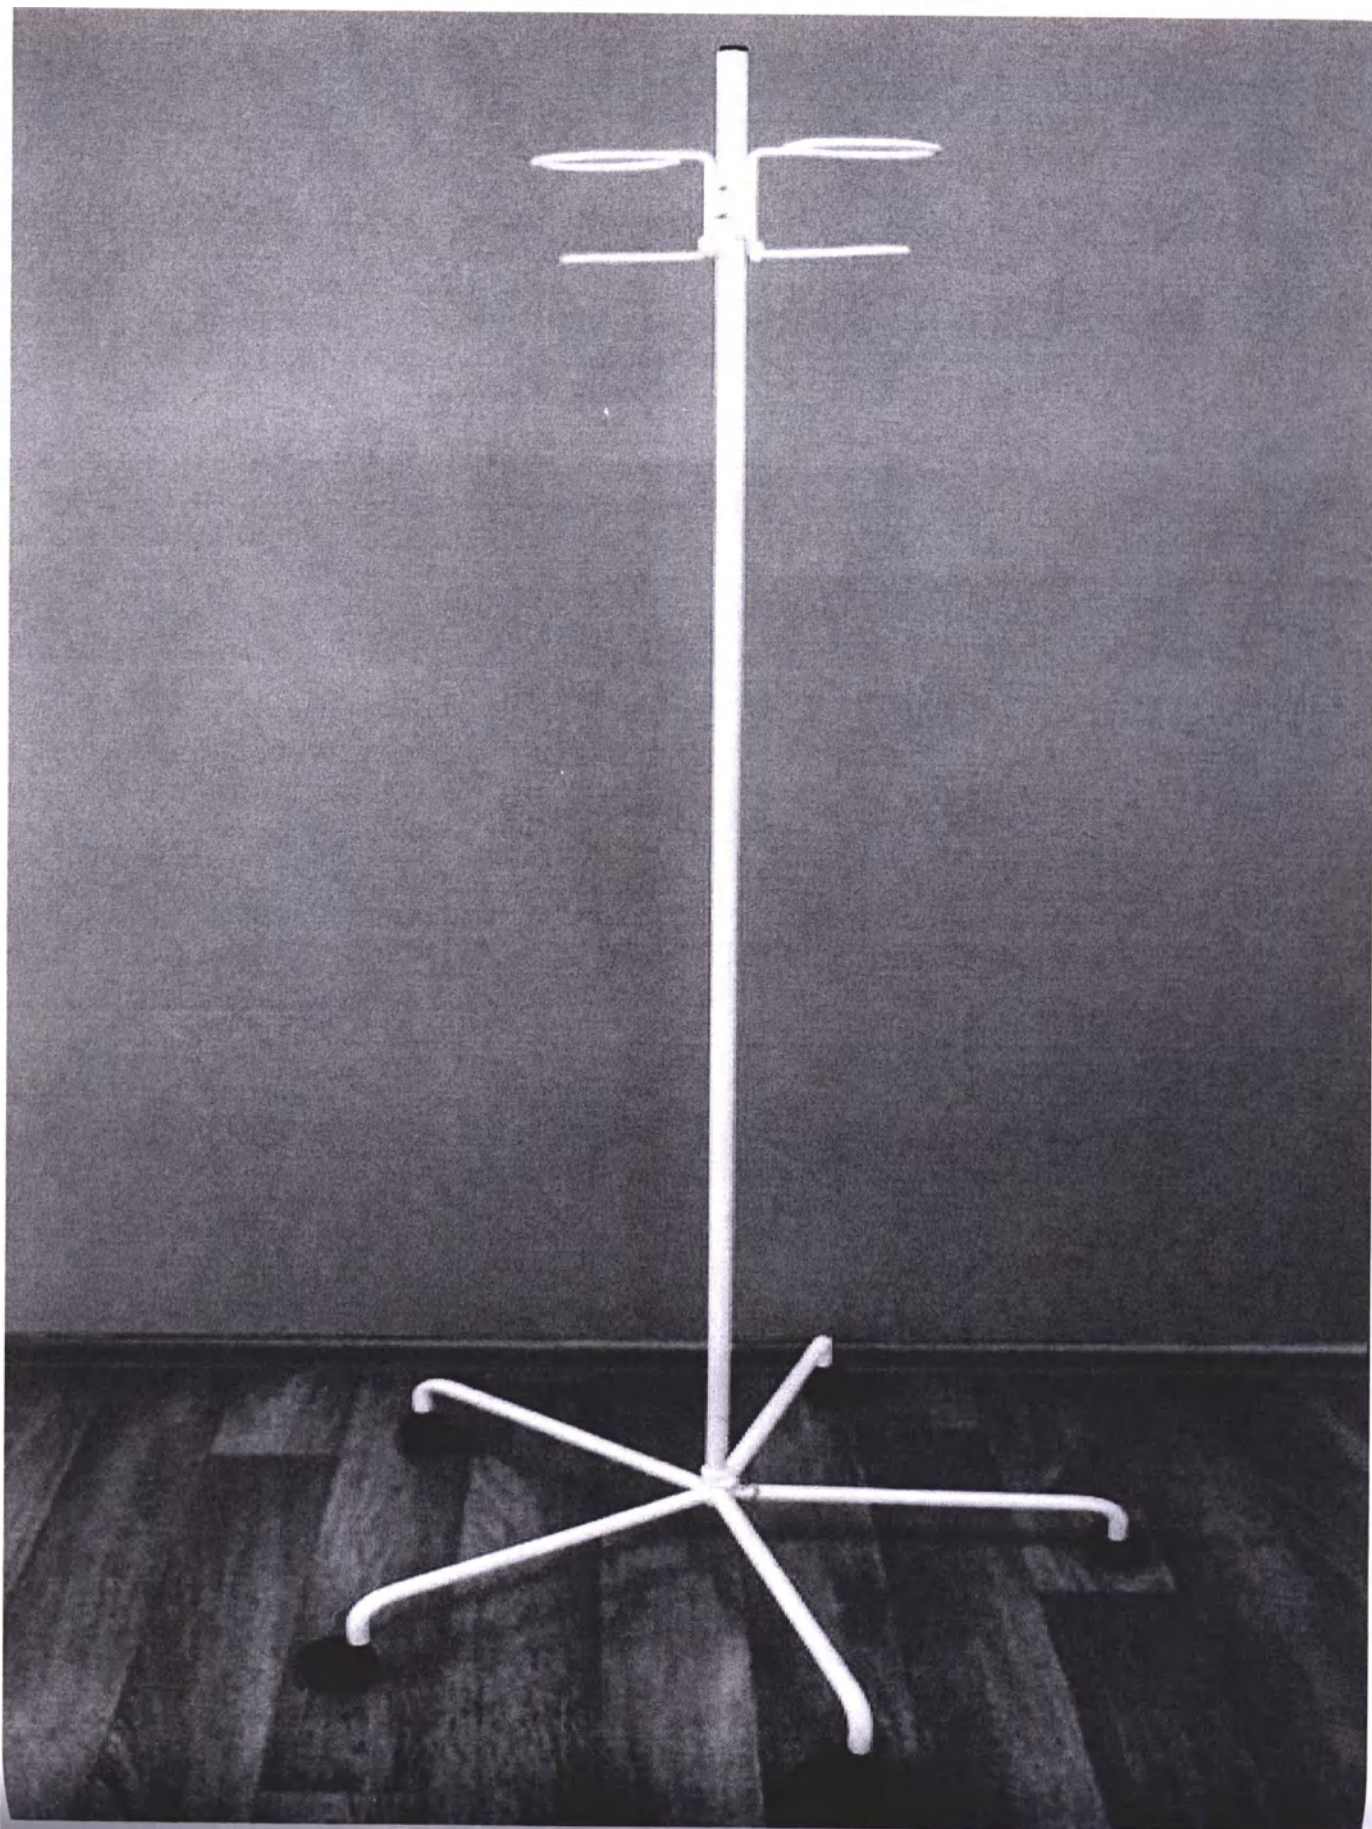


9. Штатив для длительных инфузионных вливаний на трех опорах телескопический: арт. ШВТ-03.Н / ШВТ-03.




10. Штатив для длительных инфузионных вливаний на пяти опорах телескопический: арт. ШВТ-05.Н / ШВТ-05.

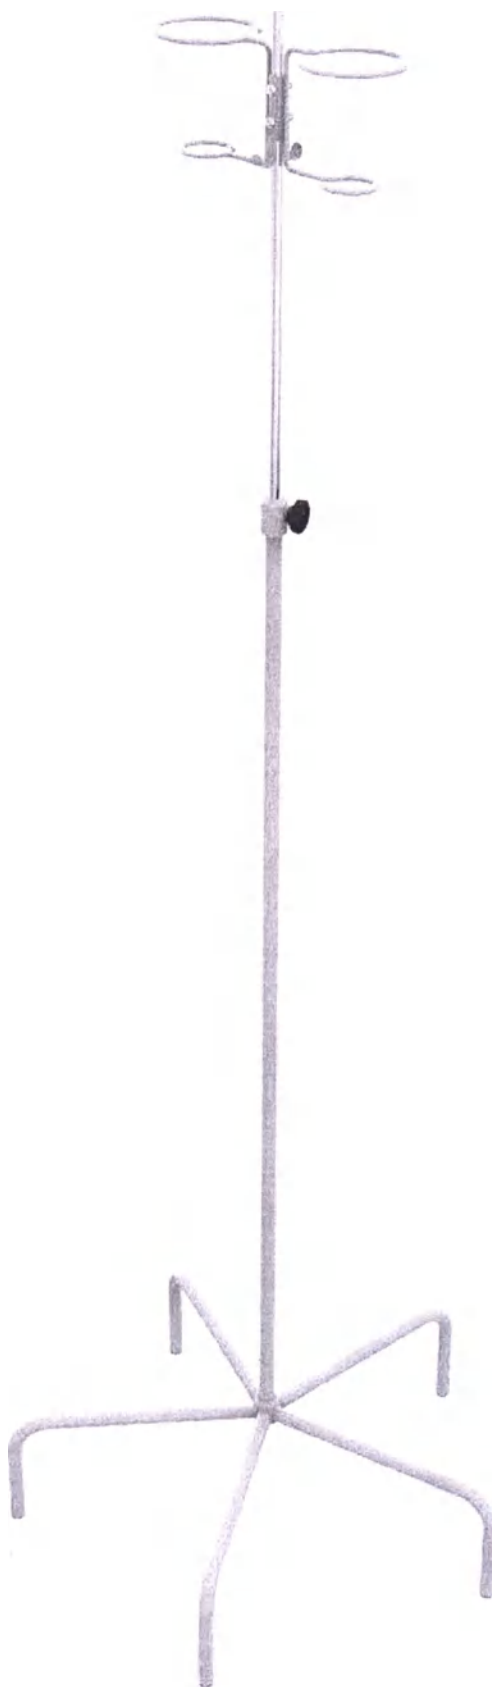


11. Штатив для длительных инфузионных вливаний на трёх опорах телескопический, с колёсами: арт. ШВТК-03.Н / ШВТК-03.

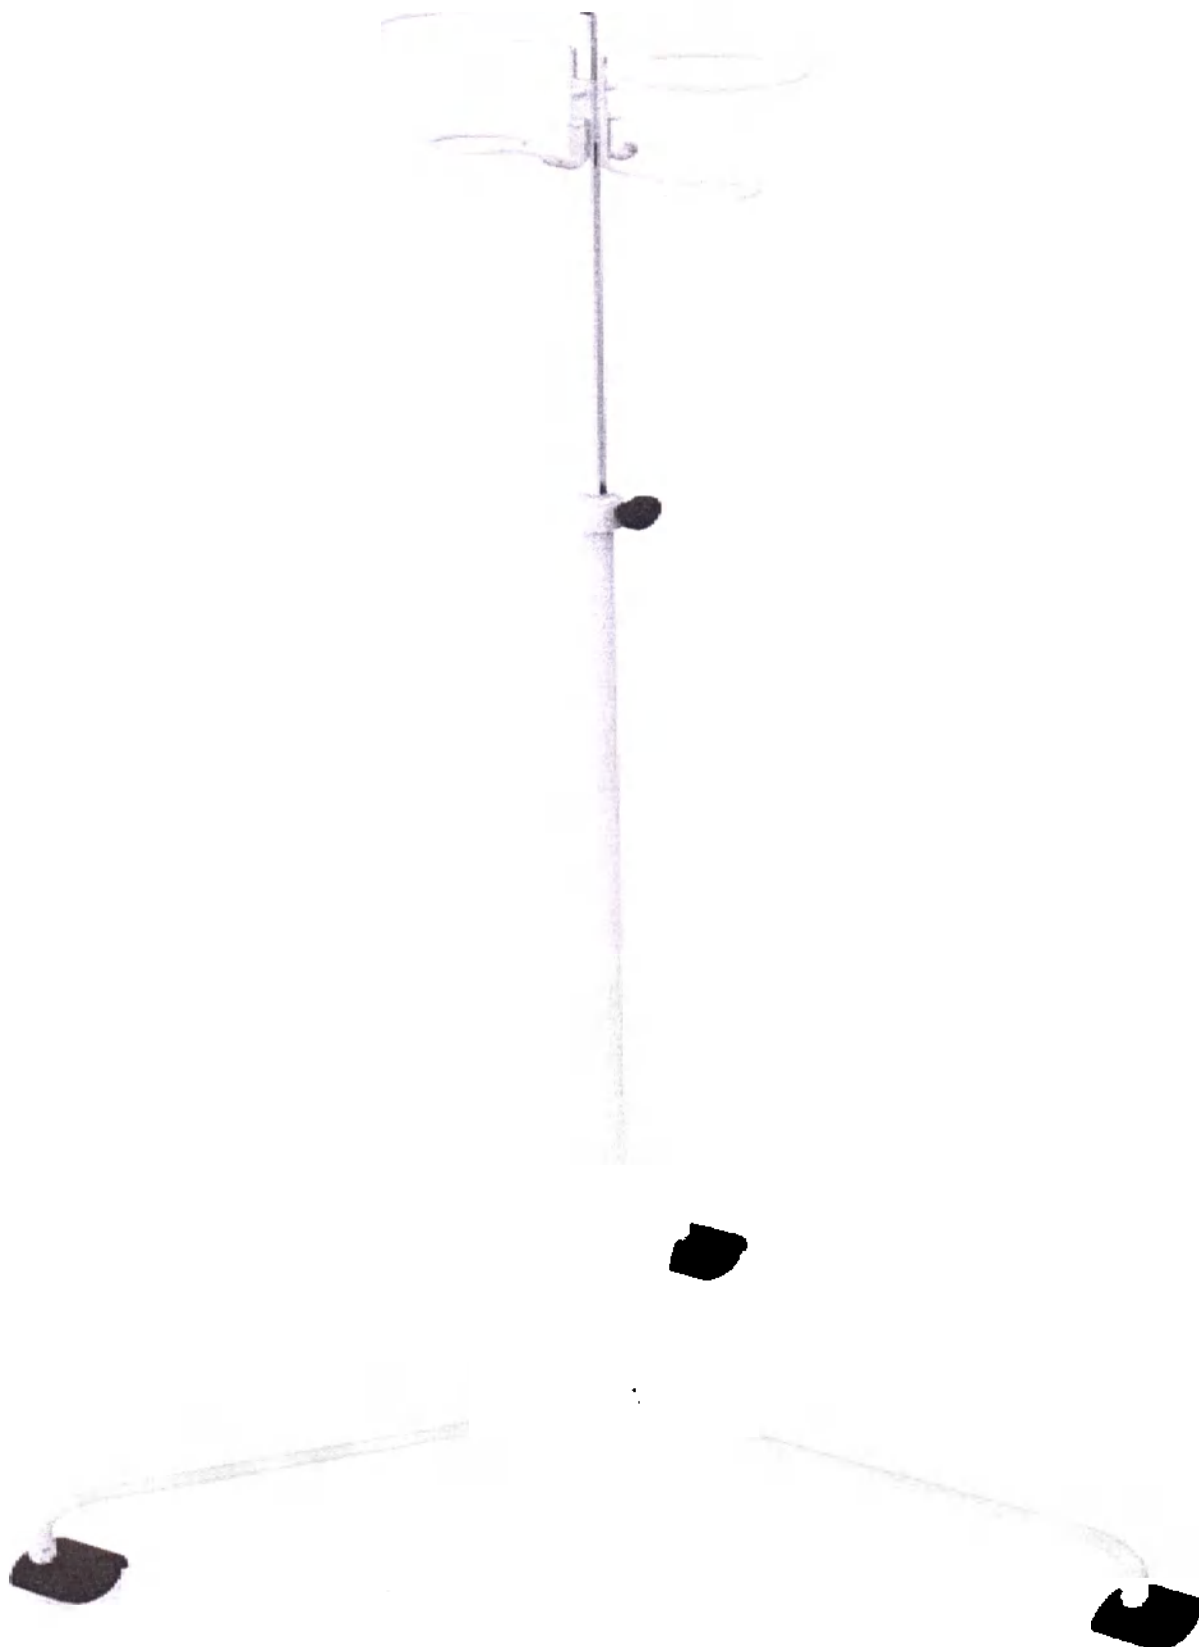


12. Штатив для длительных инфузионных вливаний на пяти опорах телескопический, с колёсами: арт. ШВТК-05.Н / ШВТК-05.

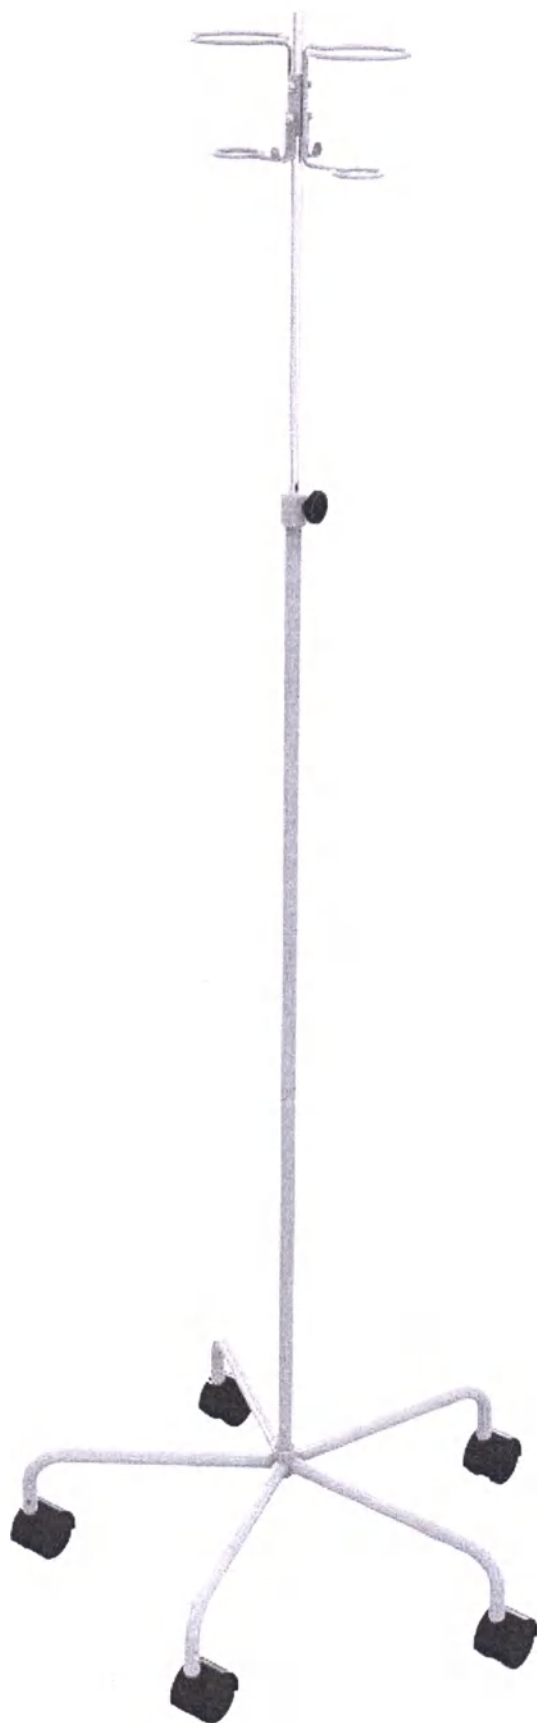


13. Штатив для длительных инфузионных вливаний разборный: арт. ШВР-03.Н / ШВР-03 / ШВР-03.17.Н/ ШВР-03.17.

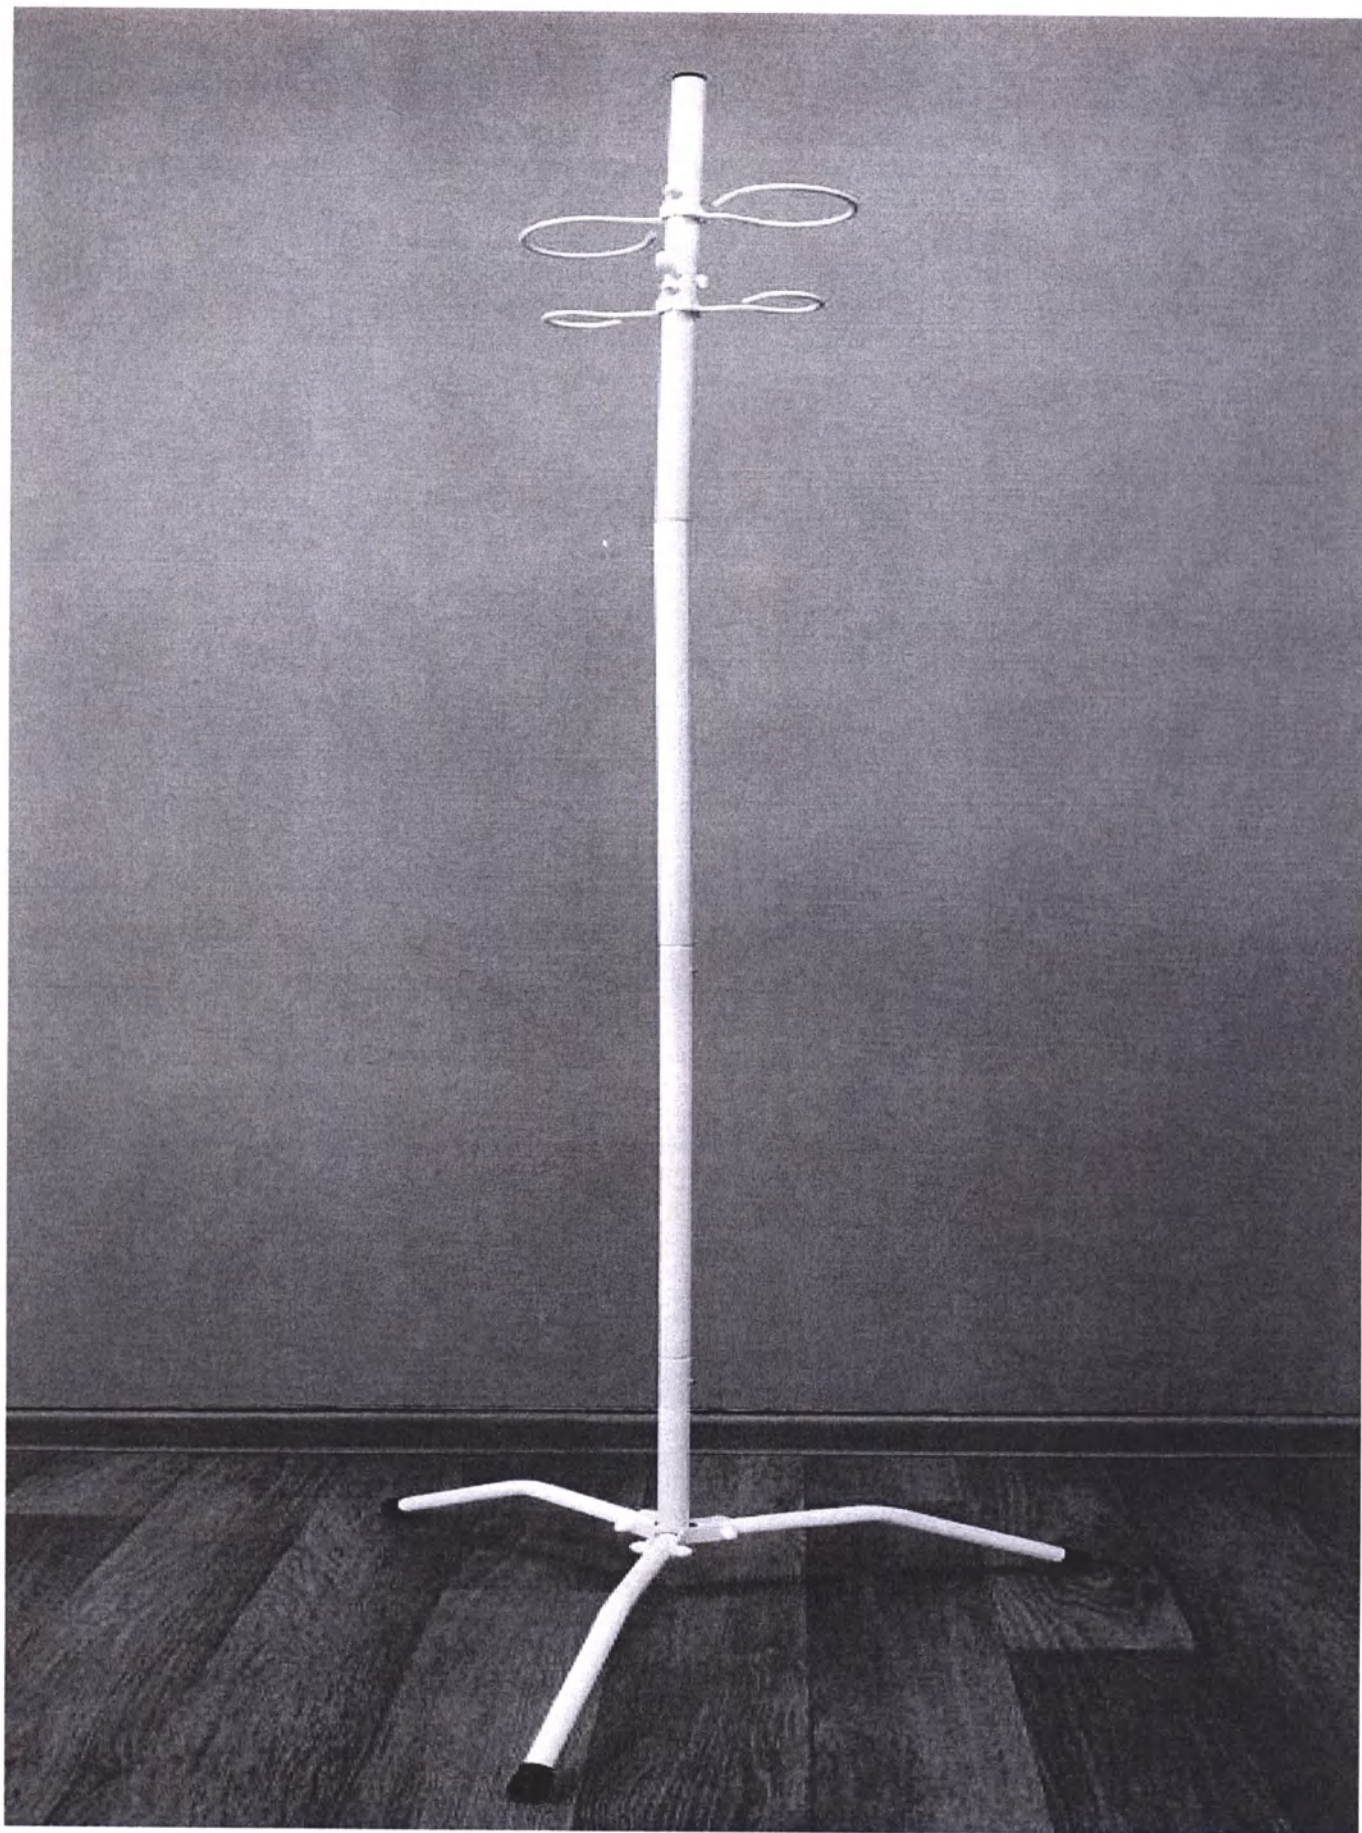



1. Флаконодержатель под 2-а флакона с двумя дополнительными крючками: арт. ФД-2.Н / ФД-2.

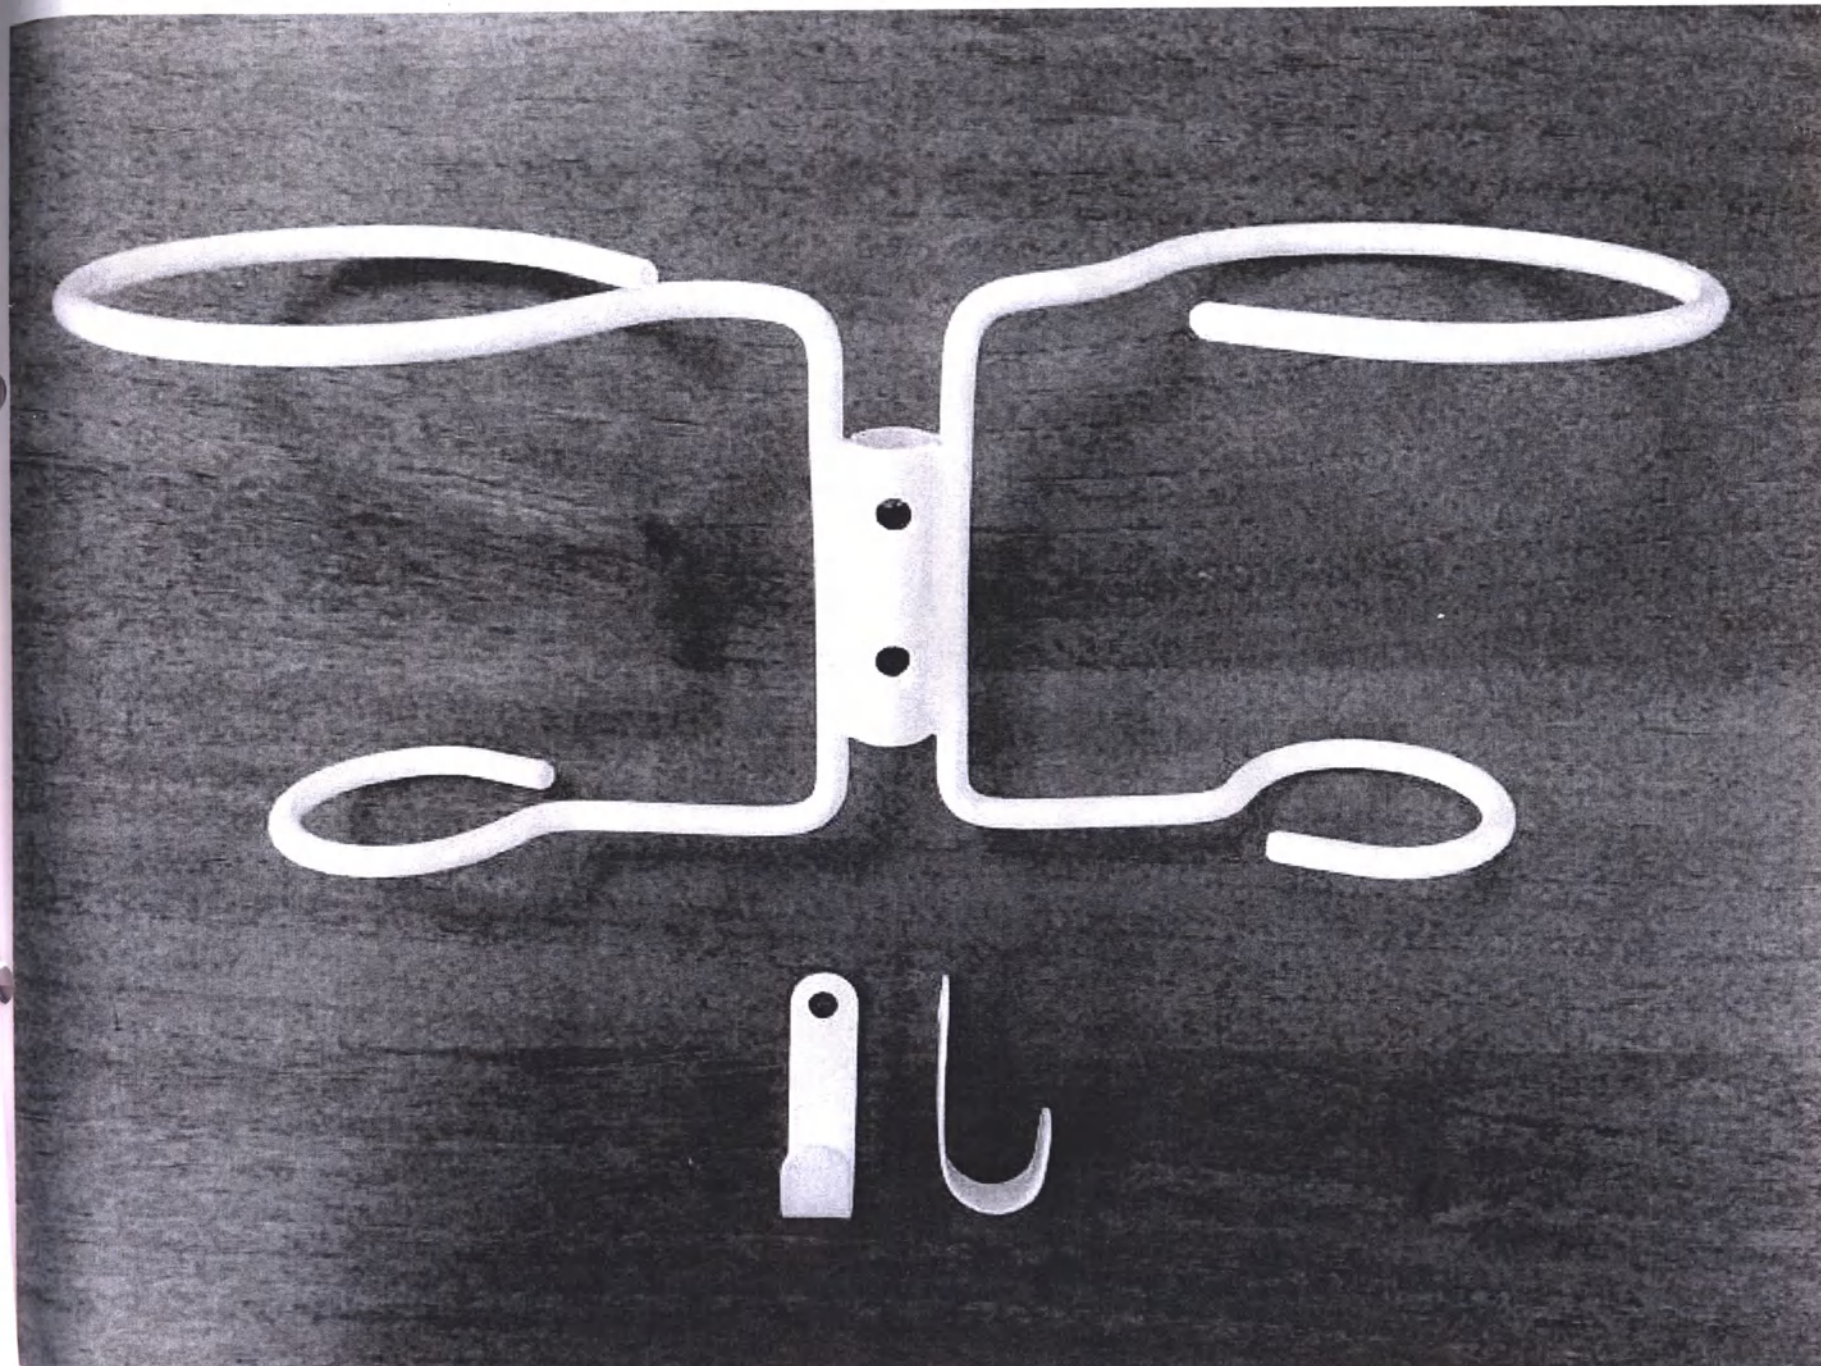


2.

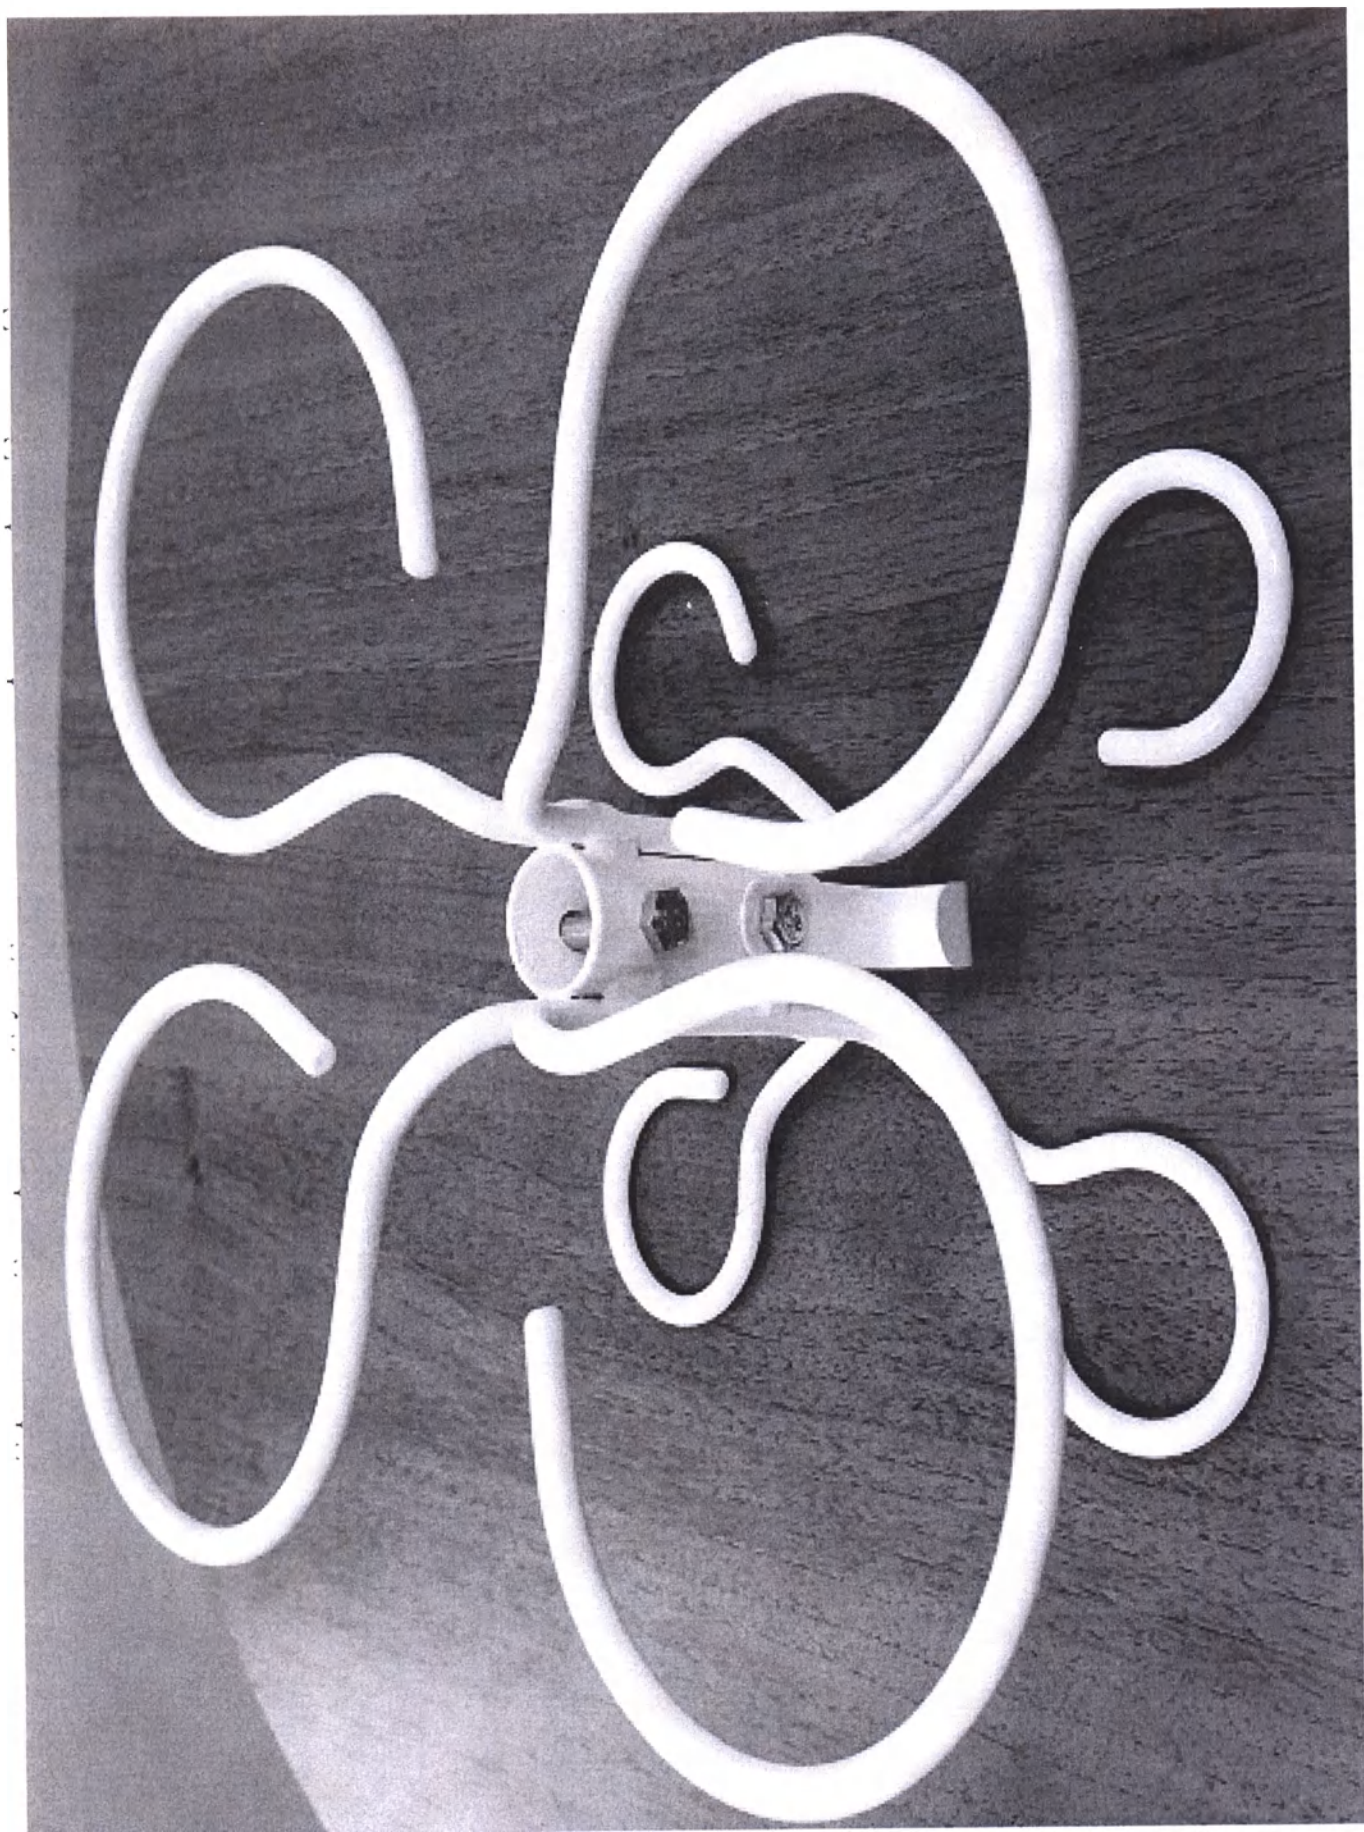

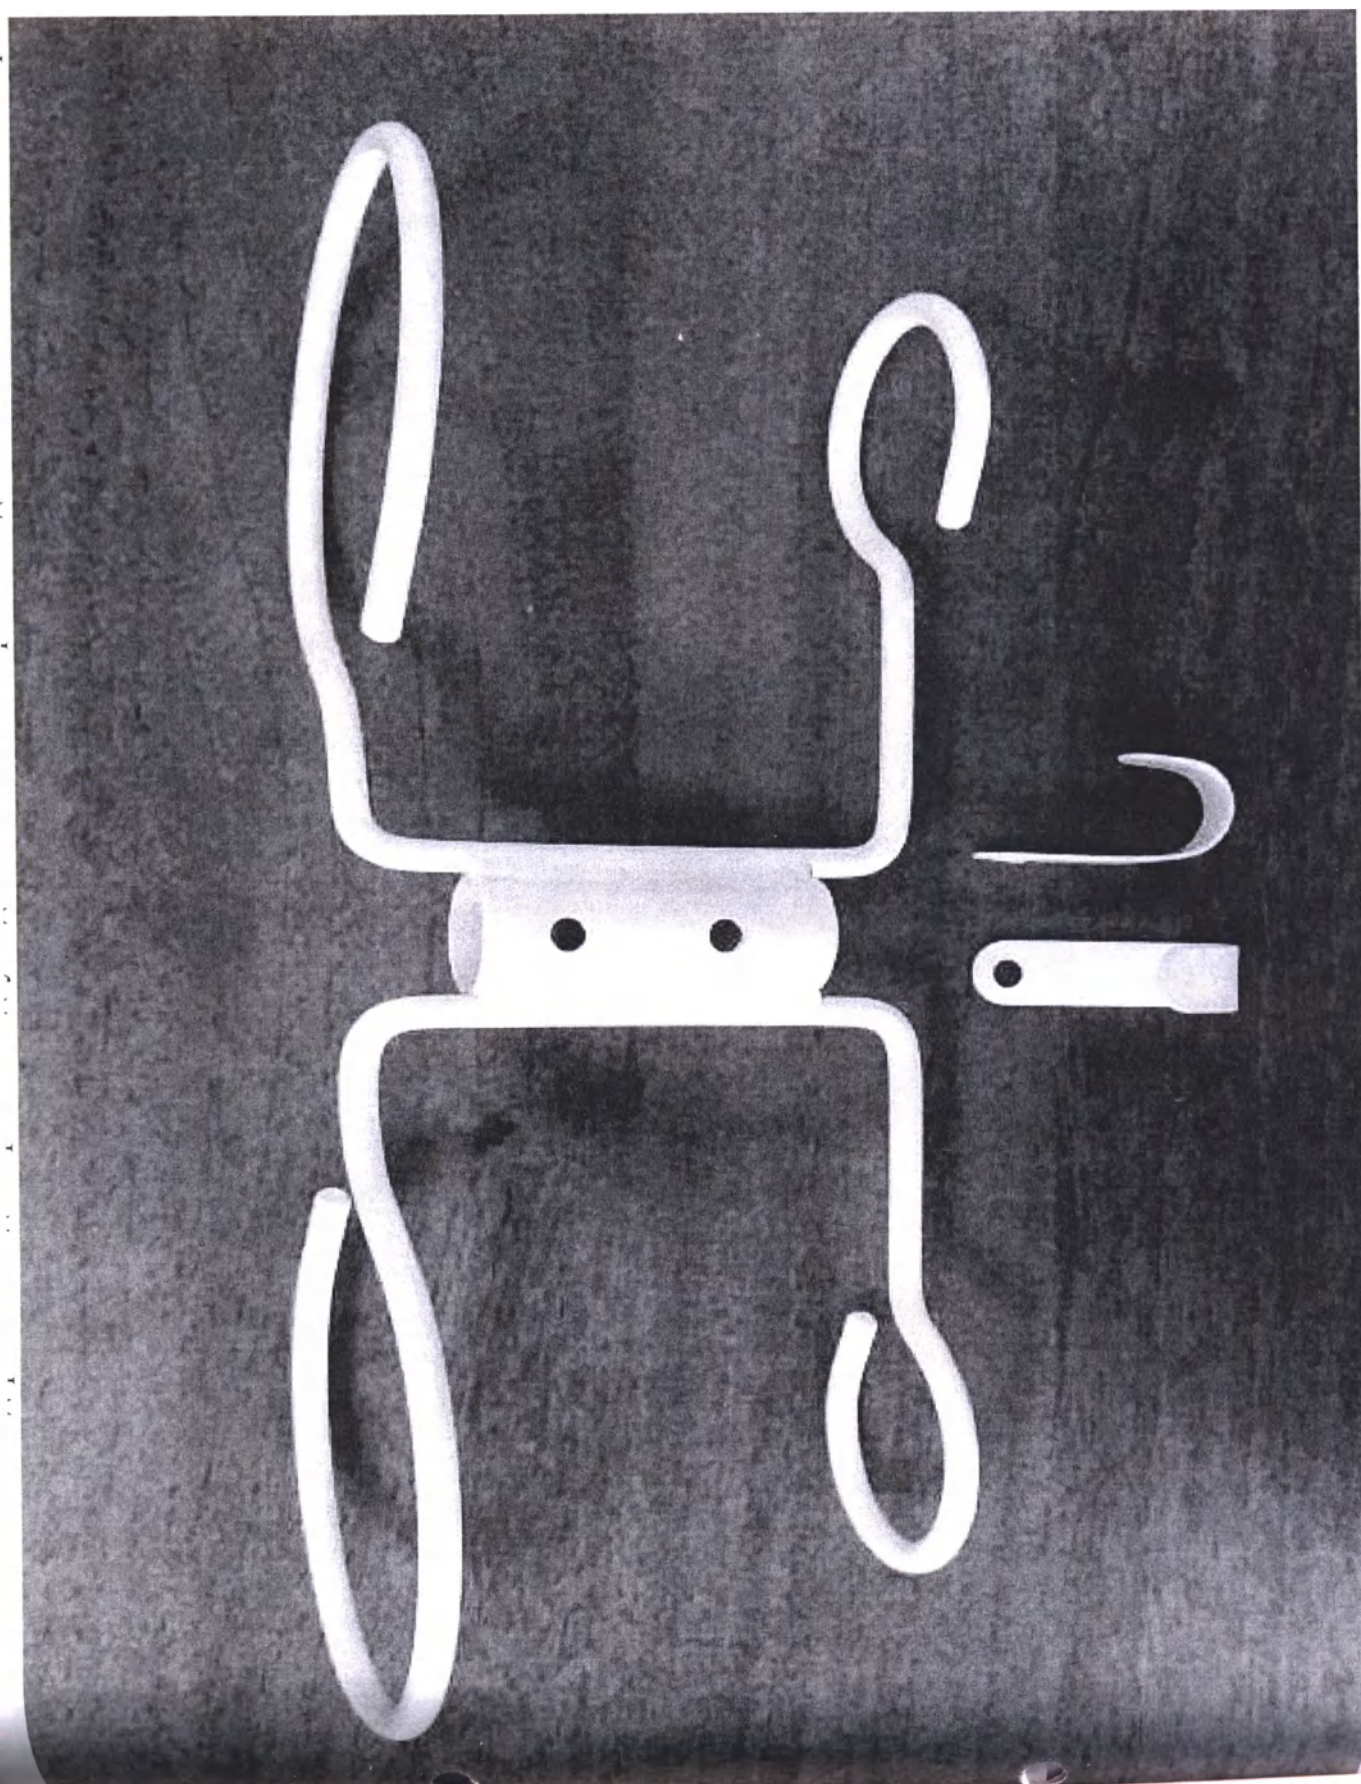

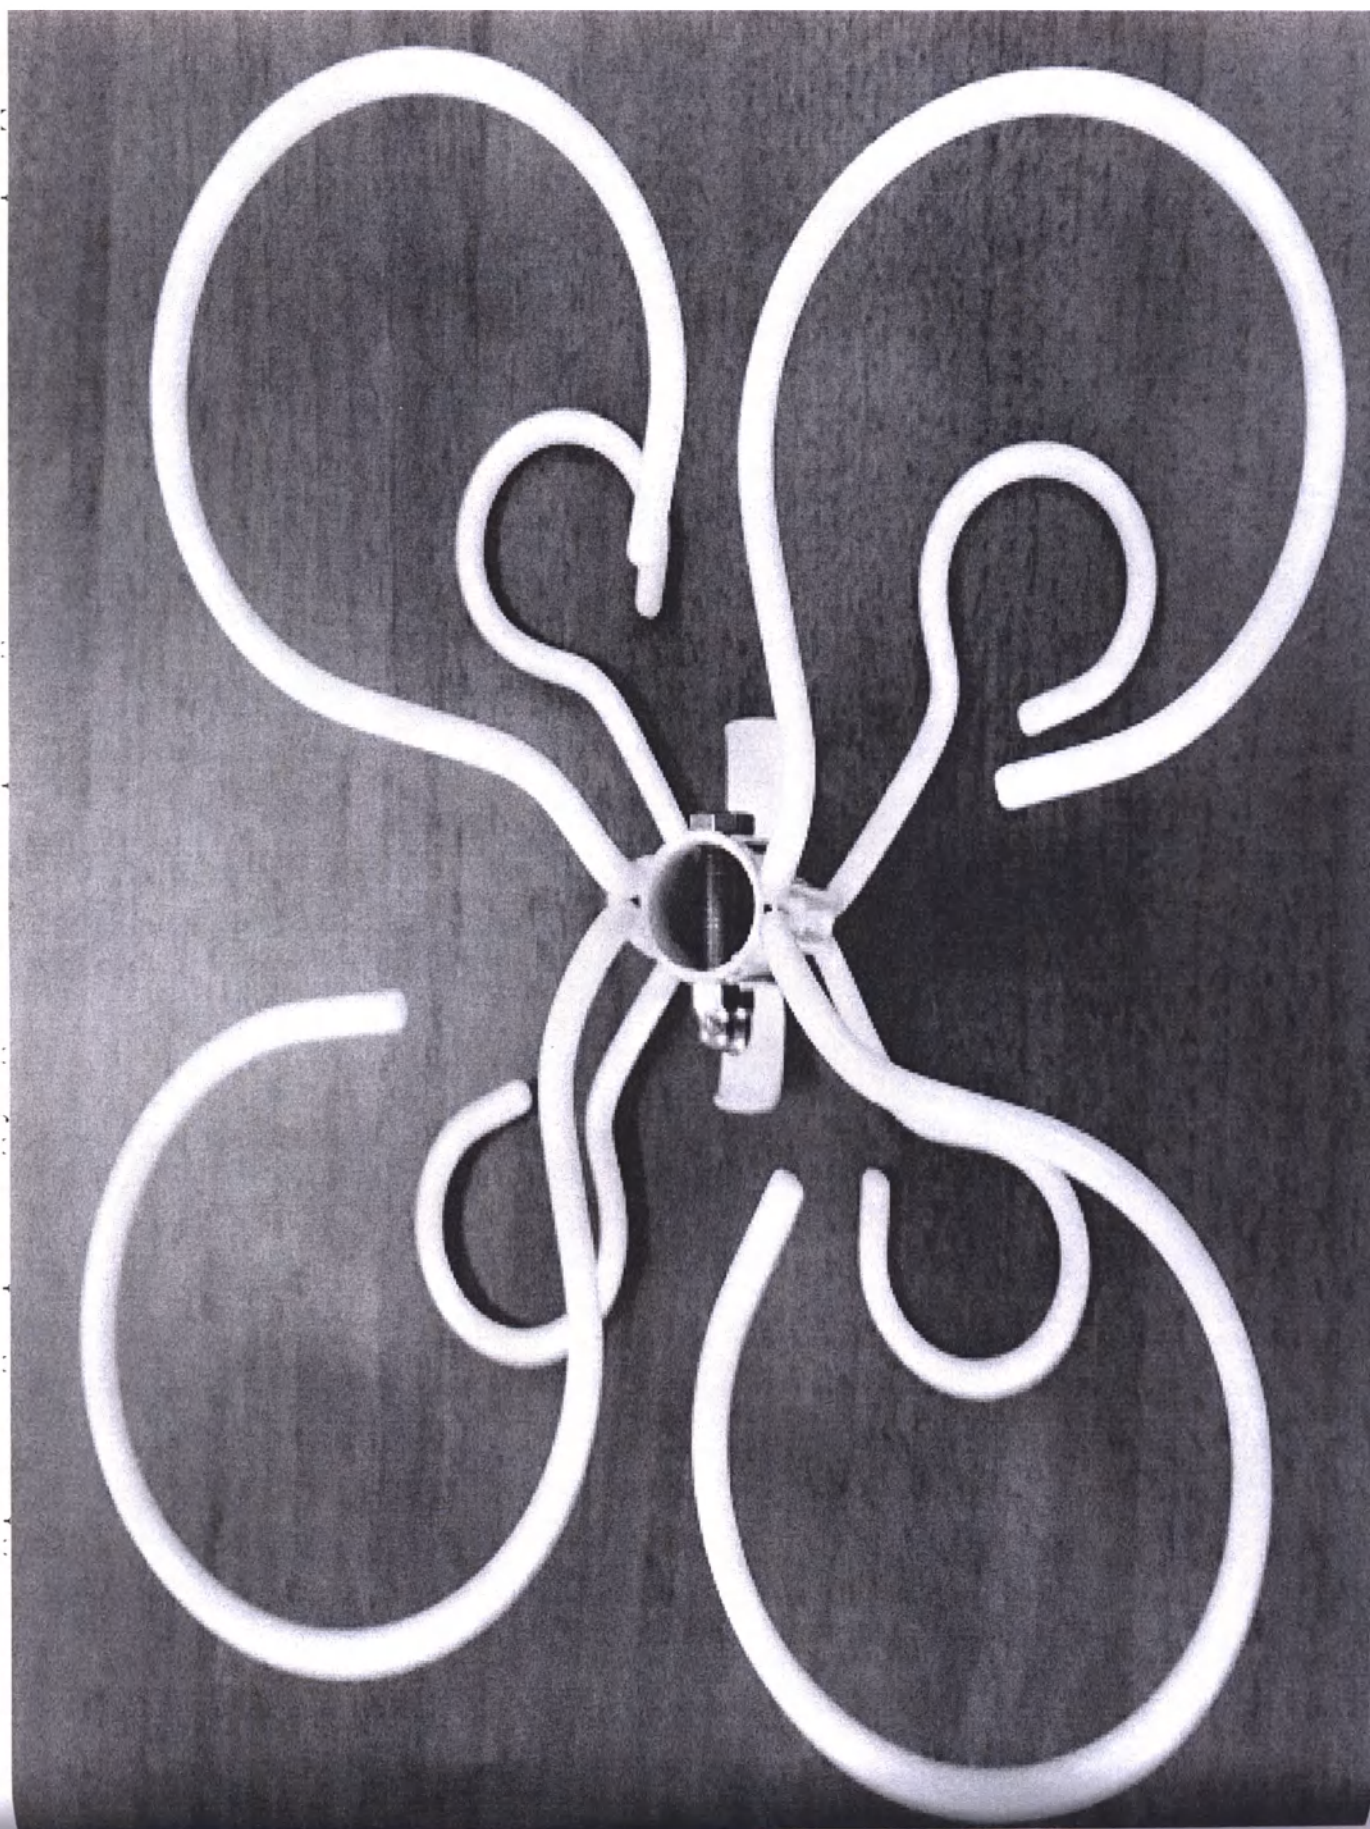

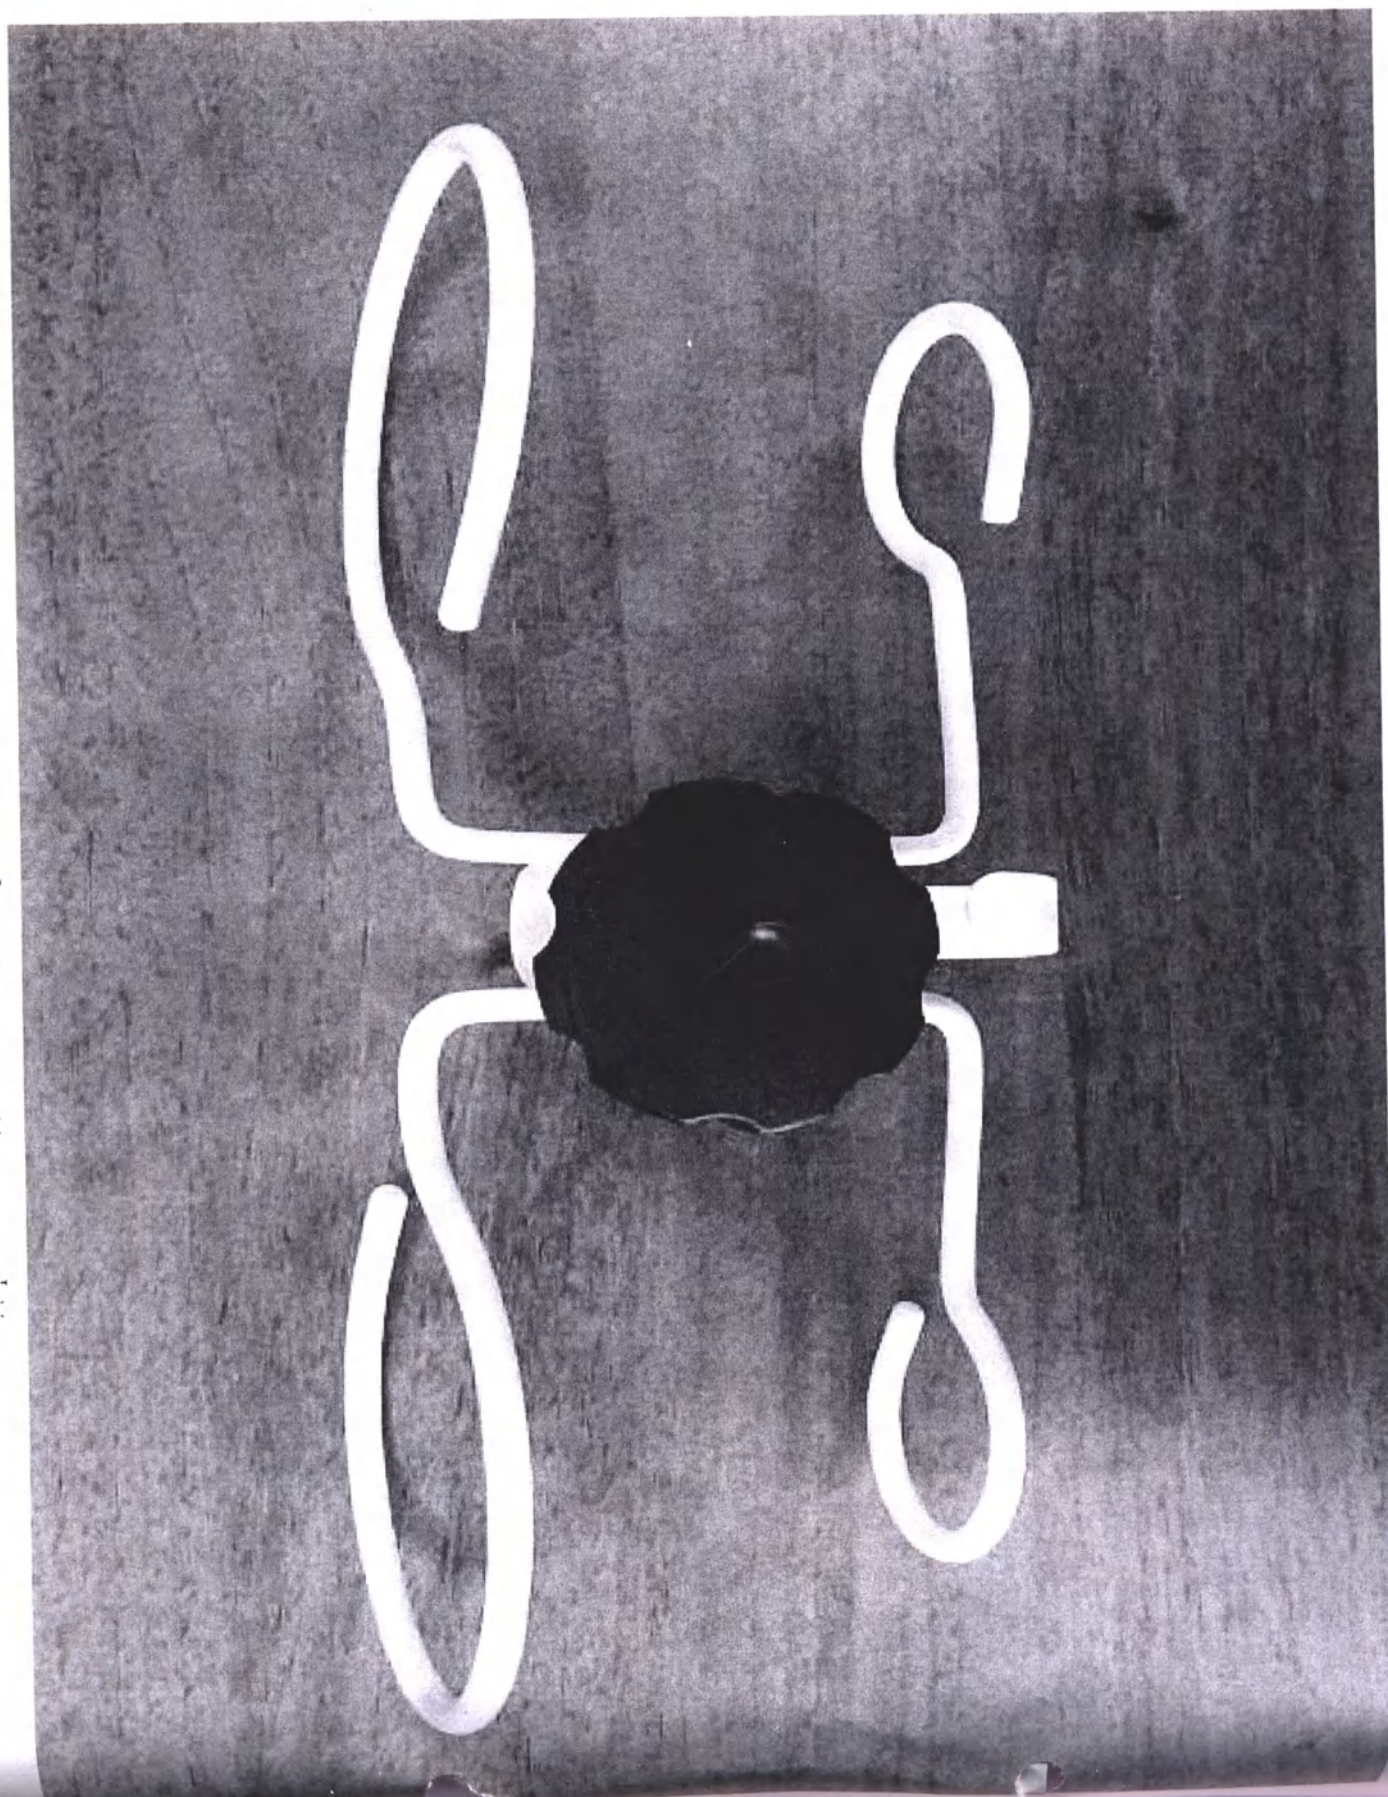

Вклеено, пронумеровано
и скреплено печатью

22 (двадцать два) листов
цифрами (двадцать два) прописью

Должность Директор

Подпись Григорьев

« » 20 г. М. П.

