

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Мирахофф»
Суворова И.В.
«14» февраля 2022 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
И
МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:**

**Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная
по ГОСТ 5556-81**

2022

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81:

- в рулонах массой 25 г, 50 г, 100 г, 250 г;
- спрессованная в кипы по 20 кг, 30 кг, 40 кг, 50 кг;
- в виде зигзагообразной ленты массой 50 г, 100 г, 250 г.

гигроскопическая • хирургическая • хлопковая
БАТА МЕДИЦИНСКАЯ
НЕСТЕРИЛЬНАЯ
по ГОСТ 5556-81.
РУ № _____ ОТ _____

ШТРИХ-КОД

ООО «Мирахофф».

рф, 170039, Тверская обл., г. Тверь,
проезд Стеклопластик, д. 5.
Тел. 8 (800) 777-75-75,
e-mail: mirahoff@mail.ru



МАССА ВАТЫ **25 г**

ГОД
ИЗГОТОВЛЕНИЯ **2021**

НОМЕР ПАРТИИ **29**

Состав: 100 % хлопок.

Назначение: для применения в
больничных, амбулаторных и
домашних условиях при
наложении повязок, компрессов,
при обработке кожных покровов. Не
предназначена для обработки
раневых поверхностей.

Противопоказания к применению:
индивидуальная непереносимость
материалов, из которых изготовлено
изделие

Показания к применению: для
медицинских целей.

Возможные побочные действия:
аллергическая реакция на
материалы, из которых изготовлено
изделие.

Способ применения: вскрыть
упаковку по линии отреза и
применить по назначению.

Условия хранения: вата должна
храниться в складских помещениях
на поддонах или стеллажах в

соответствии с прописями по
безопасности в условиях
предотвращения в
атмосферных осадках и
влаги.

Условия утилизации: исполь-
зованная вата утилизируется в соотв-
ствии с СанПиНом 2.1.3.684-21.

Срок годности 5 лет.
Форма выпуска: рулон.

АСКАЯ
хлопковая

Штрих-код

МАССА ВАТЫ 50 г

ГОД
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2021

НОМЕР ПАРТИИ 31



назначение: для
медицинских целей.

побочные действия:
аллергическая реакция на
продукты, из которых изготовлено
вату.

способ применения: вскрыть
упаковку по линии отреза и
использовать по назначению.


условия хранения: вата должна
храниться в складских помещениях
или стеллажах в

соответствии с правилами пожарной
безопасности в условиях,
предотвращающих воздействие
атмосферных осадков и почвенной
влаги.

Условия утилизации: использованная
вата утилизируется в соответствии
с СанПиНом 2.1.3684-21.

Срок годности 5 лет.

Форма выпуска: рулон



БАТА МЕДИЦИНСКАЯ

эндоскопическая • хирургическая • хлопковая
НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ГОСТ 5556-81.
ПУ № ОТ

ООО «Мирахофф».

рф, 170039, Тверская обл., г. Тверь,
проезд Стеклопластик, д. 5.

Тел. 8 (800) 777-75-75,

e-mail: mirahoff@mail.ru



Состав: 100 % хлопок.

Назначение: для применения в
больничных, амбулаторных и
домашних условиях при
наложении повязок, компрессов,
при обработке кожных покровов. Не
предназначена для обработки
раневых поверхностей.

Противопоказания к применению:
индивидуальная непереносимость
материалов, из которых изготовлено
изделие.

Показания к применению:
медицинских целей.

Возможные побочные действия:
аллергическая реакция на
материалы, из которых изготовлено
изделие.

Способ применения:
упаковку по линии сгиба
применить по назначению.

Условия хранения: вата
храниться в складских помещениях
на поддонах или стеллах.

БАТА МЕДИЦИНСКАЯ
гигроскопическая • хирургическая • хлопковая
НЕСТЕРИЛЬНАЯ
по ГОСТ 5556-81.
РУ № от

 **ООО «Мирахофф».**

РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь,
проезд Стеклопластик, д. 5.
Тел. 8 (800) 777-75-75,
e-mail: mirahoff@mail.ru



Штрих-код

МАССА БАТЫ **50 г**

ГОД
ИЗГОТОВЛЕНИЯ **2021**

НОМЕР ПАРТИИ **31**

Состав: 100 % хлопок.

Назначение: для применения в
больничных, амбулаторных и
домашних условиях при
наложении повязок, компрессов,
при обработке кожных покровов. Не
предназначена для обработки
раневых поверхностей.

Противопоказания к применению:
индивидуальная непереносимость
материала, из которого изготовлена
батата.

Показания к применению: для
медицинских целей.

Возможные побочные действия:
аллергическая реакция на
материалы, из которых изготовлено
изделие.

Способ применения: вскрыть
упаковку по линии стреза и
применить по назначению.

Условия хранения: батата должна
храниться в складских помещениях
на поддонах или стеллажах в

соответствии с правилами пожарной
безопасности в условиях,
предотвращающих воздействие
атмосферных осадков и почвенной
влаги.

Условия утилизации: использованная
батата утилизируется в соответствии
с СанПиНом 2.1.3684-20.

Срок годности: 5 лет

Формы выпуска: рулон



БАТА МЕДИЦИНСКАЯ

гигроскопическая • хирургическая • хлопковая

НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ГОСТ 5556-81.

ПУ № от

Штрих-код

 ООО «Мирахофф».

РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь,

проезд Стеклопластик, д. 5.

Тел. 8 (800) 777-75-75,

e-mail: mirahoff@mail.ru



МАССА БАТЫ 100 г

ГОД
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2021

НОМЕР ПАРТИИ 37

Состав: 100 % хлопок

Назначение: для применения в
больничных, амбулаторных и
домашних условиях при
наложении повязок, компрессов,
при обработке кожных покровов. Не
предназначено для обработки
раневых поверхностей.

Противопоказания к применению:
индивидуальная непереносимость
материалов, из которых изготовлено
изделие.

Показания к применению: для
медицинских целей.

Возможные побочные действия:
аллергическая реакция на
материалы, из которых изготовлено
изделие.

Способ применения: вскрыть
упаковку по линии отреза и
применить по назначению.


Условия хранения: вата должна
храниться в складских помещениях
на поддонах или стеллажах в

соответствии с правилами пожарной
безопасности в условиях,
предотвращающих воздействие
атмосферных осадков и почвенной
влаги.

Условия утилизации: использованная
вата утилизируется в соответствии
с СанПиНом 2.1.3.684-21.

Срок годности 5 лет.

Форма выпуска: рулон.



БАТА МЕДИЦИНСКАЯ

гигроскопическая • хирургическая • хлопковая

НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ГОСТ 5556-81

ПУ № _____ от _____

Штрих-код

 ООО «Мирахофф».

РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь,
проезд Стеклопластик, д. 5.

Тел. 8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru



МАССА БАТЫ **250 г**

ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ **2021**

НОМЕР ПАРТИИ **49**

Состав: 100 % хлопок.

Назначение: для применения в
больничных, амбулаторных и домашних
условиях при наложении повязок,
компрессов, при обработке кожных
покровов. Не предназначена для
обработки раневых поверхностей.

Противопоказания к применению:
индивидуальная непереносимость
материалов, из которых изготовлено
изделие.

Показания к применению: для
медицинских целей.

Возможные побочные действия:
аллергическая реакция на материалы,
из которых изготовлено изделие.

Способ применения: вскрыть упаковку
по линии отреза и применить по
назначению.


Условия хранения: вата должна
храниться в складских помещениях на
поддонах или стеллажах в соответствии

с правилами пожарной безопасности
в условиях, предотвращающих
воздействие атмосферных осадков и
почвенной влаги.

Условия утилизации: использованная
вата утилизируется в соответствии с
СанПиНом 21.3684-21.

Срок годности 5 лет.

Форма выпуска: рулон.



БАТА МЕДИЦИНСКАЯ
гигроскопическая • хирургическая • хлопковая
НЕСТЕРИЛЬНАЯ • ЗИГЗАГ
по ГОСТ 5556-81
ПУ № _____ от _____

Штрих-код

ООО «Мираhoff».

РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь,
проезд Стеклопластик, д. 5
Тел: 8 (800) 777-75-75,
e-mail: mirahoff@mail.ru



МАССА БАТЫ **50 г**

ГОД
ИЗГОТОВЛЕНИЯ **2021**

НОМЕР ПАРТИИ **191**

Состав: 100% хлопок.

Назначение: для применения в
больничных, амбулаторных и
домашних условиях при
наложении повязок, компрессов,
при обработке раневой поверхности.
Не предназначена для обработки
раневых поверхностей.

Противопоказания к применению:
индивидуальная непереносимость
материалов, из которых изготовлено
изделие.

Показания к применению: для
медикаментозной обработки.

Возможные побочные действия:
аллергическая реакция на
материалы, из которых изготовлено
изделие.

Способ применения: вскрыть
упаковку по линии отреза и
применить по назначению.

Условия хранения: вата должна
храниться в складках, помещенная
на подложку или стеклопластик в

соответствии с правилами пожарной
безопасности в условиях
предотвращения воздействия
атмосферных осадков и почвенной
влаги.

Условия утилизации: использованная
вата утилизируется в соответствии
с СанПином 2.1.3.694-21.

Срок годности 5 лет.

Форма выпуска:
изготовленная в
лента.



БАТА МЕДИЦИНСКАЯ

гигроскопическая • хирургическая • хлопковая

НЕСТЕРИЛЬНАЯ • ЗИГЗАГ

по ГОСТ 5556-81

РУ № от

Штрих-код

ООО «Мирахофф».

р/о, 170039, Тверская обл., г. Тверь,

проезд Стеклопластик, д. 5.

Тел. 8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru



МАССА БАТЫ 100 г

ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2021

НОМЕР ПАРТИИ 193

Состав: 100% хлопок.

Назначение: для применения в
больничных, амбулаторных и домашних
условиях при наложении повязок,
компрессов, при обработке кожных
поверхностей. Не предназначена для
обработки раневых поверхностей.

Противопоказания к применению:
индивидуальная непереносимость
материалов, из которых изготовлено
изделие.

Показания к применению: для
медицинских целей.

Возможные побочные действия:
аллергическая реакция на материалы,
из которых изготовлено изделие.

Способ применения: вскрыть упаковку
по линии отреза и применить по
назначению.

Условия хранения: вата должна
храниться в складских помещениях на
поддонах или стеллажах в соответствии

с правилами пожарной безопасности
в условиях, предотвращающих
воздействие окислительных средов и
повышенной влаги.

Условия утилизации: использованная
вата утилизируется в соответствии с
СанПиНом 2.1.3.684-21.

Срок годности 5 лет.

Форма выпуска:
зигзагообразная лента.



БАТА МЕДИЦИНСКАЯ

гигроскопическая • хирургическая • хлопковая

НЕСТЕРИЛЬНАЯ • ЗИГЗАГ

по ГОСТ 5556-81.

РУ № _____

от _____

Штрих-код

ООО «Мирахофф»

РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь,

проезд Стеклопластик, д. 5.

Тел. 8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru



МАССА БАТЫ 250 г

ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2021

НОМЕР ПАРТИИ 197

Состав: 100% хлопок.

Назначение: для применения в
больничных, амбулаторных и домашних
условиях при наложении повязок,
контроле, при обработке раневых
поверхностей. Не предназначена для
обработанных поверхностей.

Противопоказания и примечания:
индивидуальная непереносимость
материалов, из которых изготовлено
изделие.

Показания к применению: для
хирургических целей.

Возможные побочные действия:
аллергическая реакция на материалы,
из которых изготовлено изделие.

Способ применения: вскрыть упаковку
по линии отреза и применить по
назначению.

Условия хранения: вата должна
храниться в упаковке, помещенной на
холодильник или в холодильнике.

с проведением кожной пробы на
чувствительность, проведение кожной
испытательной пробы, проведение
кожной пробы.

Условия использования: использовать
вату утилизировать в соответствии с
СанПиНом 2.1.3.694-21.

Срок годности 5 лет.

Форма выпуска:
в индивидуальной упаковке.



БАТА МЕДИЦИНСКАЯ

гигроскопическая • хирургическая • хлопковая

НЕСТЕРИЛЬНАЯ • ЗИГЗАГ

по ГОСТ 5556-81.

РУ № _____ ОТ _____

Штрих-код

 ООО «Мирахофф».

РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь,
проезд Стеклопластик, д. 5.

Тел. 8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru



МАССА БАТЫ **250 г**

ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ **2021**

НОМЕР ПАРТИИ **197**

Состав: 100 % хлопок.

Назначение: для применения в
больничных, амбулаторных и домашних
условиях при наложении повязок,
компрессов, при обработке кожных
покровов. Не предназначена для
обработки раневых поверхностей.

Противопоказания к применению:
индивидуальная непереносимость
материалов, из которых изготовлено
изделие.

Показания к применению: для
медицинских целей.

Возможные побочные действия:
аллергическая реакция на материалы,
из которых изготовлено изделие.

Способ применения: вскрыть упаковку
по линии отреза и применить по
назначению.


Условия хранения: вата должна
храниться в складских помещениях на
поддонах или стеллажах в соответствии


с правилами пожарной безопасности
в условиях, предотвращающих
воздействие атмосферных осадков и
почвенной влаги.


Условия утилизации: использованная
вата утилизируется в соответствии с
СанПиНом 2.1.3684-21.

Срок годности 5 лет.

Форма выпуска:
зигзагообразная лента.



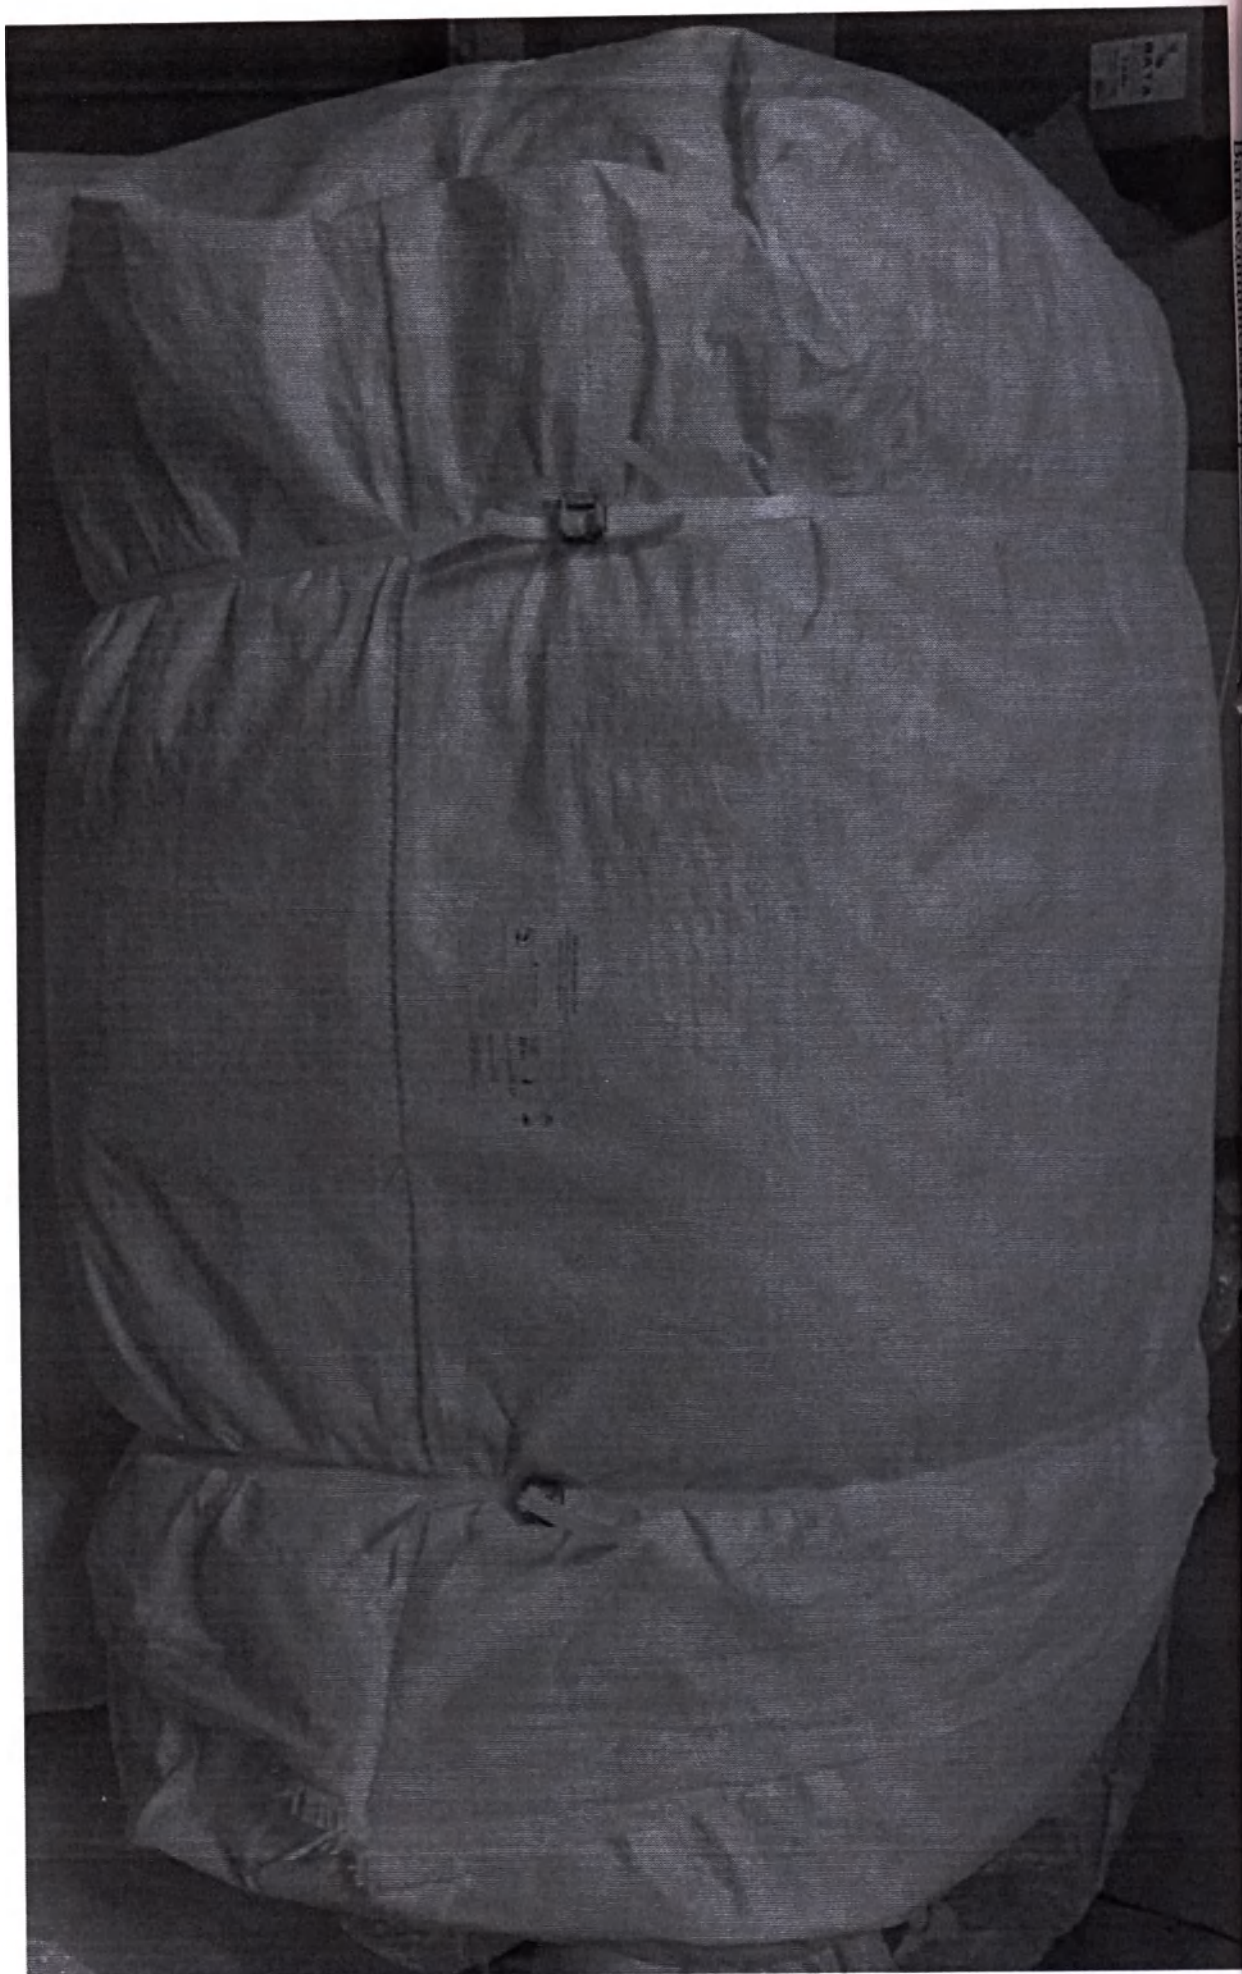

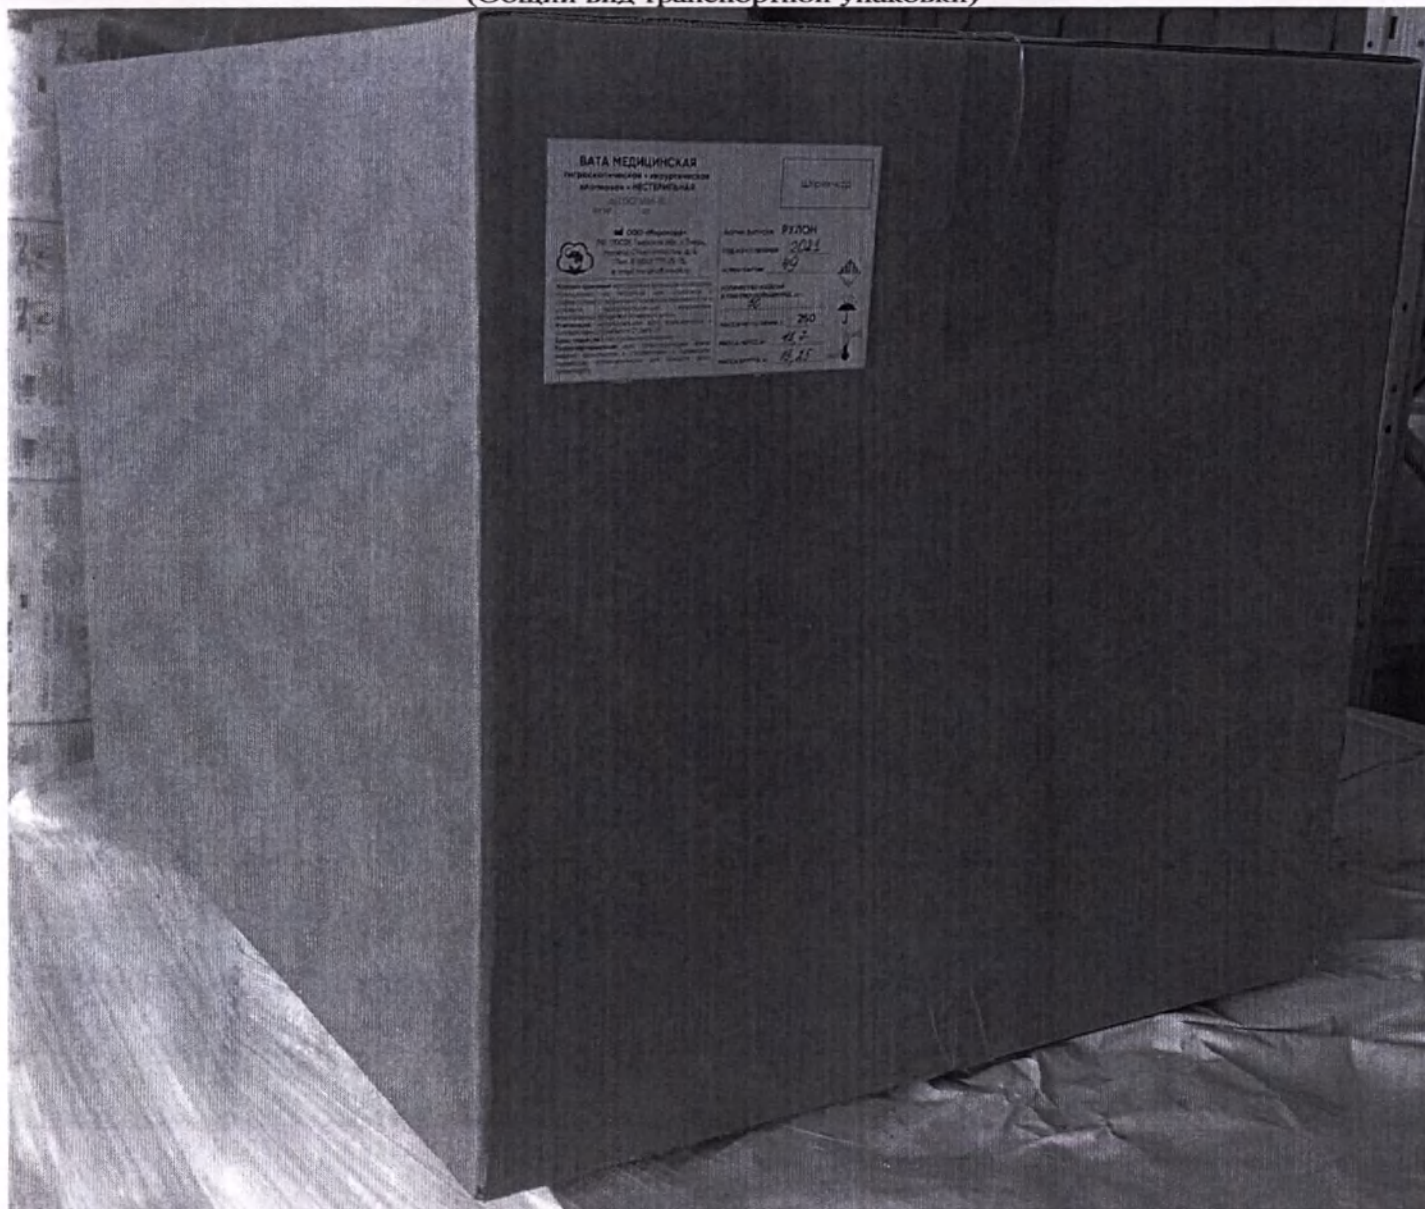

БАТА МЕДИЦИНСКАЯ
гигроскопическая • хирургическая
хлопковая • НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ГОСТ 5556-81.

РУ № _____ от _____



ООО «Мирахофф».

РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь,
проезд Стеклопластик, д. 5.

Тел. 8 (800) 777-75-75,

e-mail: mirahoff@mail.ru


Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги.

Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21.

Срок годности 5 лет с даты изготовления.

Транспортирование: вату транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, установленными для каждого вида транспорта.

Штрих-код

ФОРМА ВЫПУСКА: **РУЛОН**ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ **2021**НОМЕР ПАРТИИ **49**КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ
В УПАКОВОЧНОЙ ЕДИНИЦЕ, шт.: **50**МАССА НЕТТО ПАЧКИ, г. **250**МАССА НЕТТО, кг. **12,7**МАССА БРУТТО, кг. **13,25**

БАТА МЕДИЦИНСКАЯ
гигроскопическая • хирургическая
хлопковая • НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ГОСТ 5556-81.
РУ № ОТ



 **ООО «Мирахофф».**

РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь,
проезд Стеклопластик, д. 5.
Тел. 8 (800) 777-75-75,
e-mail: mirahoff@mail.ru

Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги.

Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21.

Срок годности 5 лет с даты изготовления.

Транспортирование: вату транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, установленными для каждого вида транспорта.

МАССА ВАТЫ
20 кг

Штрих-код


ФОРМА ВЫПУСКА: **КИПА**

ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ **2021**

НОМЕР ПАРТИИ **001**

МАССА НЕТТО, кг. **20,0**

МАССА БРУТТО, кг. **21,9**



7/



БАТА МЕДИЦИНСКАЯ
гигроскопическая • хирургическая
хлопковая • НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ГОСТ 5556-81.
РУ № ОТ



 **ООО «Мирахофф».**
РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь,
проезд Стеклопластик, д. 5.
Тел. 8 (800) 777-75-75,
e-mail: mirahoff@mail.ru

Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги.

Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21.

Срок годности 5 лет с даты изготовления.

Транспортирование: вату транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, установленными для каждого вида транспорта.

МАССА БАТЫ

30 кг

Штрих-код


ФОРМА ВЫПУСКА: **КИПА**

ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2021

НОМЕР ПАРТИИ 004

МАССА НЕТТО, кг. 30,0

МАССА БРУТТО, кг. 31,9



5/



БАТА МЕДИЦИНСКАЯ
гигроскопическая • хирургическая
хлопковая • НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ГОСТ 5556-81.
РУ № ОТ

МАССА БАТЫ
40 кг

Штрих-код



 **ООО «Мирахофф».**

РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь,
проезд Стеклопластик, д. 5.
Тел. 8 (800) 777-75-75,
e-mail: mirahoff@mail.ru

ФОРМА ВЫПУСКА: **КИПА**

ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2021

НОМЕР ПАРТИИ 007

МАССА НЕТТО, кг. 40,0


МАССА БРУТТО, кг. 42,2

Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги.

Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21.

Срок годности 5 лет с даты изготовления.

Транспортирование: вату транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, установленными для каждого вида транспорта.





БАТА МЕДИЦИНСКАЯ
гигроскопическая • хирургическая
хлопковая • НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ГОСТ 5556-81.
РУ № ОТ



 **ООО «Мирахофф».**

РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь,
проезд Стеклопластик, д. 5.
Тел. 8 (800) 777-75-75,
e-mail: mirahoff@mail.ru

Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги.

Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21.

Срок годности 5 лет с даты изготовления.

Транспортирование: вату транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, установленными для каждого вида транспорта.

МАССА БАТЫ

50 кг

Штрих-код


ФОРМА ВЫПУСКА: **КИПА**


ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ **2021**

НОМЕР ПАРТИИ **009**

МАССА НЕТТО, кг. **50,0**

МАССА БРУТТО, кг. **51,8**



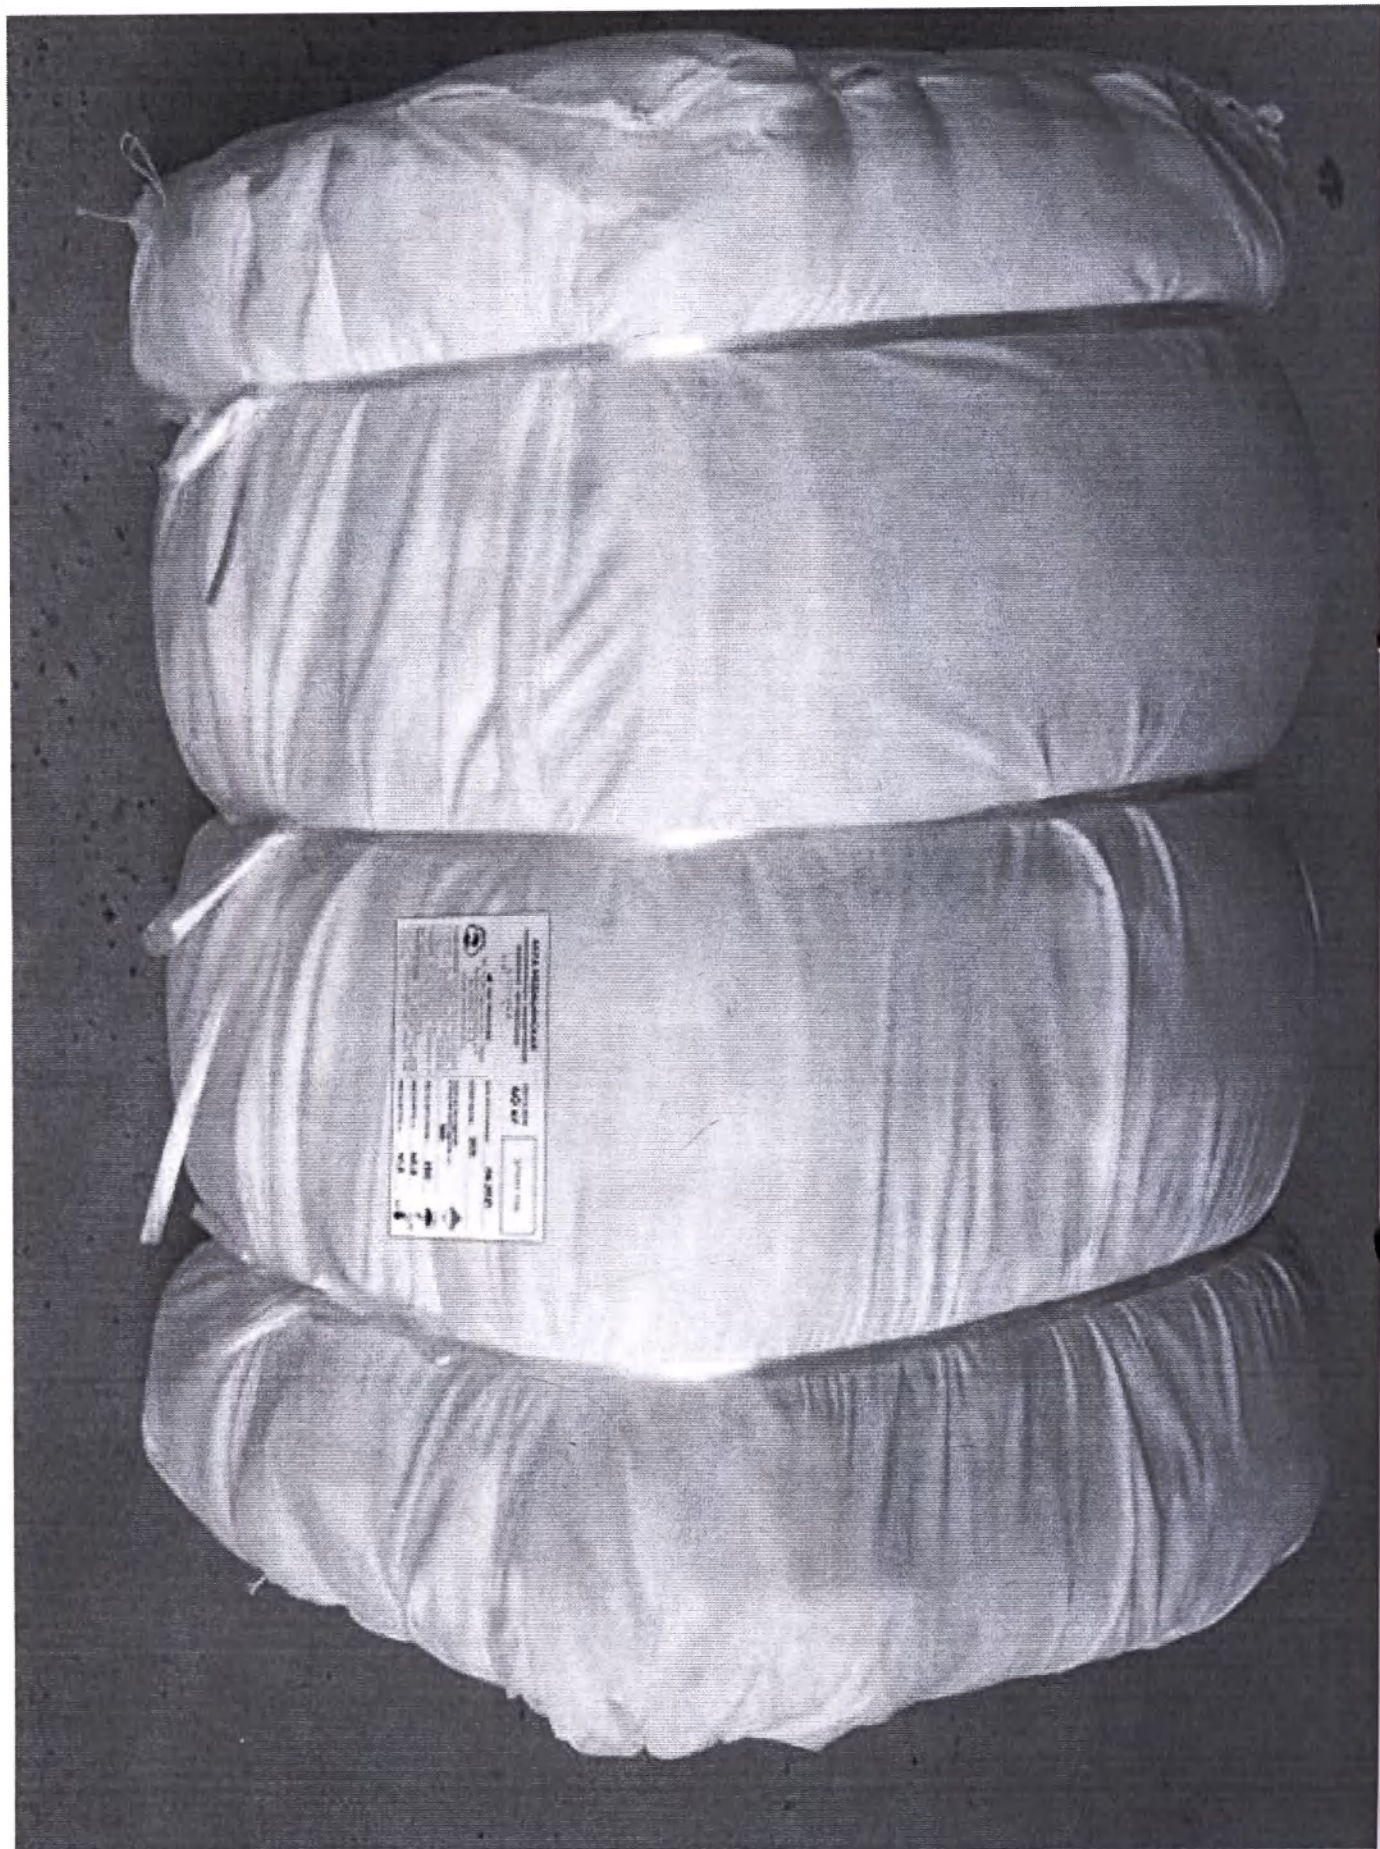

БАТА МЕДИЦИНСКАЯ
гигроскопическая • хирургическая
хлопковая • НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ГОСТ 5556-81.
РУ № от



 **ООО «Мирахофф».**

РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь,
проезд Стеклопластик, д. 5.
Тел. 8 (800) 777-75-75,
e-mail: mirahoff@mail.ru

Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги.

Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21.

Срок годности 5 лет с даты изготовления.

Транспортирование: вату транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, установленными для каждого вида транспорта.

МАССА БАТЫ
30 кг

Штрих-код

ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ

2021

НОМЕР ПАРТИИ

217

КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ
В УПАКОВОЧНОЙ ЕДИНИЦЕ, шт.:

120

МАССА НЕТТО ПАЧКИ, г.

250


МАССА НЕТТО, кг.

30,4

МАССА БРУТТО, кг.

32,1



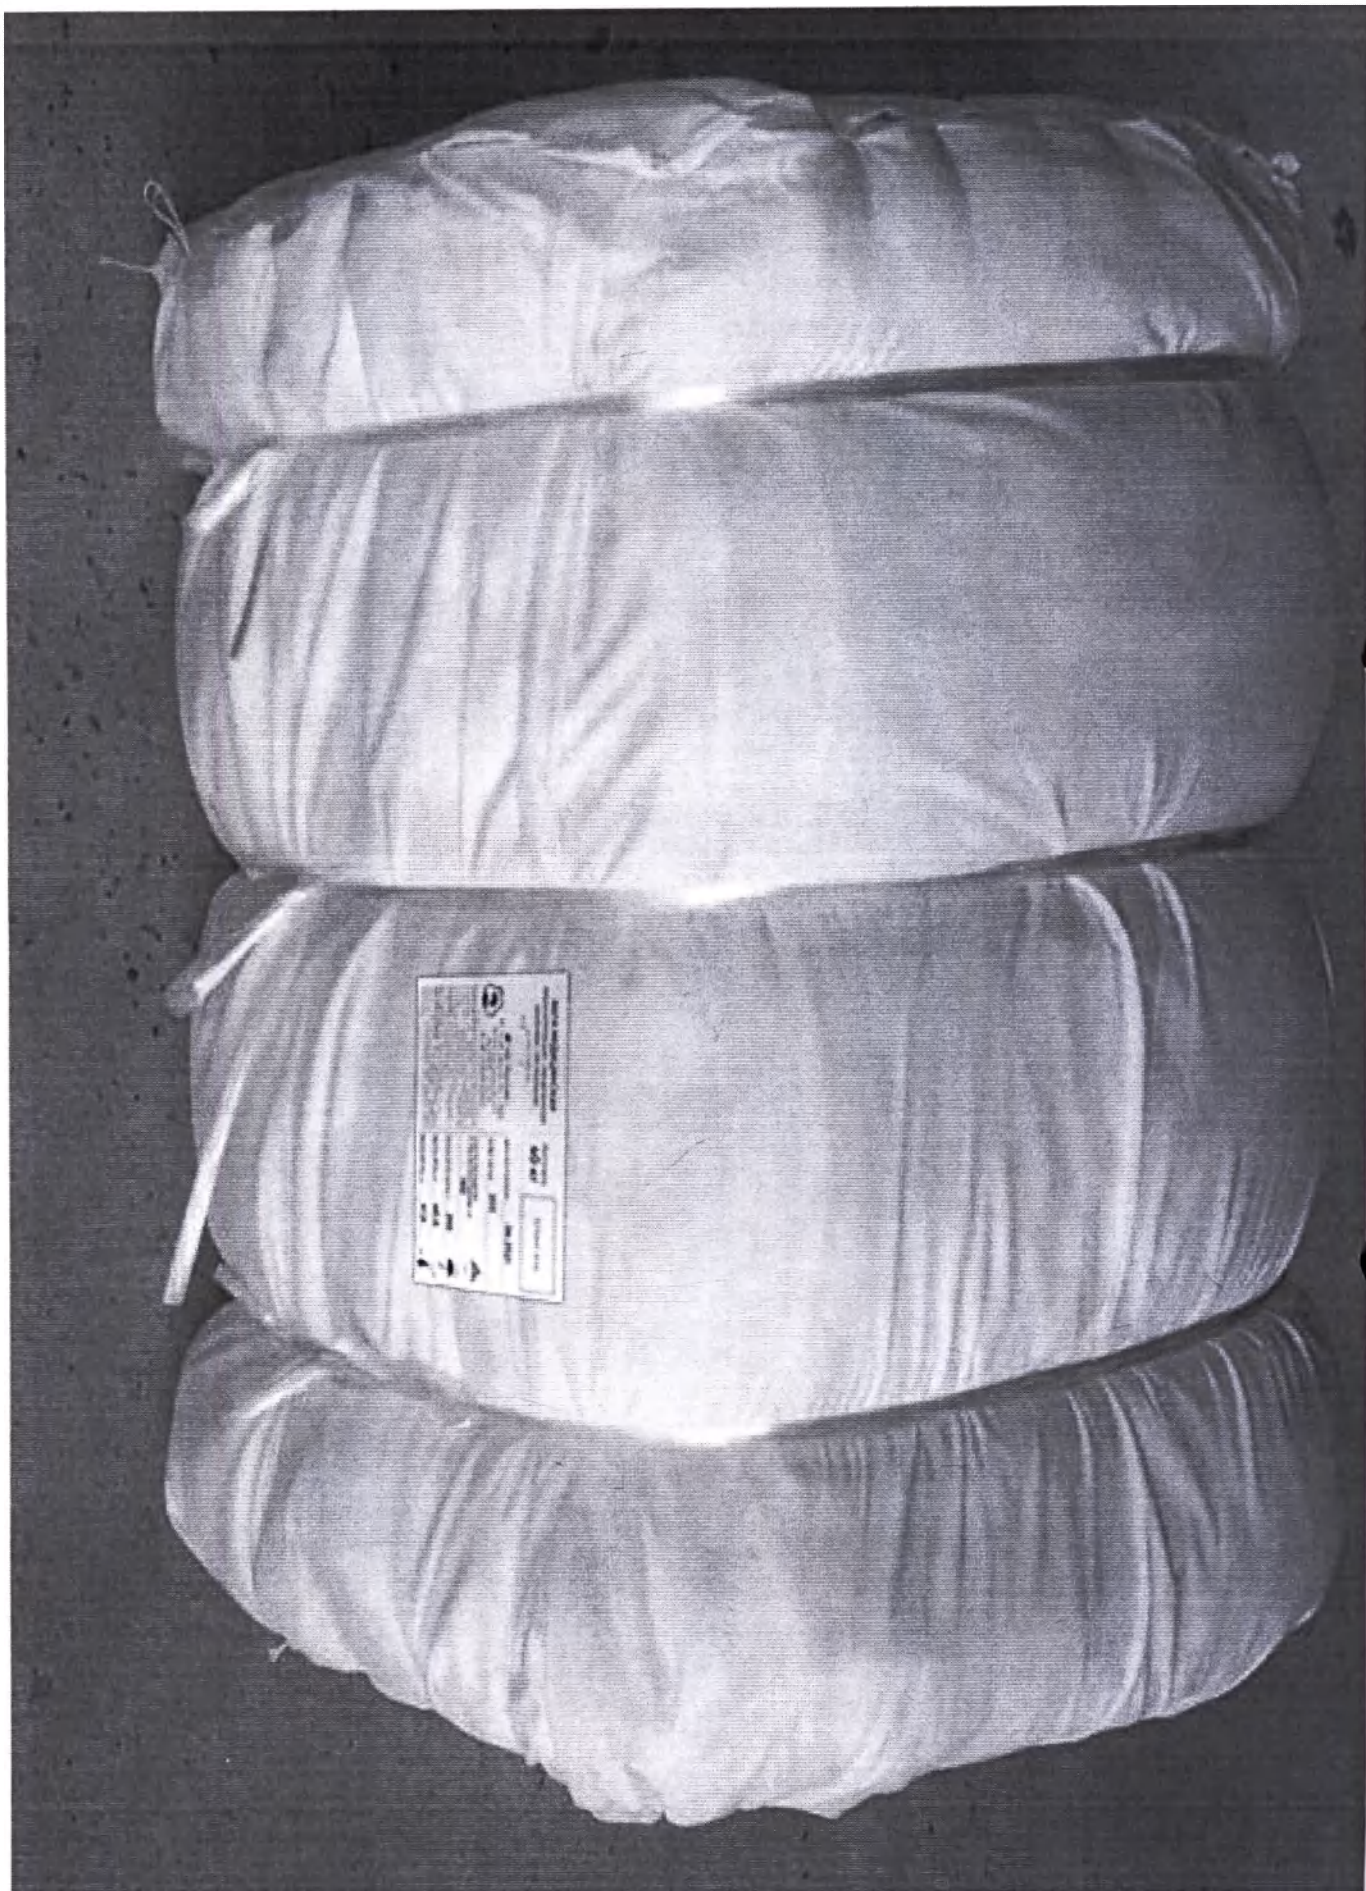

БАТА МЕДИЦИНСКАЯ
гигроскопическая • хирургическая
хлопковая • НЕСТЕРИЛЬНАЯ

по ГОСТ 5556-81.
РУ № ОТ



ООО «Мирахофф».
РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь,
проезд Стеклопластик, д. 5.
Тел. 8 (800) 777-75-75,
e-mail: mirahoff@mail.ru

Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги.
Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21.
Срок годности 5 лет с даты изготовления.
Транспортирование: вату транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, установленными для каждого вида транспорта.

МАССА БАТЫ

40 кг

Штрих-код

ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2021

НОМЕР ПАРТИИ 203


КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ
В УПАКОВОЧНОЙ ЕДИНИЦЕ, шт.:

160

МАССА НЕТТО ПАЧКИ, г. 250


МАССА НЕТТО, кг. 40,0

МАССА БРУТТО, кг. 41,5



БАТА МЕДИЦИНСКАЯ
гигроскопическая • хирургическая
хлопковая • нестерильная

по ГОСТ 5556-81.
ПУ № _____ от _____



ООО «Мирахофф».
РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь,
проезд Стеклопластик, д. 5.
Тел. 8 (800) 777-75-75,
e-mail: mirahoff@mail.ru

Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги.

Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 21.3684-21.

Срок годности 5 лет с даты изготовления.

**КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ
В УПАКОВОЧНОЙ ЕДИНИЦЕ, шт.:**

160

МАССА ВАТЫ, г.

250

ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ

2021

НОМЕР ПАРТИИ

203

ШТАМП ОТК ИЛИ НОМЕР КОНТРОЛЕРА

N2

окировка для потребительской упаковки:

а медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81

№ _____ от _____

кса ваты _____ г.

ма выпуска: рулон/зигзагообразная лента/кипа

ГЗАГ» (для ваты в виде зигзагообразной ленты)

ООО «Мирахофф». РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь, проезд Стеклопластик, д. 5.
8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru

назначение: для применения в больничных, амбулаторных и домашних условиях при наложении
язок, компрессов, при обработке кожных покровов. Не предназначена для обработки раневых
ерхностей.

отивопоказания к применению:

дивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие.

казания к применению: для медицинских целей.

можные побочные действия:

аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие

особ применения: вскрыть упаковку по линии отреза и применить по назначению.

став: 100 % хлопок.

словия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в
ответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие
иосферных осадков и почвенной влаги.

илизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21.

д изготовления _____

мер партии _____

ок годности 5 лет с даты изготовления.

мволы на упаковке:



афическое изображение:

мволы на упаковке:



Штрих-код

формация на ярлыке, вкладываемого во внутрь ящика, мешка или цилиндрической кипы:

а медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81

ичество изделий в упаковочной единице: _____

са ваты, _____ г,

№ _____ от _____

ООО «Мирахофф». РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь, проезд Стеклопластик, д. 5.
8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru

овия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в
ответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие
осферных осадков и почвенной влаги.

утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21.

изготовления _____

мер партии _____

ок годности 5 лет с даты изготовления.

мволы на упаковке:



амп ОТК или номер контролера

Маркировка для транспортной упаковки:

1 медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81

№ _____ от _____

Количество изделий в упаковочной единице: _____

Масса нетто пачки, _____ г,

Масса нетто и брутто, _____ кг,

Дата выпуска _____

ГЗАОГ» (для ваты в виде зигзагообразной ленты)

ООО «Мирахофф». РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь, проезд Стеклопластик, д. 5.
8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru

Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги.

Транспортирование: вату транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, установленными для каждого вида транспорта.


Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21.

Дата изготовления _____

Номер партии _____

Срок годности 5 лет с даты изготовления.


Символы на упаковке:



Штрих-код

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 80 (тридцать)
_____ листа(ов).

Генеральный директор
ООО «Мирахофф»

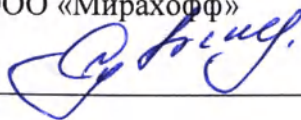

Суворова Н. В.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Мирахофф»

Суворова И. В.

«14» февраля 2022 г.



Макеты этикеток медицинского изделия:

**Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая
нестерильная по ГОСТ 5556-81**

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная

по ГОСТ 5556-81:

- в рулонах массой 25 г, 50 г, 100 г, 250 г;
- спрессованная в кипы по 20 кг, 30 кг, 40 кг, 50 кг;
- в виде зигзагообразной ленты массой 50 г, 100 г, 250 г.

Индивидуальная упаковка

1.1. Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81 в рулонах массой 25 г.

БАТА МЕДИЦИНСКАЯ гигроскопическая • хирургическая • хлопковая НЕСТЕРИЛЬНАЯ по ГОСТ 5556-81. РУ № _____ от _____		Штрих-код
 ООО «Мирахофф». РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь, проезд Стеклопластик, д. 5. Тел. 8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru		
		МАССА БАТЫ 25 г ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____ НОМЕР ПАРТИИ _____
Состав: 100 % хлопок. Назначение: для применения в больничных, амбулаторных и домашних условиях при наложении повязок, компрессов, при обработке кожных покровов. Не предназначена для обработки рваных поверхностей. Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Показания к применению: для медицинских целей. Возможные побочные действия: аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие. Способ применения: вскрыть упаковку по линии отреза и применить по назначению. Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги. Условия утилизации: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.36.84-21. Срок годности 5 лет. Форма выпуска: рулон. 		

1.2 Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81 в рулонах массой 50 г.

БАТА МЕДИЦИНСКАЯ гигроскопическая • хирургическая • хлопковая НЕСТЕРИЛЬНАЯ по ГОСТ 5556-81. РУ № _____ от _____		Штрих-код
 ООО «Мирахофф». РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь, проезд Стеклопластик, д. 5. Тел. 8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru		
		МАССА БАТЫ 50 г ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____ НОМЕР ПАРТИИ _____
Состав: 100 % хлопок. Назначение: для применения в больничных, амбулаторных и домашних условиях при наложении повязок, компрессов, при обработке кожных покровов. Не предназначена для обработки рваных поверхностей. Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Показания к применению: для медицинских целей. Возможные побочные действия: аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие. Способ применения: вскрыть упаковку по линии отреза и применить по назначению. Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги. Условия утилизации: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.36.84-21. Срок годности 5 лет. Форма выпуска: рулон. 		

1.3 Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81 в рулонах массой 100 г.

БАТА МЕДИЦИНСКАЯ гигроскопическая • хирургическая • хлопковая НЕСТЕРИЛЬНАЯ по ГОСТ 5556-81, РУ № _____ от _____		Штрих-код
ООО «Мирахофф». РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь, проезд Стеклопластик, д. 5. Тел. 8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru		
		МАССА БАТЫ 100 г ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____ НОМЕР ПАРТИИ _____
Состав: 100 % хлопок. Назначение: для применения в больничных, амбулаторных и домашних условиях при наложении повязок, компрессов, при обработке кожных покровов. Не предназначена для обработки раневых поверхностей. Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Показания к применению: для медицинских целей. Возможные побочные действия: аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие. Способ применения: вскрыть упаковку по линии отреза и применить по назначению. Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги. Условия утилизации: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.36.84-21. Срок годности 5 лет. Форма выпуска: рулон.		

1.4 Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81 в рулонах массой 250 г.

БАТА МЕДИЦИНСКАЯ гигроскопическая • хирургическая • хлопковая НЕСТЕРИЛЬНАЯ по ГОСТ 5556-81, РУ № _____ от _____		Штрих-код
ООО «Мирахофф». РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь, проезд Стеклопластик, д. 5. Тел. 8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru		
		МАССА БАТЫ 250 г ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____ НОМЕР ПАРТИИ _____
Состав: 100 % хлопок. Назначение: для применения в больничных, амбулаторных и домашних условиях при наложении повязок, компрессов, при обработке кожных покровов. Не предназначена для обработки раневых поверхностей. Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Показания к применению: для медицинских целей. Возможные побочные действия: аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие. Способ применения: вскрыть упаковку по линии отреза и применить по назначению. Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги. Условия утилизации: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.36.84-21. Срок годности 5 лет. Форма выпуска: рулон.		

1.5 Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81 в виде зигзагообразной ленты массой 50 г.

БАТА МЕДИЦИНСКАЯ гигроскопическая • хирургическая • хлопковая НЕСТЕРИЛЬНАЯ • ЗИГЗАГ по ГОСТ 5556-81. ру № _____ от _____		Штрих-код
 ООО «Мирахофф». РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь, проезд Стеклопластик, д. 5. Тел. 8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru	МАССА БАТЫ 50 г ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____ НОМЕР ПАРТИИ _____	
Состав: 100 % хлопок. Назначение: для применения в больничных, амбулаторных и домашних условиях при наложении повязок, компрессов, при обработке кожных покровов. Не предназначена для обработки раневых поверхностей. Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Показания к применению: для медицинского целей. Возможные побочные действия: аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие. Способ применения: вскрыть упаковку по линии отреза и применить по назначению. Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги. Условия утилизации: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.36.84-21. Срок годности: 5 лет. Форма выпуска: зигзагообразная лента.		

1.6 Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81 в виде зигзагообразной ленты массой 100 г.

БАТА МЕДИЦИНСКАЯ гигроскопическая • хирургическая • хлопковая НЕСТЕРИЛЬНАЯ • ЗИГЗАГ по ГОСТ 5556-81. ру № _____ от _____		Штрих-код
 ООО «Мирахофф». РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь, проезд Стеклопластик, д. 5. Тел. 8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru	МАССА БАТЫ 100 г ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____ НОМЕР ПАРТИИ _____	
Состав: 100 % хлопок. Назначение: для применения в больничных, амбулаторных и домашних условиях при наложении повязок, компрессов, при обработке кожных покровов. Не предназначена для обработки раневых поверхностей. Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Показания к применению: для медицинского целей. Возможные побочные действия: аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие. Способ применения: вскрыть упаковку по линии отреза и применить по назначению. Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги. Условия утилизации: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.36.84-21. Срок годности: 5 лет. Форма выпуска: зигзагообразная лента.		

1.7 Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81 в виде зигзагообразной ленты массой 250 г.


БАТА МЕДИЦИНСКАЯ гигроскопическая • хирургическая • хлопковая НЕСТЕРИЛЬНАЯ • ЗИГЗАГ по ГОСТ 5556-81. РУ № _____ от _____		Штрих-код
 ООО «Мирахофф». РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь, проезд Стеклопластик, д. 5. Тел. 8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru	МАССА БАТЫ 250 г ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____ НОМЕР ПАРТИИ _____	
Состав: 100 % хлопок. Назначение: для применения в больничных, амбулаторных и домашних условиях при наложении повязок, компрессов, при обработке кожных покровов. Не предназначена для обработки раневых поверхностей. Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Показания к применению: для медицинского целей. Возможные побочные действия: аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие. Способ применения: вскрыть упаковку по линии отреза и применить по назначению. Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги. Условия утилизации: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21. Срок годности: 5 лет. Форма выпуска: зигзагообразная лента.		

Упаковка в кипы.


2.1 Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81 спрессованная в кипу 20 кг.

БАТА МЕДИЦИНСКАЯ гигроскопическая • хирургическая хлопковая • НЕСТЕРИЛЬНАЯ по ГОСТ 5556-81. РУ № _____ от _____		Штрих-код
 ООО «Мирахофф». РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь, проезд Стеклопластик, д. 5. Тел. 8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru	МАССА БАТЫ 20 кг ФОРМА ВЫПУСКА: КИПА ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____ НОМЕР ПАРТИИ _____ МАССА НЕТТО, кг. _____ МАССА БРУТТО, кг. _____	
Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги. Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21. Срок годности: 5 лет с даты изготовления. Транспортирование: вату транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, установленными для каждого вида транспорта.		

2.2 Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81 спрессованная в кипу 30 кг.

БАТА МЕДИЦИНСКАЯ гигроскопическая • хирургическая хлопковая • НЕСТЕРИЛЬНАЯ по ГОСТ 5556-81, ПУ № _____ от _____  ООО «Мирахофф». РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь, проезд Стеклопластик, д. 5. Тел. 8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru	МАССА БАТЫ 30 кг	Штрих-код
Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги. Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21. Срок годности: 5 лет с даты изготовления. Транспортирование: вату транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, установленными для каждого вида транспорта.	ФОРМА ВЫПУСКА: КИПА ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____ НОМЕР ПАРТИИ _____ МАССА НЕТТО, кг. _____ МАССА БРУТТО, кг. _____	  

2.3 Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81 спрессованная в кипу 40 кг.

БАТА МЕДИЦИНСКАЯ гигроскопическая • хирургическая хлопковая • НЕСТЕРИЛЬНАЯ по ГОСТ 5556-81, ПУ № _____ от _____  ООО «Мирахофф». РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь, проезд Стеклопластик, д. 5. Тел. 8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru	МАССА БАТЫ 40 кг	Штрих-код
Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги. Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21. Срок годности: 5 лет с даты изготовления. Транспортирование: вату транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, установленными для каждого вида транспорта.	ФОРМА ВЫПУСКА: КИПА ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____ НОМЕР ПАРТИИ _____ МАССА НЕТТО, кг. _____ МАССА БРУТТО, кг. _____	  

2.4 Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81 спрессованная в кипу 50 кг.

БАТА МЕДИЦИНСКАЯ гигроскопическая • хирургическая хлопковая • НЕСТЕРИЛЬНАЯ по ГОСТ 5556-81. РУ № _____ от _____		МАССА БАТЫ 50 кг	Штрих-код
 ООО «Мирахофф». РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь, проезд Стеклопластик, д. 5. Тел. 8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru		ФОРМА ВЫПУСКА: КИПА ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____ НОМЕР ПАРТИИ _____ МАССА НЕТТО, кг. _____ МАССА БРУТТО, кг. _____	
Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги. Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21. Срок годности 5 лет с даты изготовления. Транспортирование: вату транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, установленными для каждого вида транспорта.			

2.5 Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81 в цилиндрической кипе 30 кг.

БАТА МЕДИЦИНСКАЯ гигроскопическая • хирургическая хлопковая • НЕСТЕРИЛЬНАЯ по ГОСТ 5556-81. РУ № _____ от _____		МАССА БАТЫ 30 кг	Штрих-код
 ООО «Мирахофф». РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь, проезд Стеклопластик, д. 5. Тел. 8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru		ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____ НОМЕР ПАРТИИ _____ КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВОЧНОЙ ЕДИНИЦЕ, шт.: _____ МАССА НЕТТО ПАЧКИ, г. _____ МАССА НЕТТО, кг. _____ МАССА БРУТТО, кг. _____	
Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги. Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21. Срок годности 5 лет с даты изготовления. Транспортирование: вату транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, установленными для каждого вида транспорта.			

2.6 Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81 в цилиндрической кипе 40 кг.

БАТА МЕДИЦИНСКАЯ гигроскопическая • хирургическая хлопковая • НЕСТЕРИЛЬНАЯ по ГОСТ 5556-81. РУ № _____ от _____		МАССА БАТЫ 40 кг	Штрих-код
 ООО «Мирахофф». РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь, проезд Стеклопластик, д. 5. Тел. 8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru		ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____ НОМЕР ПАРТИИ _____	
Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги. Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21. Срок годности 5 лет с даты изготовления. Транспортирование: вату транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, установленными для каждого вида транспорта.		КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВОЧНОЙ ЕДИНИЦЕ, шт.: _____ МАССА НЕТТО ПАЧКИ, г. _____ МАССА НЕТТО, кг. _____ МАССА БРУТТО, кг. _____	

2.7 Информация на ярлыке, вкладываемого во внутрь ящика, мешка или цилиндрической кипы.

БАТА МЕДИЦИНСКАЯ гигроскопическая • хирургическая хлопковая • нестерильная по ГОСТ 5556-81. РУ № _____ от _____		  	
 ООО «Мирахофф». РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь, проезд Стеклопластик, д. 5. Тел. 8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru		КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВОЧНОЙ ЕДИНИЦЕ, шт.: _____ МАССА БАТЫ, г. _____ ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____ НОМЕР ПАРТИИ _____ ШТАМП ОТК ИЛИ НОМЕР КОНТРОЛЕРА _____	
Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги. Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21. Срок годности 5 лет с даты изготовления.			

Транспортная упаковка.

3.1 Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81 в рулонах массой 25 г.

БАТА МЕДИЦИНСКАЯ гигроскопическая • хирургическая хлопковая • НЕСТЕРИЛЬНАЯ по ГОСТ 5556-81. РУ № _____ от _____		Штрих-код	
 ООО «Мирахофф». РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь, проезд Стеклопластик, д. 5. Тел. 8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru		ФОРМА ВЫПУСКА: РУЛОН ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____ НОМЕР ПАРТИИ _____ КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВОЧНОЙ ЕДИНИЦЕ, шт.: _____ МАССА НЕТТО ПАЧКИ, г. 25 МАССА НЕТТО, кг. _____ МАССА БРУТТО, кг. _____	
Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги. Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21. Срок годности 5 лет с даты изготовления. Транспортирование: вату транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, установленными для каждого вида транспорта.		  	

3.2 Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81 в рулонах массой 50 г.

БАТА МЕДИЦИНСКАЯ гигроскопическая • хирургическая хлопковая • НЕСТЕРИЛЬНАЯ по ГОСТ 5556-81. РУ № _____ от _____		Штрих-код	
 ООО «Мирахофф». РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь, проезд Стеклопластик, д. 5. Тел. 8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru		ФОРМА ВЫПУСКА: РУЛОН ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____ НОМЕР ПАРТИИ _____ КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВОЧНОЙ ЕДИНИЦЕ, шт.: _____ МАССА НЕТТО ПАЧКИ, г. 50 МАССА НЕТТО, кг. _____ МАССА БРУТТО, кг. _____	
Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги. Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21. Срок годности 5 лет с даты изготовления. Транспортирование: вату транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, установленными для каждого вида транспорта.		  	

3.3 Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81 в рулонах массой 100 г.

БАТА МЕДИЦИНСКАЯ гигроскопическая • хирургическая хлопковая • НЕСТЕРИЛЬНАЯ по ГОСТ 5556-81. РУ № _____ от _____		Штрих-код	
 ООО «Мирахофф». РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь, проезд Стеклопластик, д. 5. Тел. 8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru		ФОРМА ВЫПУСКА: РУЛОН	
Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги. Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21. Срок годности 5 лет с даты изготовления. Транспортирование: вату транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, установленными для каждого вида транспорта.		ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____ НОМЕР ПАРТИИ _____ КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВОЧНОЙ ЕДИНИЦЕ, шт.: _____ МАССА НЕТТО ПАЧКИ, г. 100 МАССА НЕТТО, кг. _____ МАССА БРУТТО, кг. _____	
		  	

3.4 Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81 в рулонах массой 250 г.

БАТА МЕДИЦИНСКАЯ гигроскопическая • хирургическая хлопковая • НЕСТЕРИЛЬНАЯ по ГОСТ 5556-81. РУ № _____ от _____		Штрих-код	
 ООО «Мирахофф». РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь, проезд Стеклопластик, д. 5. Тел. 8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru		ФОРМА ВЫПУСКА: РУЛОН	
Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги. Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21. Срок годности 5 лет с даты изготовления. Транспортирование: вату транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, установленными для каждого вида транспорта.		ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____ НОМЕР ПАРТИИ _____ КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВОЧНОЙ ЕДИНИЦЕ, шт.: _____ МАССА НЕТТО ПАЧКИ, г. 250 МАССА НЕТТО, кг. _____ МАССА БРУТТО, кг. _____	
		  	

3.5 Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81 в виде зигзагообразной ленты массой 50 г.

БАТА МЕДИЦИНСКАЯ гигроскопическая • хирургическая хлопковая • НЕСТЕРИЛЬНАЯ • ЗИГЗАГ по ГОСТ 5556-81. РУ № _____ от _____		Штрих-код	
 ООО «Мирахофф». РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь, проезд Стеклопластик, д. 5. Тел. 8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru		ФОРМА ВЫПУСКА: ЗИГЗАГООБРАЗНАЯ ЛЕНТА ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____ НОМЕР ПАРТИИ _____ КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВОЧНОЙ ЕДИНИЦЕ, шт.: _____ МАССА НЕТТО ПАЧКИ, г. 50 МАССА НЕТТО, кг. _____ МАССА БРУТТО, кг. _____	
Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги. Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.36.84-21. Срок годности 5 лет с даты изготовления. Транспортирование: вату транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, установленными для каждого вида транспорта.		  	


3.6 Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81 в виде зигзагообразной ленты массой 100 г.

БАТА МЕДИЦИНСКАЯ гигроскопическая • хирургическая хлопковая • НЕСТЕРИЛЬНАЯ • ЗИГЗАГ по ГОСТ 5556-81. РУ № _____ от _____		Штрих-код	
 ООО «Мирахофф». РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь, проезд Стеклопластик, д. 5. Тел. 8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru		ФОРМА ВЫПУСКА: ЗИГЗАГООБРАЗНАЯ ЛЕНТА ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____ НОМЕР ПАРТИИ _____ КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВОЧНОЙ ЕДИНИЦЕ, шт.: _____ МАССА НЕТТО ПАЧКИ, г. 100 МАССА НЕТТО, кг. _____ МАССА БРУТТО, кг. _____	
Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги. Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.36.84-21. Срок годности 5 лет с даты изготовления. Транспортирование: вату транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, установленными для каждого вида транспорта.		  	

3.7 Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81 в виде зигзагообразной ленты массой 250 г.


БАТА МЕДИЦИНСКАЯ гигроскопическая • хирургическая хлопковая • НЕСТЕРИЛЬНАЯ • ЗИГЗАГ по ГОСТ 5556-81. РУ № _____ от _____		Штрих-код	
	ООО «Мирахофф». РФ, 170039, Тверская обл., г. Тверь, проезд Стеклопластик, д. 5. Тел. 8 (800) 777-75-75, e-mail: mirahoff@mail.ru	ФОРМА ВЫПУСКА: ЗИГЗАГООБРАЗНАЯ ЛЕНТА	
	Условия хранения: вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги. Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21. Срок годности 5 лет с даты изготовления. Транспортирование: вату транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, установленными для каждого вида транспорта.	ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____ НОМЕР ПАРТИИ _____ КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВОЧНОЙ ЕДИНИЦЕ, шт.: _____ МАССА НЕТТО ПАЧКИ, г. 250 МАССА НЕТТО, кг. _____ МАССА БРУТТО, кг. _____	





Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 12 двенадцать
_____ листа(ов).

Генеральный директор
ООО «Мирахофф»



Суворова И. В.

