

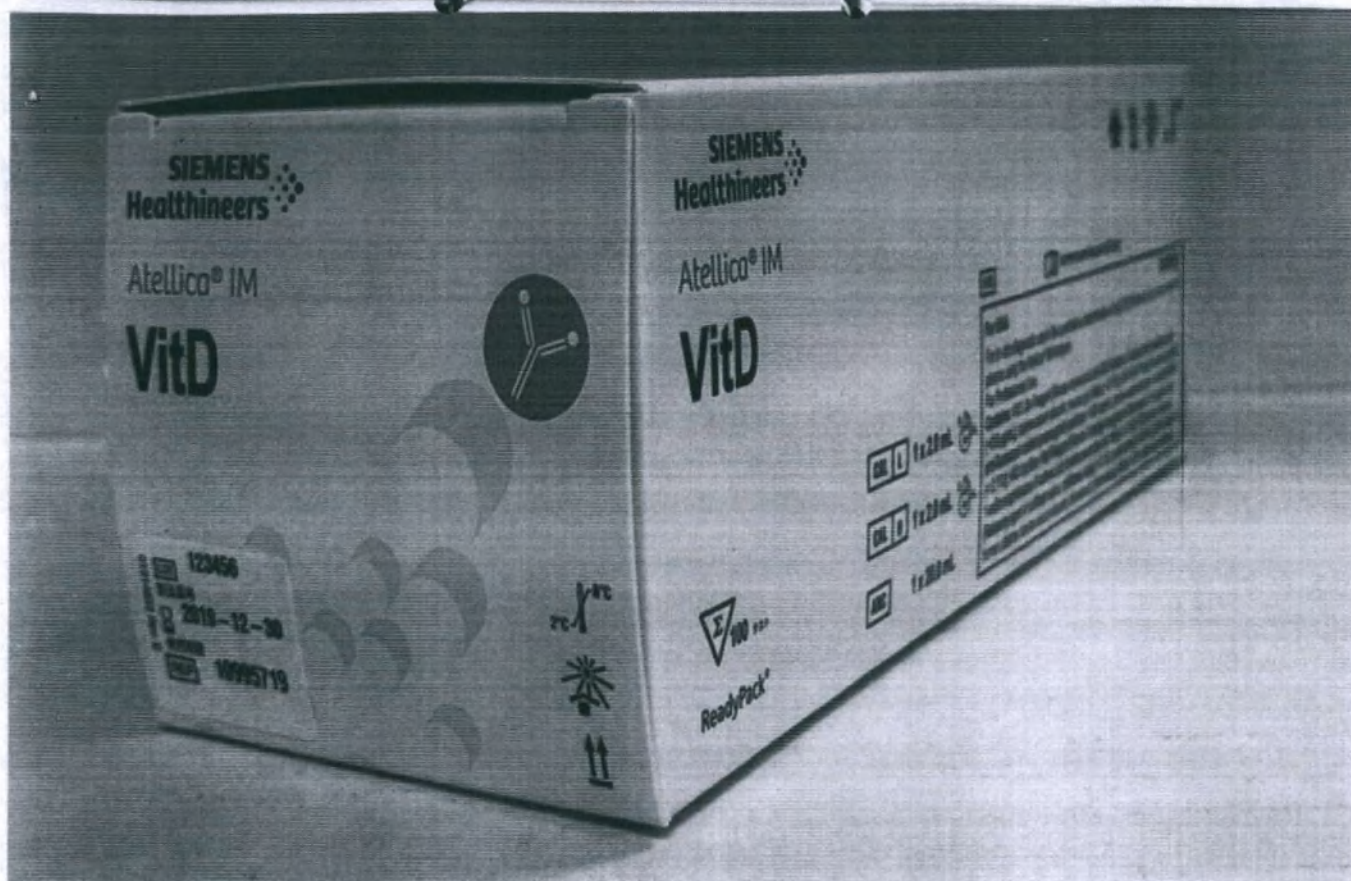


Рисунок 1. Набор реагентов для определения общего витамина D на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin D Total (Atellica IM VitD)): Фасовка 100 тестов. Общий вид

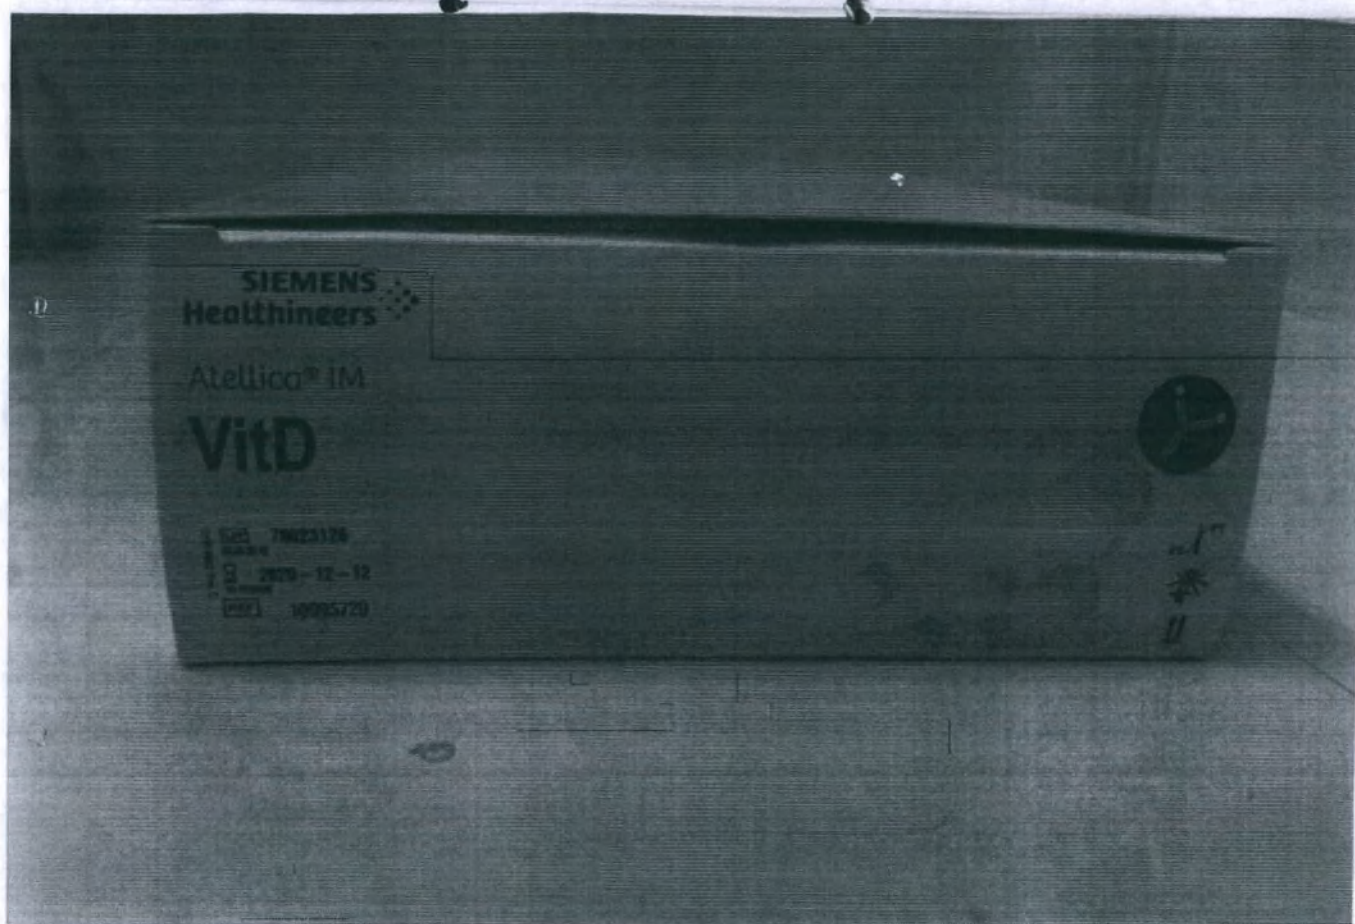


Рисунок 2. Набор реагентов для определения общего витамина D на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin D Total (Atellica IM VitD)): Фасовка 500 тестов. Общий вид

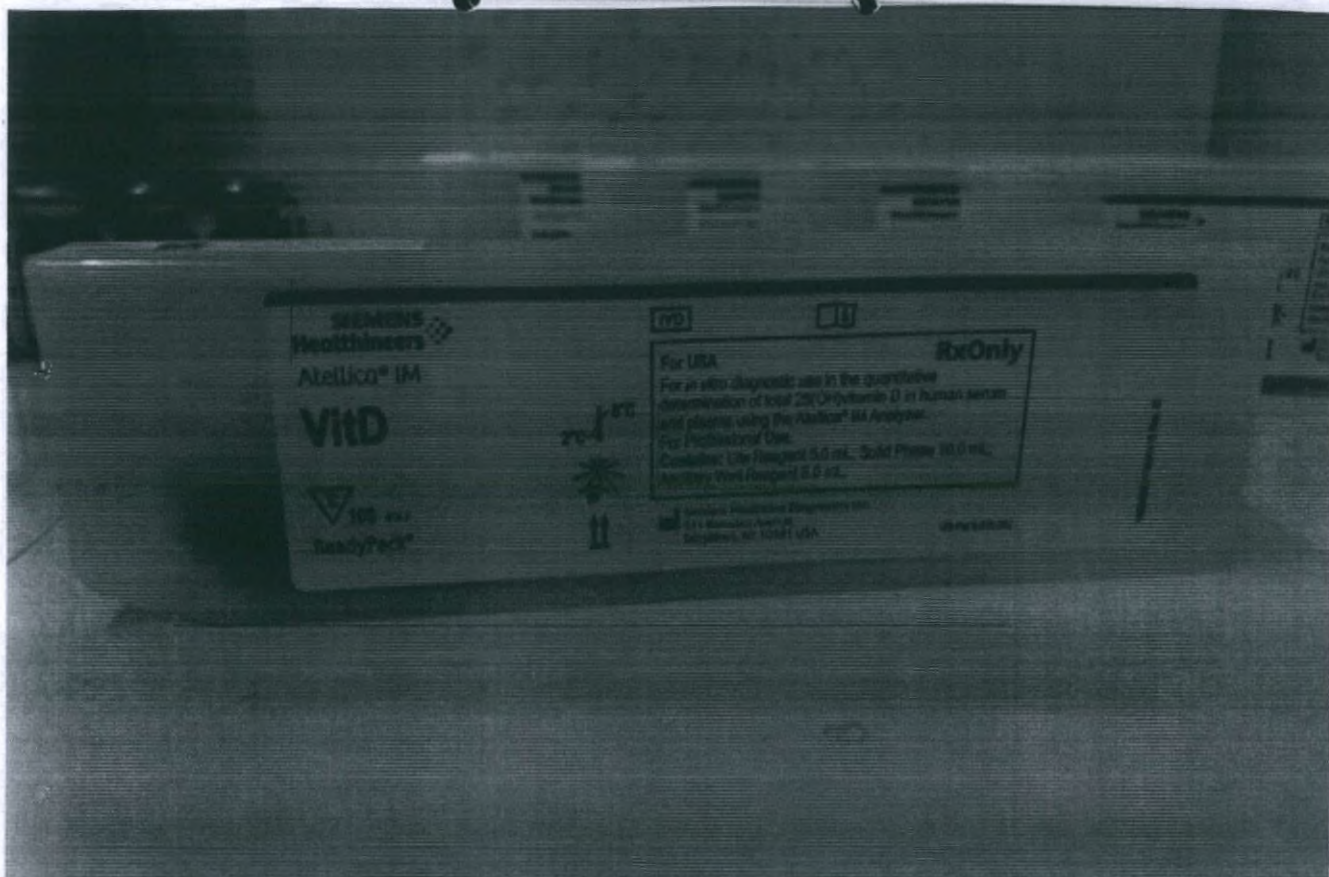


Рисунок 3. Набор реагентов для определения общего витамина D на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin D Total (Atellica IM VitD)): Первичный реагент Atellica IM VitD

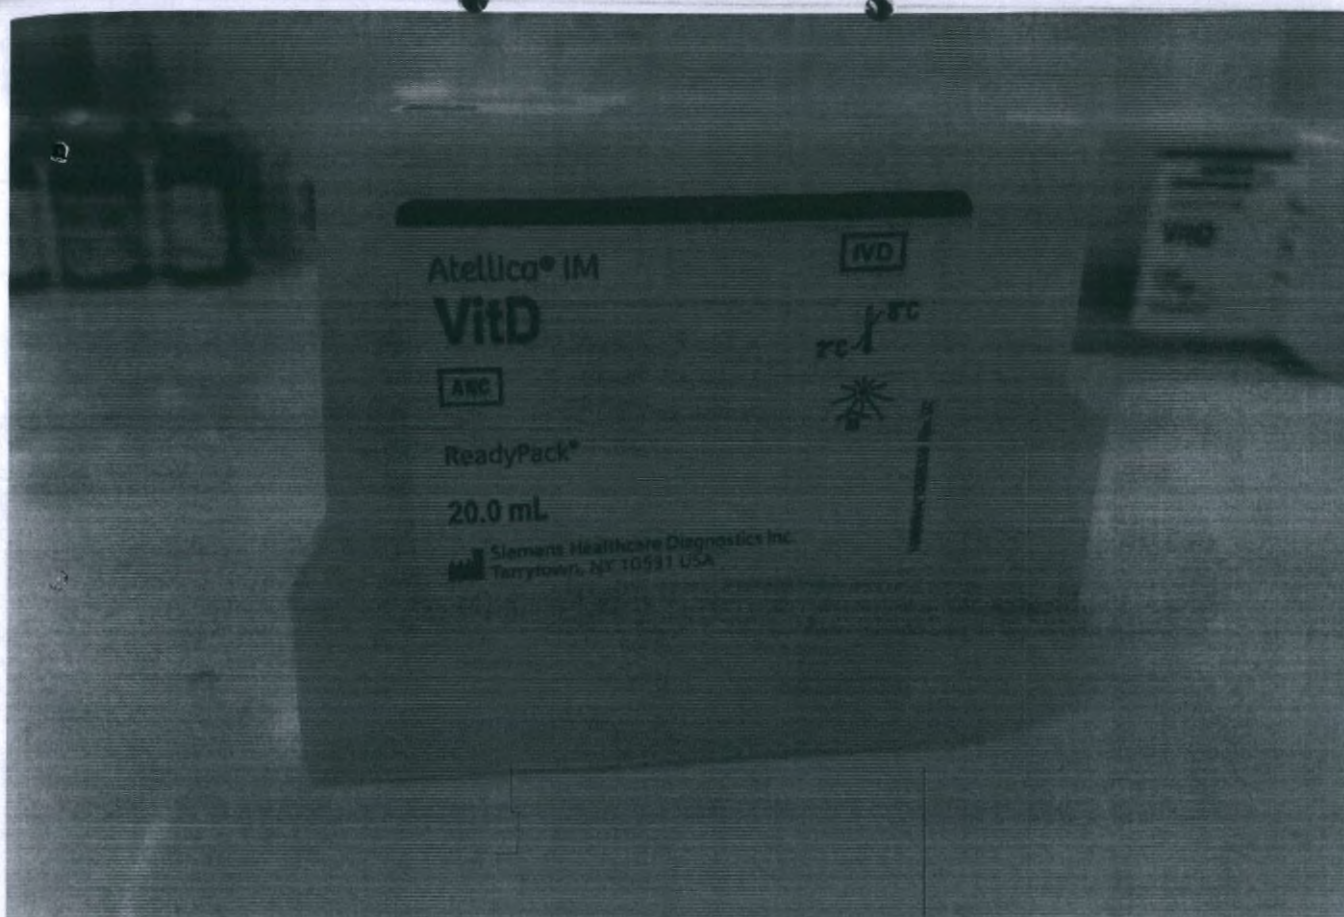


Рисунок 4. Набор реагентов для определения общего витамина D на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin D Total (Atellica IM VitD)): Дополнительный реагент Atellica IM VitD, 20,0 мл

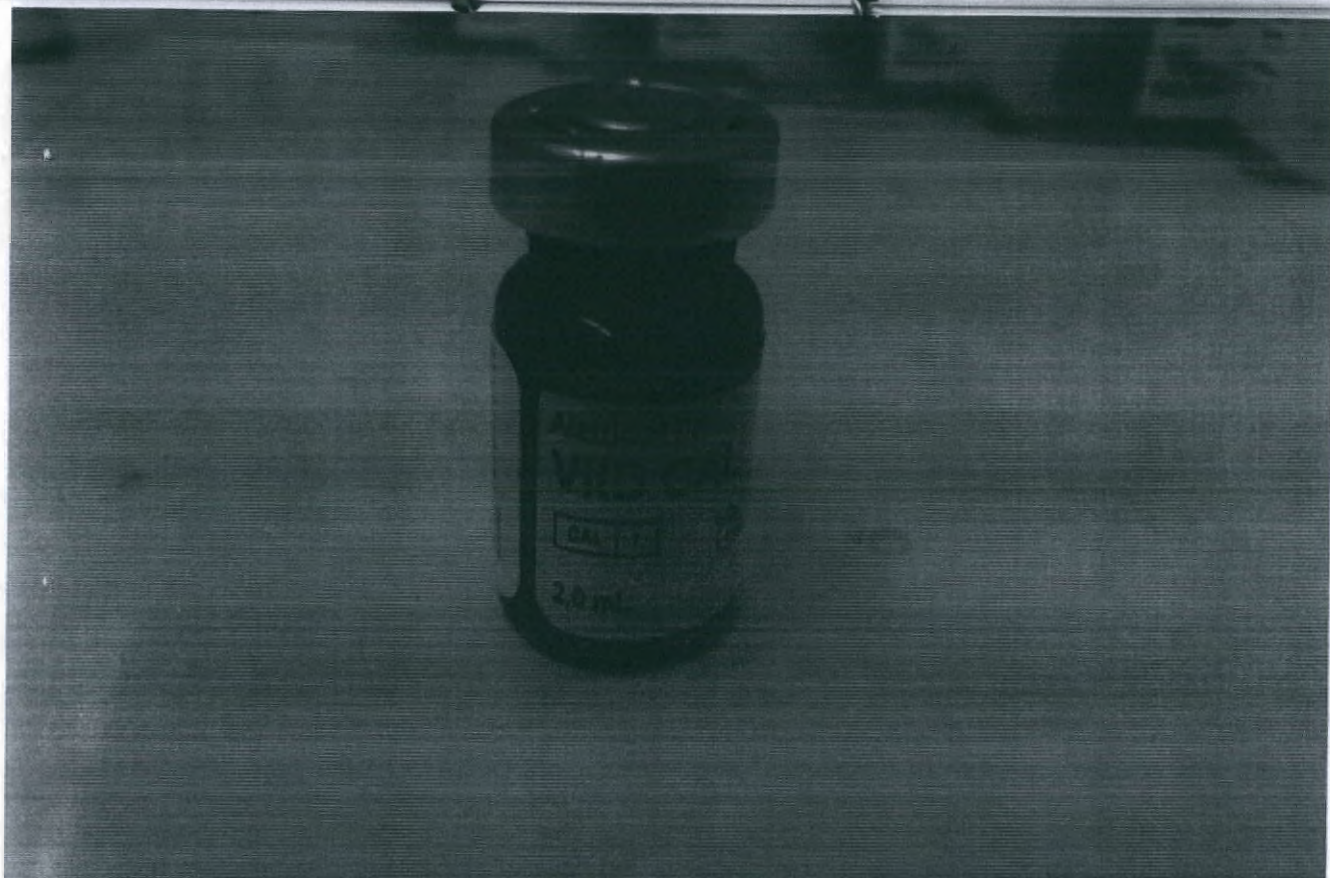


Рисунок 5. Набор реагентов для определения общего витамина D на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin D Total (Atellica IM VitD)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM VitD CAL L, 2,0 мл

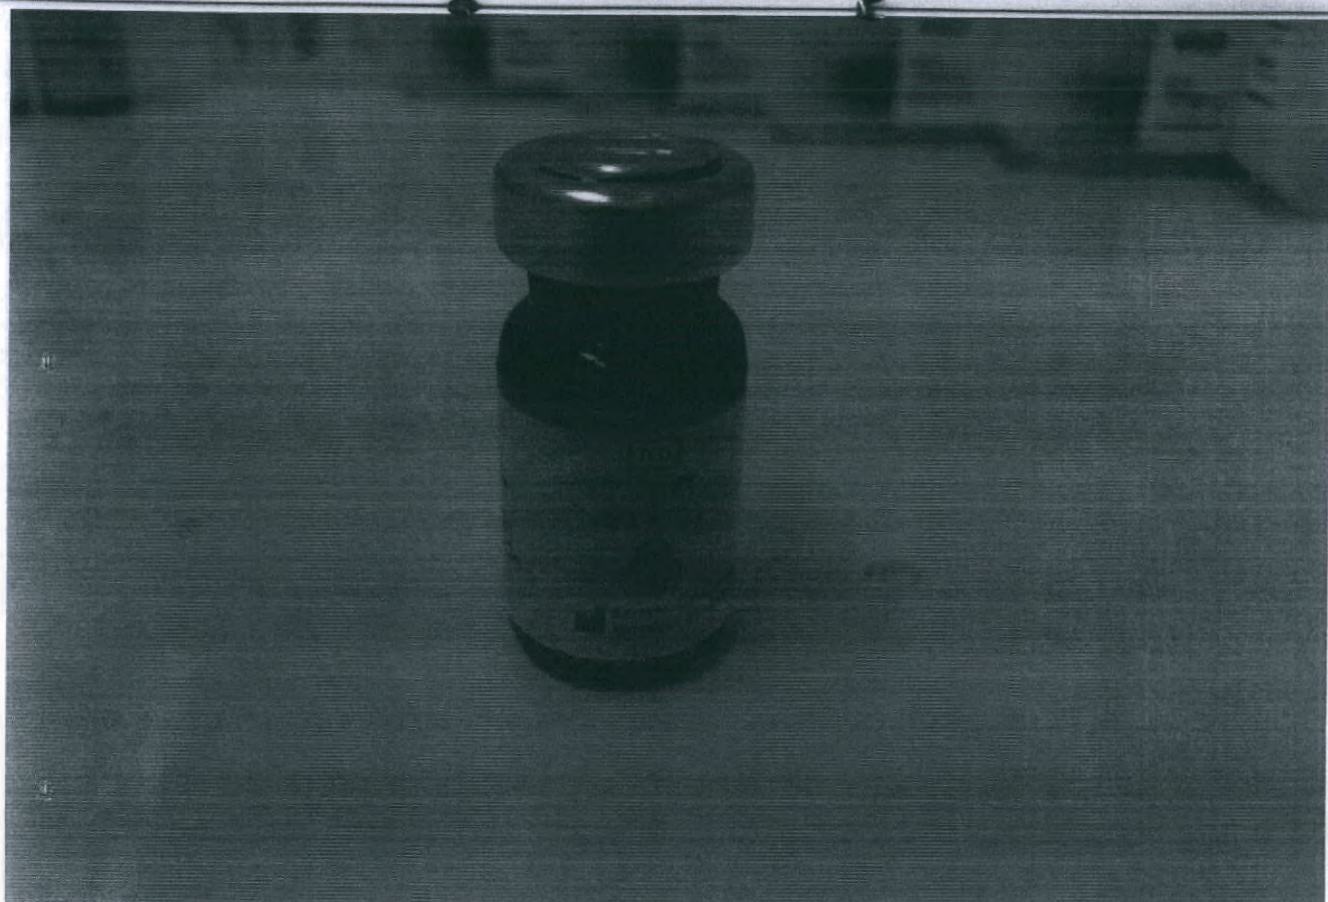


Рисунок 6. Набор реагентов для определения общего витамина D на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin D Total (Atellica IM VitD)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM VitD CAL L, 2,0 мл

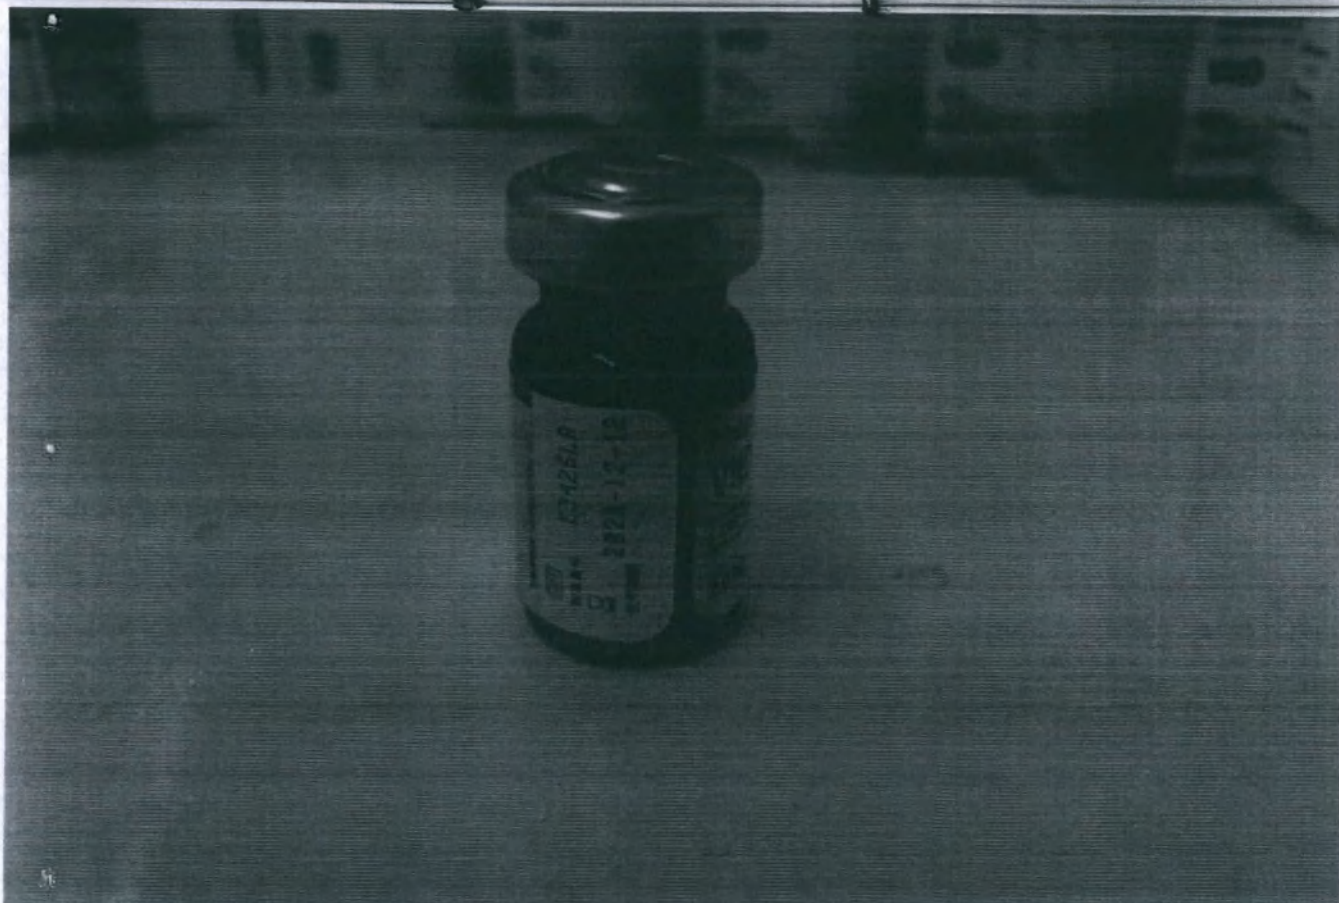


Рисунок 7. Набор реагентов для определения общего витамина D на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin D Total (Atellica IM VtD)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM VtD CAL L, 2.0 мл

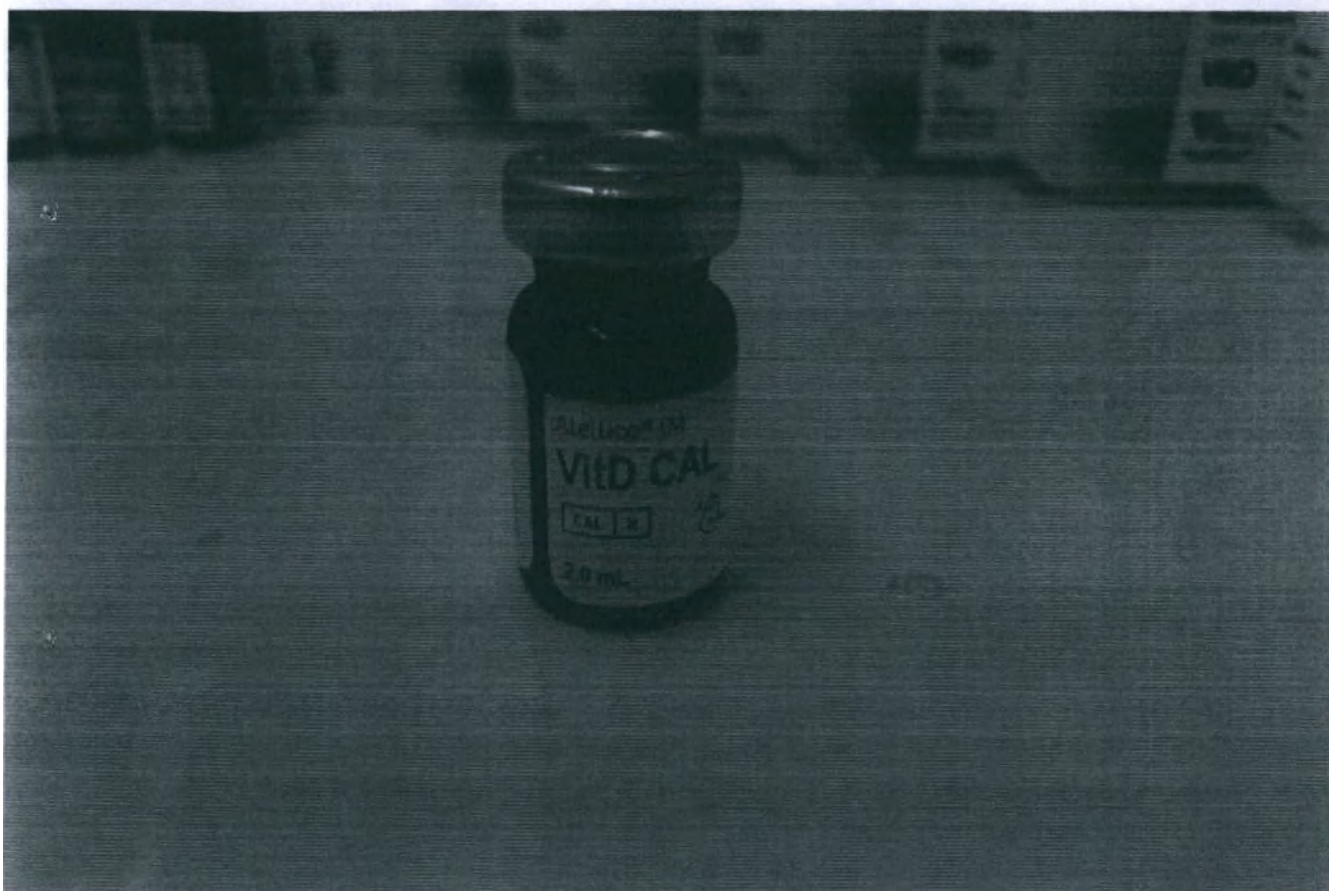


Рисунок 8. Набор реагентов для определения общего витамина D на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin D Total (Atellica IM VtD)): Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM VtD CAL H, 2.0 мл

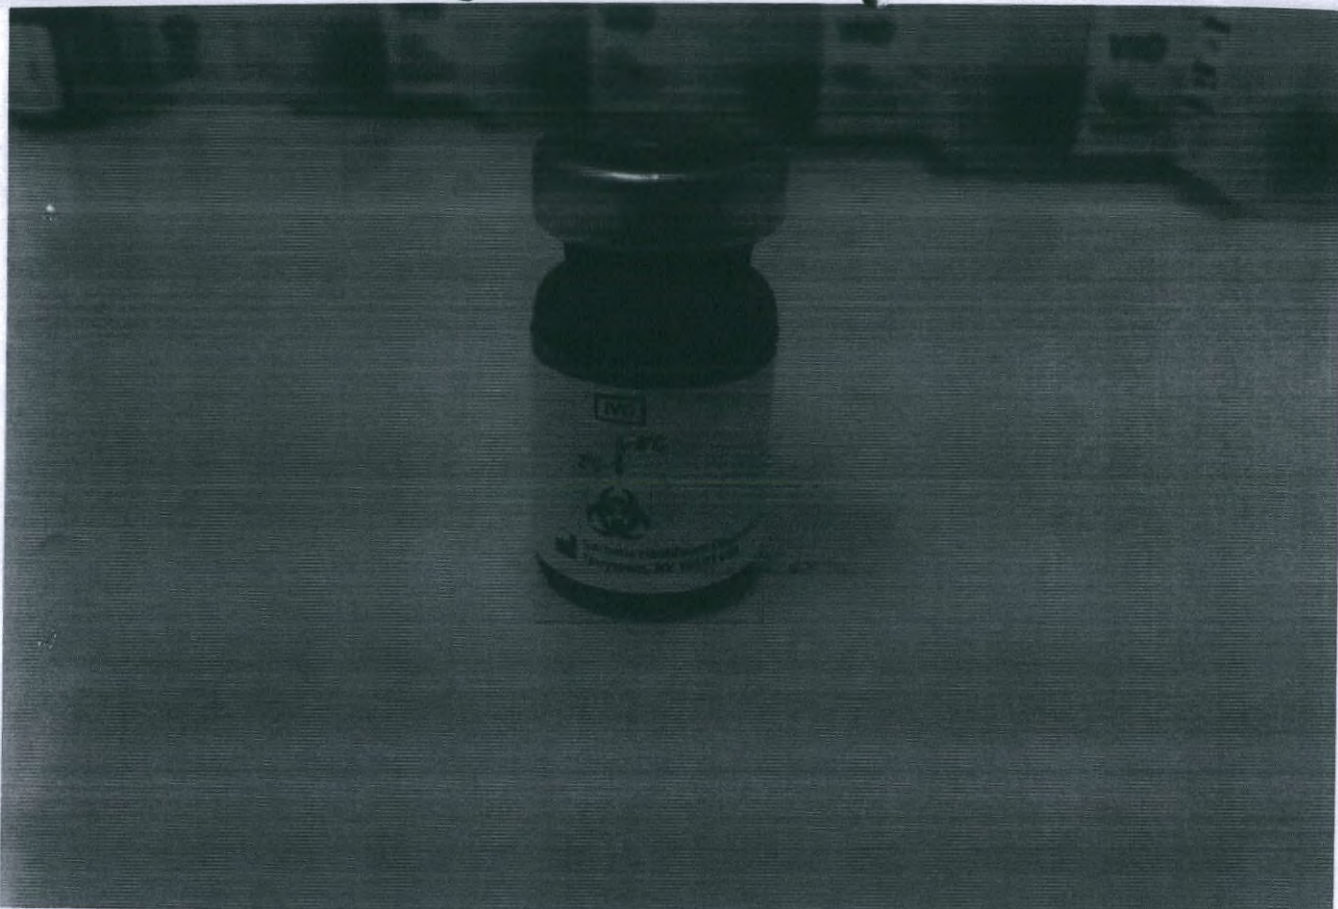


Рисунок 9. Набор реагентов для определения общего витамина D на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin D Total (Atellica IM VitD)): Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM VitD CAL H, 2,0 мл

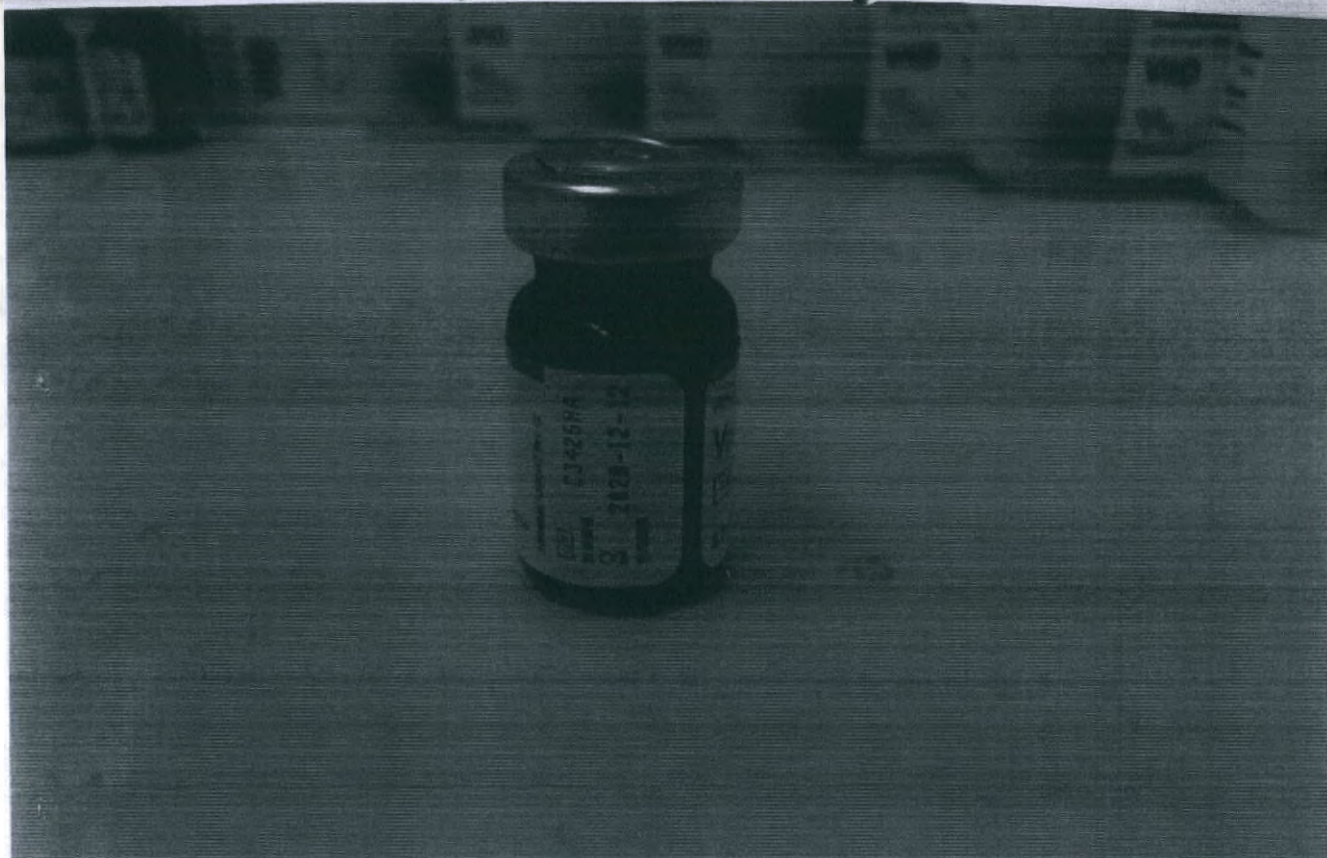


Рисунок 10. Набор реагентов для определения общего витамина D на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin D Total (Atellica IM VitD)): Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM VitD CAL H, 2,0 мл



Рисунок 11. Набор реагентов для определения общего витамина D на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin D Total (Atellica IM VitD)): Лист значений параметров серии калибратора



Рисунок 12. Набор реагентов для определения общего витамина D на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Vitamin D Total (Atellica IM VitD)): Вкладыш со штрих-кодом MC TDEF для Atellica IM VitD